


Фотографическое изображение медицинского изделия
«Материал стоматологический для герметизации фиссур UltraSeal XT hydro»
производства Ultradent Products Inc., США.

Фотографическое изображение упаковки варианта исполнения:

Материал стоматологический для герметизации фиссур UltraSeal XT hydro в составе:

- материал UltraSeal XT hydro цвета Opaque White или Natural в шприце по 1,2 мл. – 1 шт.;
- протравка Ultra-Etch в шприце по 1,2 мл. – 1 шт.;
- насадки Delivery tips 40 шт.: насадки Blue Micro Tips 20 шт. 1 уп. и насадки Inspiral Brush Tips 20 шт. 1 уп.;
- инструкция по применению Ultra-Etch – 1шт.;
- инструкция по применению UltraSeal XT hydro – 1шт.

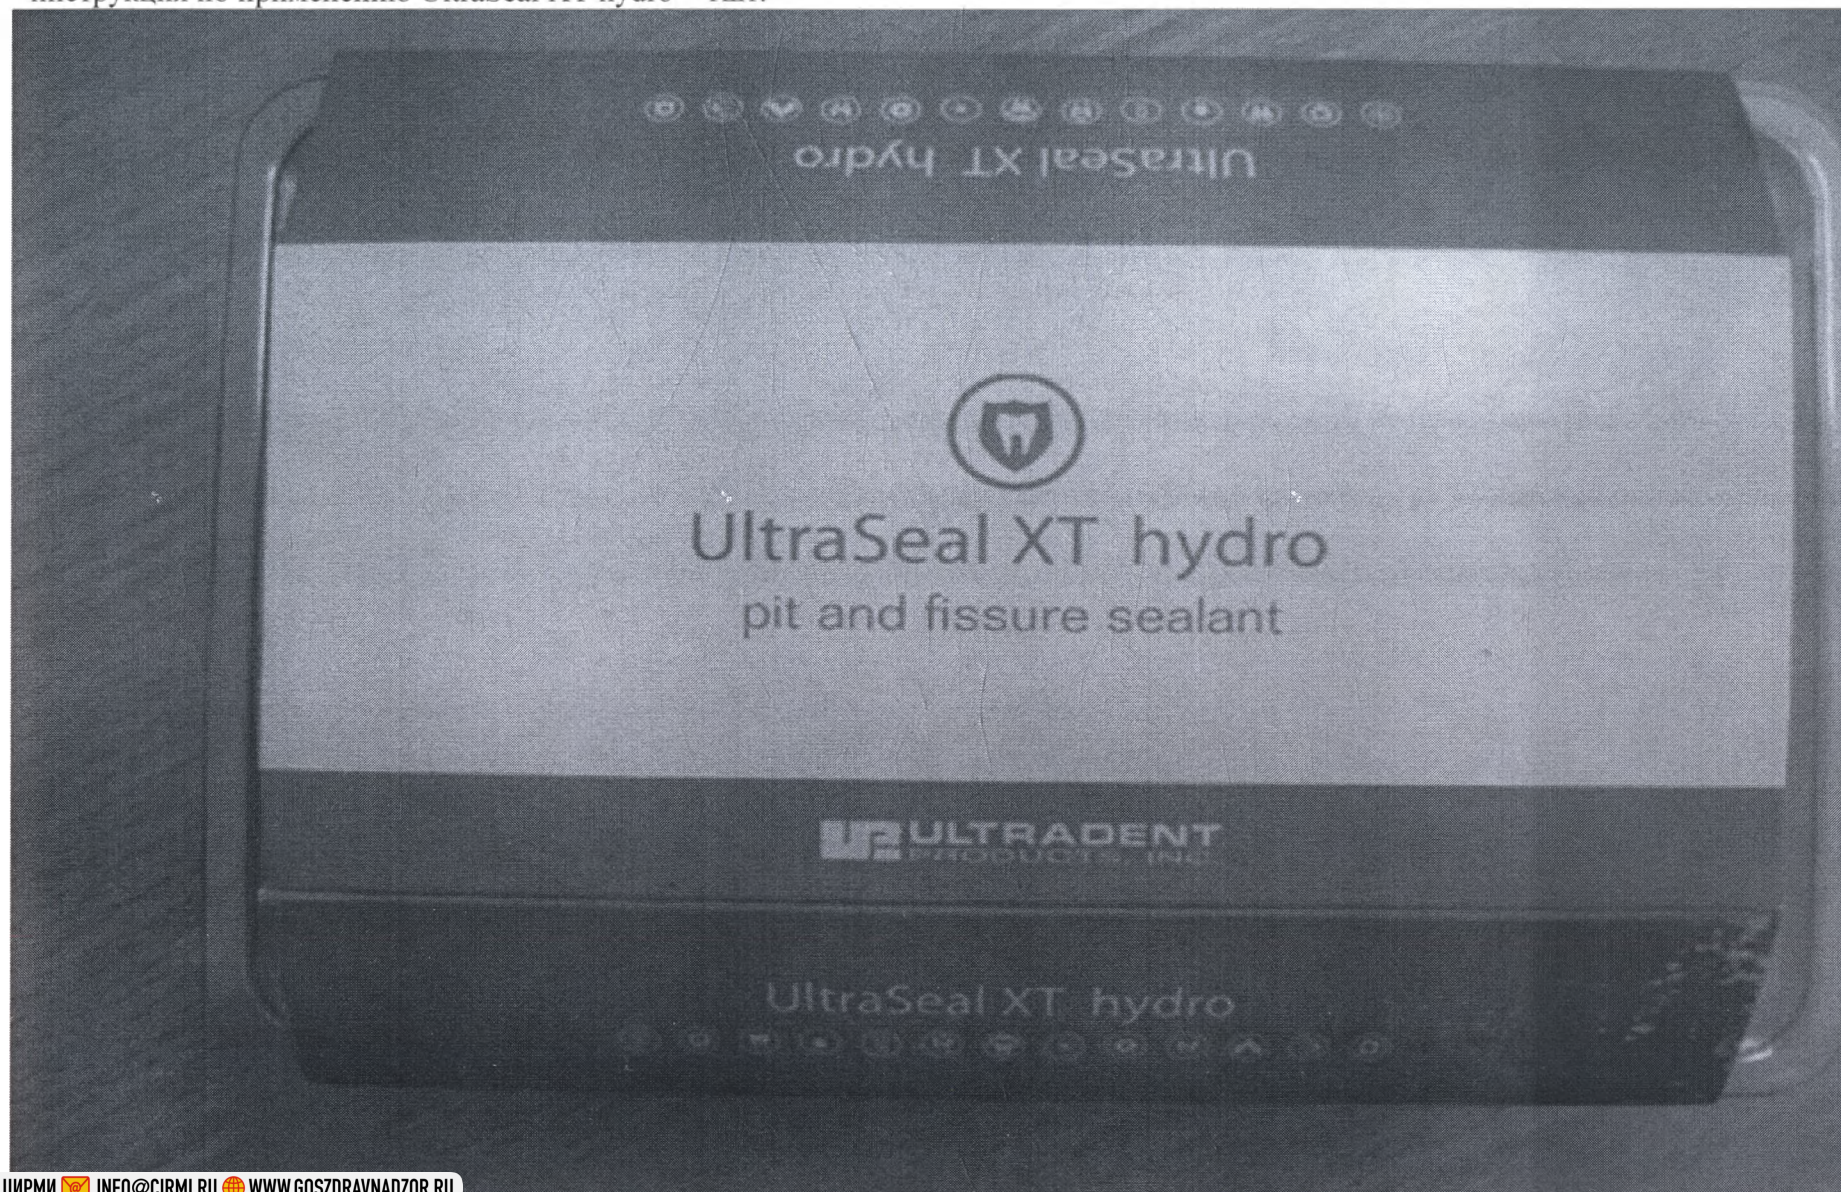

@ UltraSeal XT hydro

PII & Fissure Sealant


De Versieging für Gießbeton und Fissuren/FR-Sealant pour béton et fissures/NI-Sealant voor gips and fissuren/II-Sealante per scelti e fissure/ES-Sealante de fresas y fisuras/PT-Sealante de fissuras e fissuras/SV-Grout och fissurförsegling/DA-PR- og fissurförsegningsmateriale/IT-Fissuristen la riempire fessure/EL-Σφωρυστικό Ραβδόγων και Ορύσμων

CONTENTS:

- 1 - 1.2ml UltraSeal XT hydro
- 1 - 1.2ml Ultra-Tech*
- 40 - delivery tips
- DE - St. Sportbrunnenstraße/FR-emboute d'application/NI-application/PT-puntas aplic-
abais/ES-puntas dispensadoras/PT-pontas de aplicacao/SV-Spridar för applicering/
DA-Åpningsspidder/IT-Ventilabboni/NO-åpningssprøyer/EL-πυλιν

Manufactured by Ultraseal Products Inc.
505 West 10200 South, Suite 1000, West Jordan, UT 84086, USA
Made in USA Phone: 4 081115

ULTRASEAL

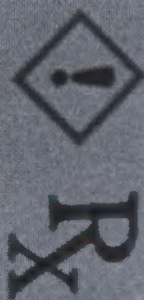

- 14 - Signs of toxic ingredients
15 - See Resonance for signs
16 - Category 2 ingredients
17 - See Resonance for signs
18 - Category 2 ingredients
19 - Hazardous ingredients
20 - Hazardous ingredients
21 - Hazardous ingredients
22 - Hazardous ingredients
23 - Hazardous ingredients
24 - Hazardous ingredients
25 - Hazardous ingredients
26 - Hazardous ingredients
27 - Hazardous ingredients
28 - Hazardous ingredients
29 - Hazardous ingredients
30 - Hazardous ingredients
31 - Hazardous ingredients
32 - Hazardous ingredients
33 - Hazardous ingredients
34 - Hazardous ingredients
35 - Hazardous ingredients
36 - Hazardous ingredients
37 - Hazardous ingredients
38 - Hazardous ingredients
39 - Hazardous ingredients
40 - Hazardous ingredients

REF-UP 3533-

2018-10-06

103/COB3205104182

2018046L

17180111

10/6046L

CE 0044

Ultraseal Products GmbH, Am Weinberg
Berg 30, 51149 Cologne, Germany



ULTRASEAL

000 502 5012




CE EC REP Ultracent Products GmbH
ULTRACENT PRODUKTE
51149 Westshover Berg 30
SOUTH COLOMBE ST SOUTH
KLAUS IN GERMANY
REF/UP 158 LOT BD2CR

For information on the complete
range of products, please refer
to the website www.ultracent.com
or call 0800 1 572 6700




ULTRACENT
ULTRACENT
ULTRACENT

REF/UP 710 LOT BD2VC

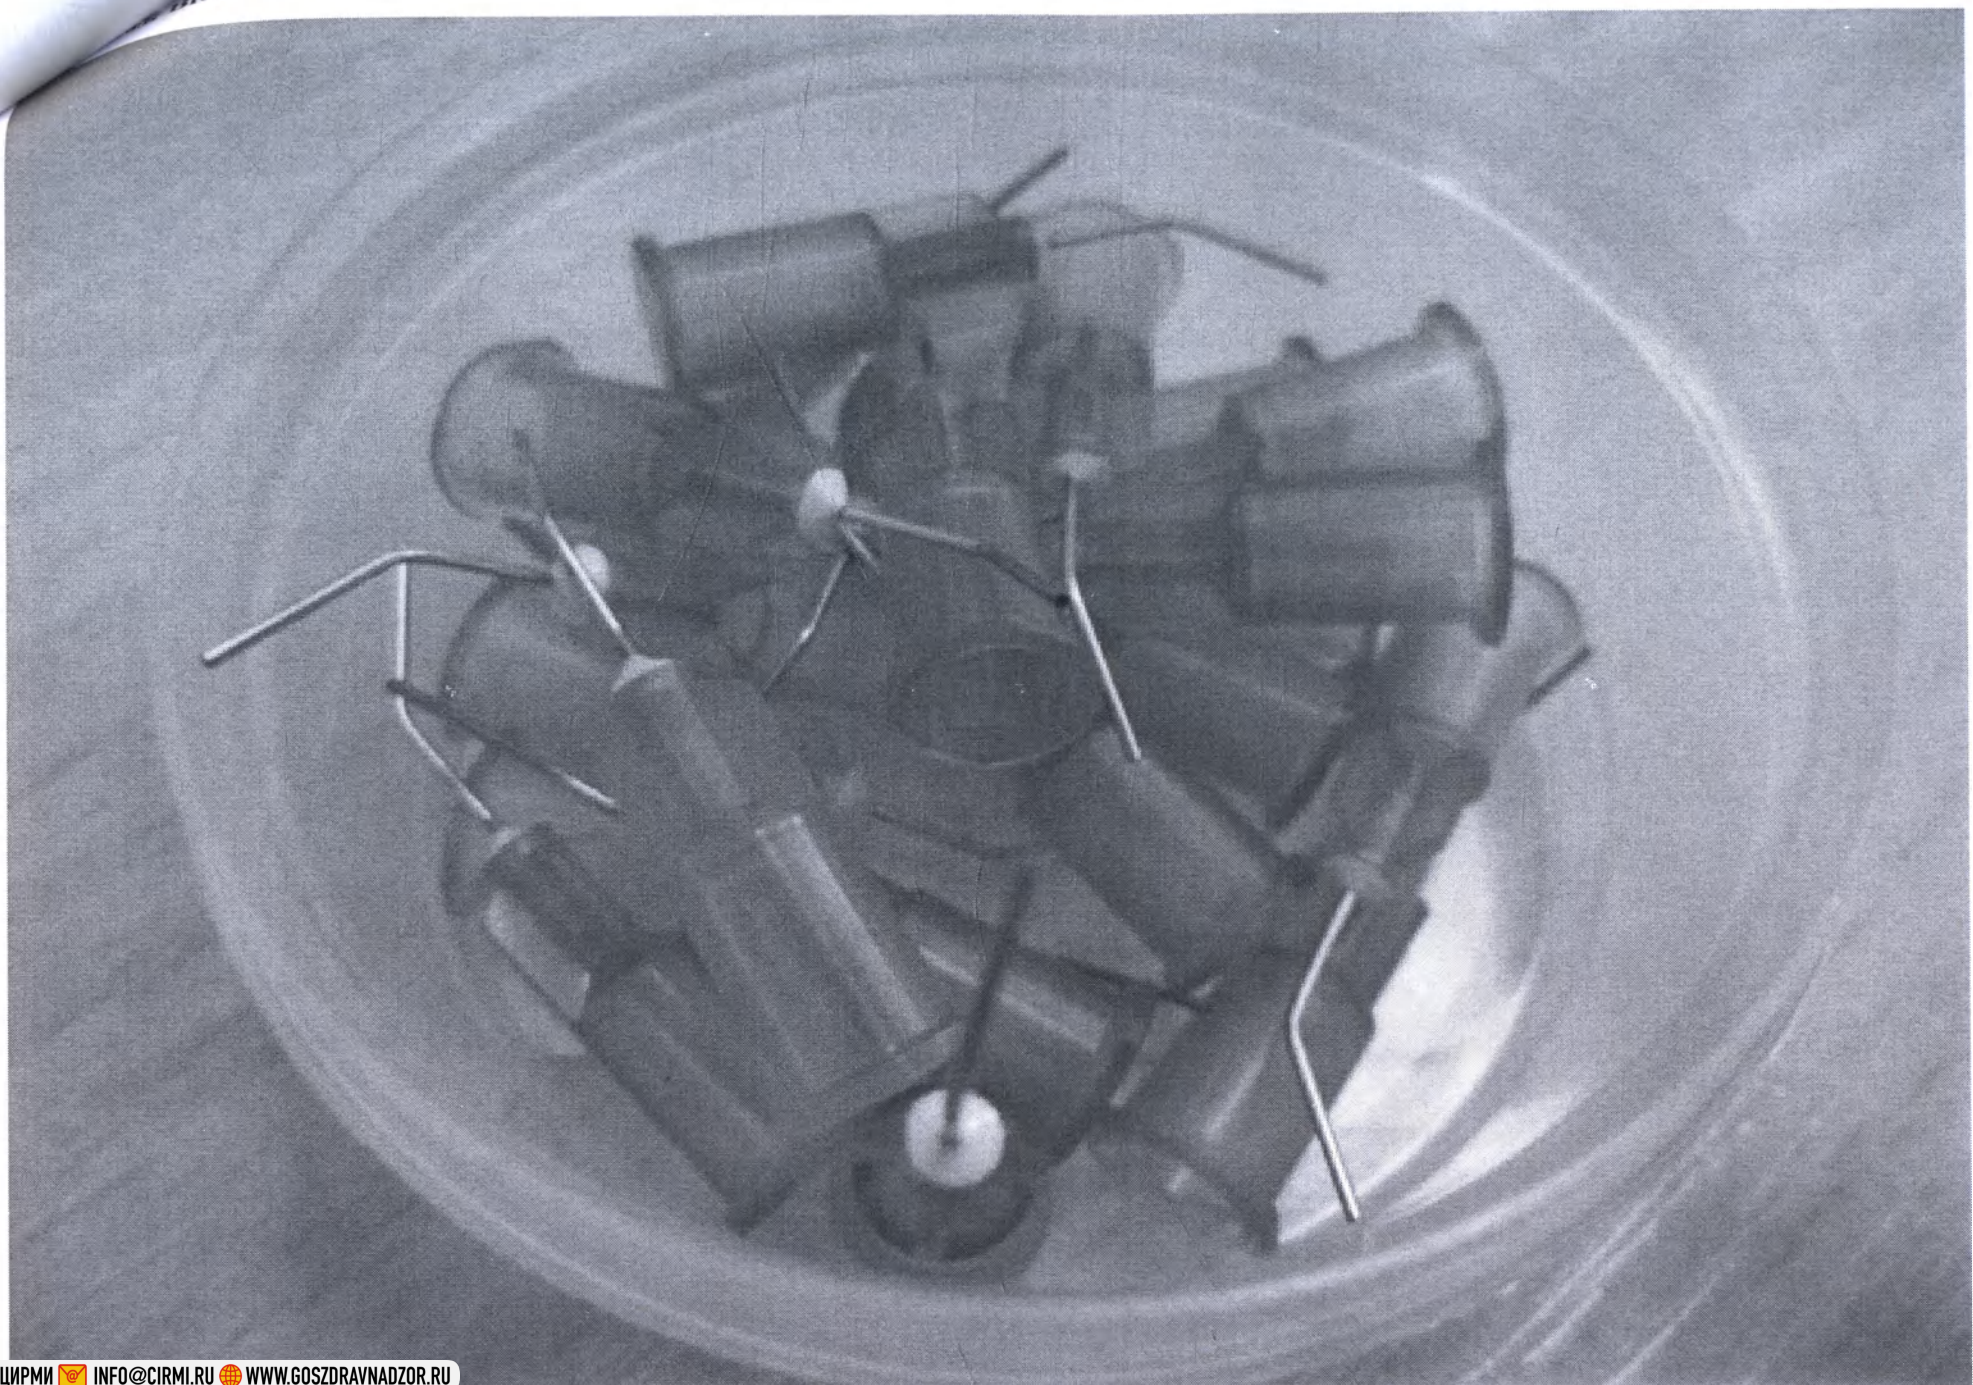





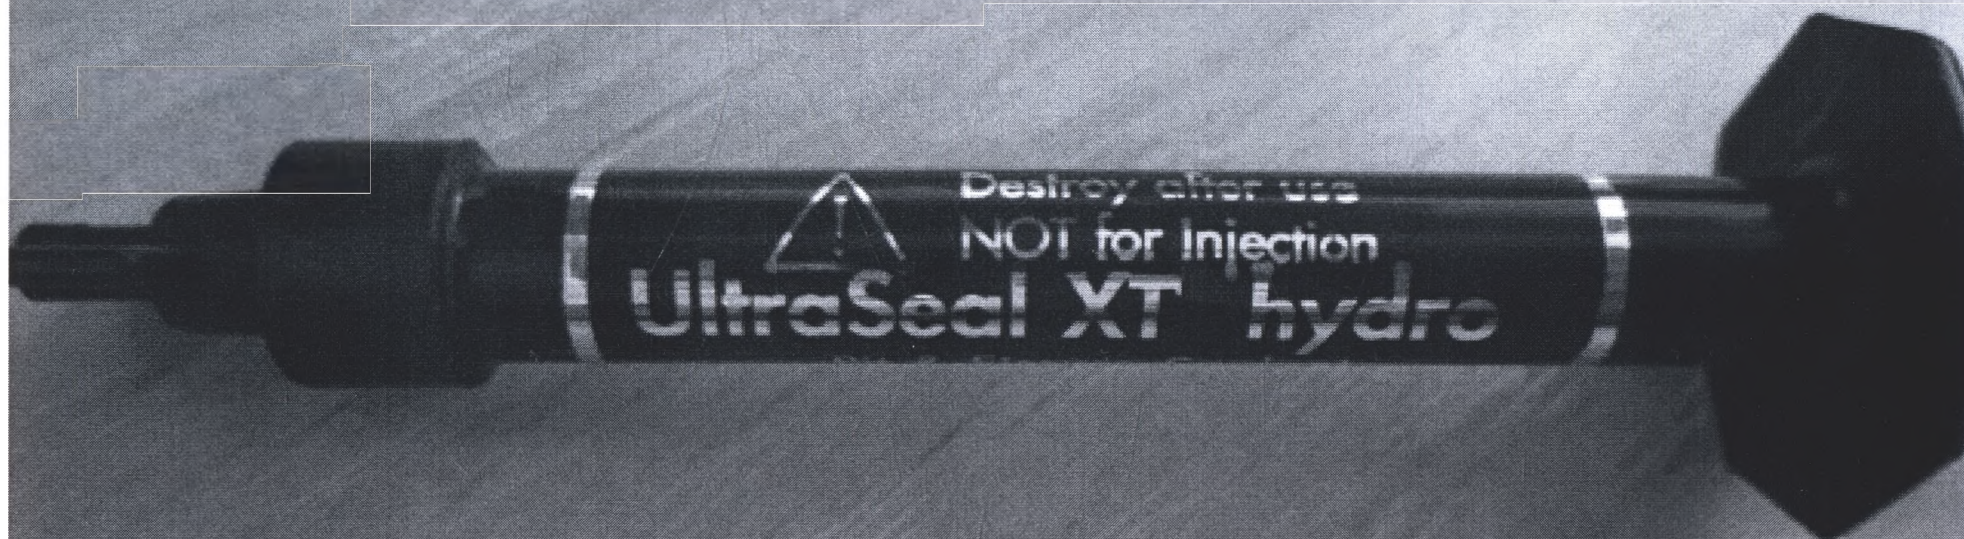

Внешнее изображение упаковки варианта исполнения:

Стоматологический для герметизации фиссур UltraSeal XT hydro Refill в составе:
 материал UltraSeal XT hydro цвета Opaque White или Natural в шприцах по 1, 2 мл. - 4 шт.;
 инструкция по применению UltraSeal XT hydro – 1шт.



Графическое изображение упаковки варианта исполнения:

стоматологический для герметизации фиссур UltraSeal XT hydro Econo Refill в составе:
материал UltraSeal XT hydro цвета Opaque White в шприцах по 1, 2 мл.- 20 шт.
инструкция по применению UltraSeal XT hydro – 1шт.



Генеральный директор
ООО Управляющая компания «Квадро»
управляющего ООО «Эс Ти Ай лент»

А.Г.Сафронова



Проект
по месту

