УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ПК Медицинские
Реабилитационные Системы»
_____Я.И. Гаврилов

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Кушетка бесконтактного гидромассажа «АКВАСМАРТ» по ТУ 32.50.21-001-24973017-2019»

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПК Медицинские Реабилитационные Системы» (ООО «ПК Медицинские Реабилитационные Системы»)

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

КУШЕТКА БЕСКОНТАКТНОГО ГИДРОМАССАЖА «АКВАСМАРТ»

ТУ 32.50.21-001-24973017-2019

Исполнение - 28Г8Х

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- ООО «ПК Медицинские Реабилитационные Системы»

Наименование изделия: Кушетка бесконтактного гидромассажа «АКВАСМАРТ», исполнение 28Г8Х

напряжение питания и частота переменного тока питающей сети - ~(220±22)В, 50 Гц;

потребляемая мощность, не более, кВА: 3,5

SN - 001

- 2019г (I квартал)

ТУ 32.50.21-001-24973017-2019

IP45

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КУШЕТКА БЕСКОНТАКТНОГО ГИДРОМАССАЖА «АКВАСМАРТ»

ТУ 32.50.21-001-24973017-2019

Исполнение - 24Г8Х

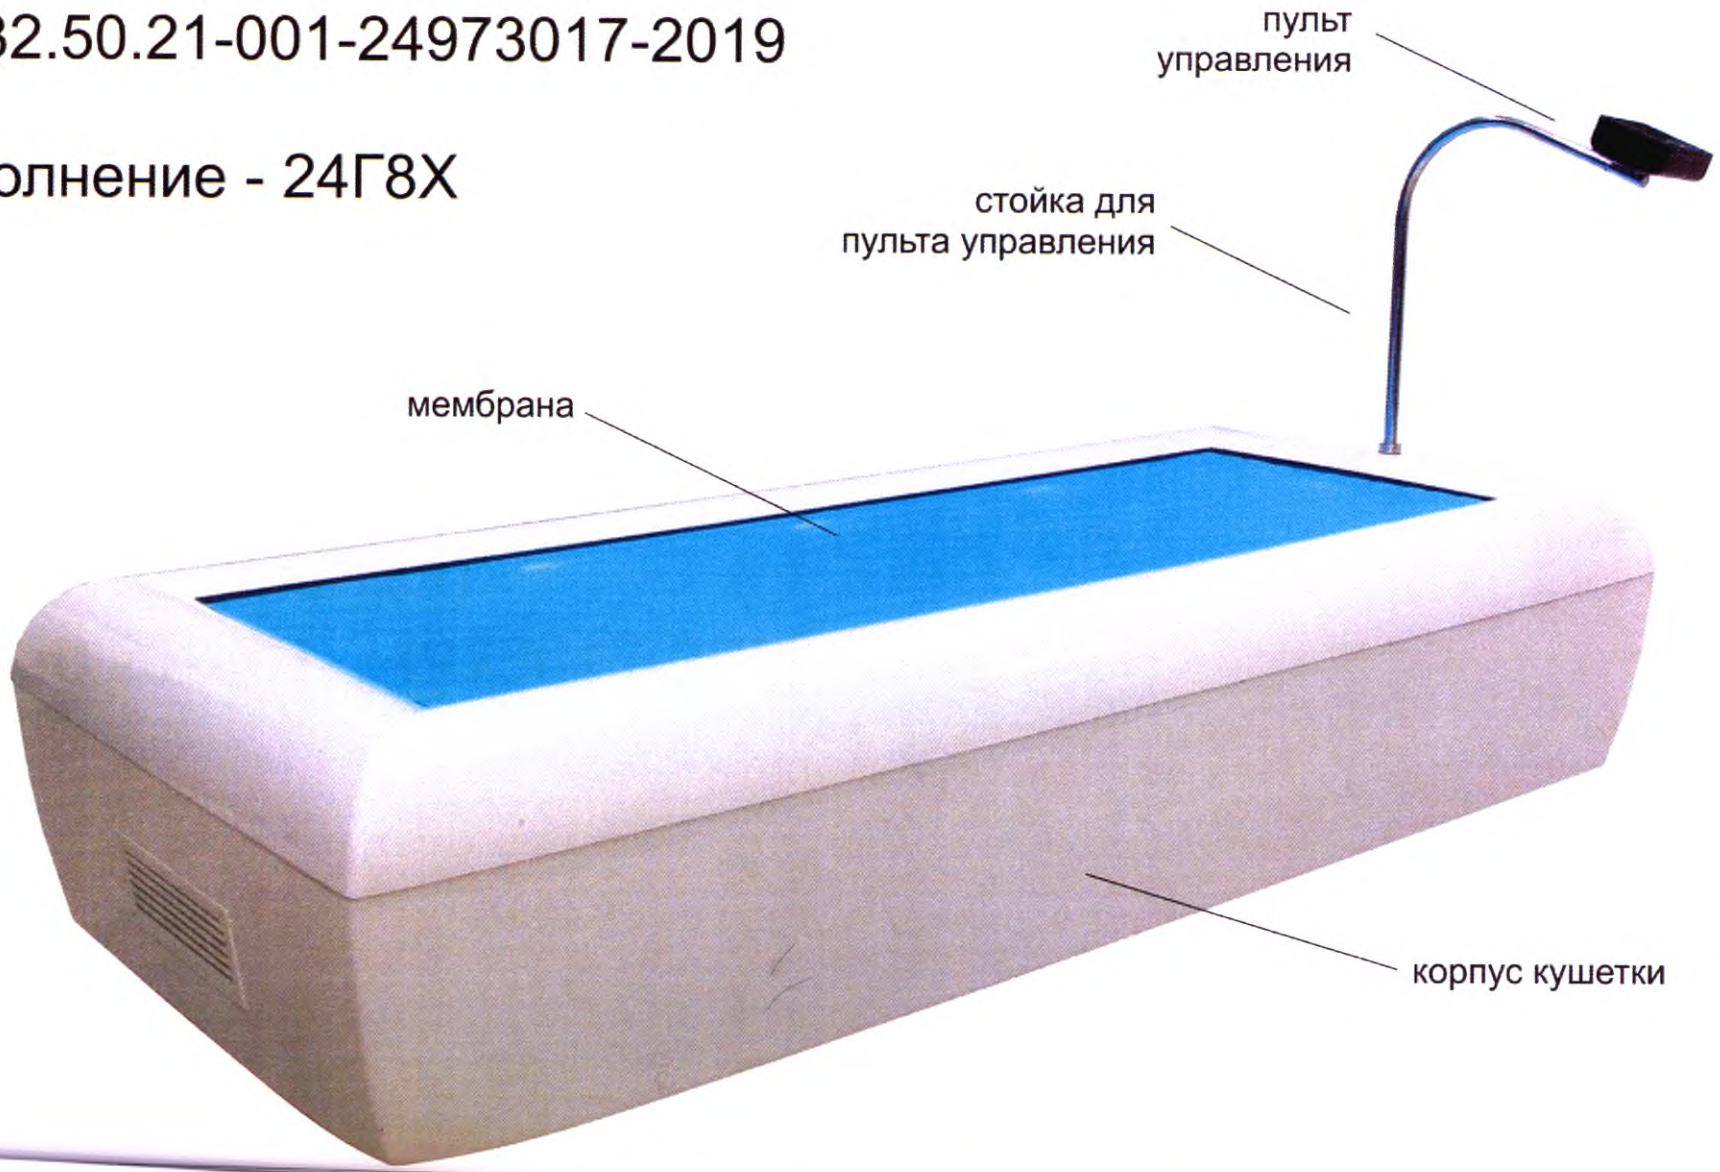

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- ООО «ПК Медицинские Реабилитационные Системы»

Наименование изделия: Кушетка бесконтактного гидромассажа «АКВАСМАРТ», исполнение 24Г8Х

напряжение питания и частота переменного тока питающей сети - ~(220±22)В, 50 Гц;

потребляемая мощность, не более, кВА: 3,5

SN - 001

- 2019г (I квартал)

ТУ 32.50.21-001-24973017-2019

IP45

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КУШЕТКА БЕСКОНТАКТНОГО ГИДРОМАССАЖА «АКВАСМАРТ»

ТУ 32.50.21-001-24973017-2019

Исполнение - 28Г

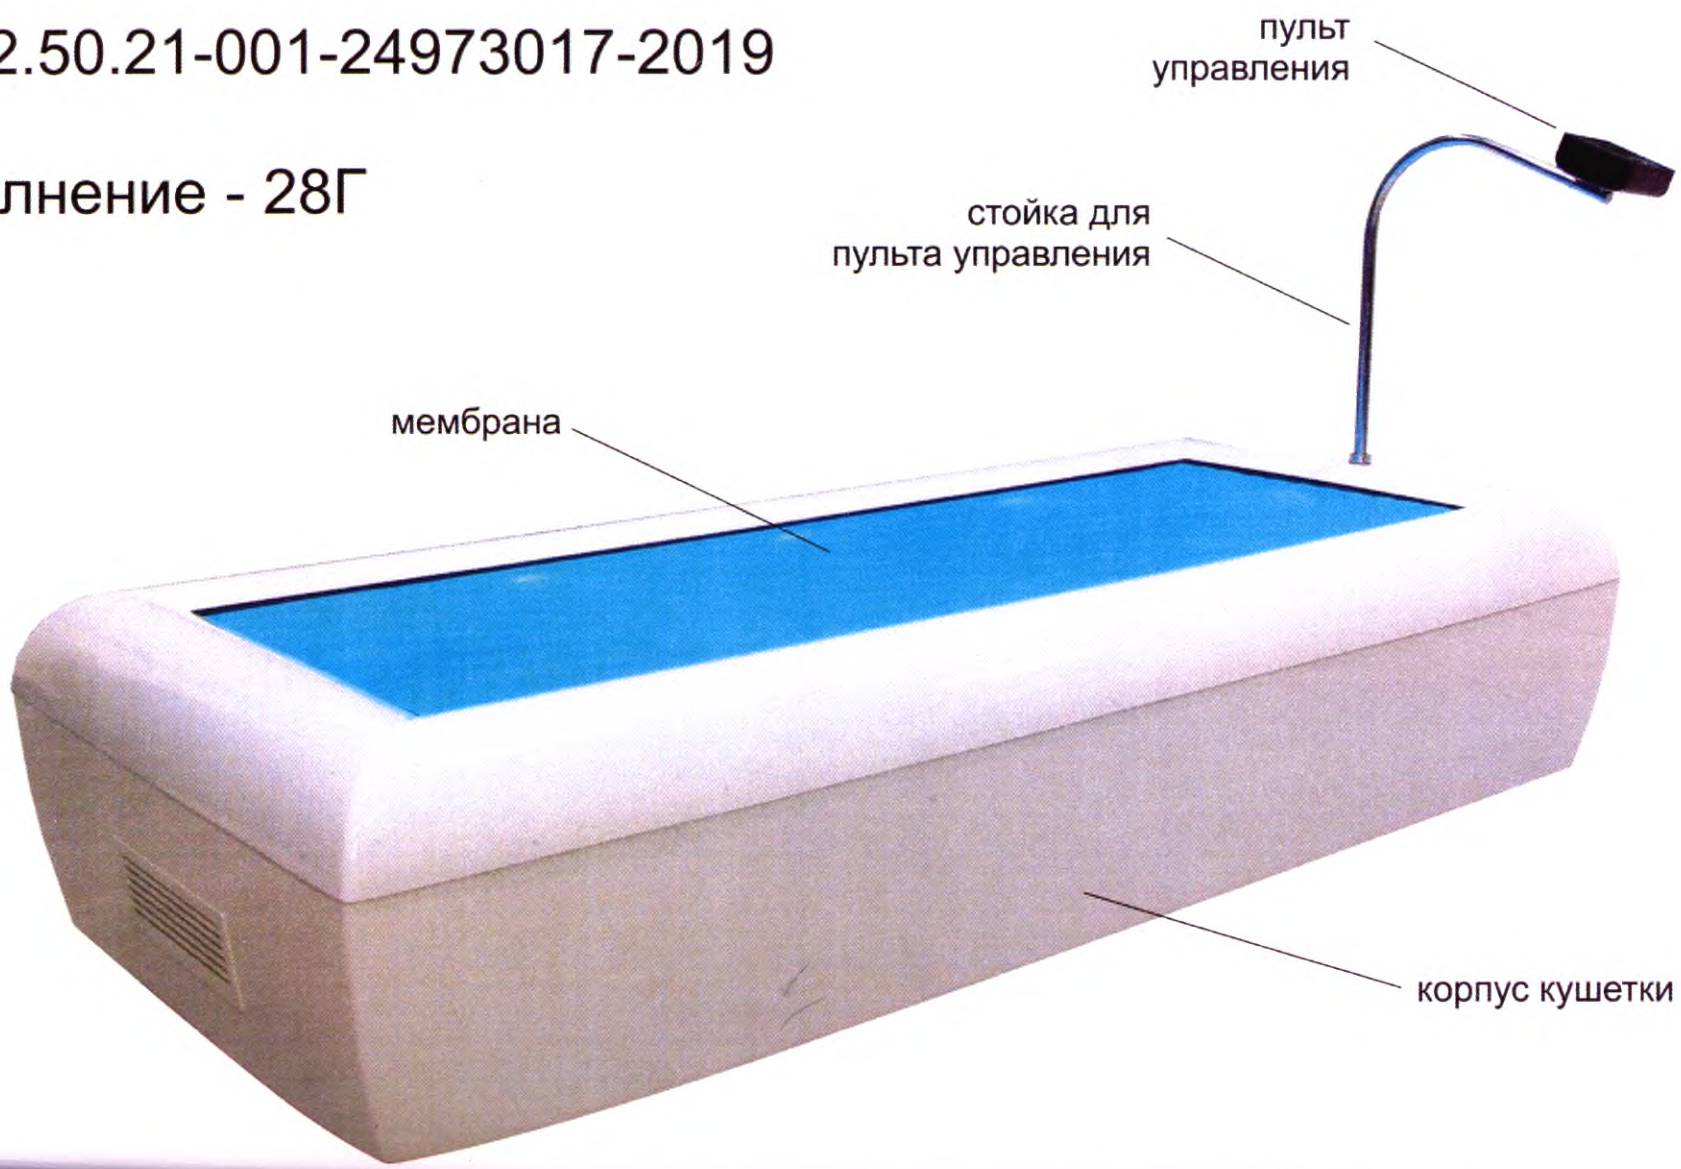

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- ООО «ПК Медицинские Реабилитационные Системы»

Наименование изделия: Кушетка бесконтактного гидромассажа «АКВАСМАРТ», исполнение 28Г

напряжение питания и частота переменного тока питающей сети - ~(220±22)В, 50 Гц;

потребляемая мощность, не более, кВА: 3,05

SN - 001

- 2019г (I квартал)

ТУ 32.50.21-001-24973017-2019

IP45

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КУШЕТКА БЕСКОНТАКТНОГО ГИДРОМАССАЖА «АКВАСМАРТ»

ТУ 32.50.21-001-24973017-2019

Исполнение - 24Г

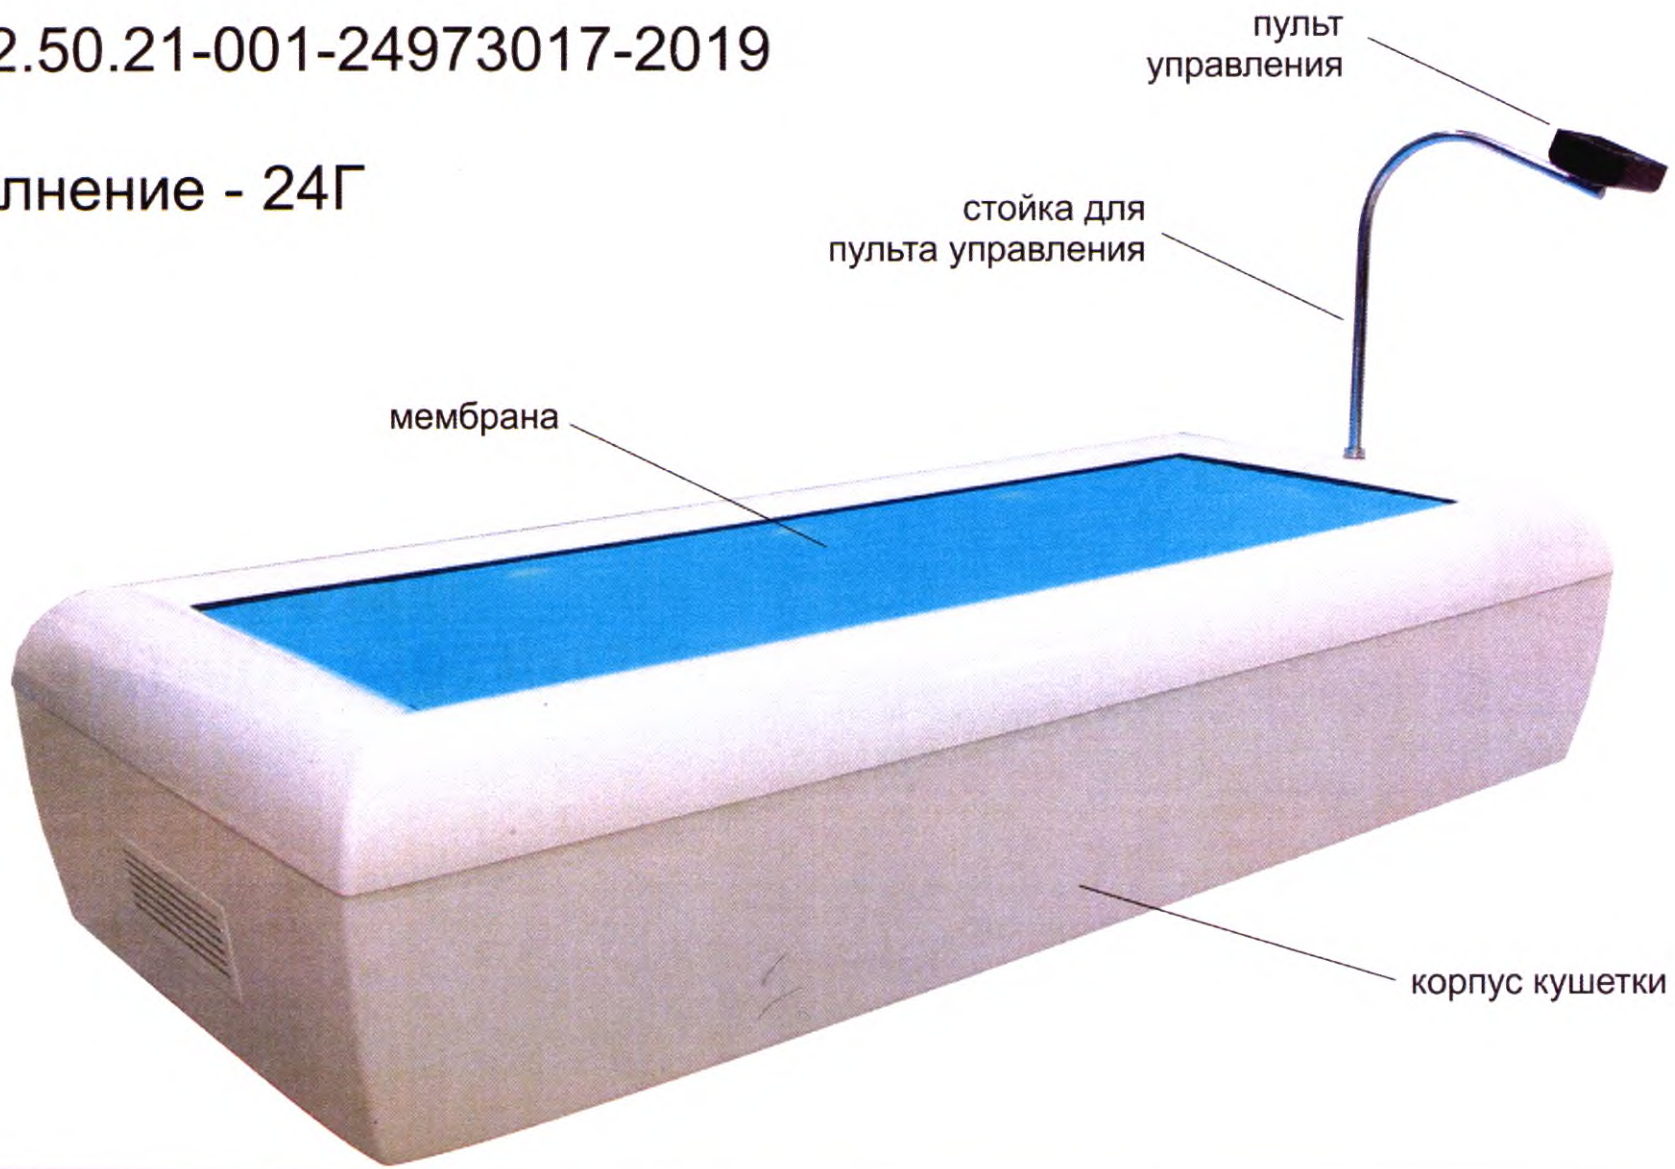

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- ООО «ПК Медицинские Реабилитационные Системы»

Наименование изделия: Кушетка бесконтактного гидромассажа «АКВАСМАРТ», исполнение 24Г

напряжение питания и частота переменного тока питающей сети - ~(220±22)В, 50 Гц;

потребляемая мощность, не более, кВА: 3,05

SN - 001

- 2019г (I квартал)

ТУ 32.50.21-001-24973017-2019

IP45

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КУШЕТКА БЕСКОНТАКТНОГО ГИДРОМАССАЖА «АКВАСМАРТ»

ТУ 32.50.21-001-24973017-2019

Исполнение - 12Г8Х

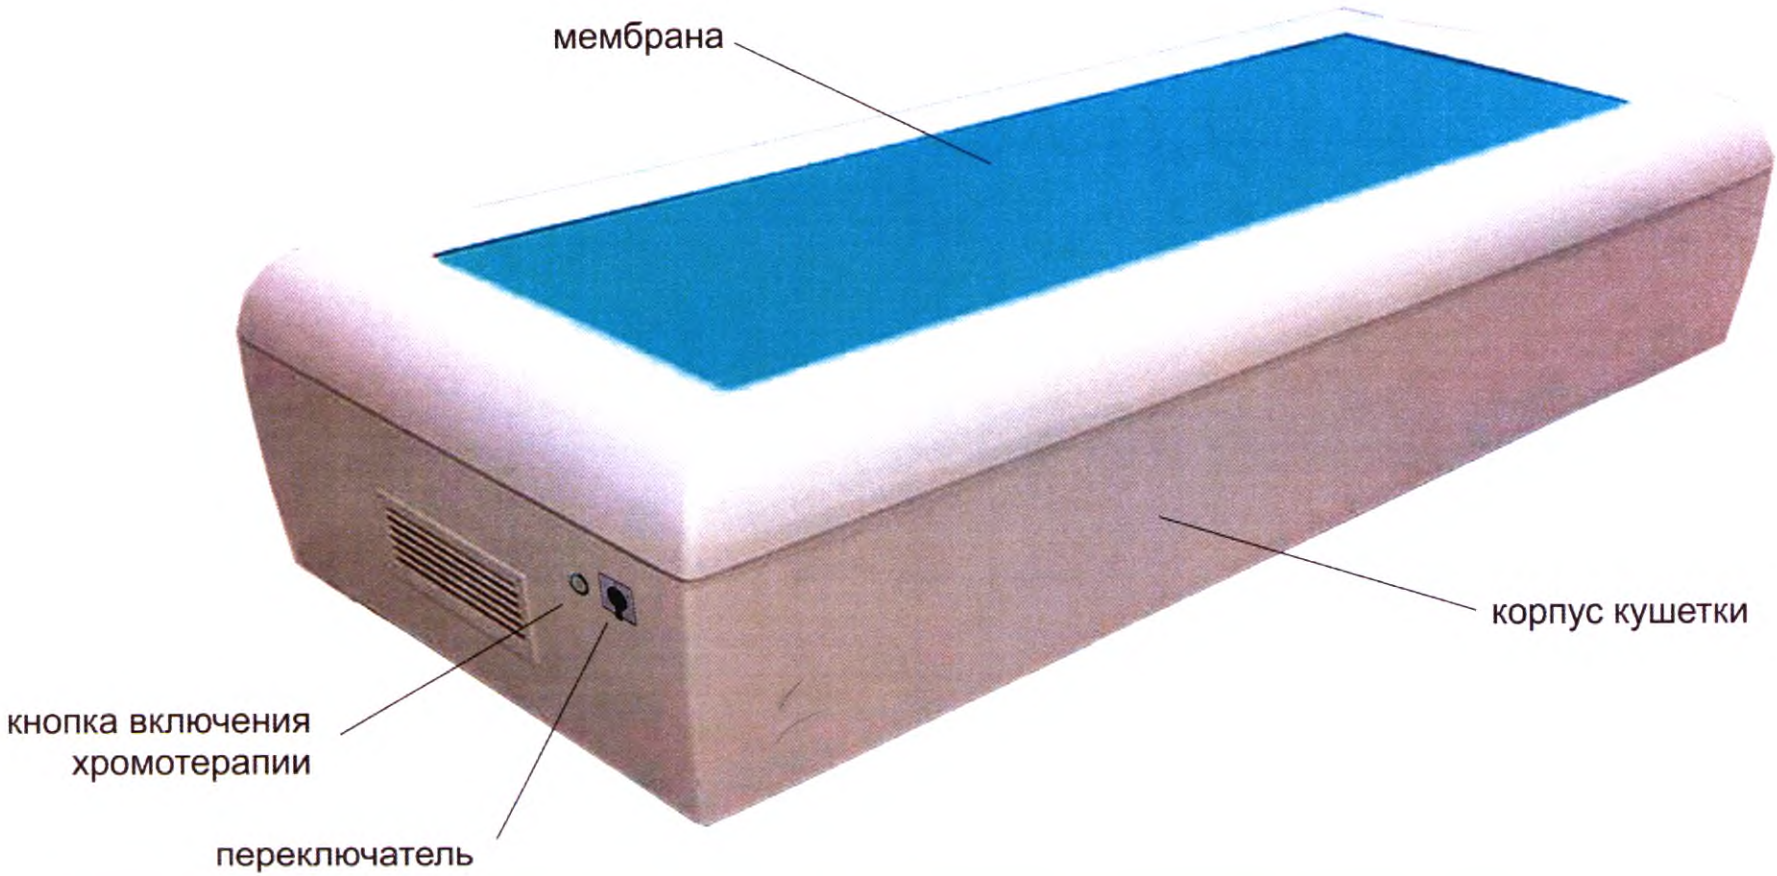

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- ООО «ПК Медицинские Реабилитационные Системы»

Наименование изделия: Кушетка бесконтактного гидромассажа «АКВАСМАРТ», исполнение 12Г8Х

напряжение питания и частота переменного тока питающей сети - ~(220±22)В, 50 Гц;

потребляемая мощность, не более, кВА: 3,5

SN - 001

- 2019г (I квартал)

ТУ 32.50.21-001-24973017-2019

IP45

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КУШЕТКА БЕСКОНТАКТНОГО ГИДРОМАССАЖА «АКВАСМАРТ»

ТУ 32.50.21-001-24973017-2019

Исполнение - 12Г

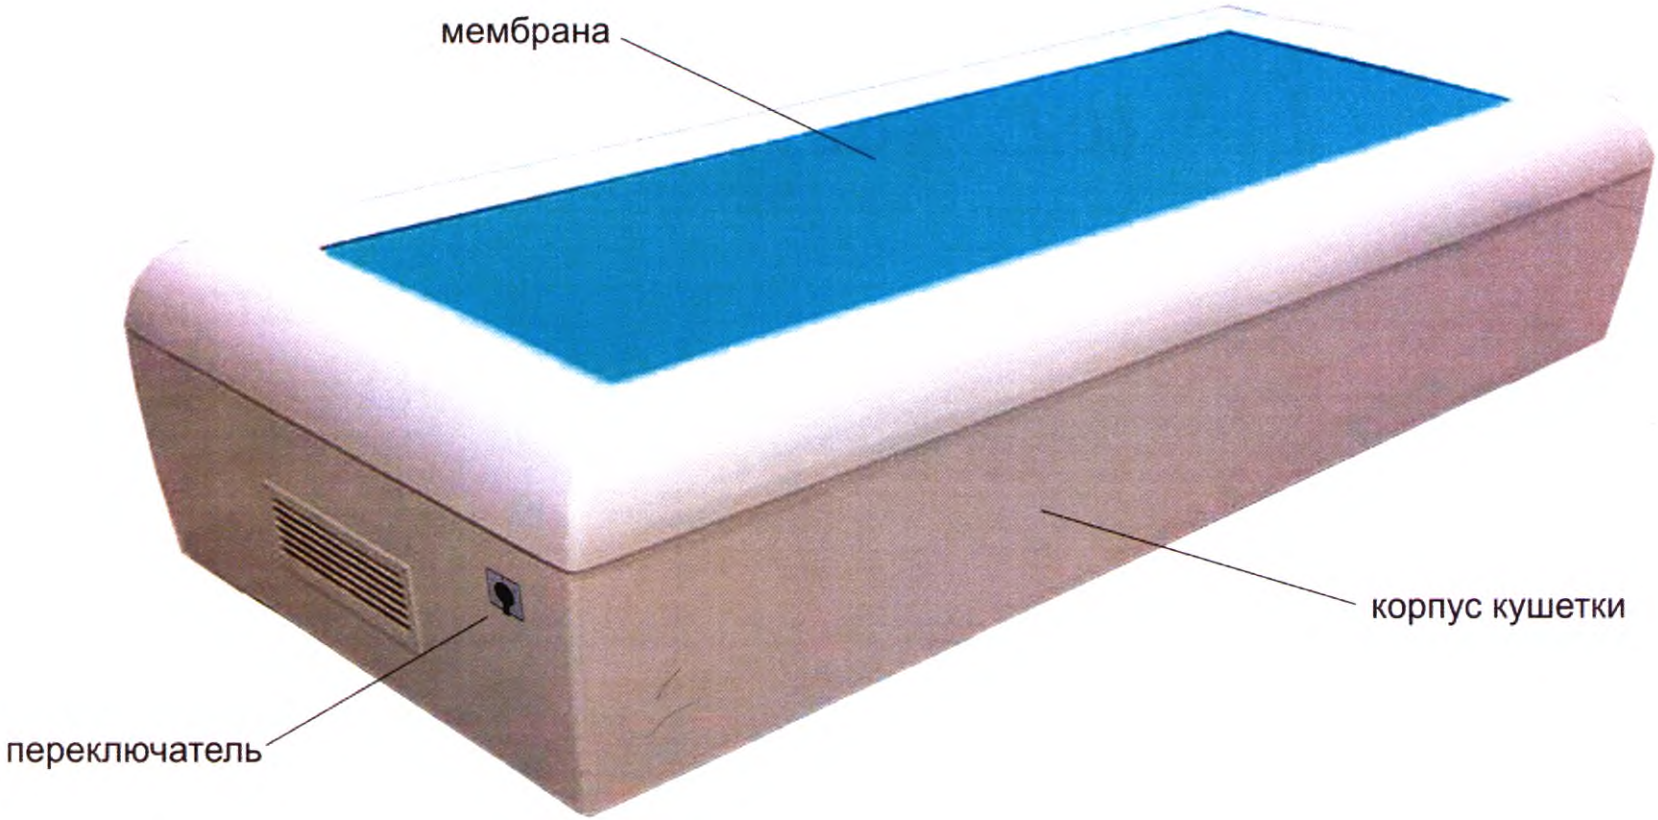

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- ООО «ПК Медицинские Реабилитационные Системы»

Наименование изделия: Кушетка бесконтактного гидромассажа «АКВАСМАРТ», исполнение 12Г

напряжение питания и частота переменного тока питающей сети - ~(220±22)В, 50 Гц;

потребляемая мощность, не более, кВА: 3,05

SN - 001

- 2019г (I квартал)

ТУ 32.50.21-001-24973017-2019

IP45

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КУШЕТКА БЕСКОНТАКТНОГО ГИДРОМАССАЖА «АКВАСМАРТ»

ТУ 32.50.21-001-24973017-2019

Исполнение - 8Г6Х

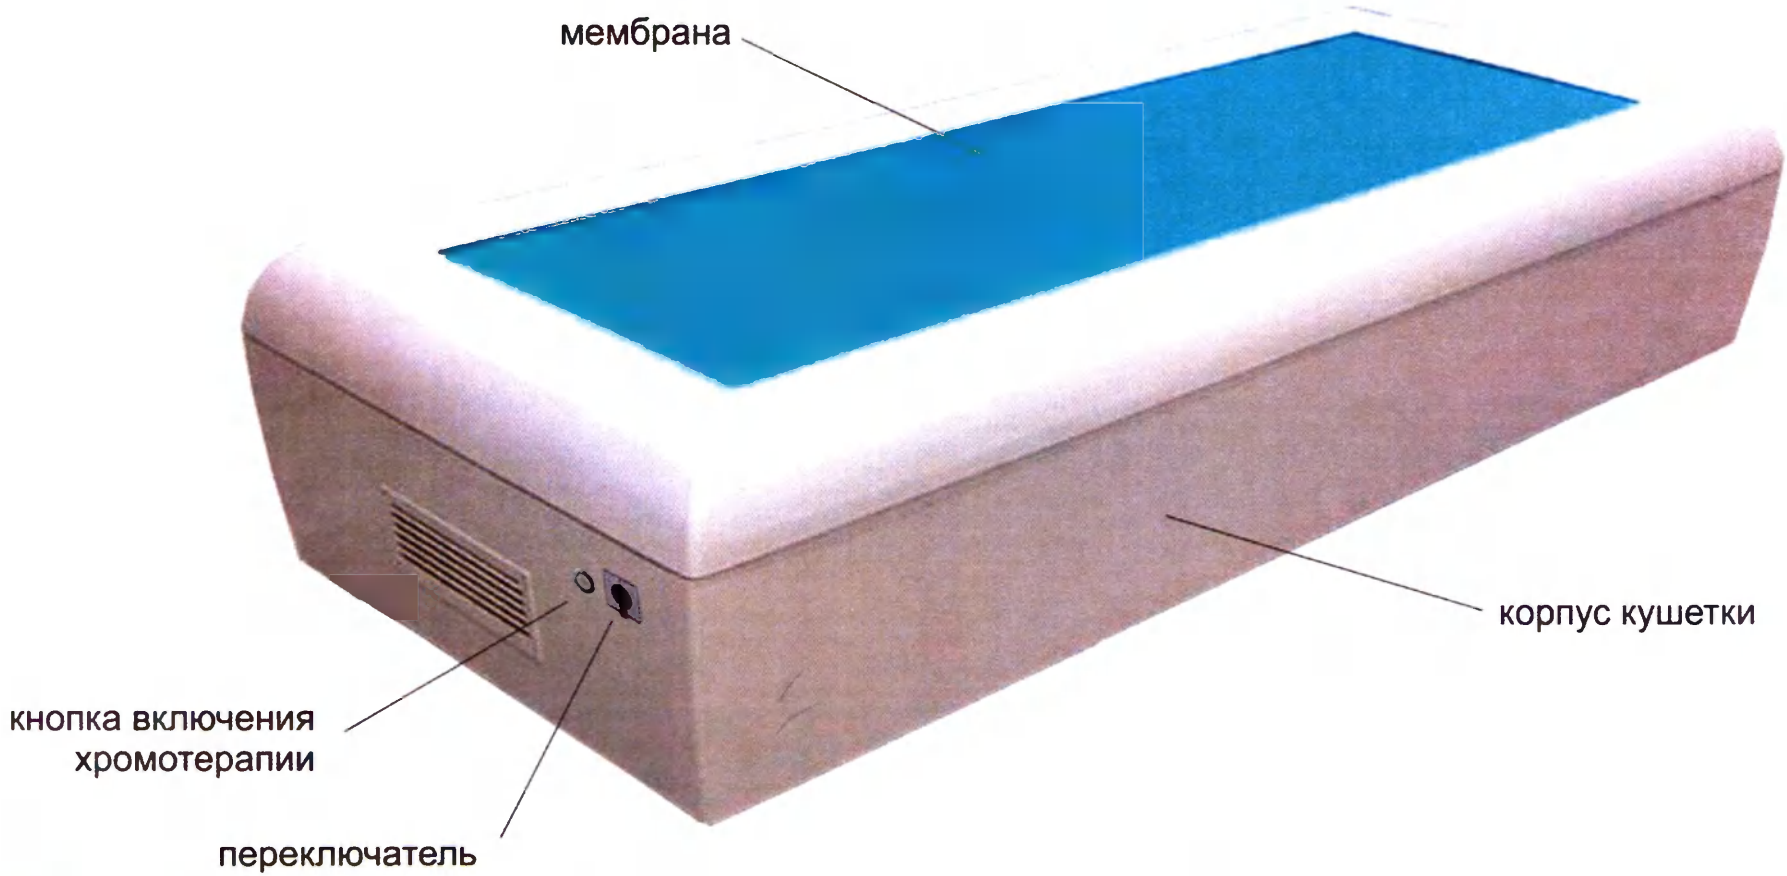

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- ООО «ПК Медицинские Реабилитационные Системы»

Наименование изделия: Кушетка бесконтактного гидромассажа «АКВАСМАРТ», исполнение 8Г6Х

напряжение питания и частота переменного тока питающей сети - ~(220±22)В, 50 Гц;

потребляемая мощность, не более, кВА: 1,9

SN - 001

- 2019г (I квартал)

ТУ 32.50.21-001-24973017-2019

IP45

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пульт управления на длинной стойке

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

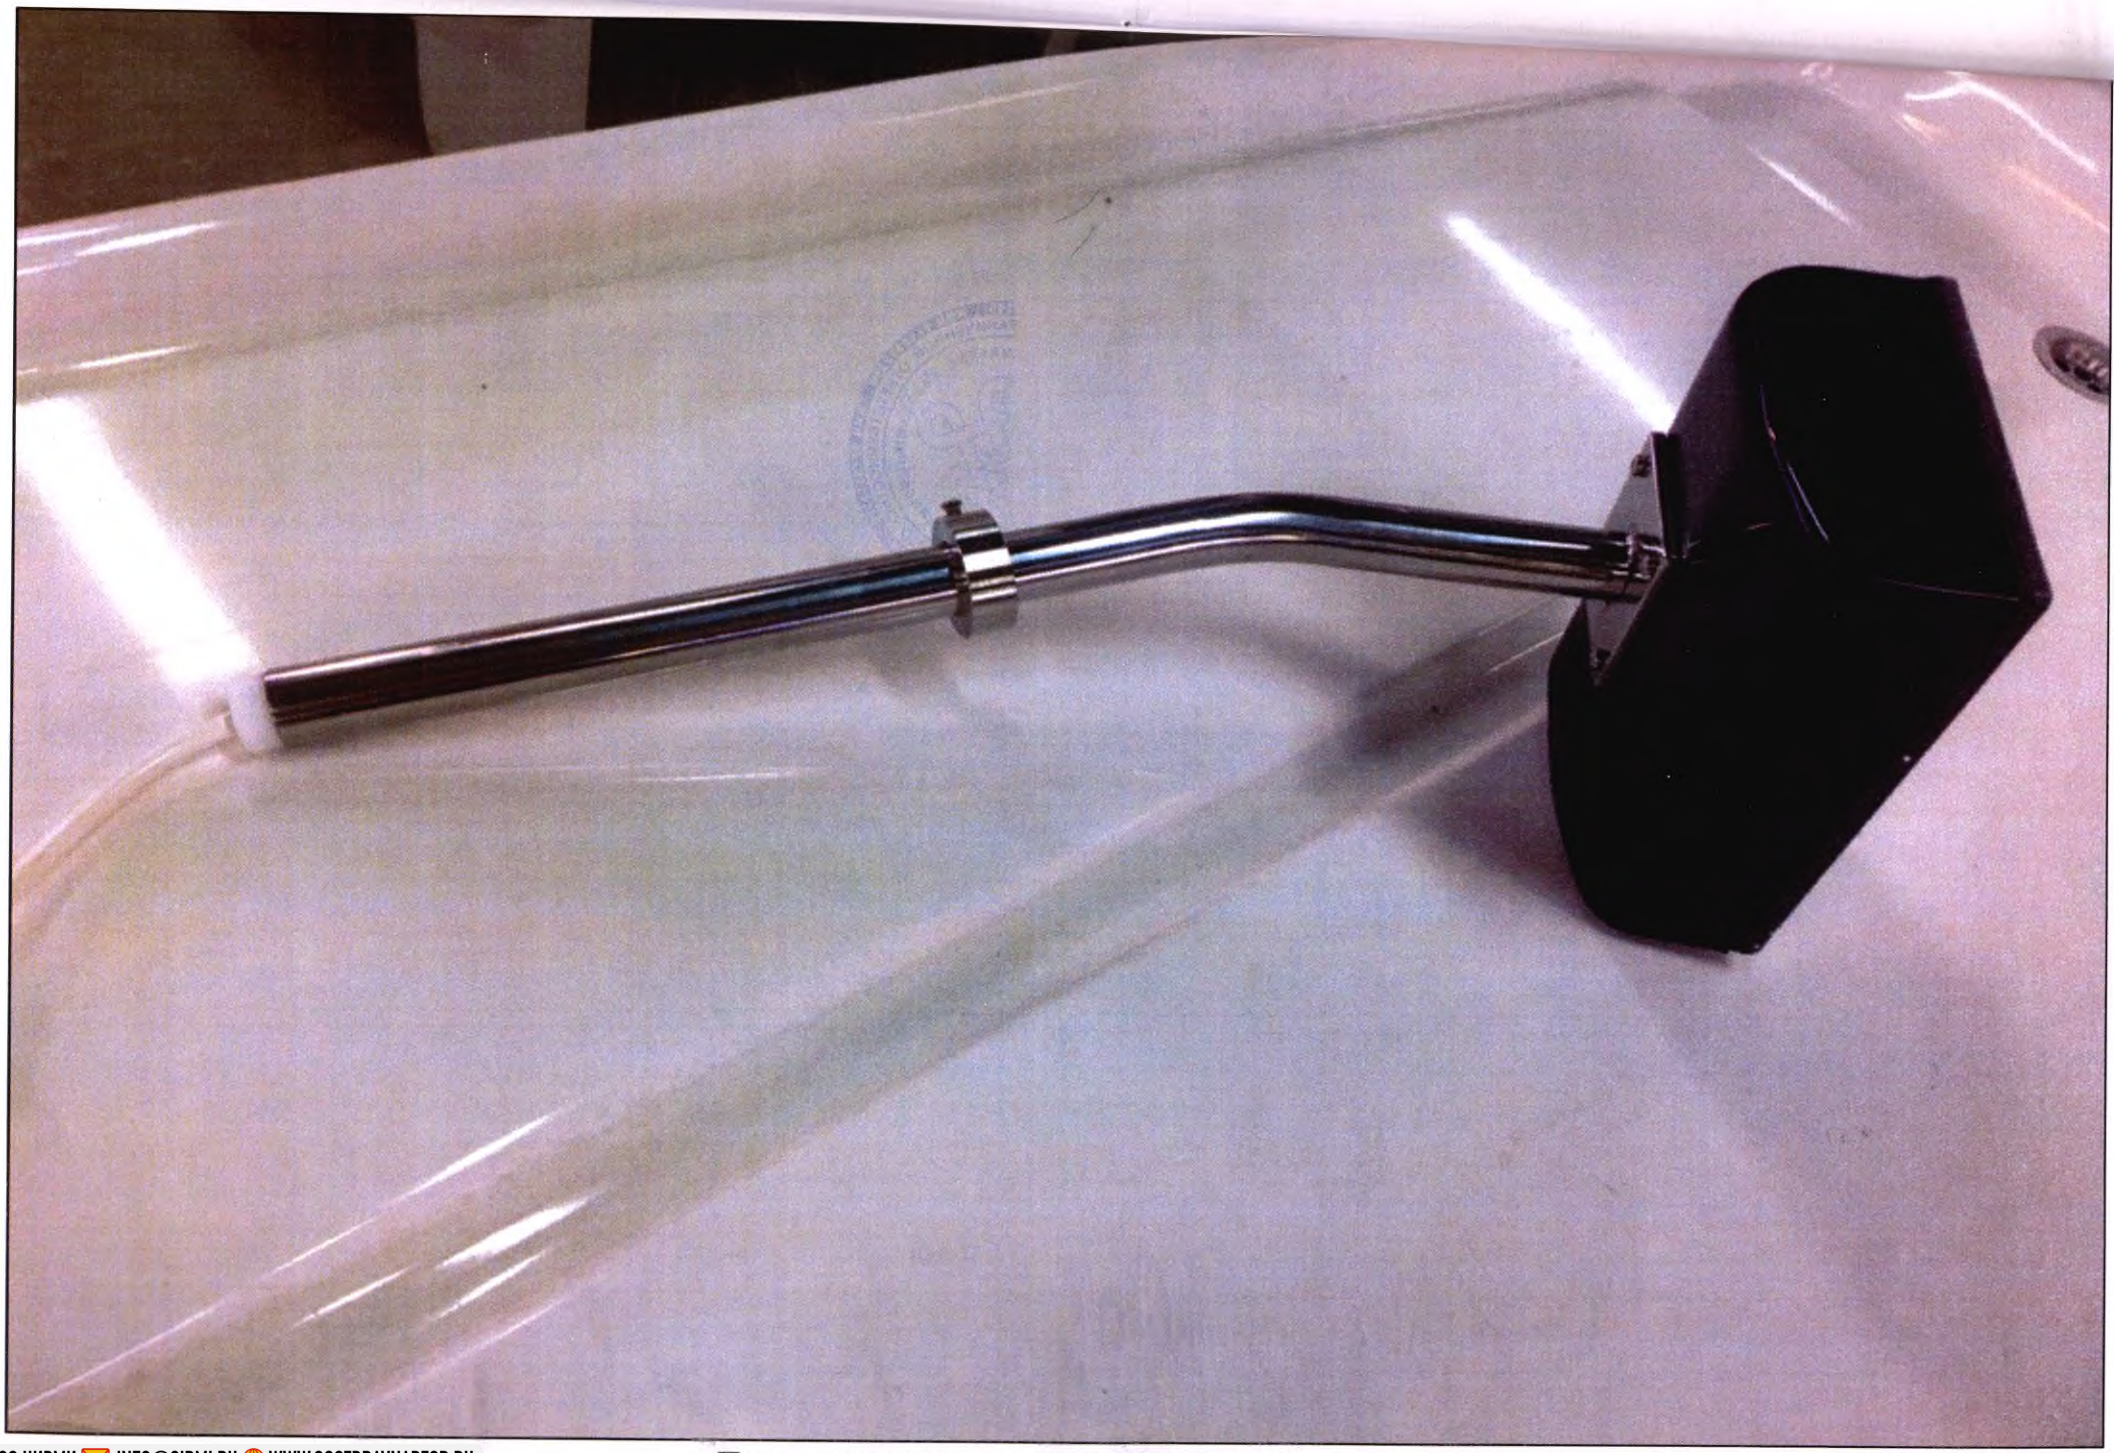

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пульт управления на короткой стойке

Прошито и пронумеровано
Кол-во: 17 листов (семнадцать)

Подпись

Ген.дир Гаврилов Я.И.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU