

**Анализатор иммуноферментный
автоматический «Чароит» (Charoite) с
принадлежностями**

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ**

Предоставляется как часть досье для регистрации изделия медицинской техники.

Москва 2013

Оглавление:

Фото 1. Общий вид анализатора «Чароит».....	стр. 3
Фото 2. Идентификационная табличка.....	стр. 4
Фото 3. Отсек для размещения емкостей для промывочных растворов в открытом состоянии	стр. 5
Фото 4. Расположение контейнера для сброса использованных одноразовых наконечников.....	стр. 6
Фото 5. Сервисный режим.....	стр. 7
Фото 6. Упаковка с мандренами для чистки 0,018”.....	стр. 8
Фото 7. Упаковка с мандренами для чистки 0,040”	стр. 9
Фото 8. Силиконовая смазка кольцевых прокладок.....	стр. 10
Фото 9. Стрипы для предварительного разведения.....	стр. 11
Фото 10. Контейнеры для перемешивания реагентов	стр. 12
Фото 11. Наконечники для образцов.....	стр. 13
Фото 12. Наконечники для реактивов.....	стр. 14
Фото 13. Картридж стрипов для разведения.....	стр. 15
Фото 14. Картридж контейнеров для перемешивания.....	стр. 16
Фото 15. Картридж штатива для реагентов.....	стр. 17
Фото 16. Рамка-держатель планшета.....	стр. 18
Фото 17. Флаконы для контролей (с крышками).....	стр. 19
Фото 18. Флаконы для реагентов.....	стр. 20
Фото 19. Штатив «Бронзовый».....	стр. 21
Фото 20. Лоток для штатива «Бронзовый».....	стр. 22
Фото 21. Восьмигранный ключ 2 мм.....	стр. 23
Фото 22. Восьмигранный ключ 4 мм.....	стр. 24
Фото 23. Гарантийный формуляр	стр. 25
Фото 24. Шнур питания.....	стр. 26

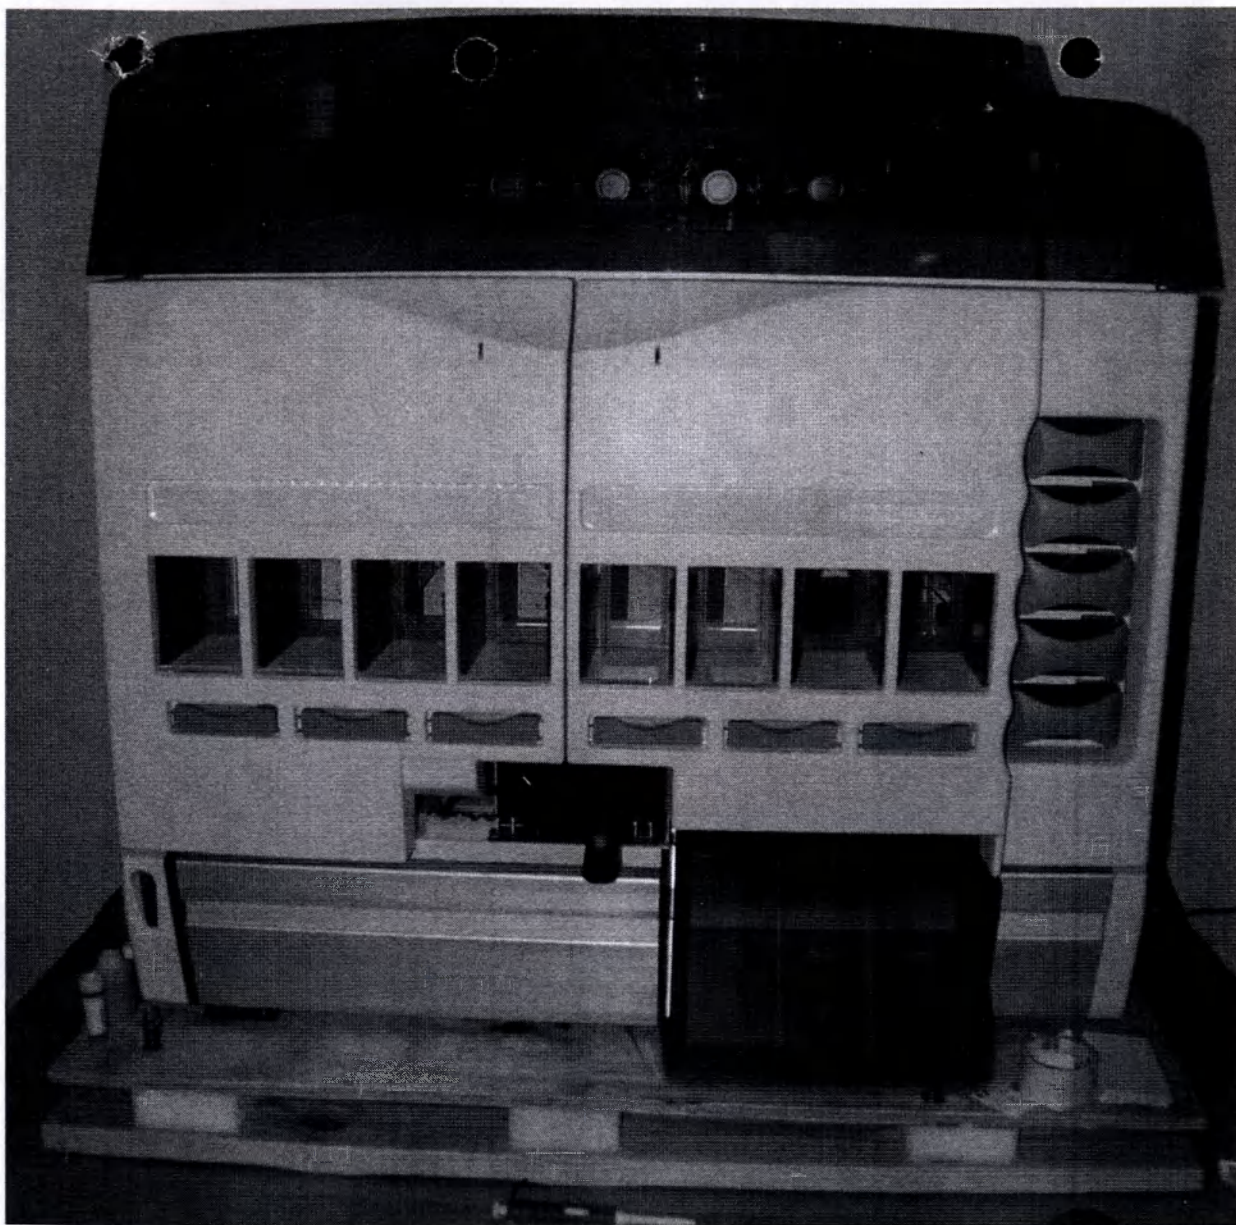


Фото 1. Общий вид анализатора иммуноферментного автоматического «Чаройт»

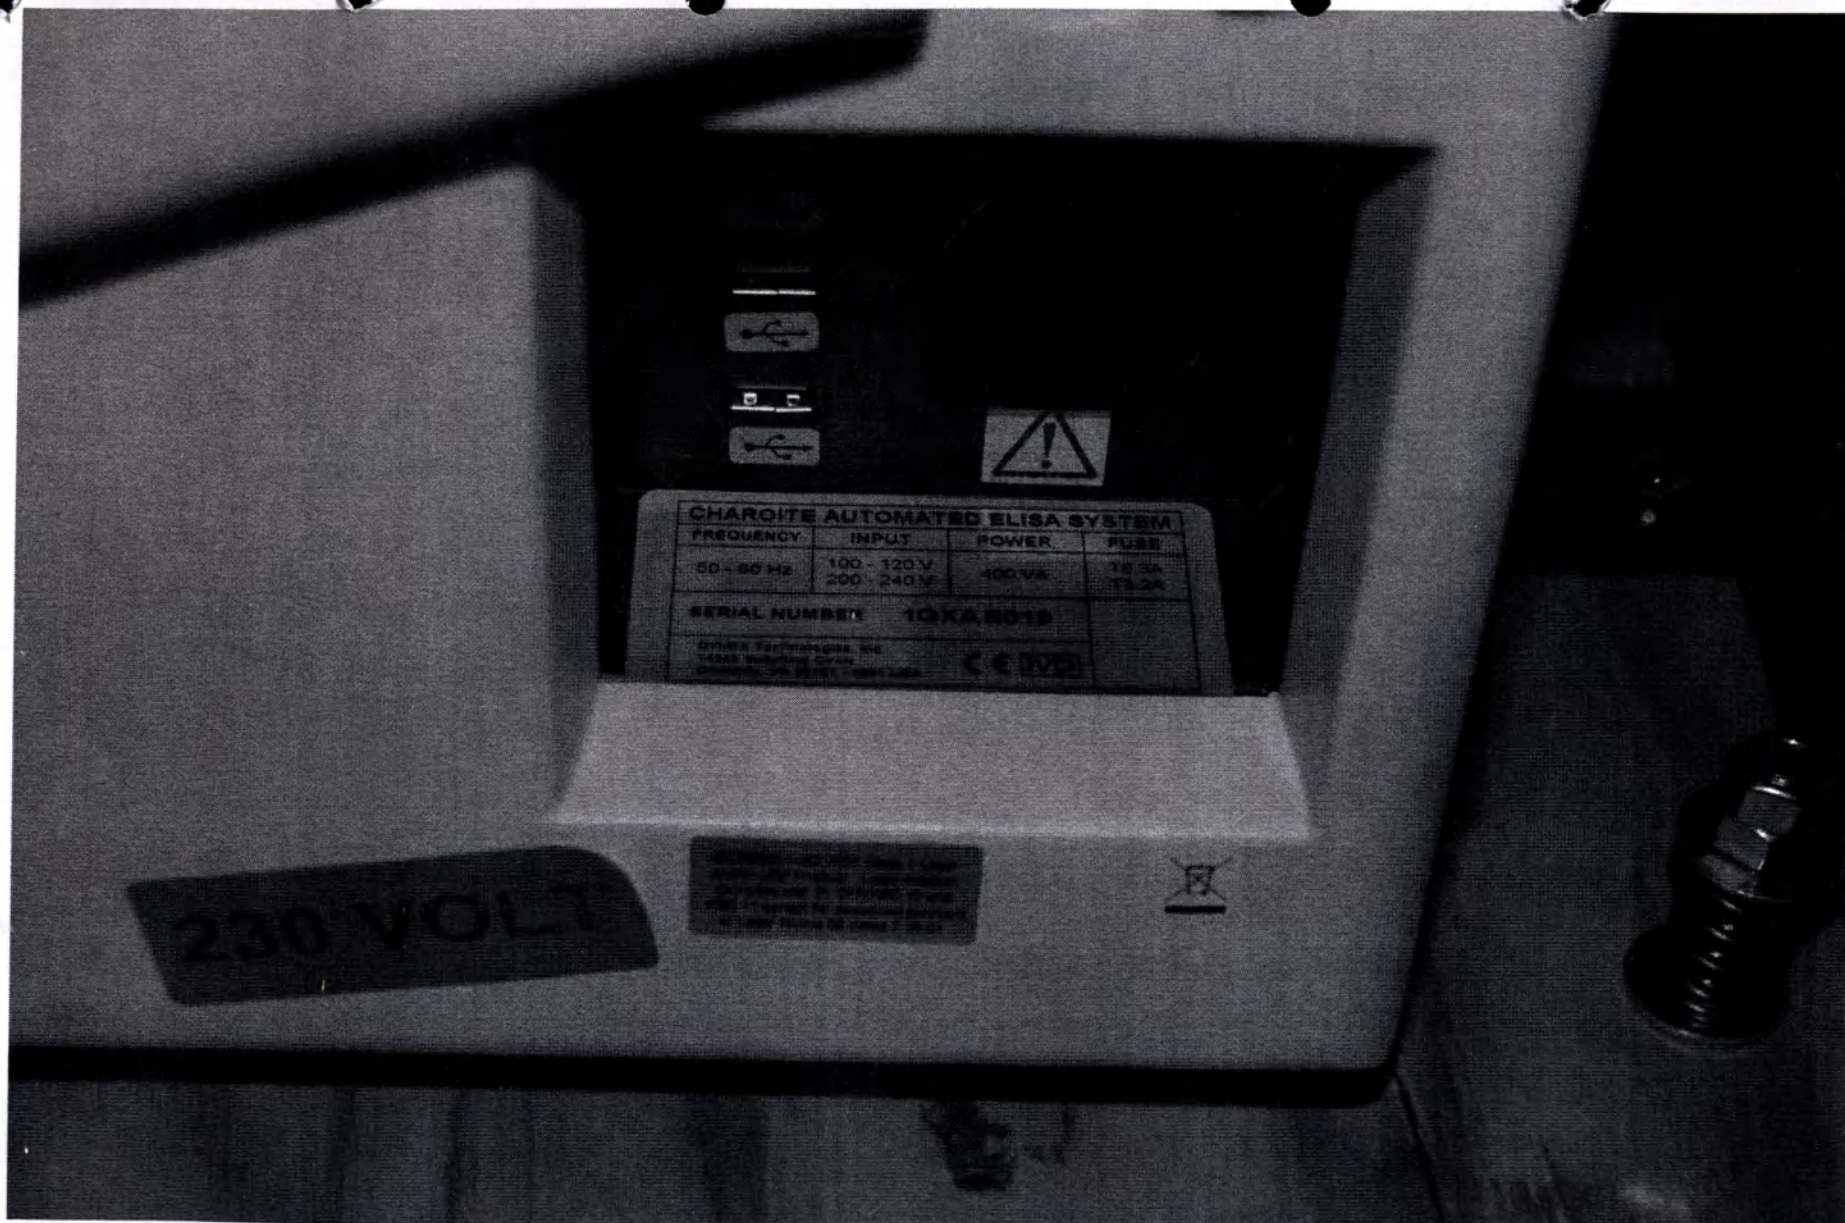


Фото 2. Идентификационная табличка, которой маркируются анализаторы иммуноферментные автоматические «Чароит», с указанием названия прибора, серийного номера и электротехнических характеристик.

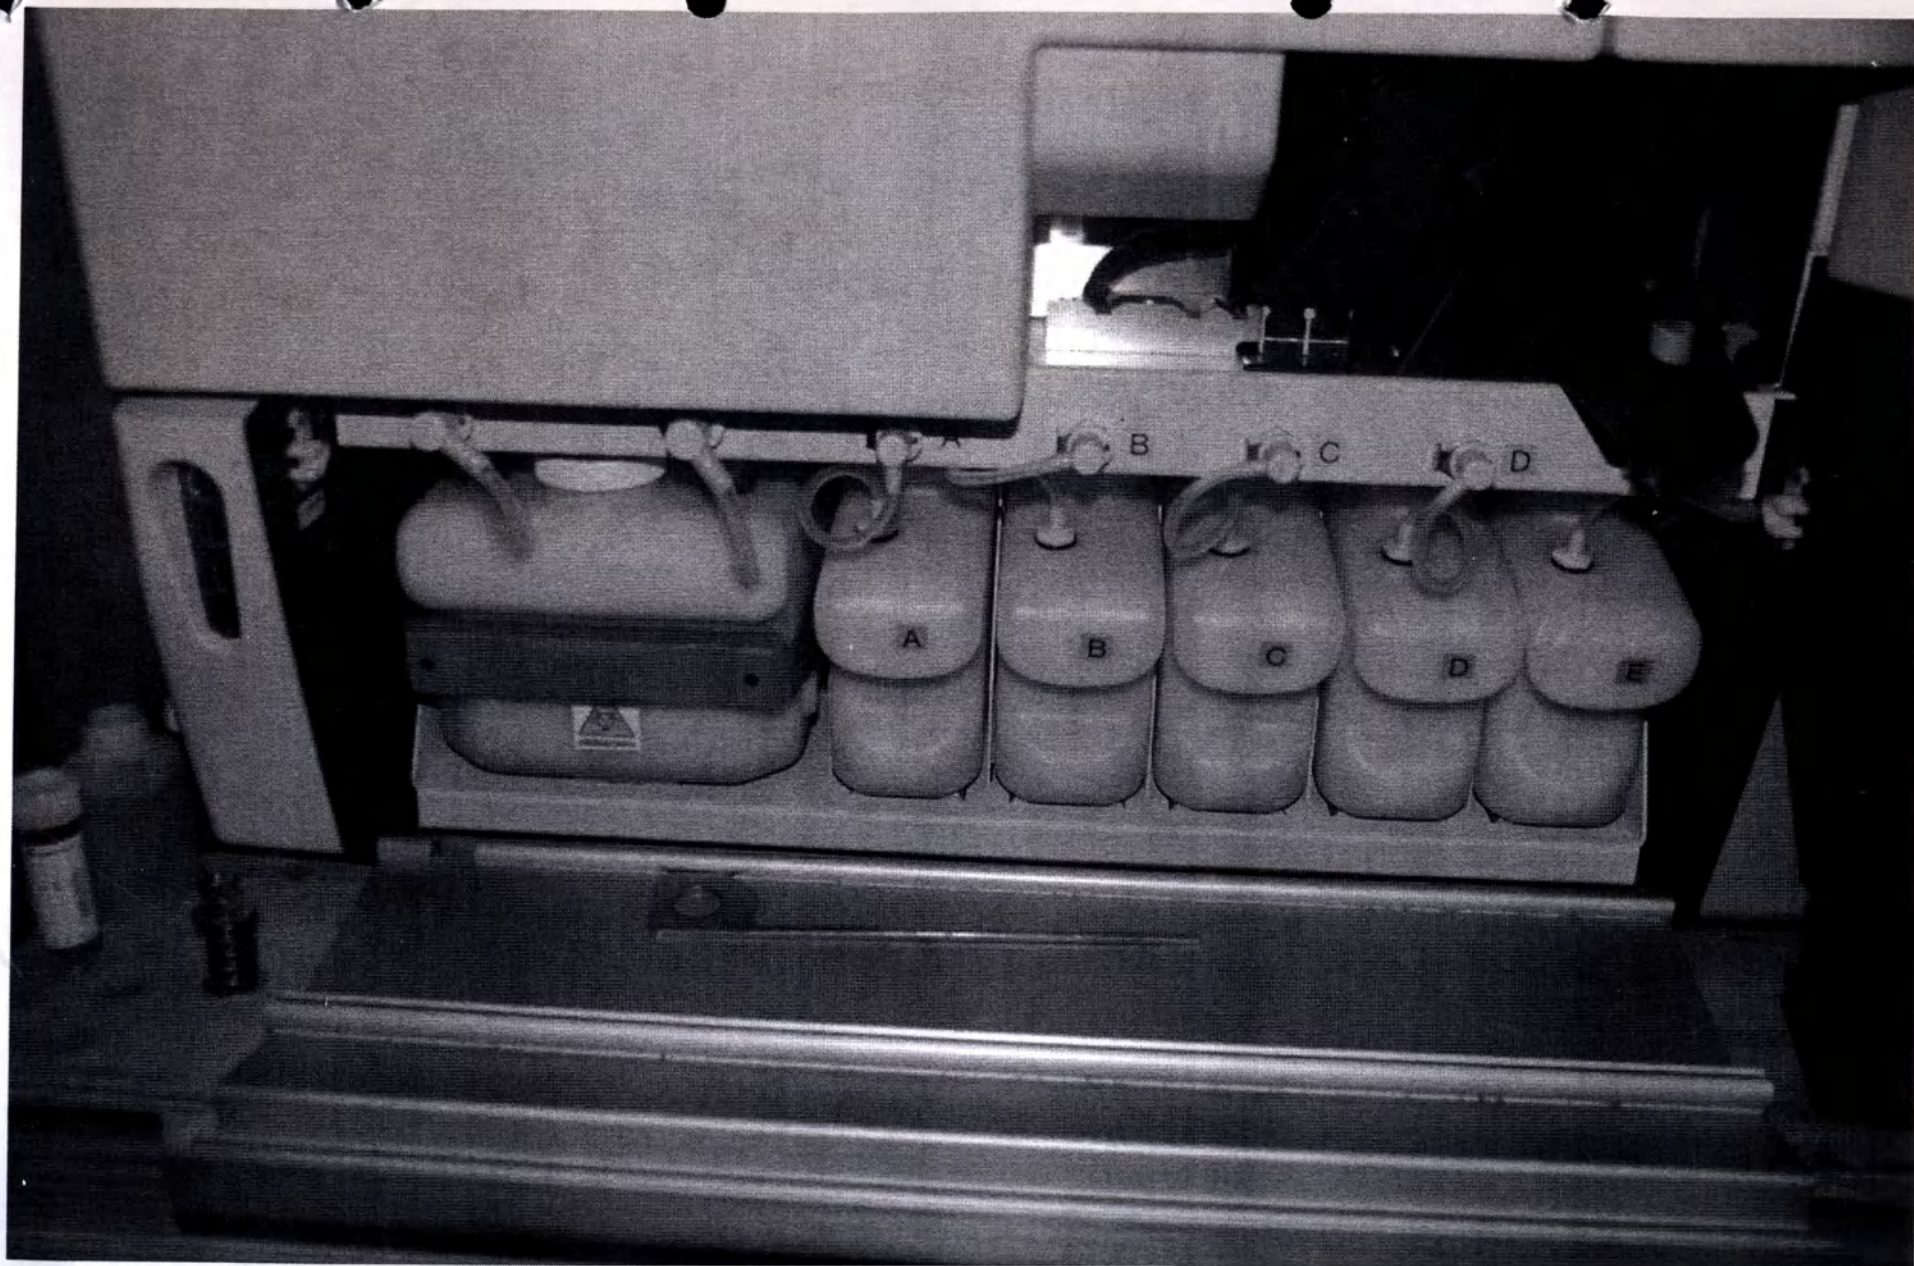


Фото 3. Отсек для размещения емкостей для промывочных растворов в открытом состоянии.

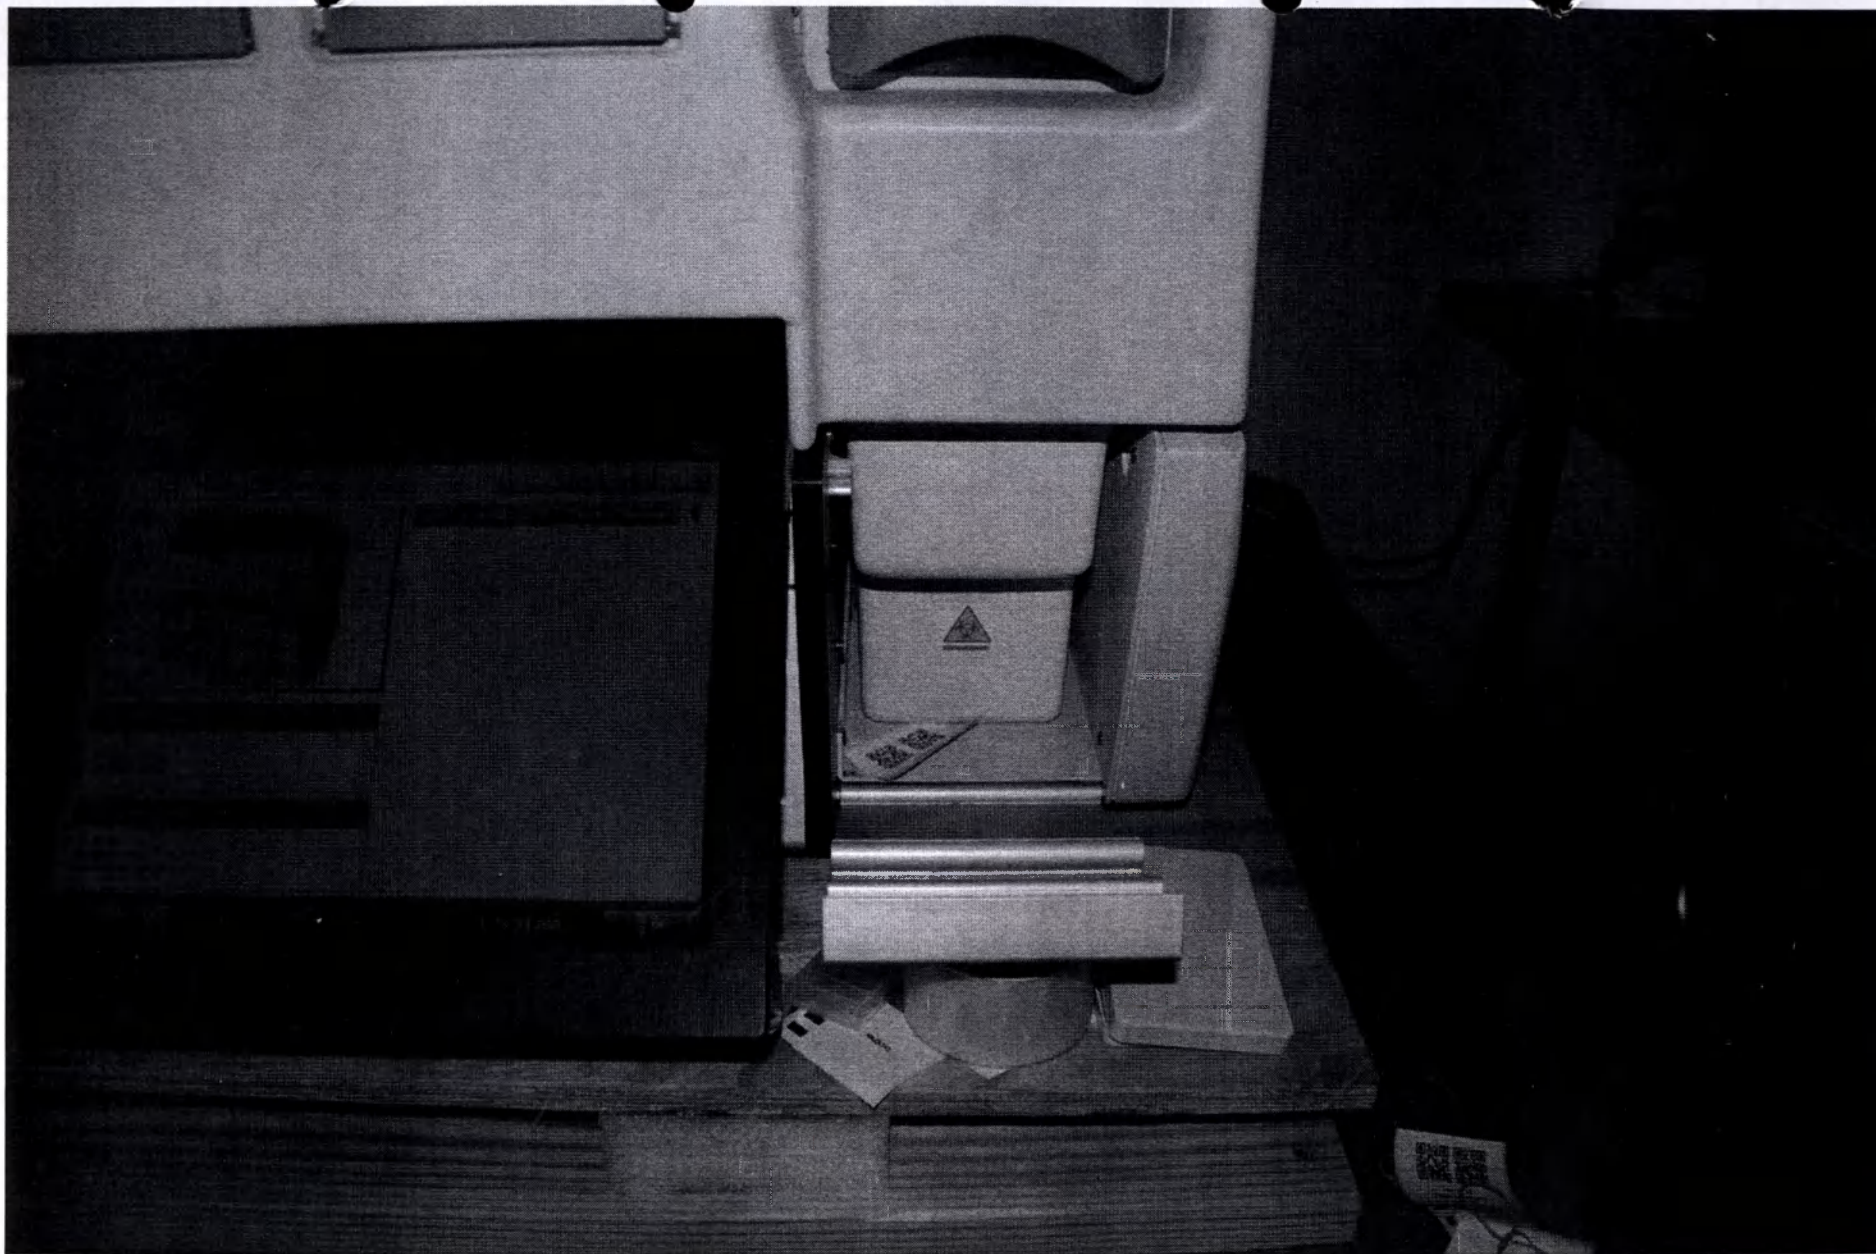


Фото 4. Расположение контейнера для сброса использованных одноразовых наконечников.

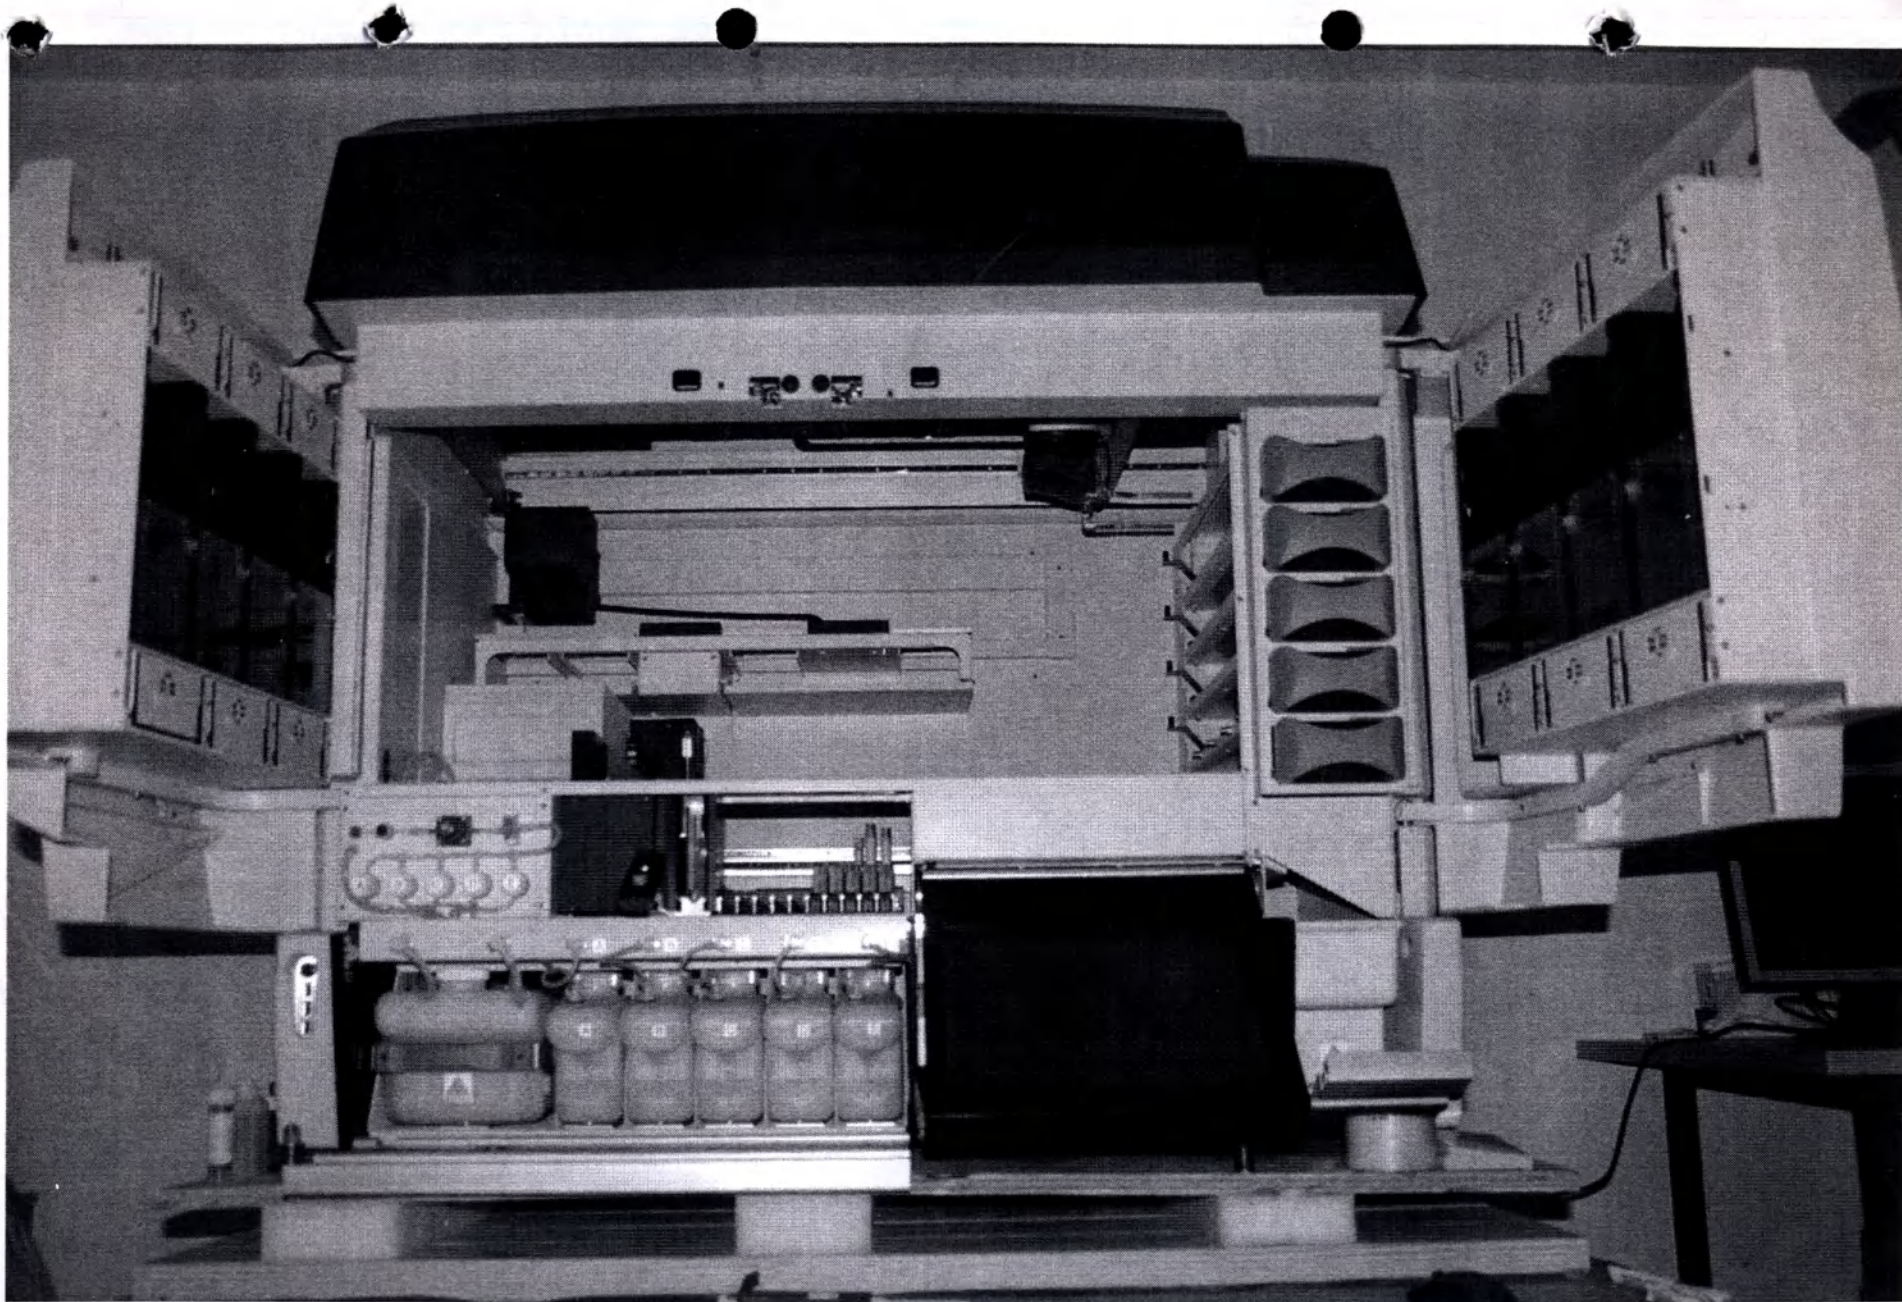


Фото 5. Сервисный режим: Открыты дверцы для доступа к органам управления и манипуляторам анализатора.



352101800
Cleaning Wire .018

Фото 6. Упаковка с мандренами для чистки 0,018" (Cleaning Wire .018").

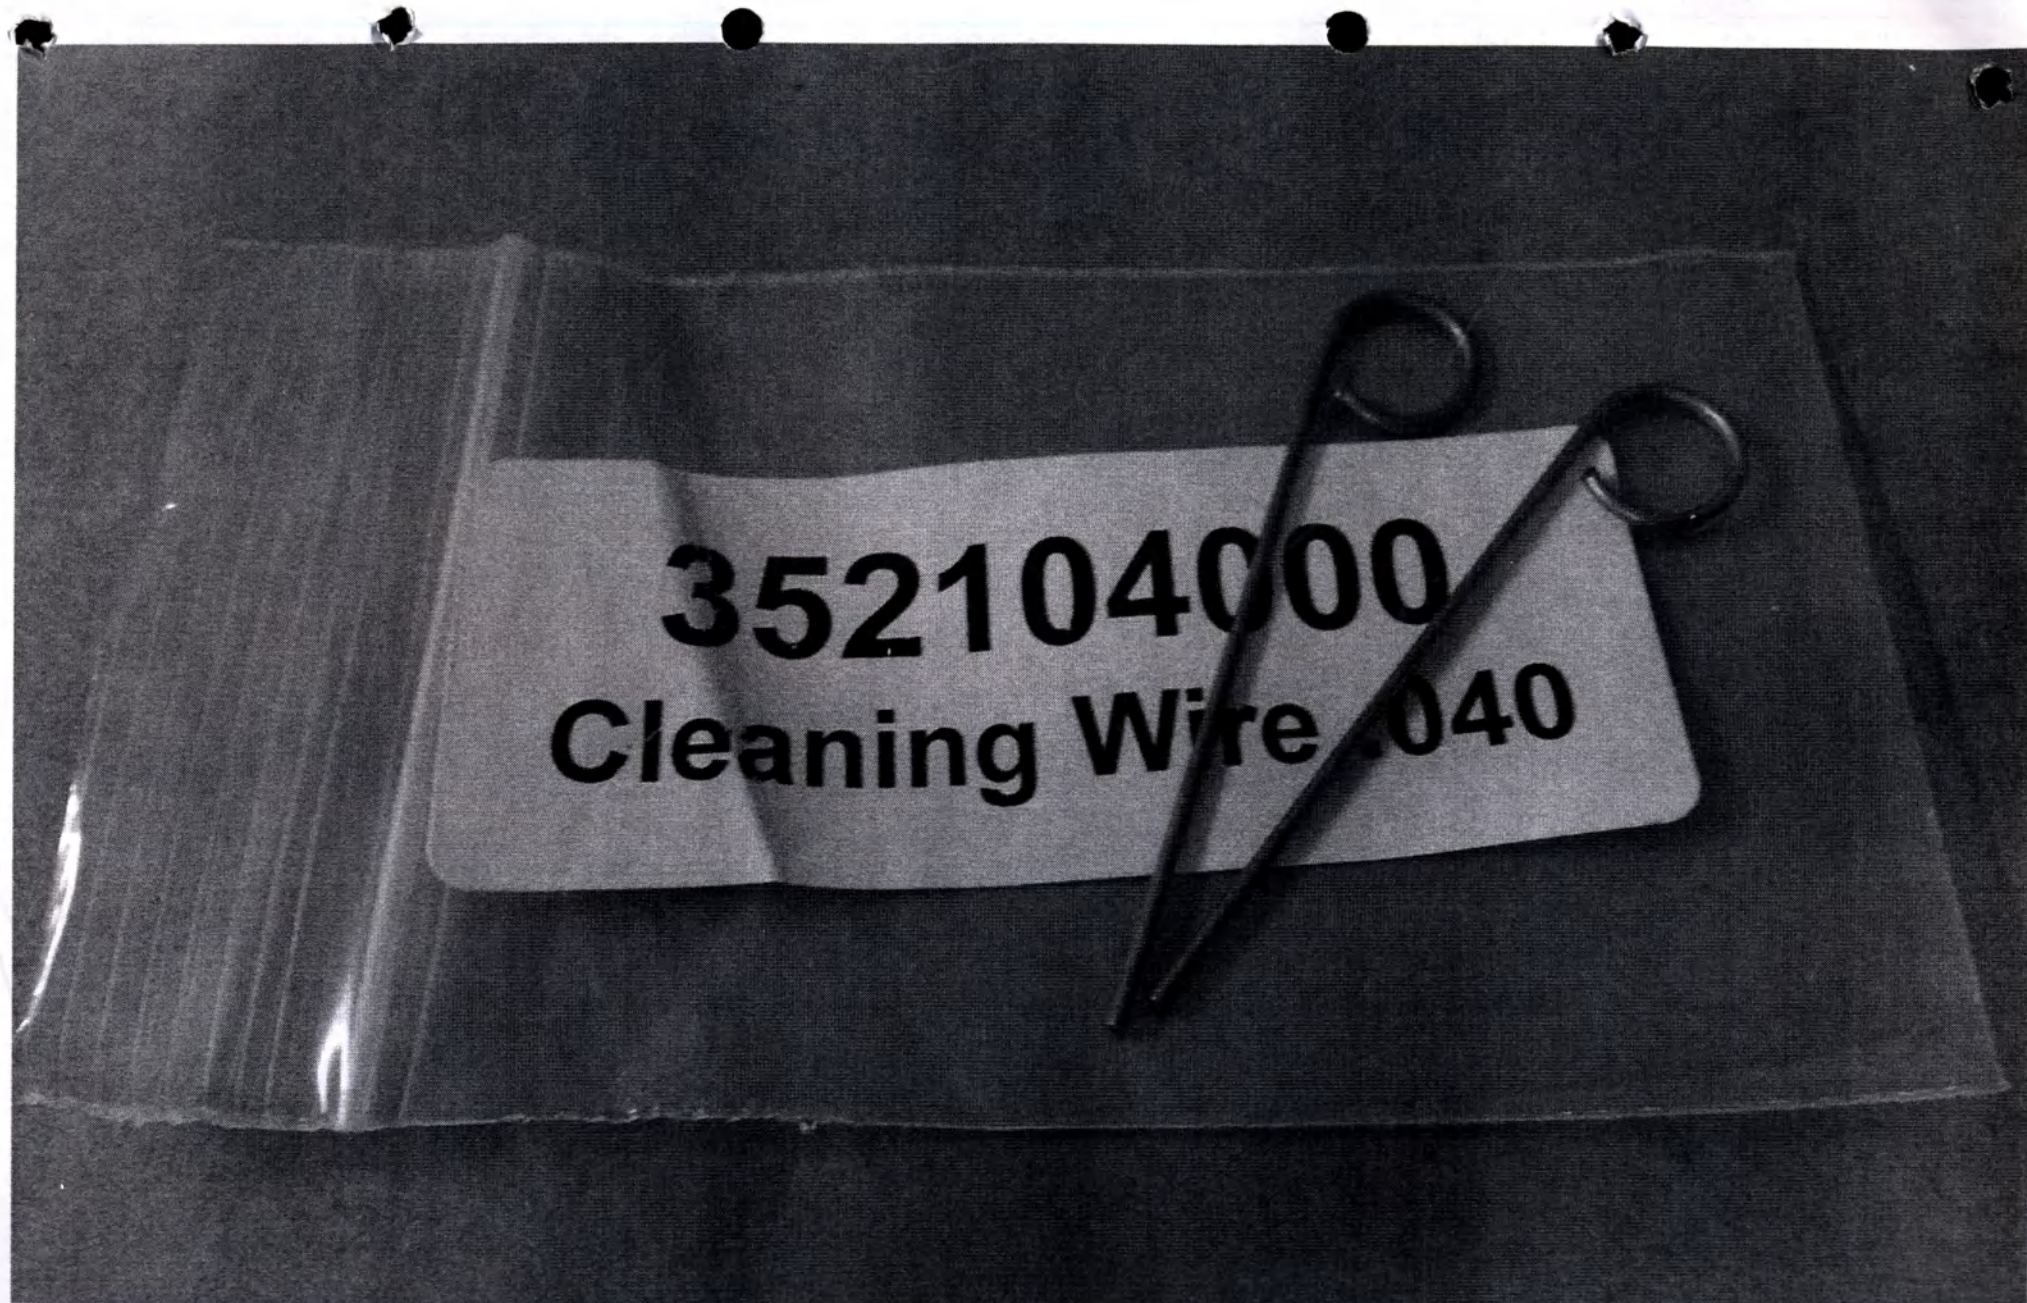


Фото 7. Упаковка с мандренами для чистки 0,040" (Cleaning Wire .040").



Фото 8. Силиконовая смазка кольцевых прокладок (тюбик 14 г.) (O-Ring Lubricant Silicone 1/2 Oz Tube).



Фото 9. Стрипы для предварительного разведения (Deep Well Strips).

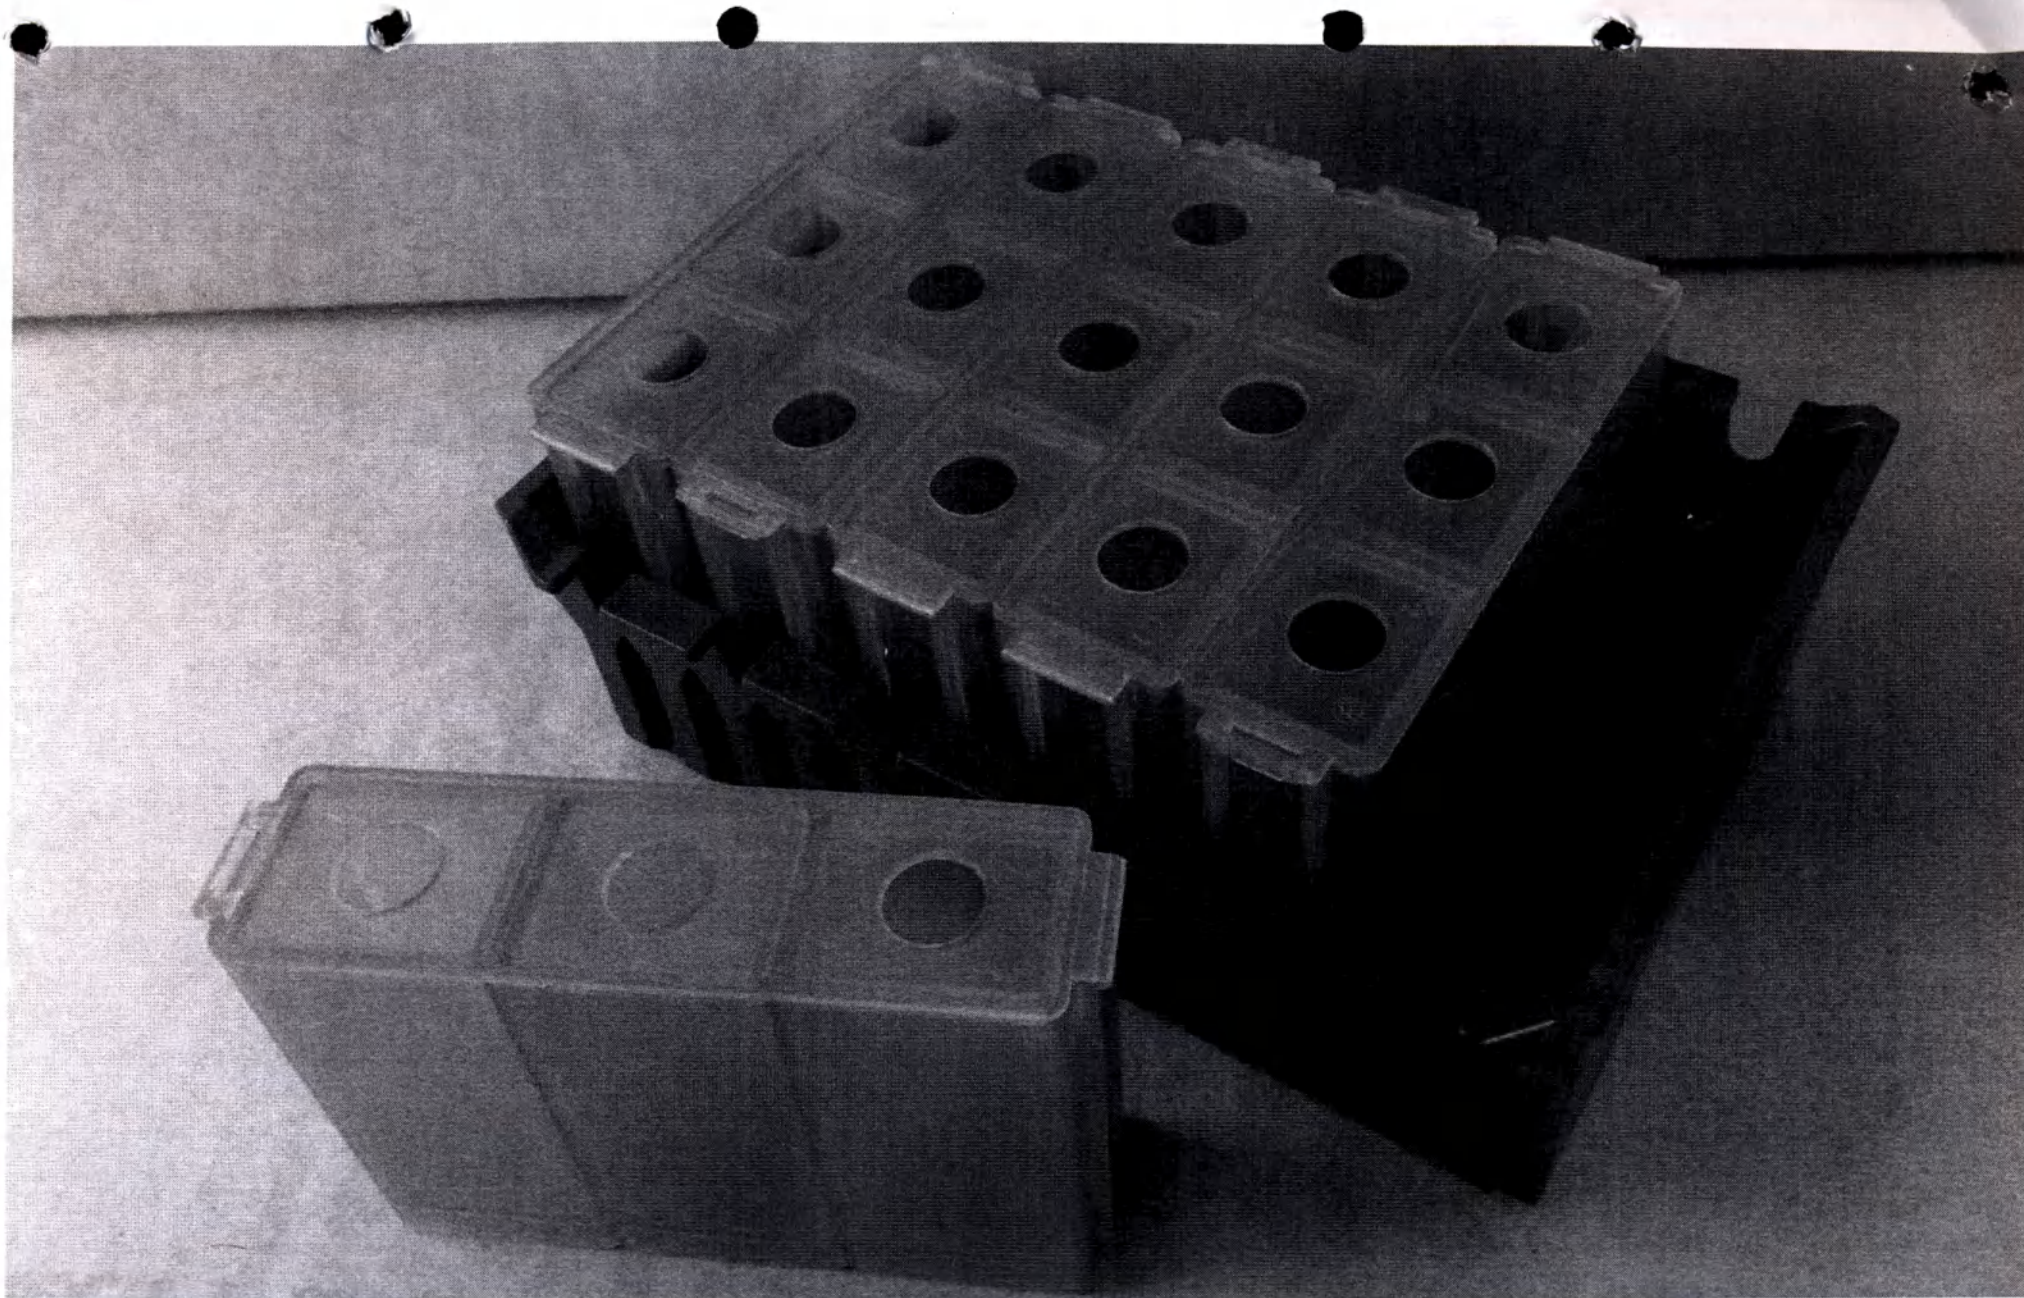


Фото 10. Контейнеры для перемешивания реагентов (синего цвета) (Mixing Well Strips (Blue)).



Фото 11. Наконечники для образцов (Коробка 896 шт.) (Sample Tips (Box of 896)).



Фото 12. Наконечники для реактивов (Коробка 196 шт.) (Reagent Tips (Box of 196)).

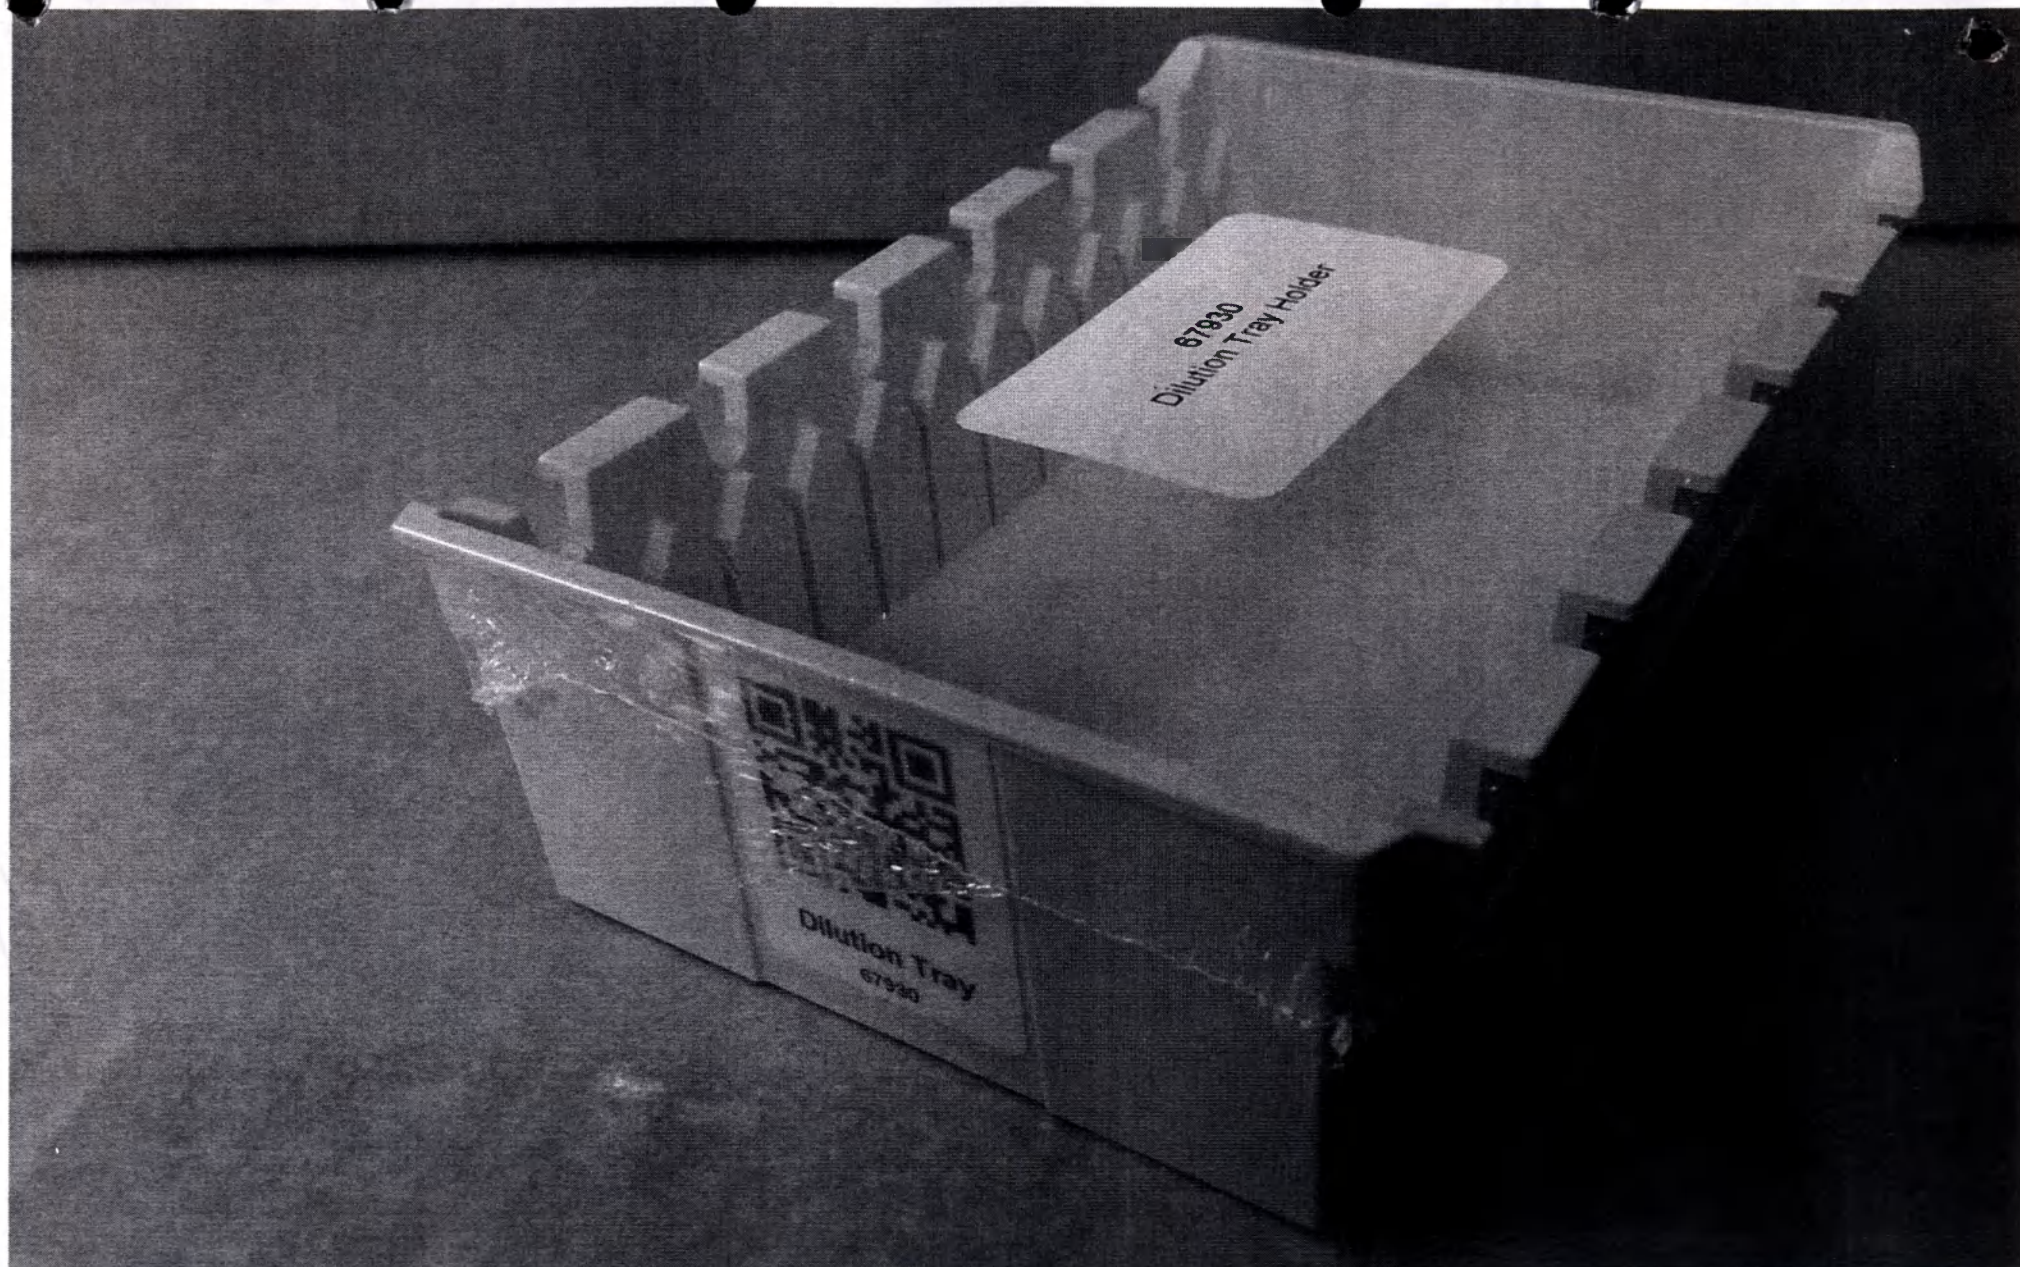


Фото 13. Картридж стрипов для разведения со штрих-кодом (Dilution Tray Holder With Barcode Label).



Фото 14. Картридж контейнеров для перемешивания со штрих-кодом (Mixing Tray Holder With Barcode Label).

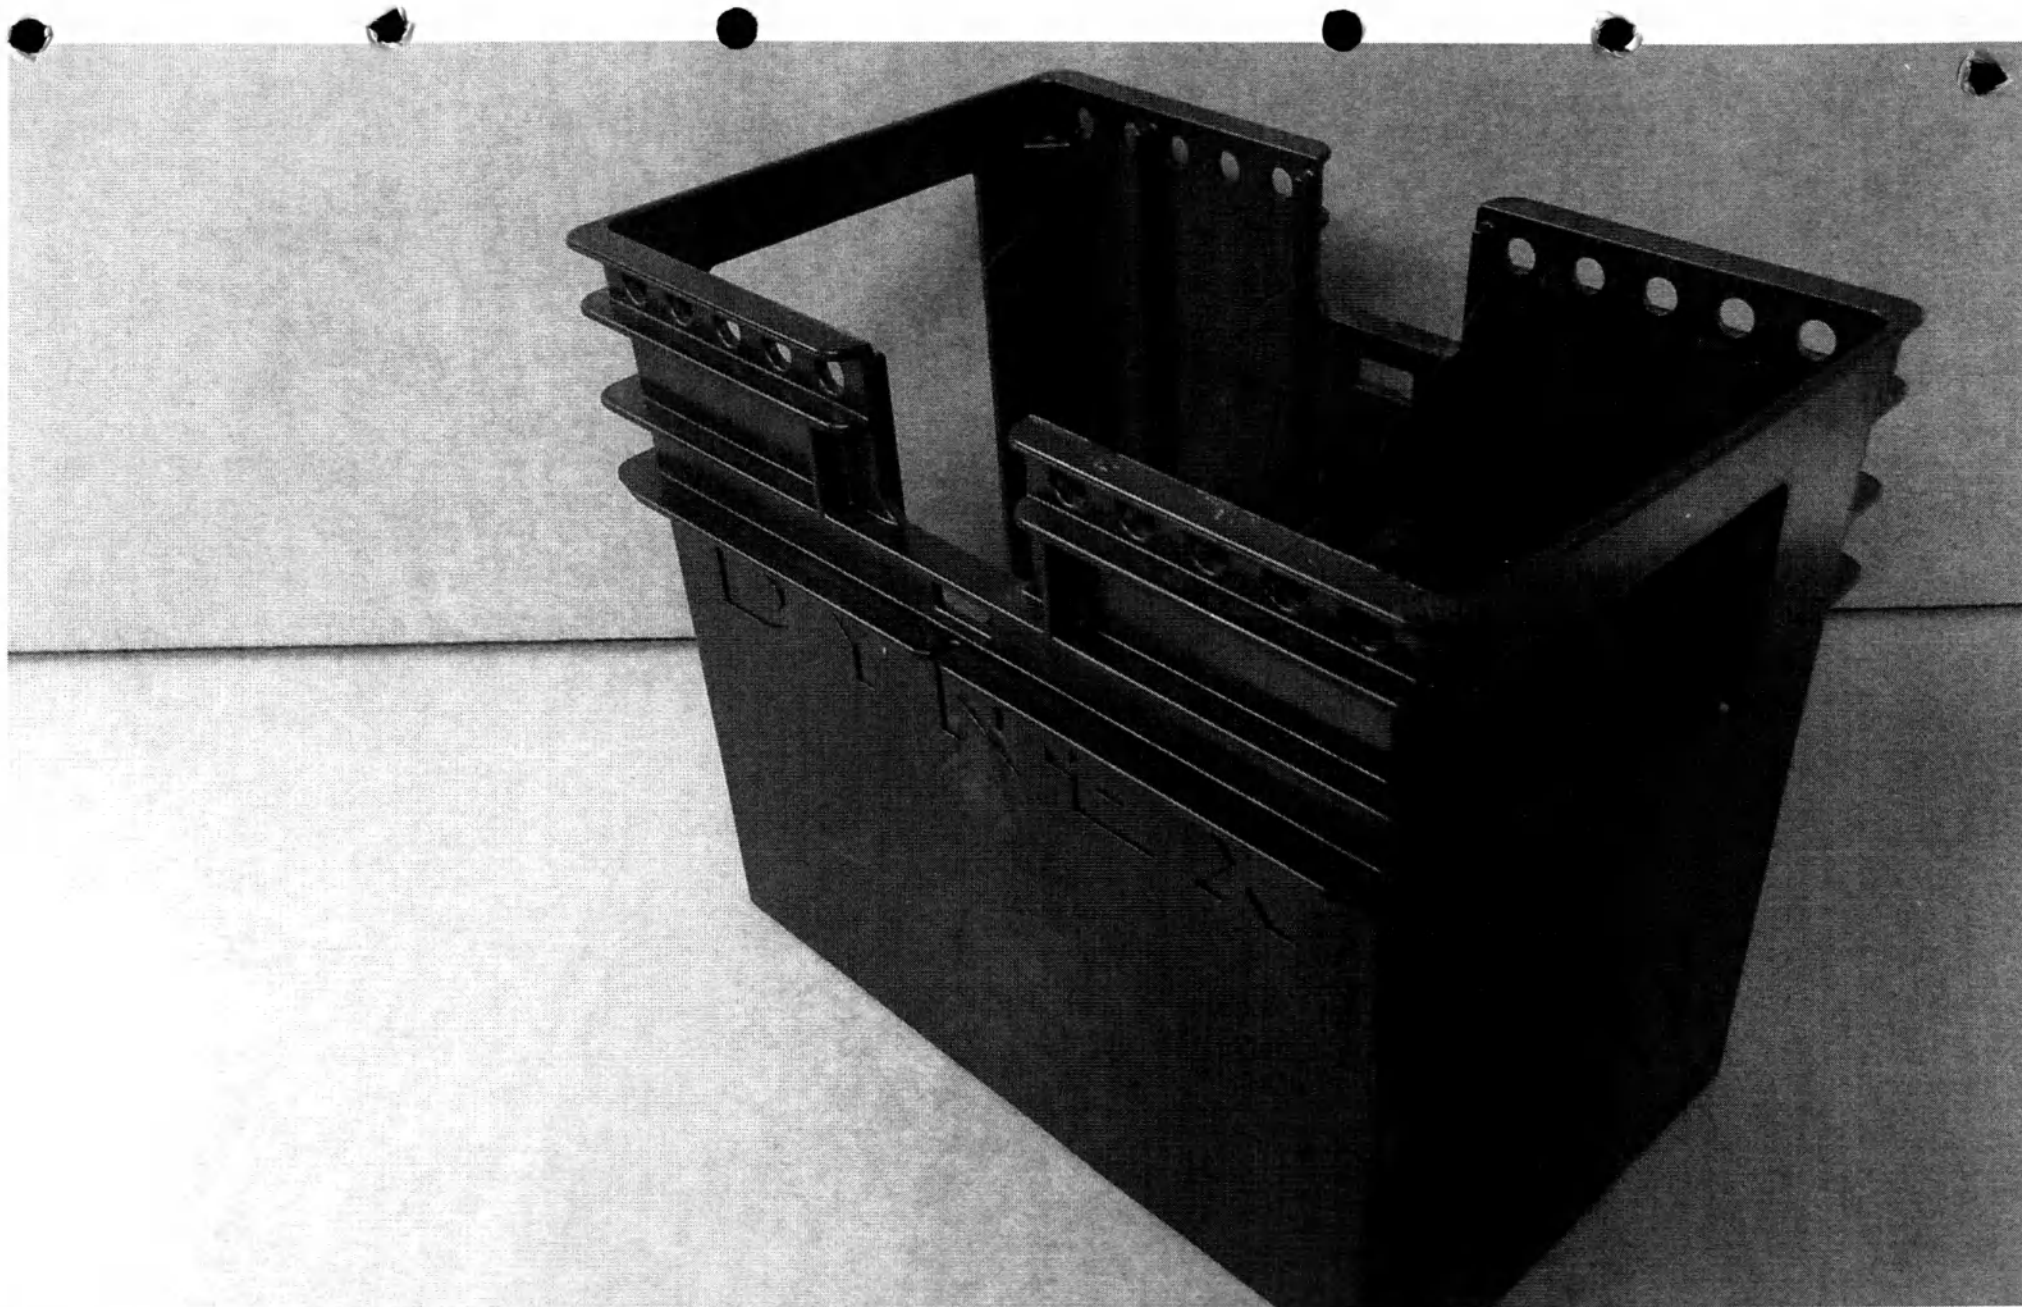


Фото 15. Картридж штатива для реагентов (Reagent Rack Holder).

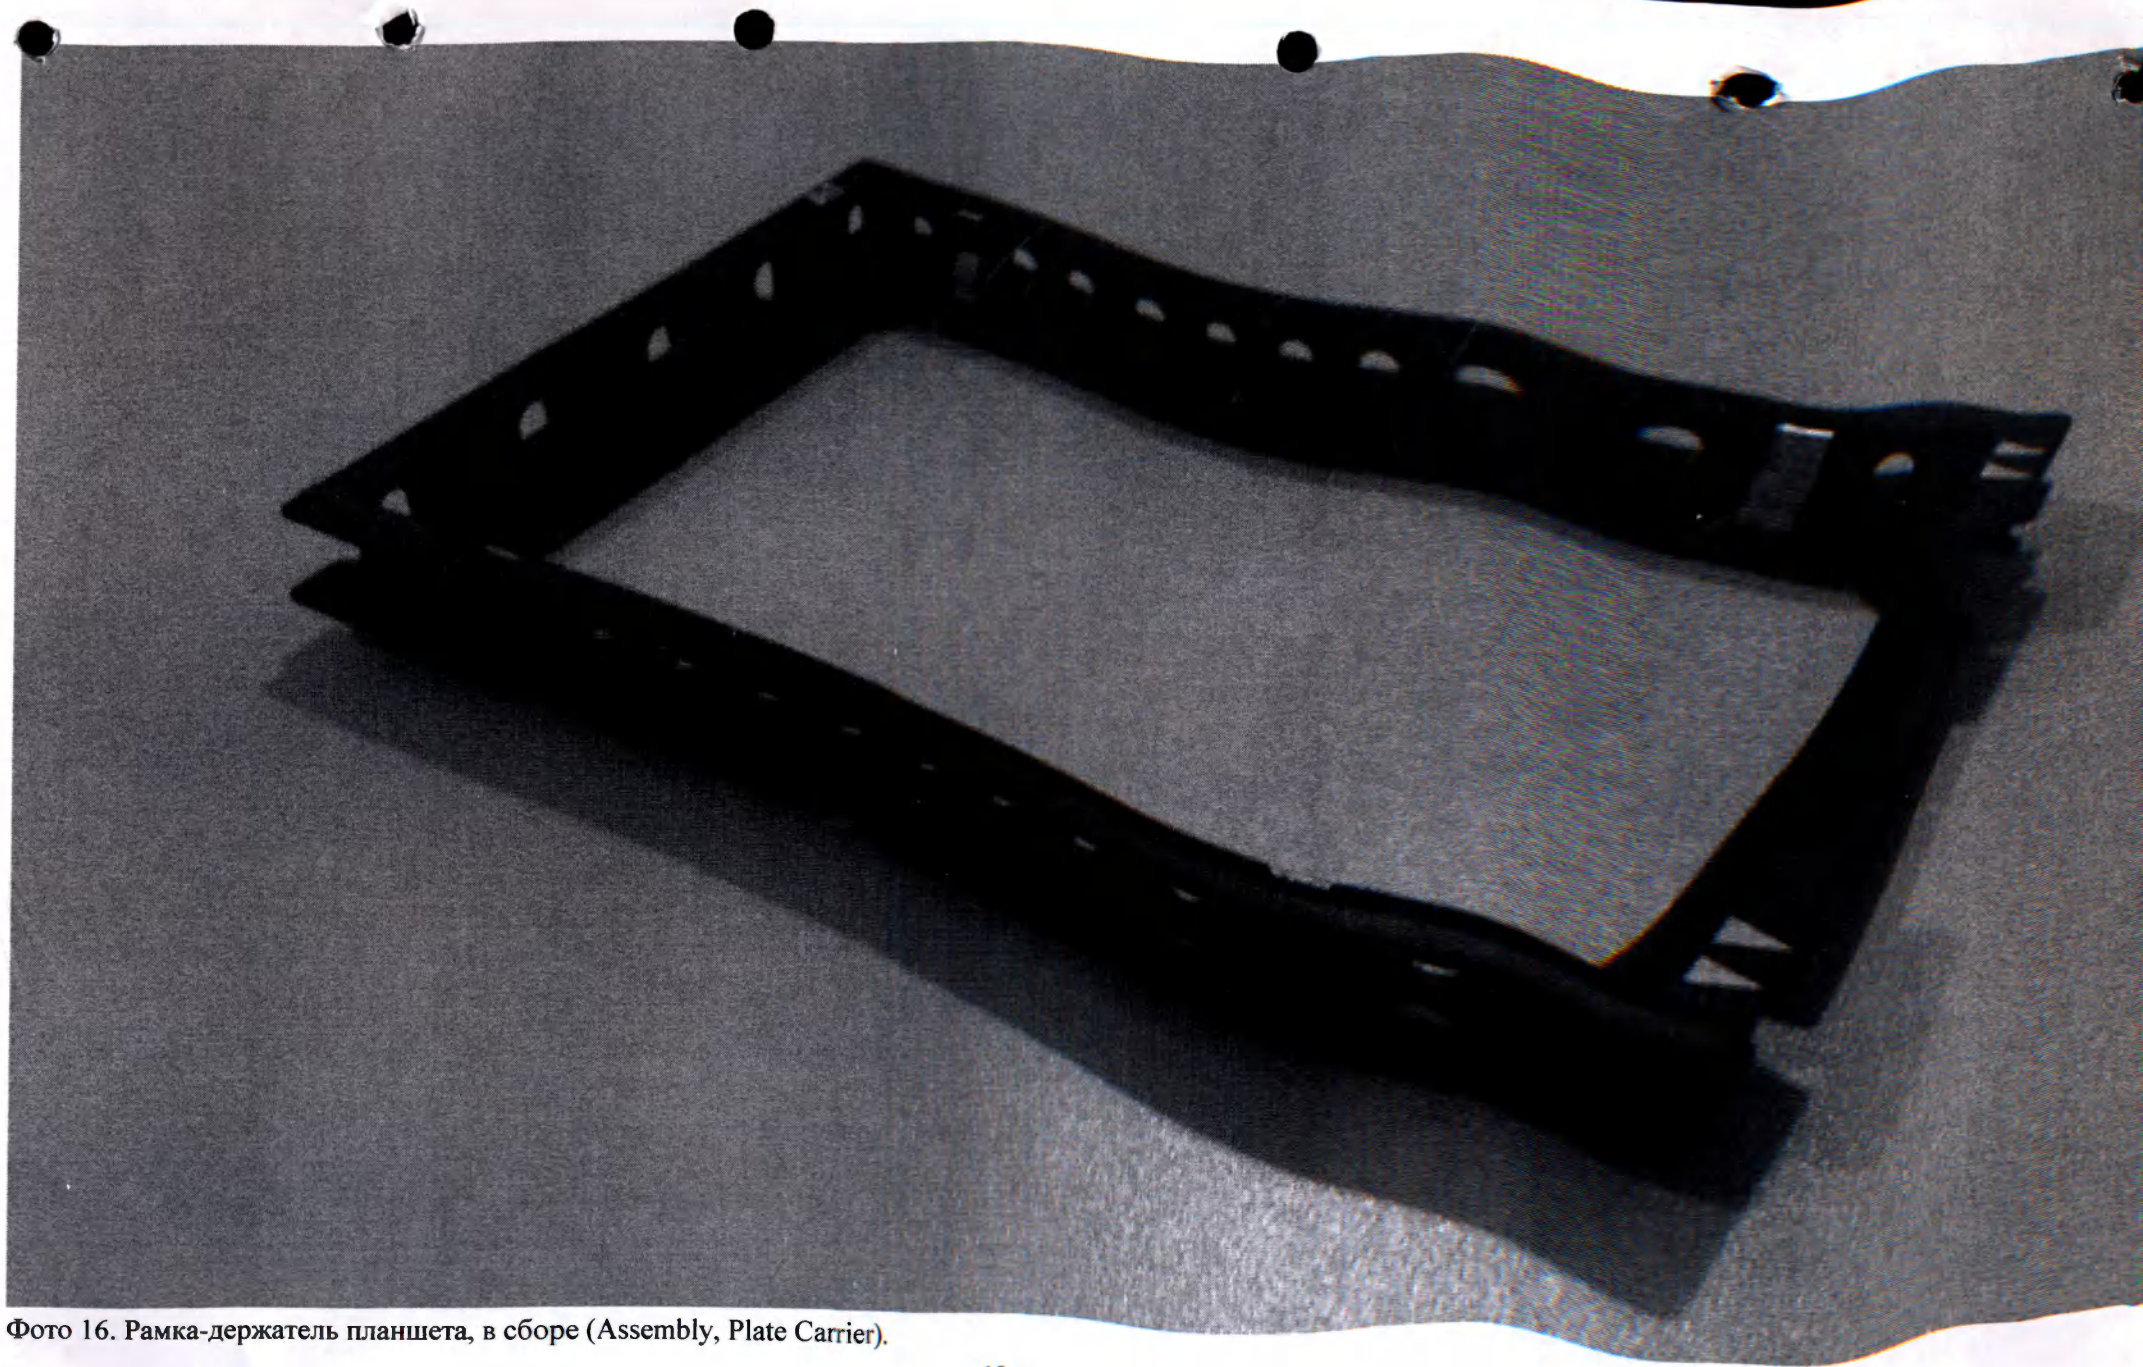


Фото 16. Рамка-держатель планшета, в сборе (Assembly, Plate Carrier).

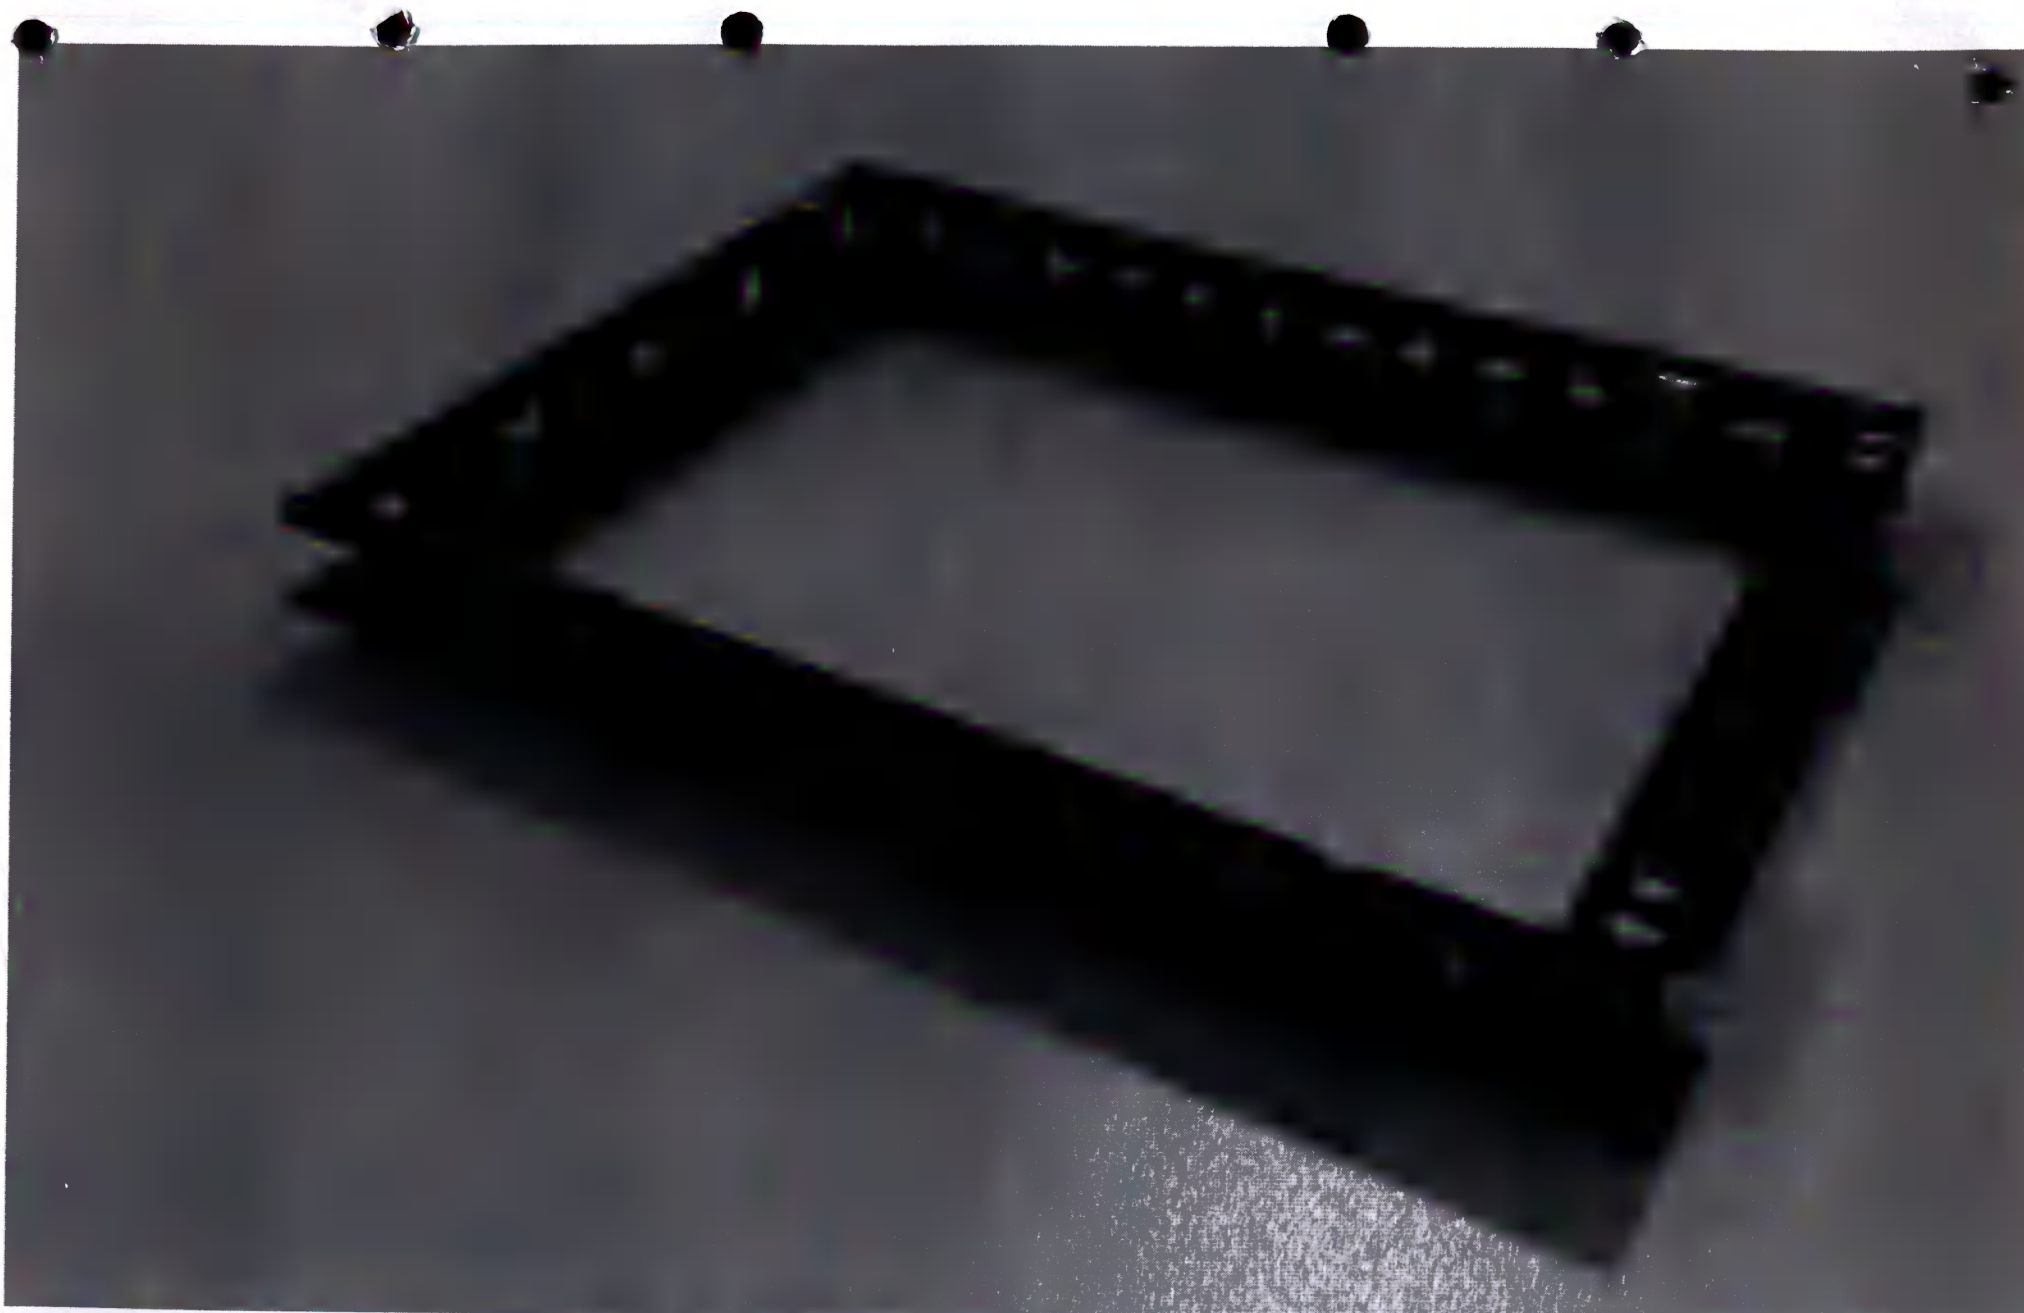


Фото 16. Рамка-держатель планшета, в сборе (Assembly, Plate Carrier).



Фото 17. Флаконы для контролей (с крышками) (упаковка, 33 шт.) (Vials, Control (With Caps) (Pack of 33).



Фото 18. Флаконы для реагентов, 25 мл (упаковка, 10 шт.) (Tubes, Reagent, 25ml (Pack of 10)).

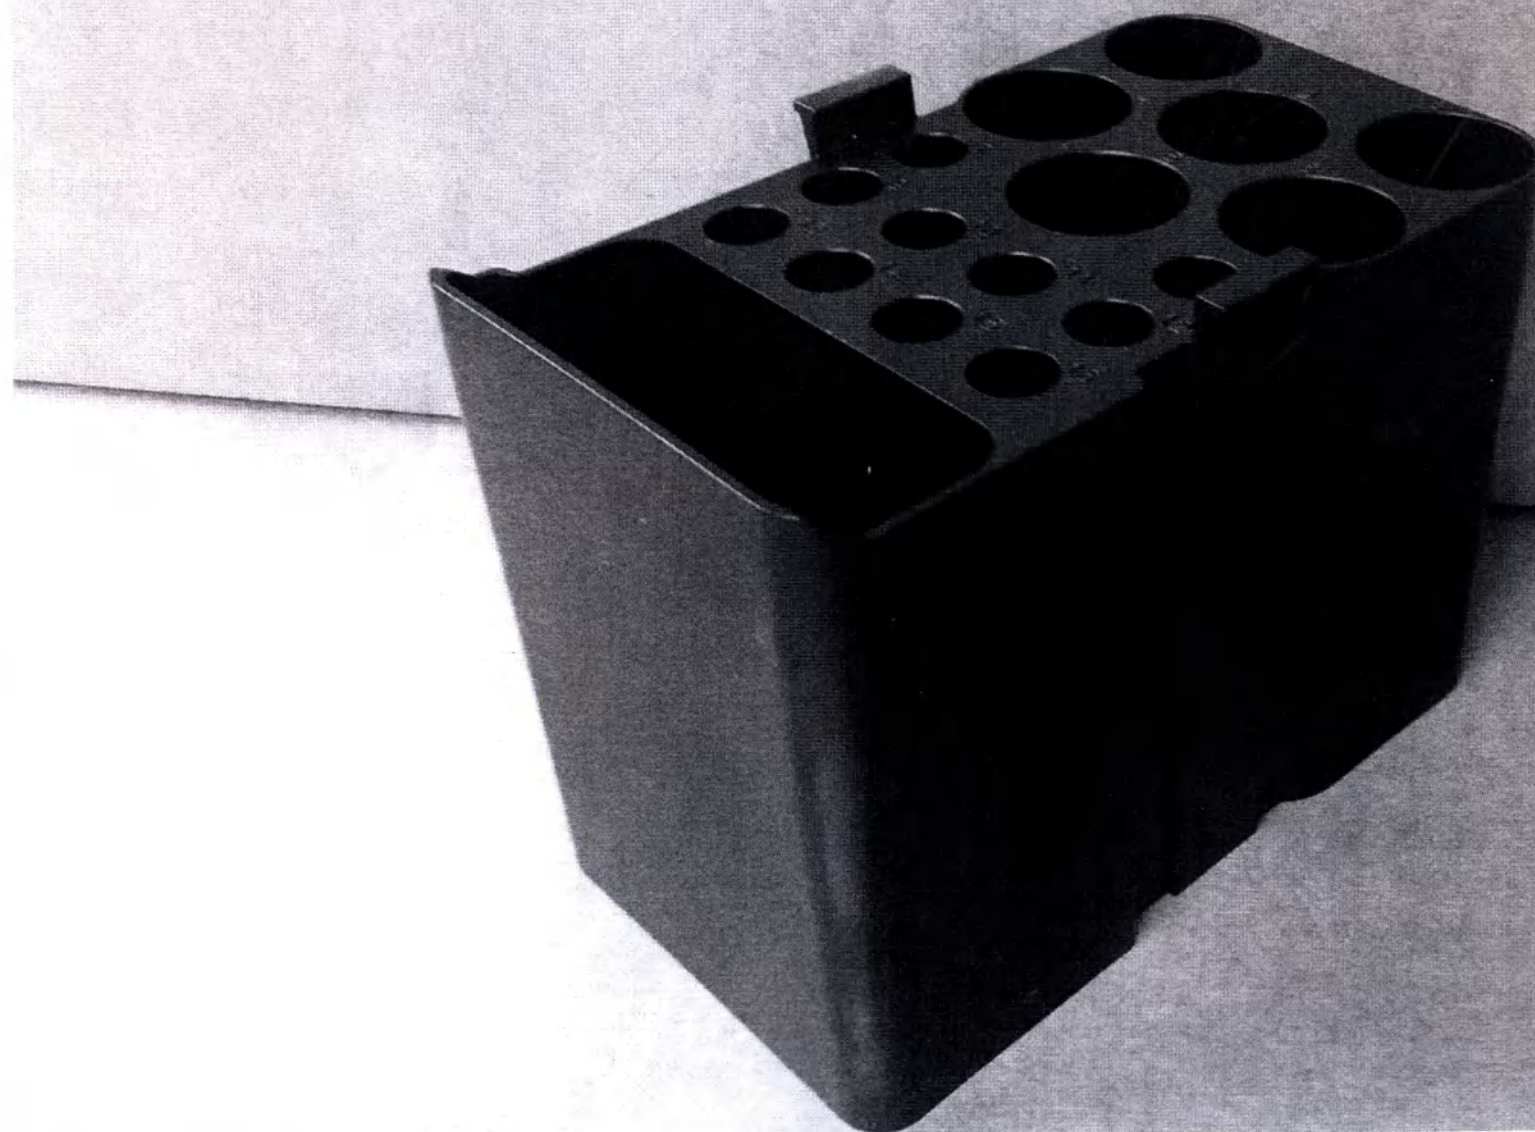


Фото 19. Штатив «Бронзовый» (Bronze Kit Insert).



Фото 20. Лоток для штатива «Бронзовый» (Bronze Kit Trough).

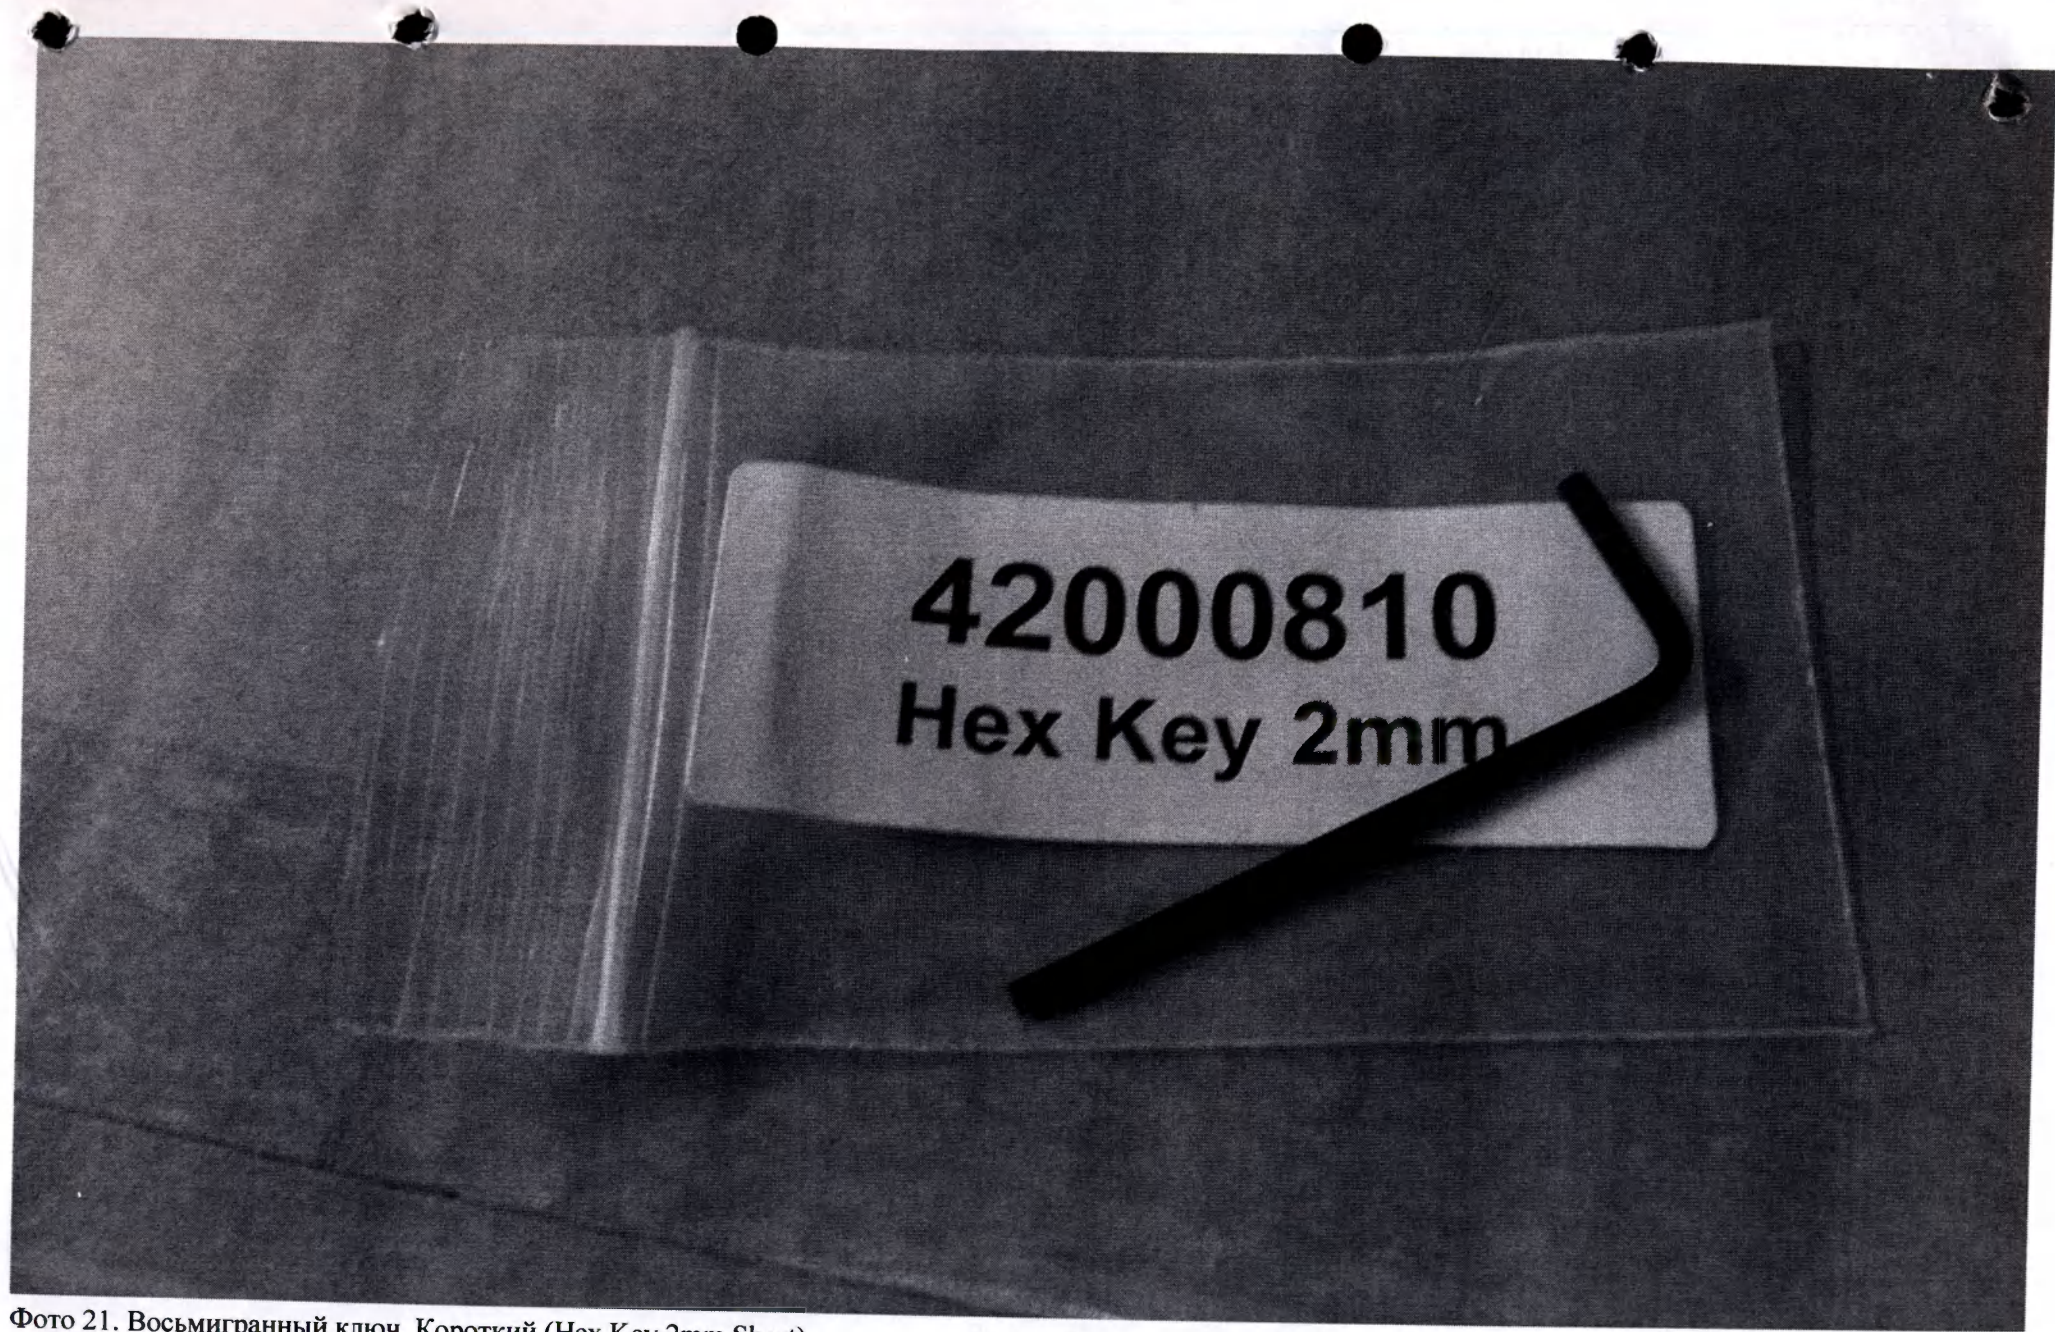


Фото 21. Восьмигранный ключ, Короткий (Hex Key 2mm Short).

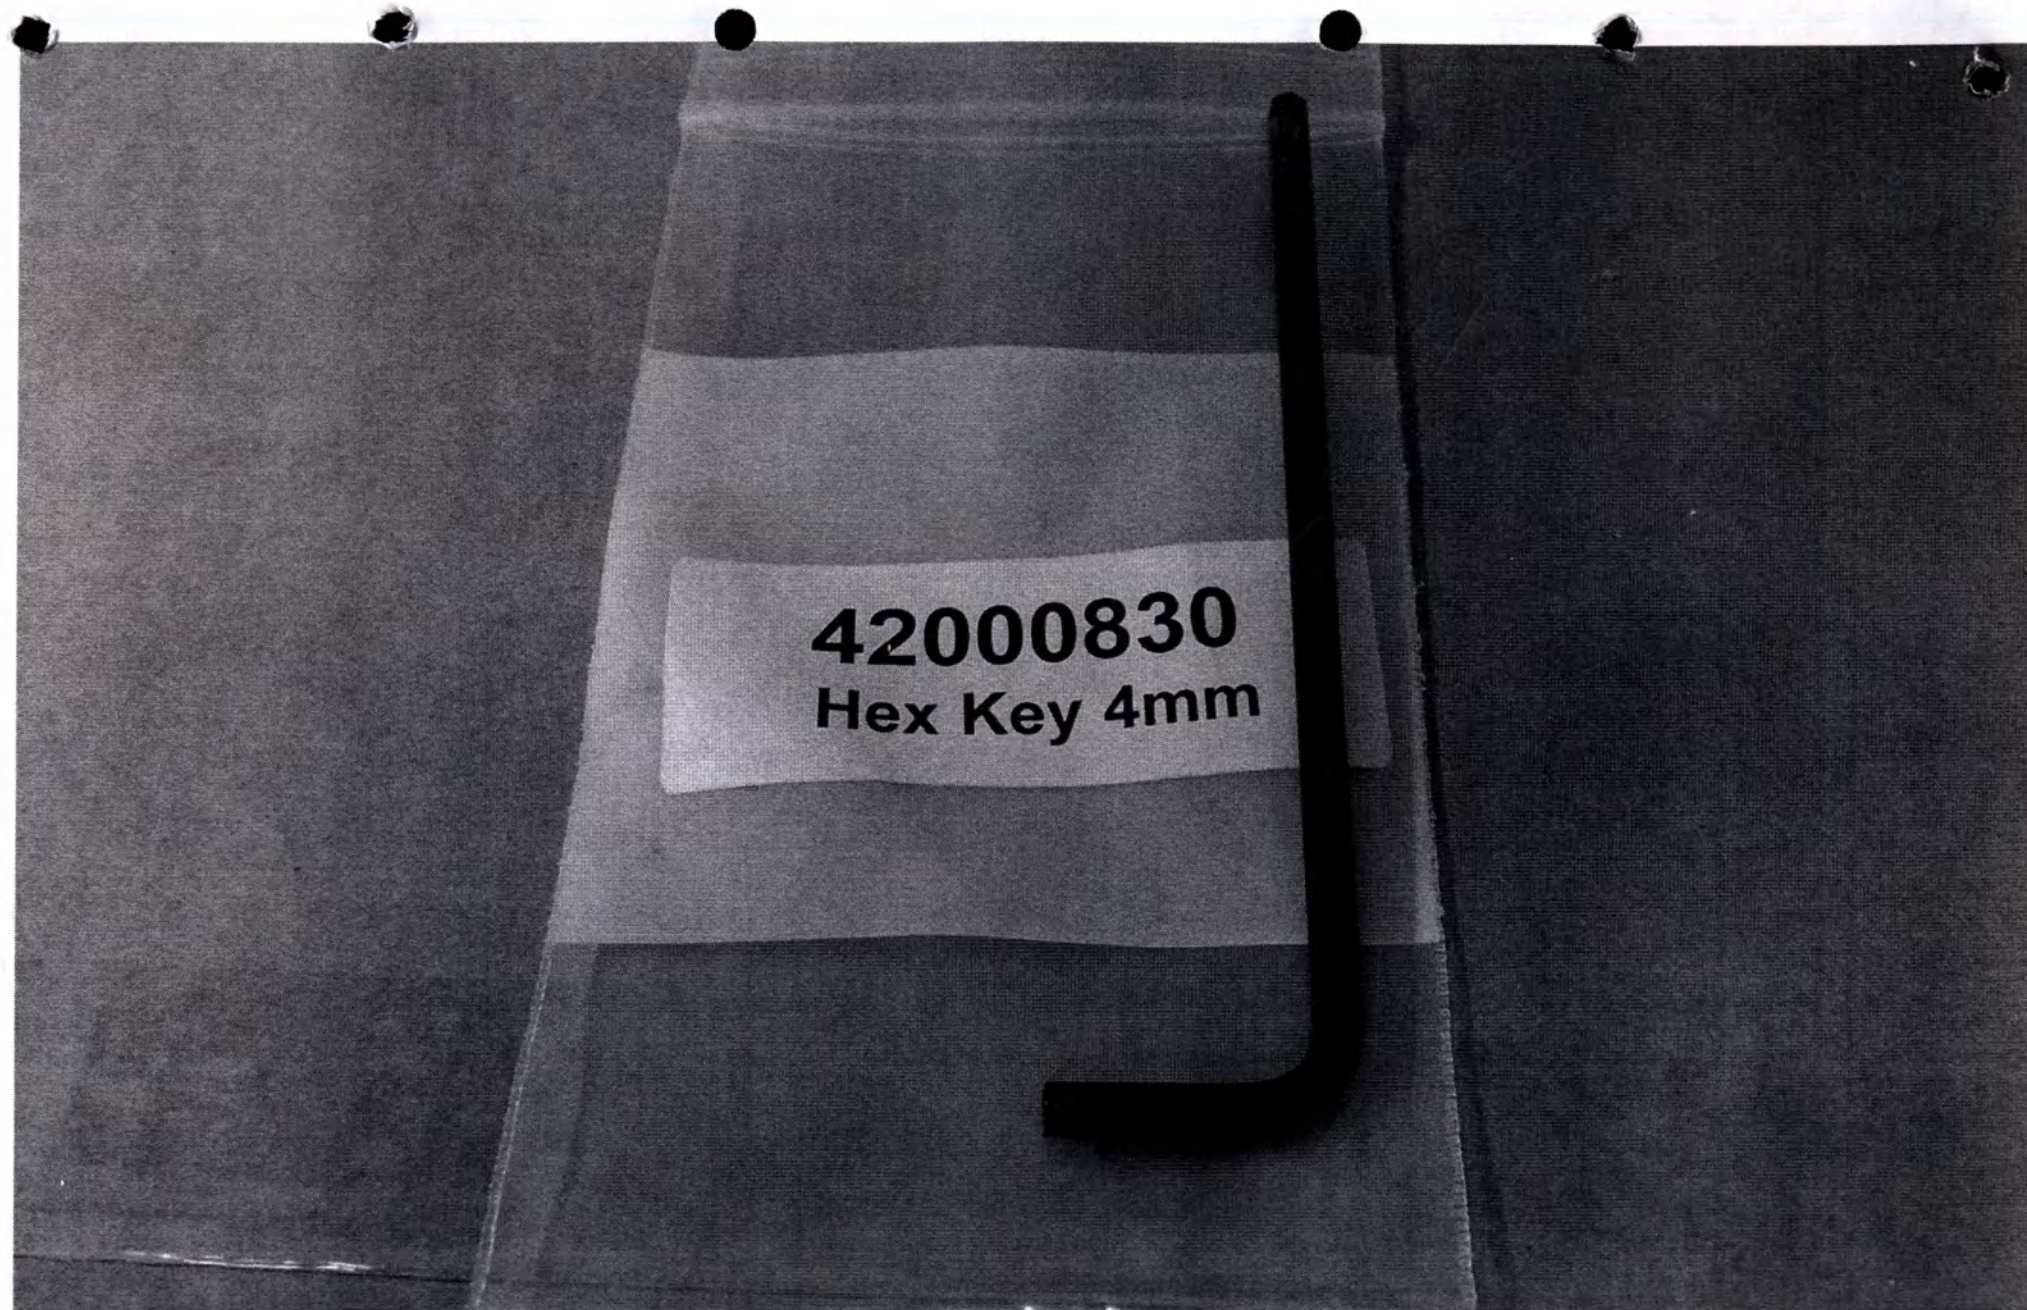


Фото 22. Восьмигранный ключ, Длинный (Hex Key 4mm Long).

[illegible][illegible]

SUMMARY AND DISCUSSION

WARRANTY CARD

DATA

Product

Serial Number _____

User Name _____

Company/Institution Name _____

Department _____

Address _____

City _____ State _____ Zip _____

Telephone No. _____ Ext. _____

Comments

www.dynextechnologies.com

— 2004 —

Фото 23. Гарантийный формуляр (Card warranty).



Фото 24. Шнур питания (Power cord).

ПРОШТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
26 ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЛИСТОВ
ШЕСТЬ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Позднев П.В.