

ООО «ЛАНГЕР ГРУПП»
119002, г. Москва, Сивцев Вражек пер., 29/16 стр1

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

«Аппарат для подкожных инъекций CO₂ CARBOMED»

Производства «LED SpA» / «ЛЕД СпА», Италия.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
(должность)

Н.В.







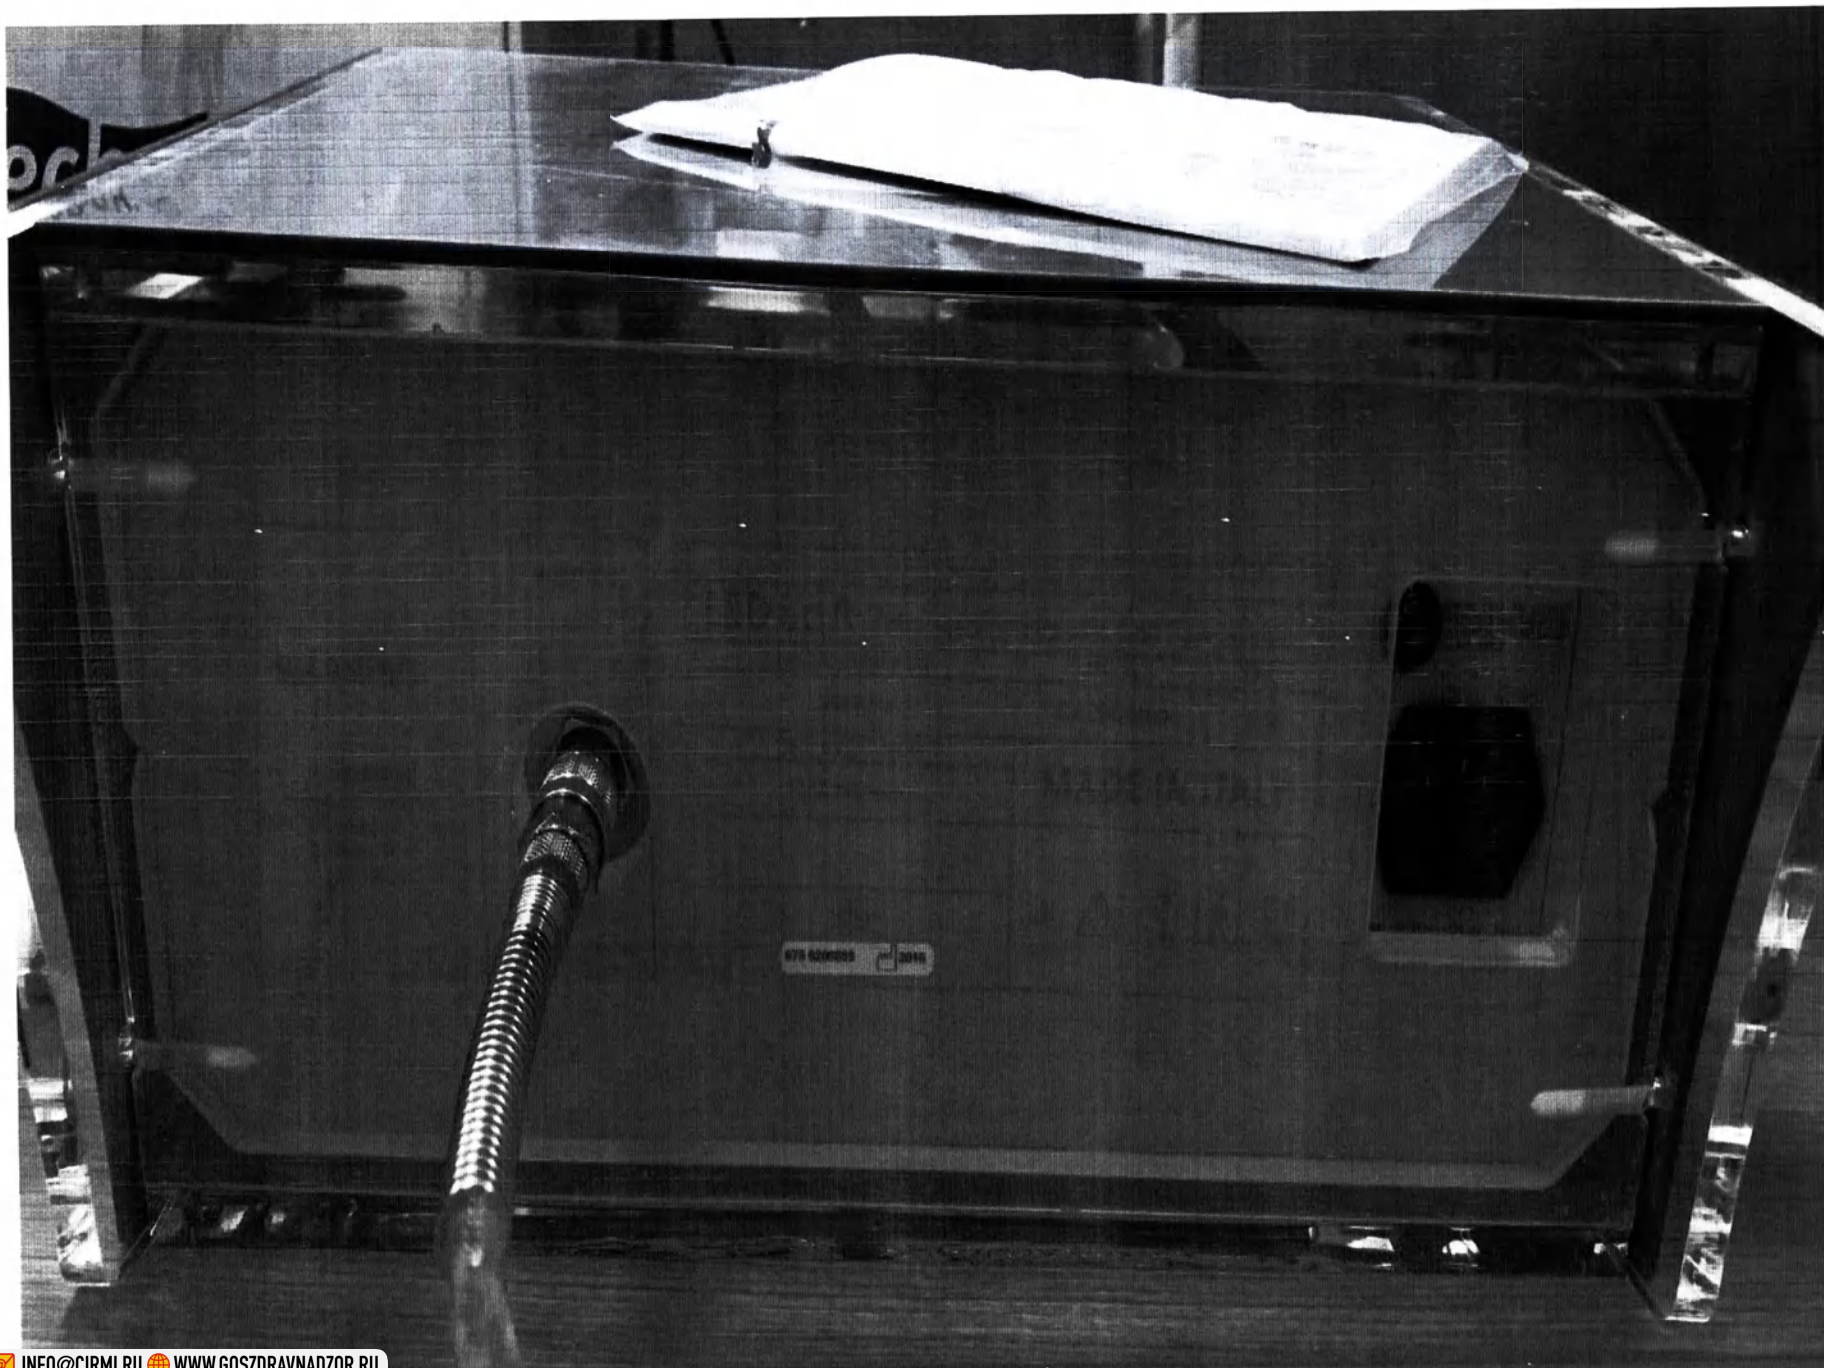
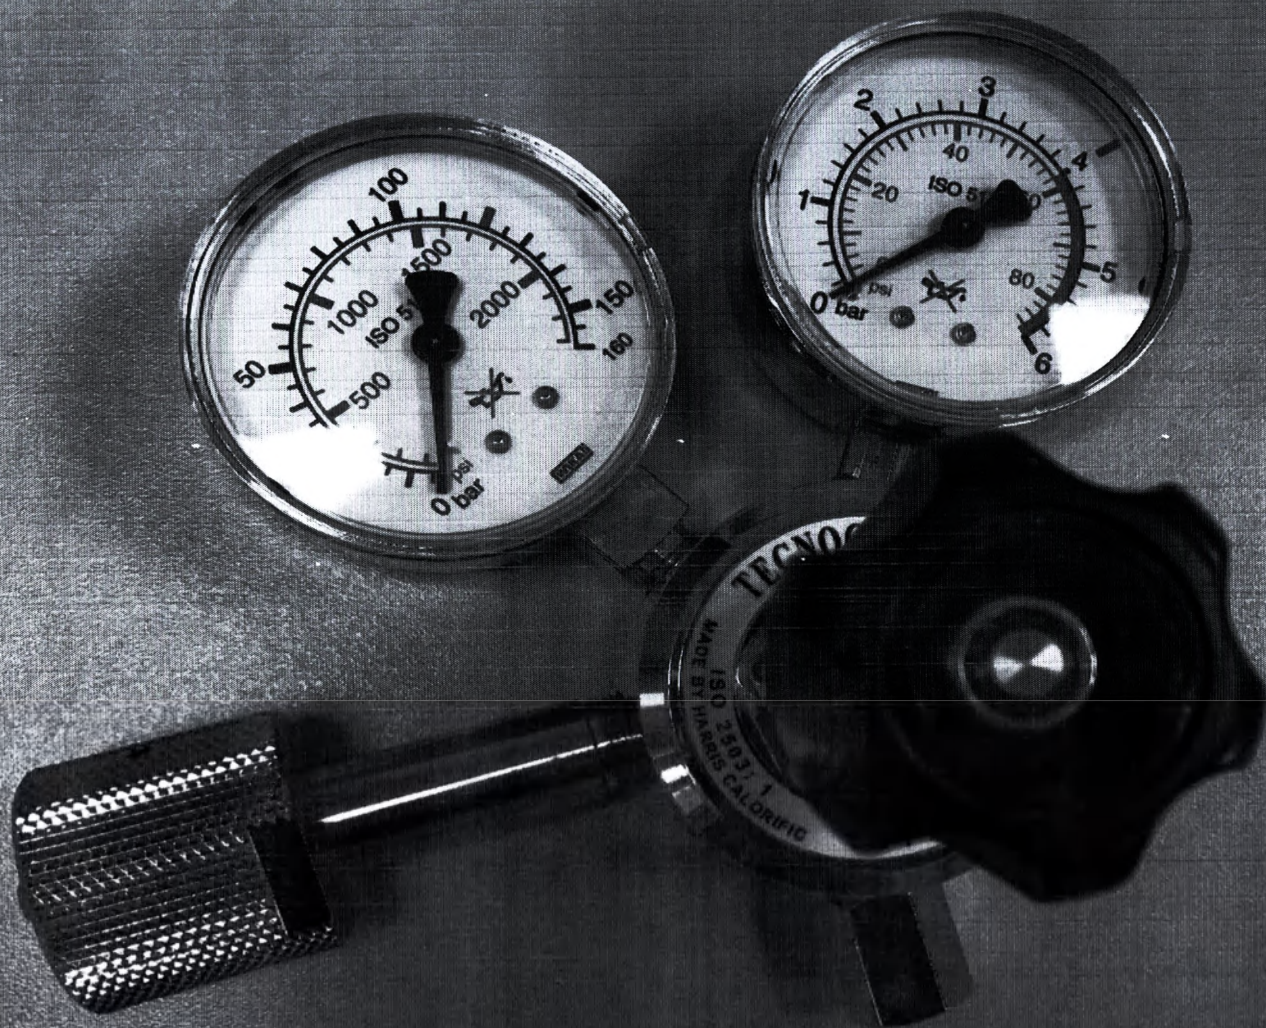


Рис.3. Аппарат для подкожных инъекций CO₂ CARBOMED. Фотографическое изображение задней части прибора.



Рис.4. Фотография кабеля с датчиком температуры и влажности для системы S-17. Кабель выполнен из ПВХ и имеет длину 10 м.





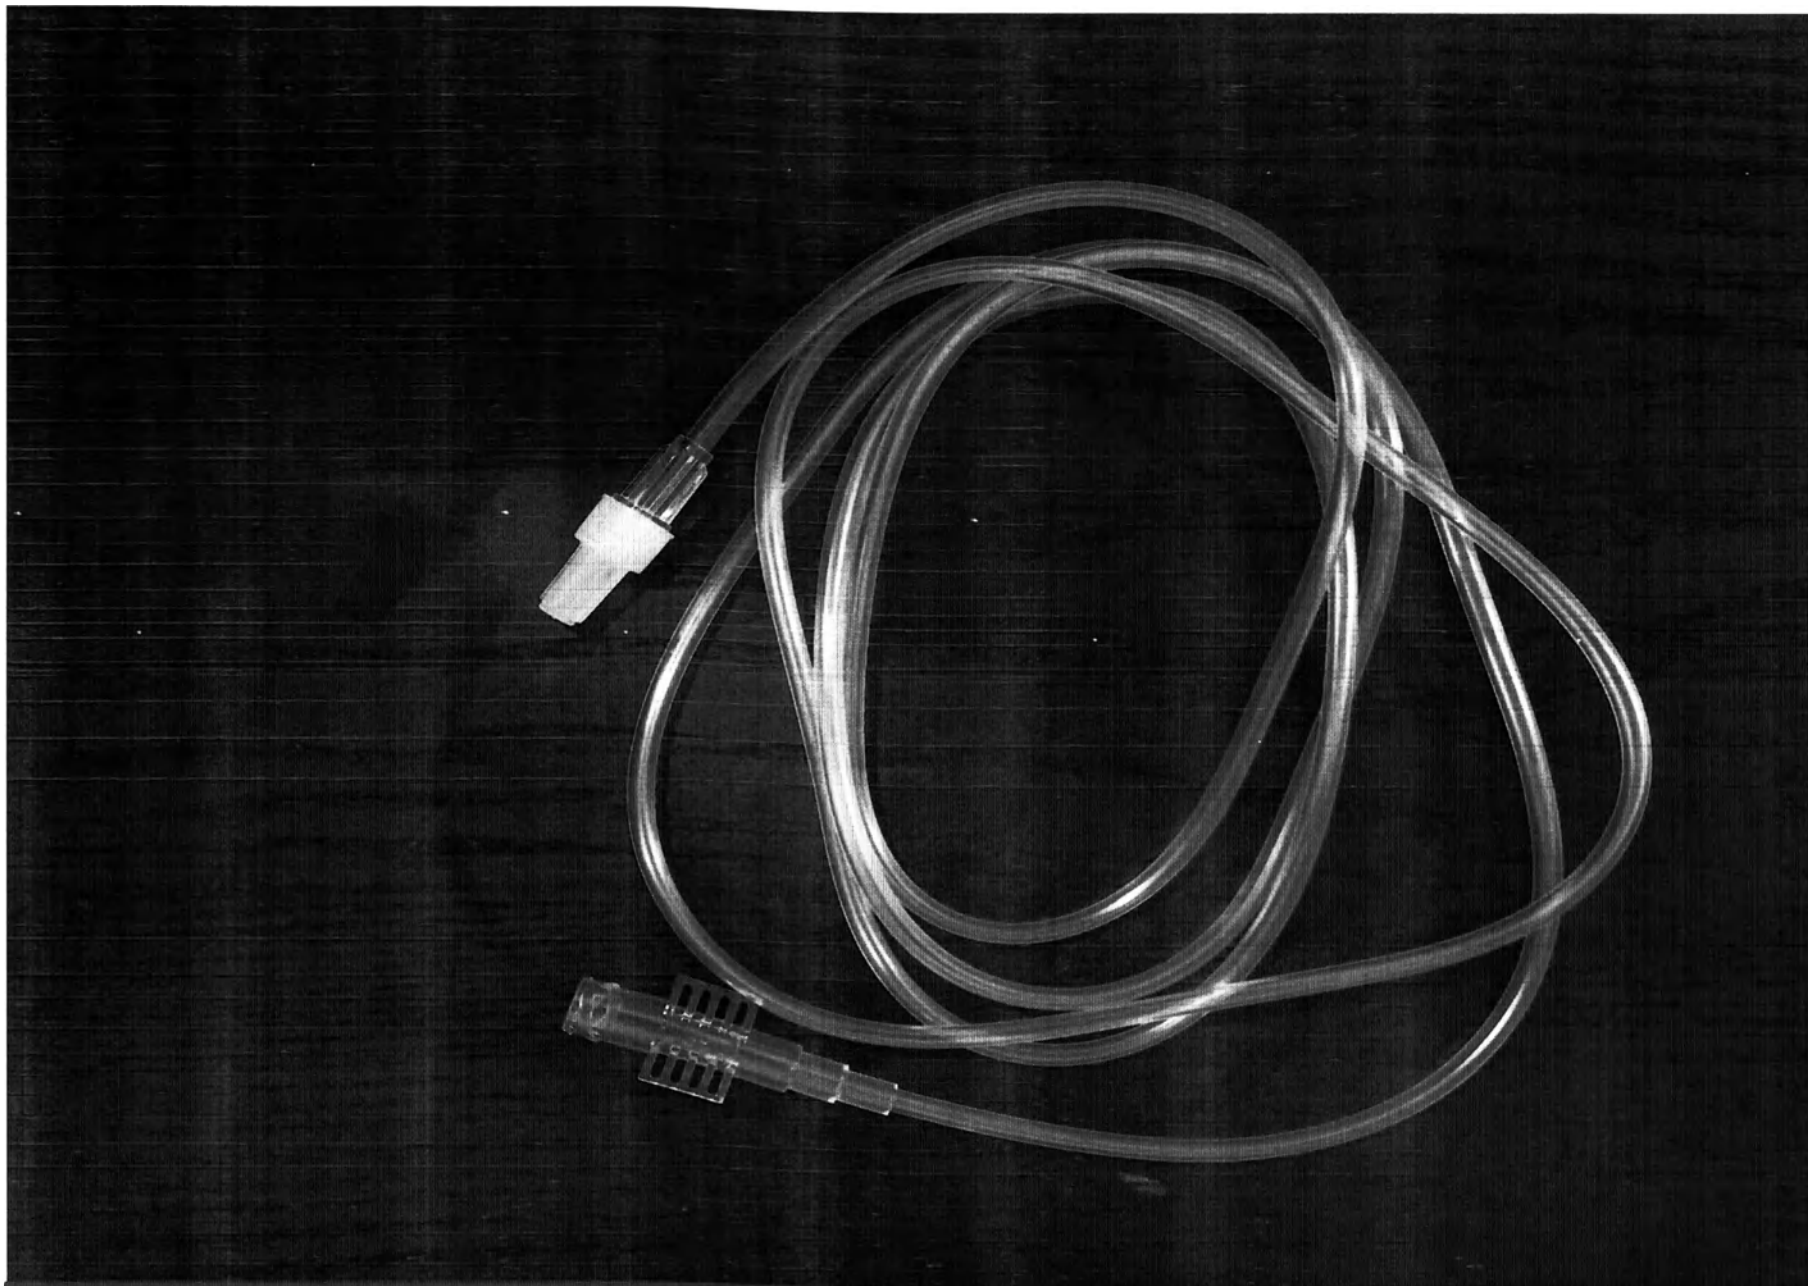


Рис.7. Фотографическое изображение трубки выходной, входящей в состав медицинского изделия.

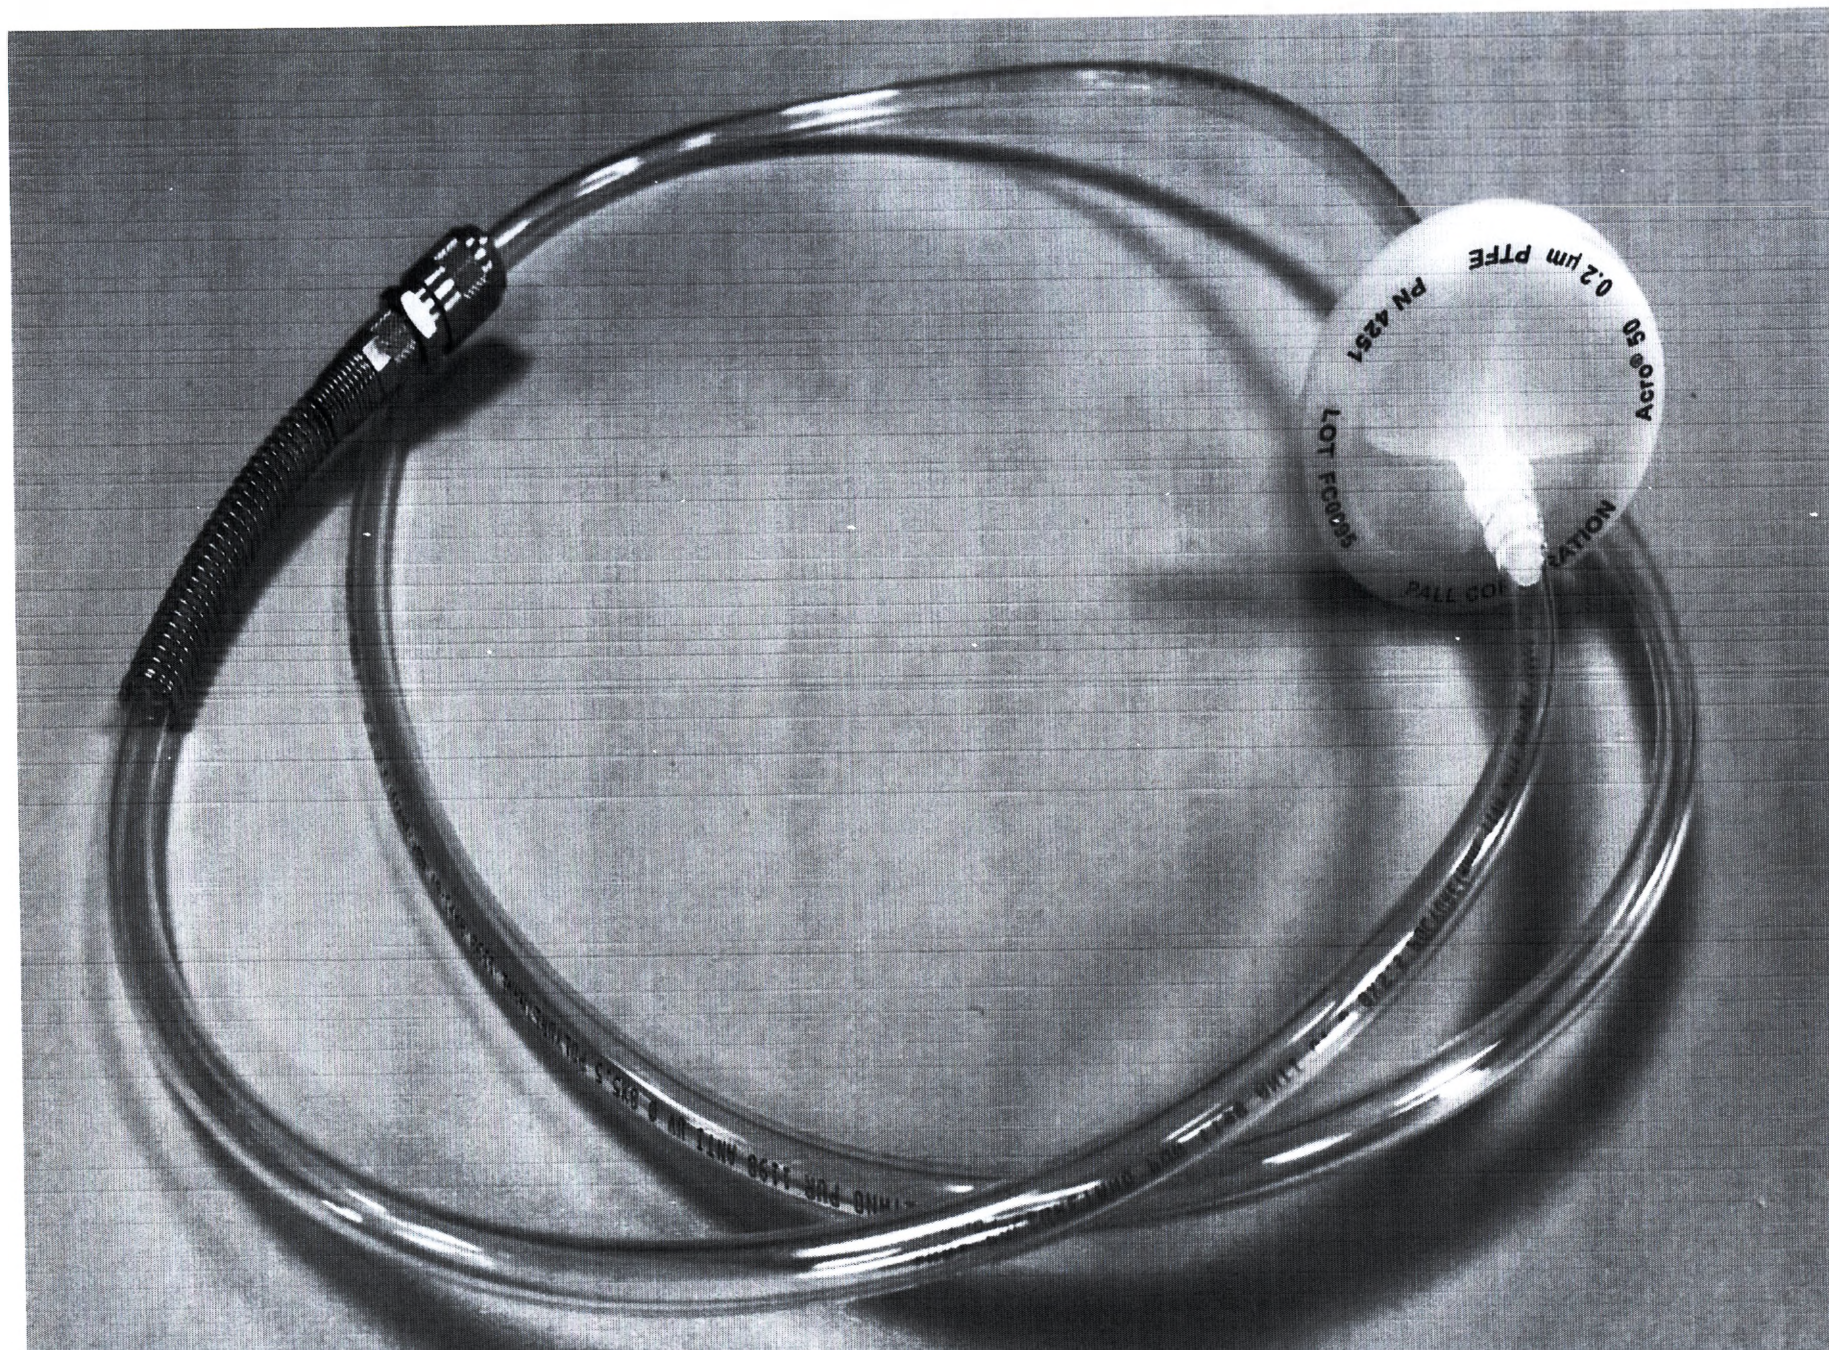


Рис.8. Фотографическое изображение комплекта для подключения редукционного клапана на вход, в составе:



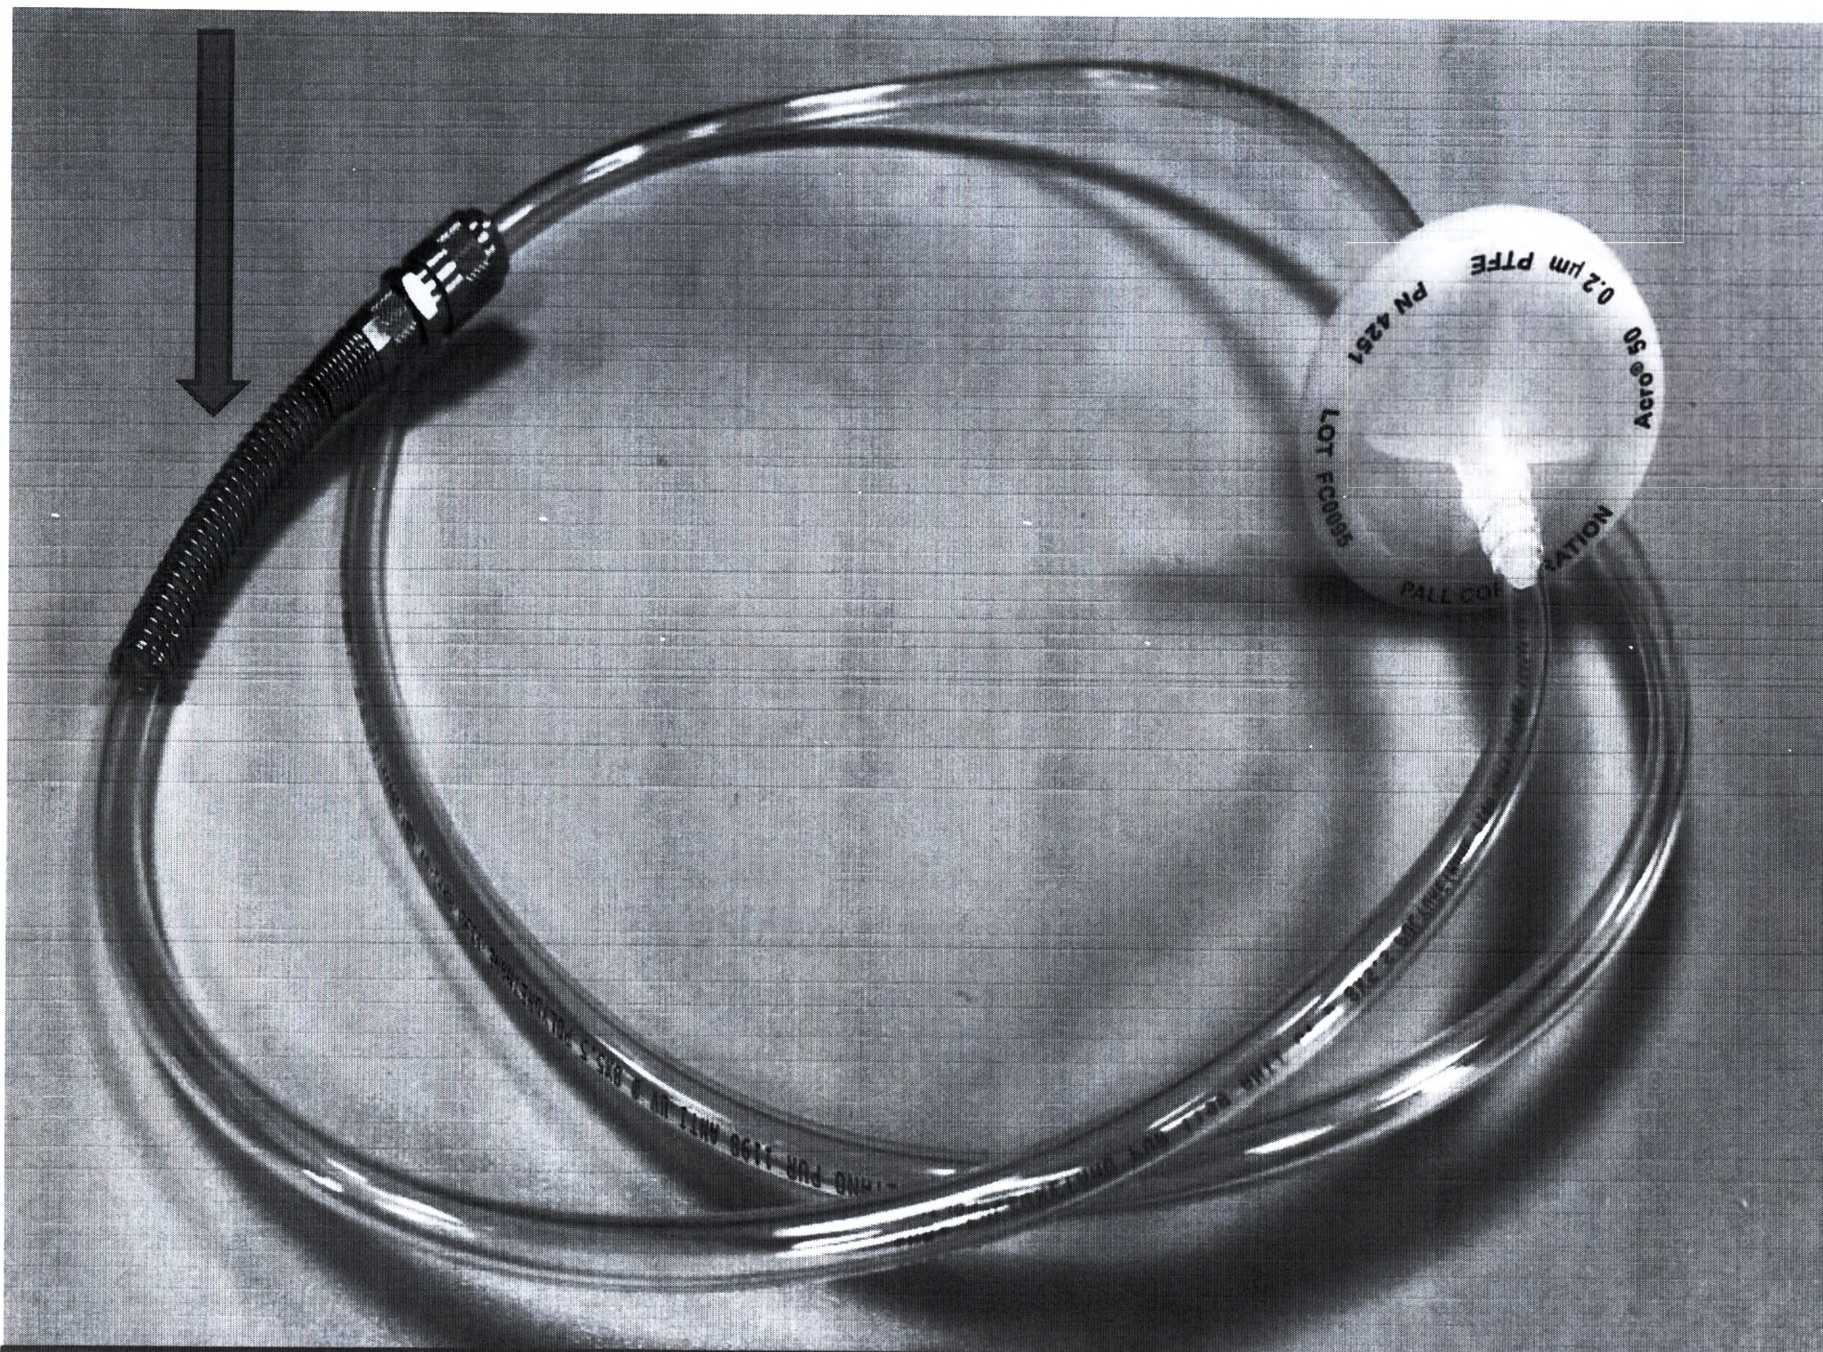


Рис.10. Фотографическое изображение фильтра.

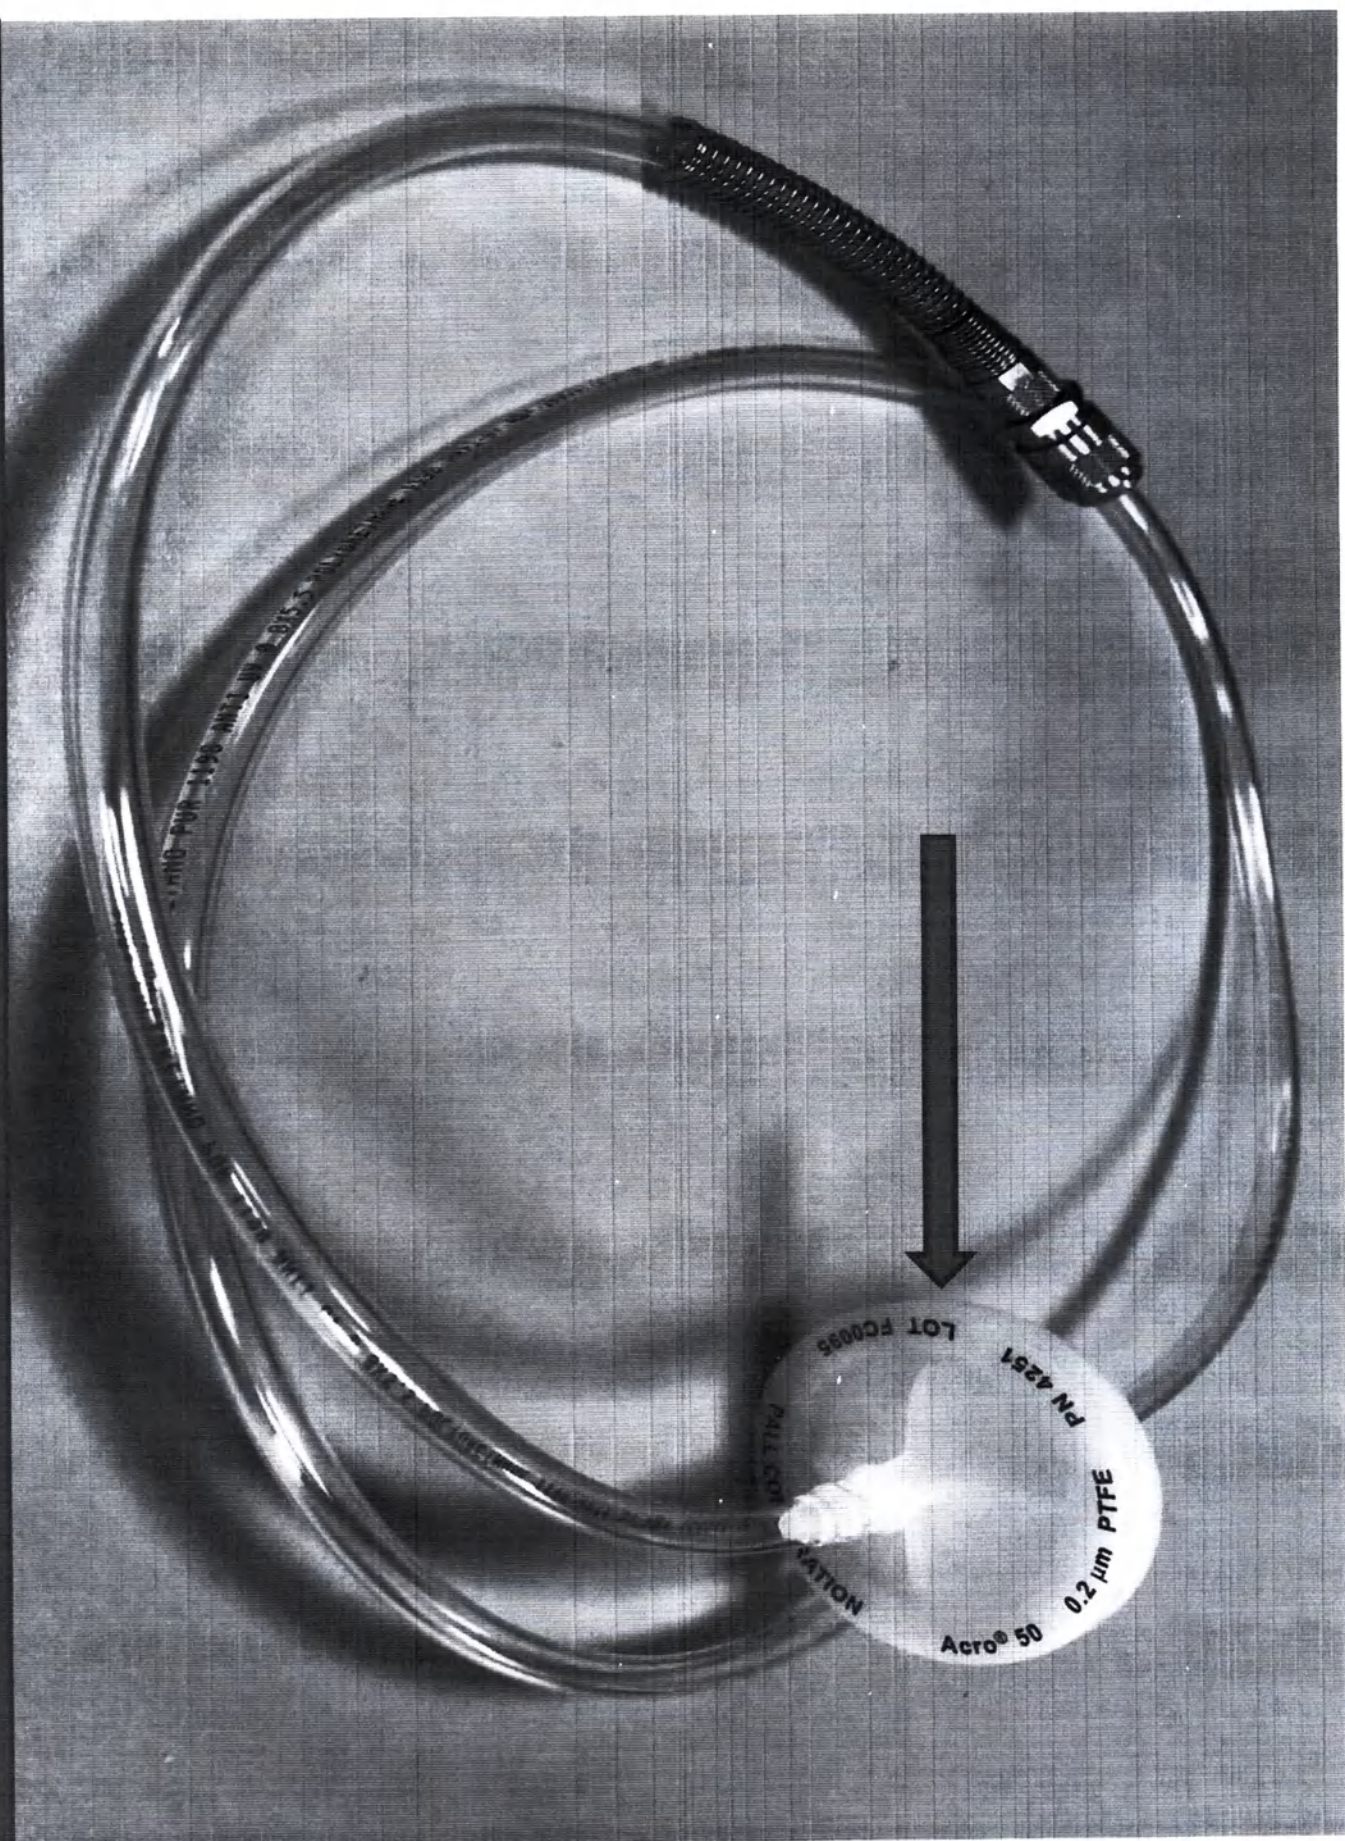

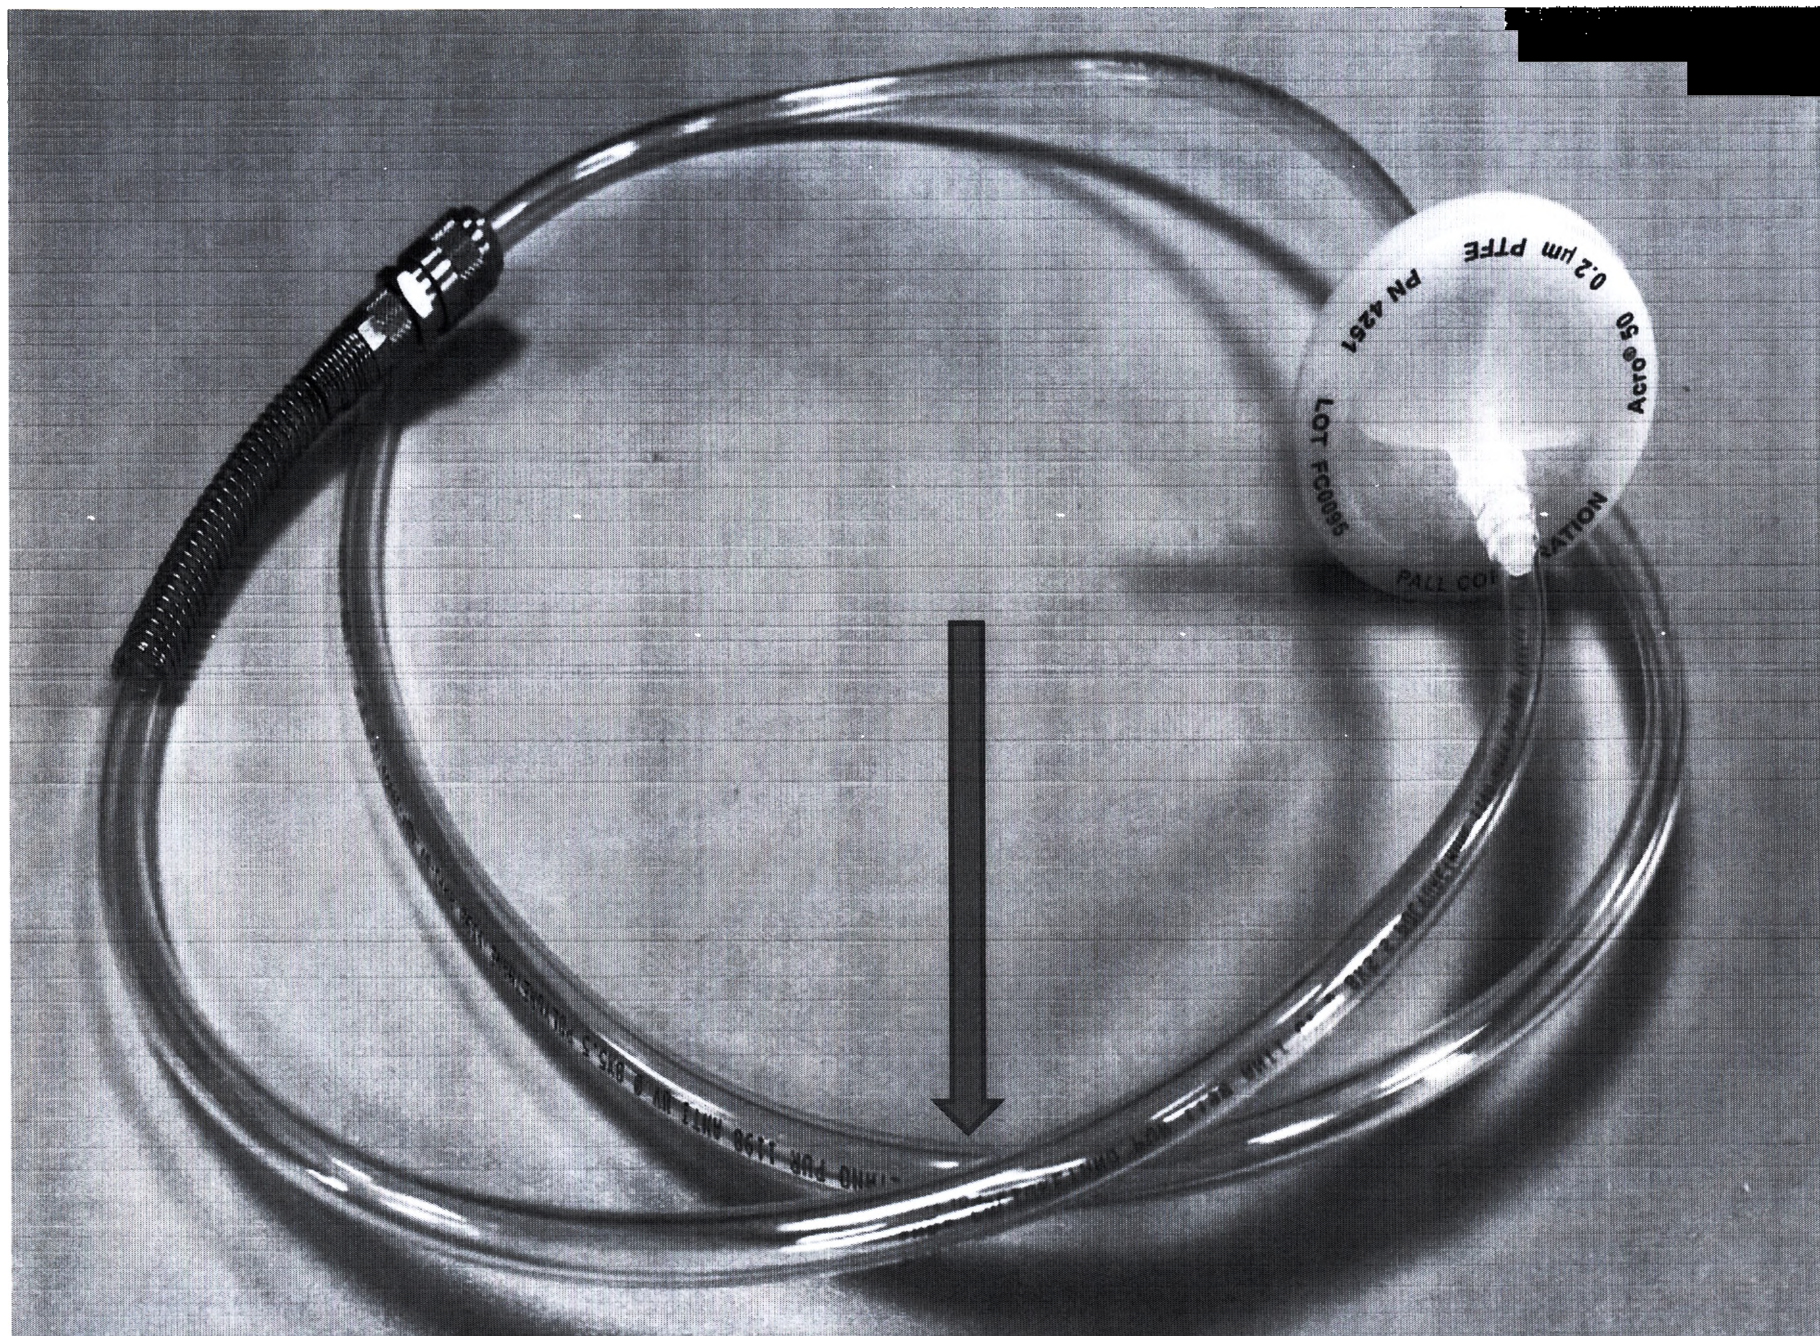

LED SpA

Instruction for use/Руководство по эксплуатации
«Анализатор для переносных измерений CO₂ CARBOMED»



Наименование	ПЗНМ	Назначение для эксплуатации на стационарном анализаторе для переносных измерений CO ₂ CARBOMED»
Линейный датчик	240 1007	Измерение
Датчик температуры	0	Измерение
Датчик влажности	01	Измерение
Датчик давления	1000	Измерение
Датчик pH	00	Измерение
Датчик электропроводности	0	Измерение
Датчик кислорода	0	Измерение

