

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Фармстандарт - Медтехника»

А.Ф. Зезуля


2019 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
"Машина термозапаивающая Famos с принадлежностями"





Машина термозапаивающая Famos F110D Protec, F110D Protec Tyvek, F110DBC-P/USB Protec,
F110DBC-P/USB Protec Tyvek, F110DEP-P/USB Protec, F110DEP-P/USB Protec Tyvek

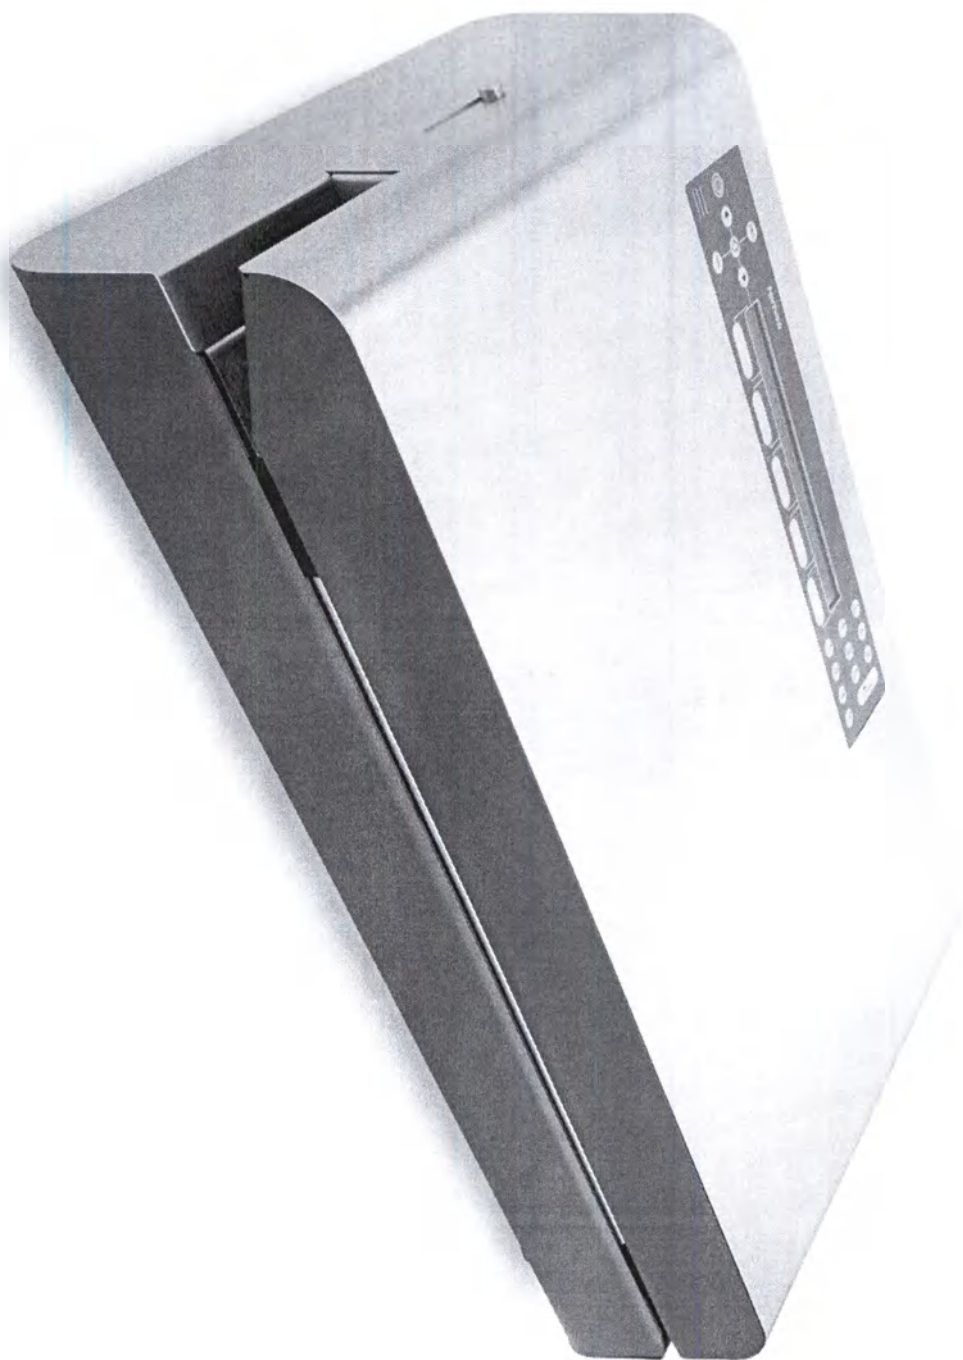


Машина термозапаивающая Famos F220DBC-P/USB Protec, F220DBC-P/USB Protec Tyvek, F220DEP-P/USB Protec, F220DEP-P/USB Protec Tyvek.

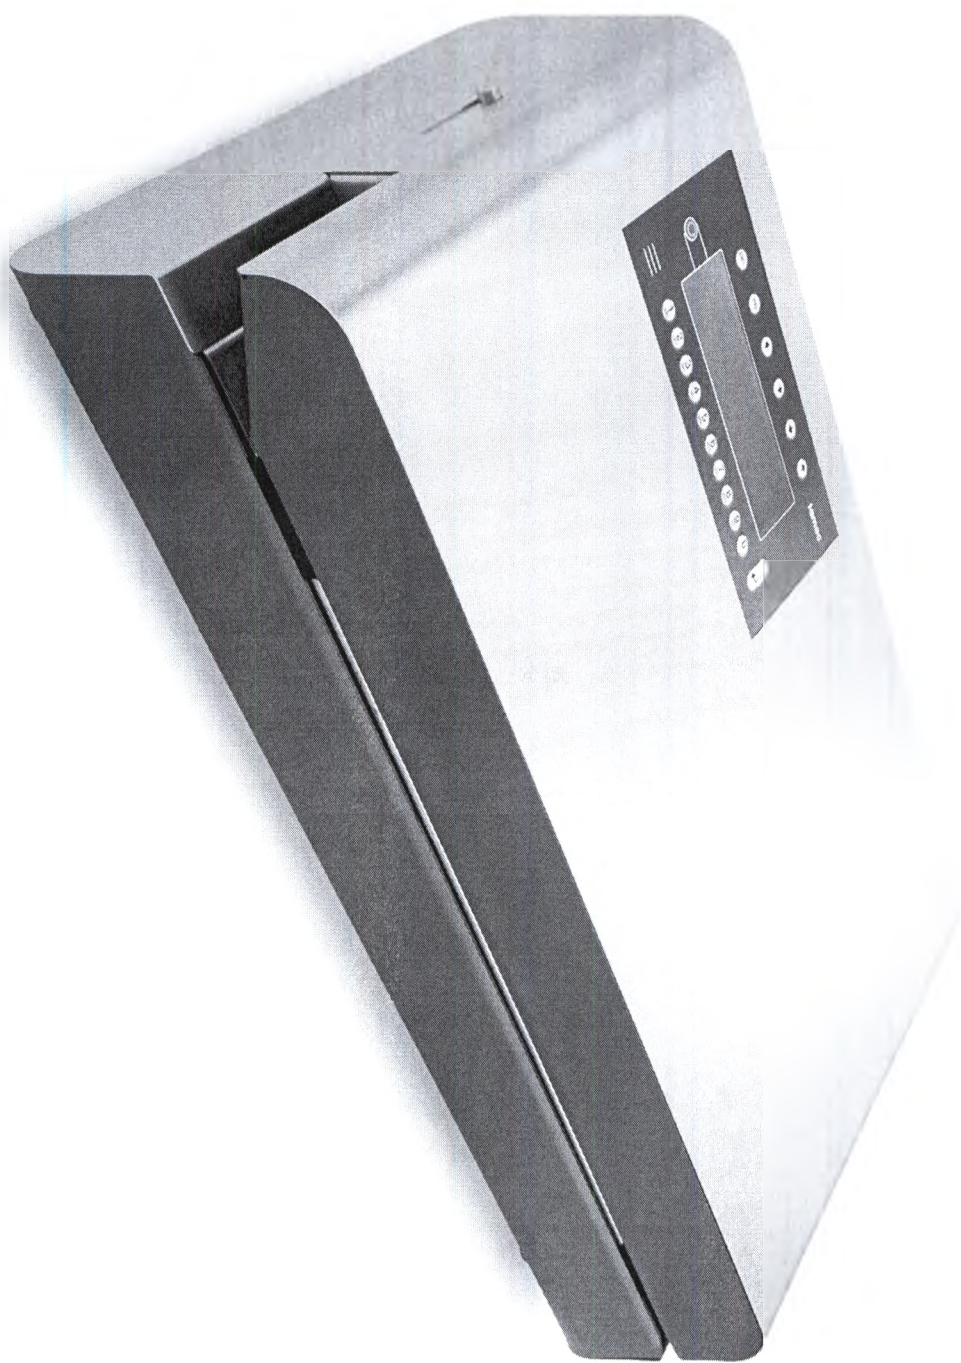


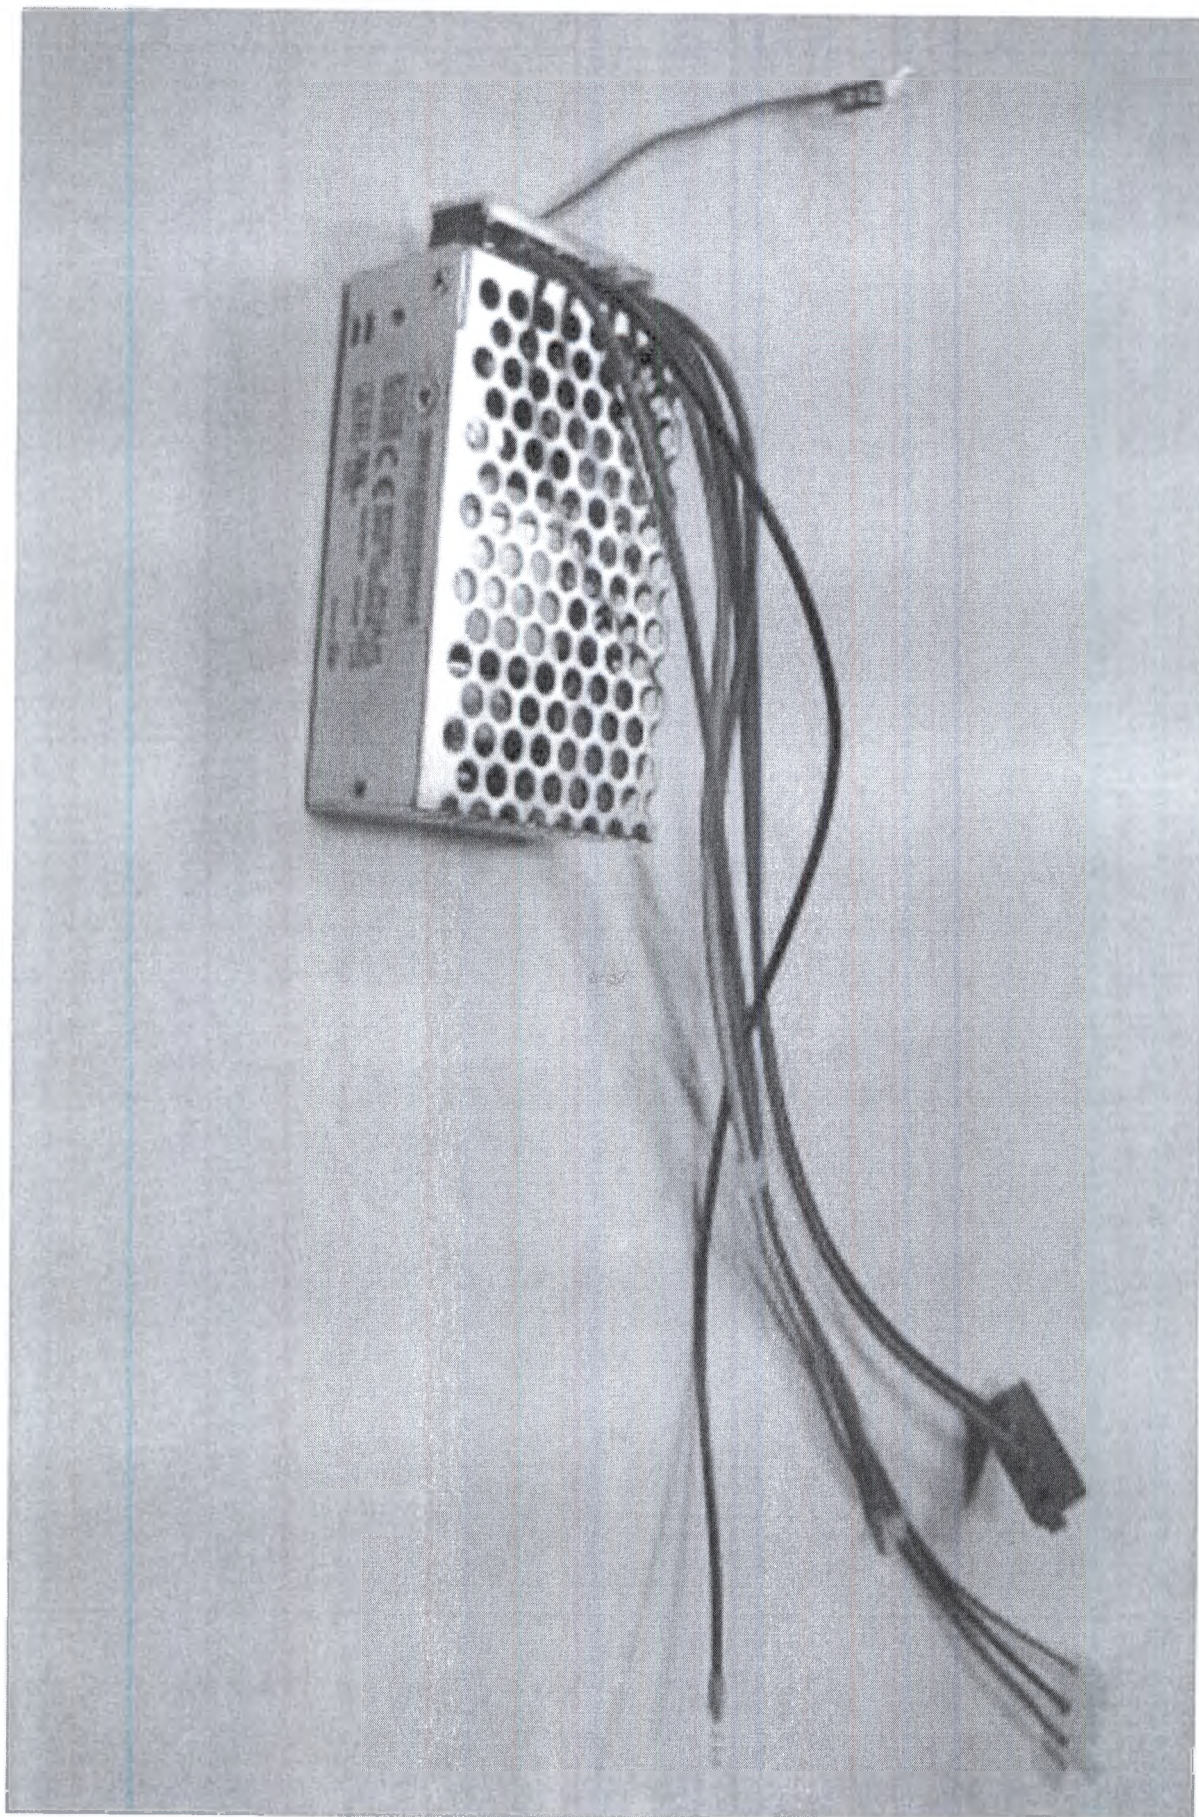

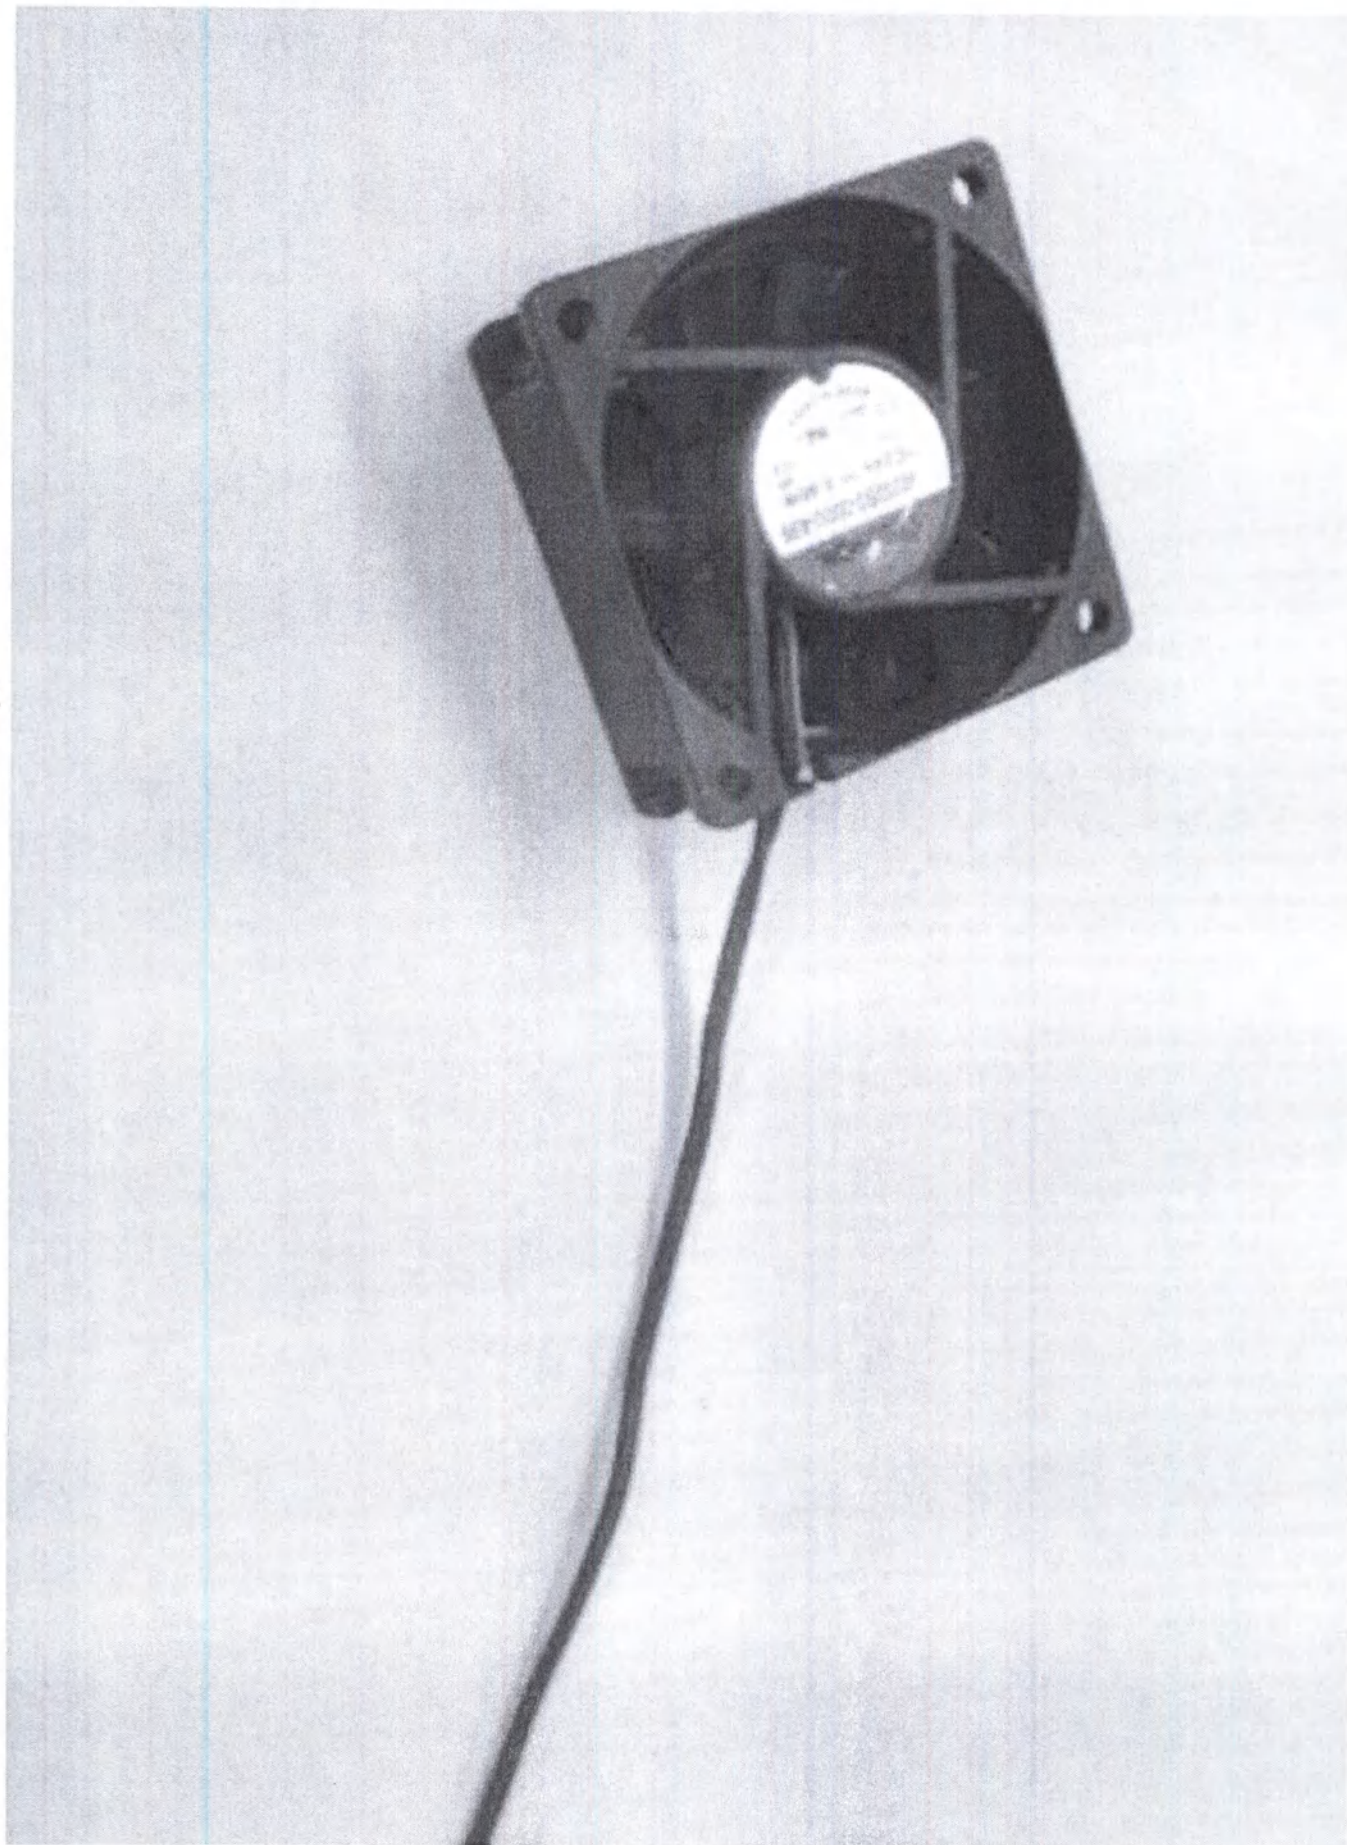


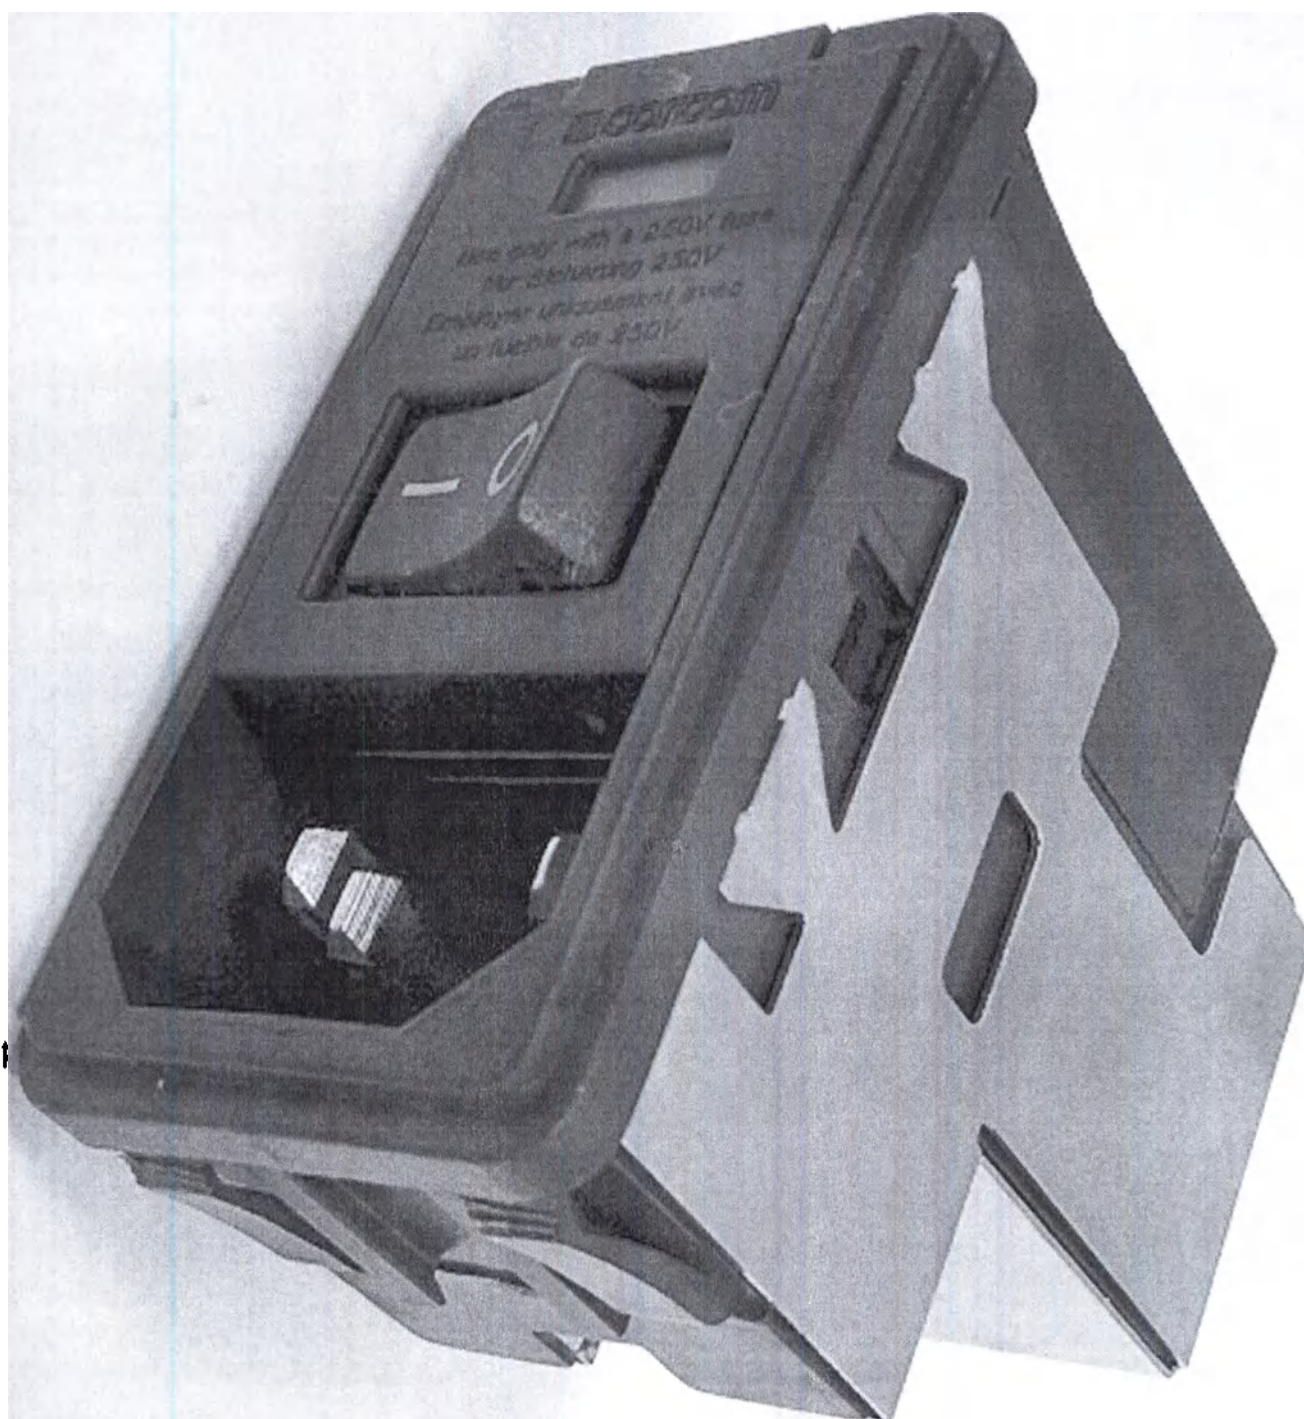




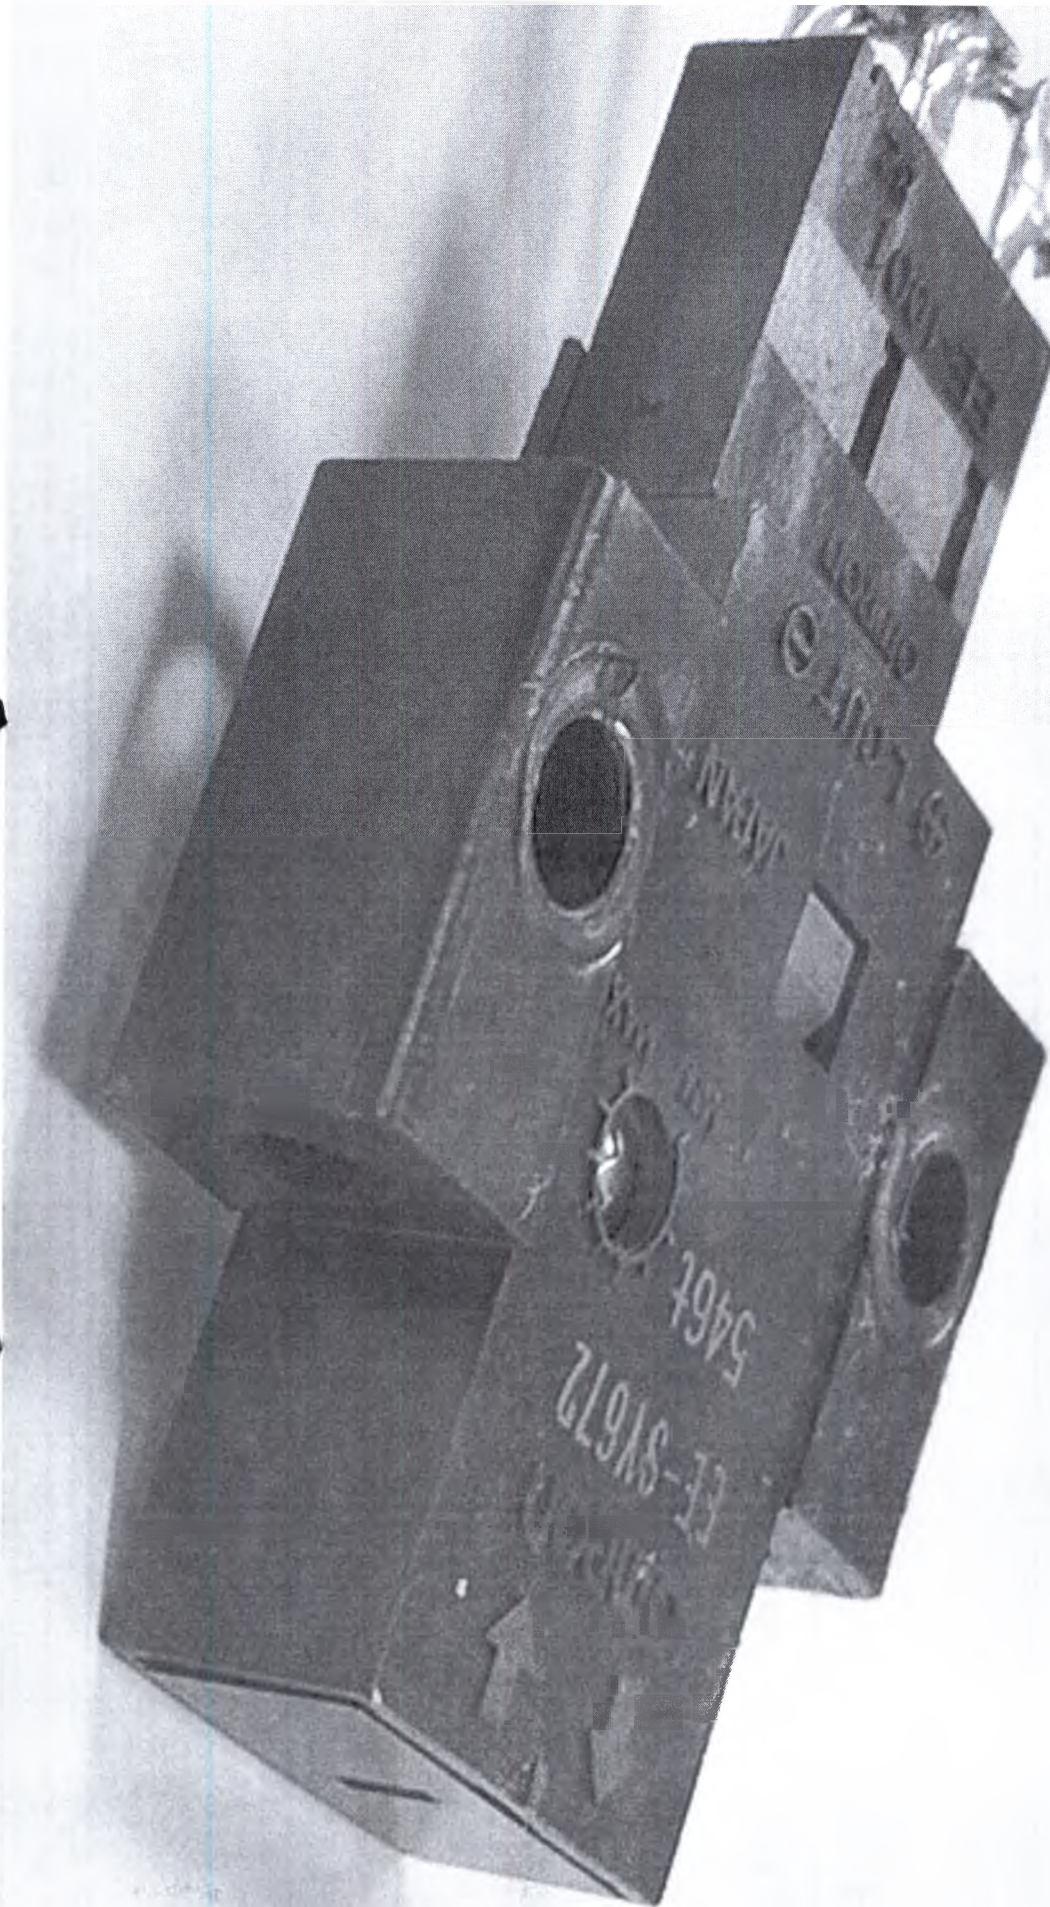


Датчик скорости

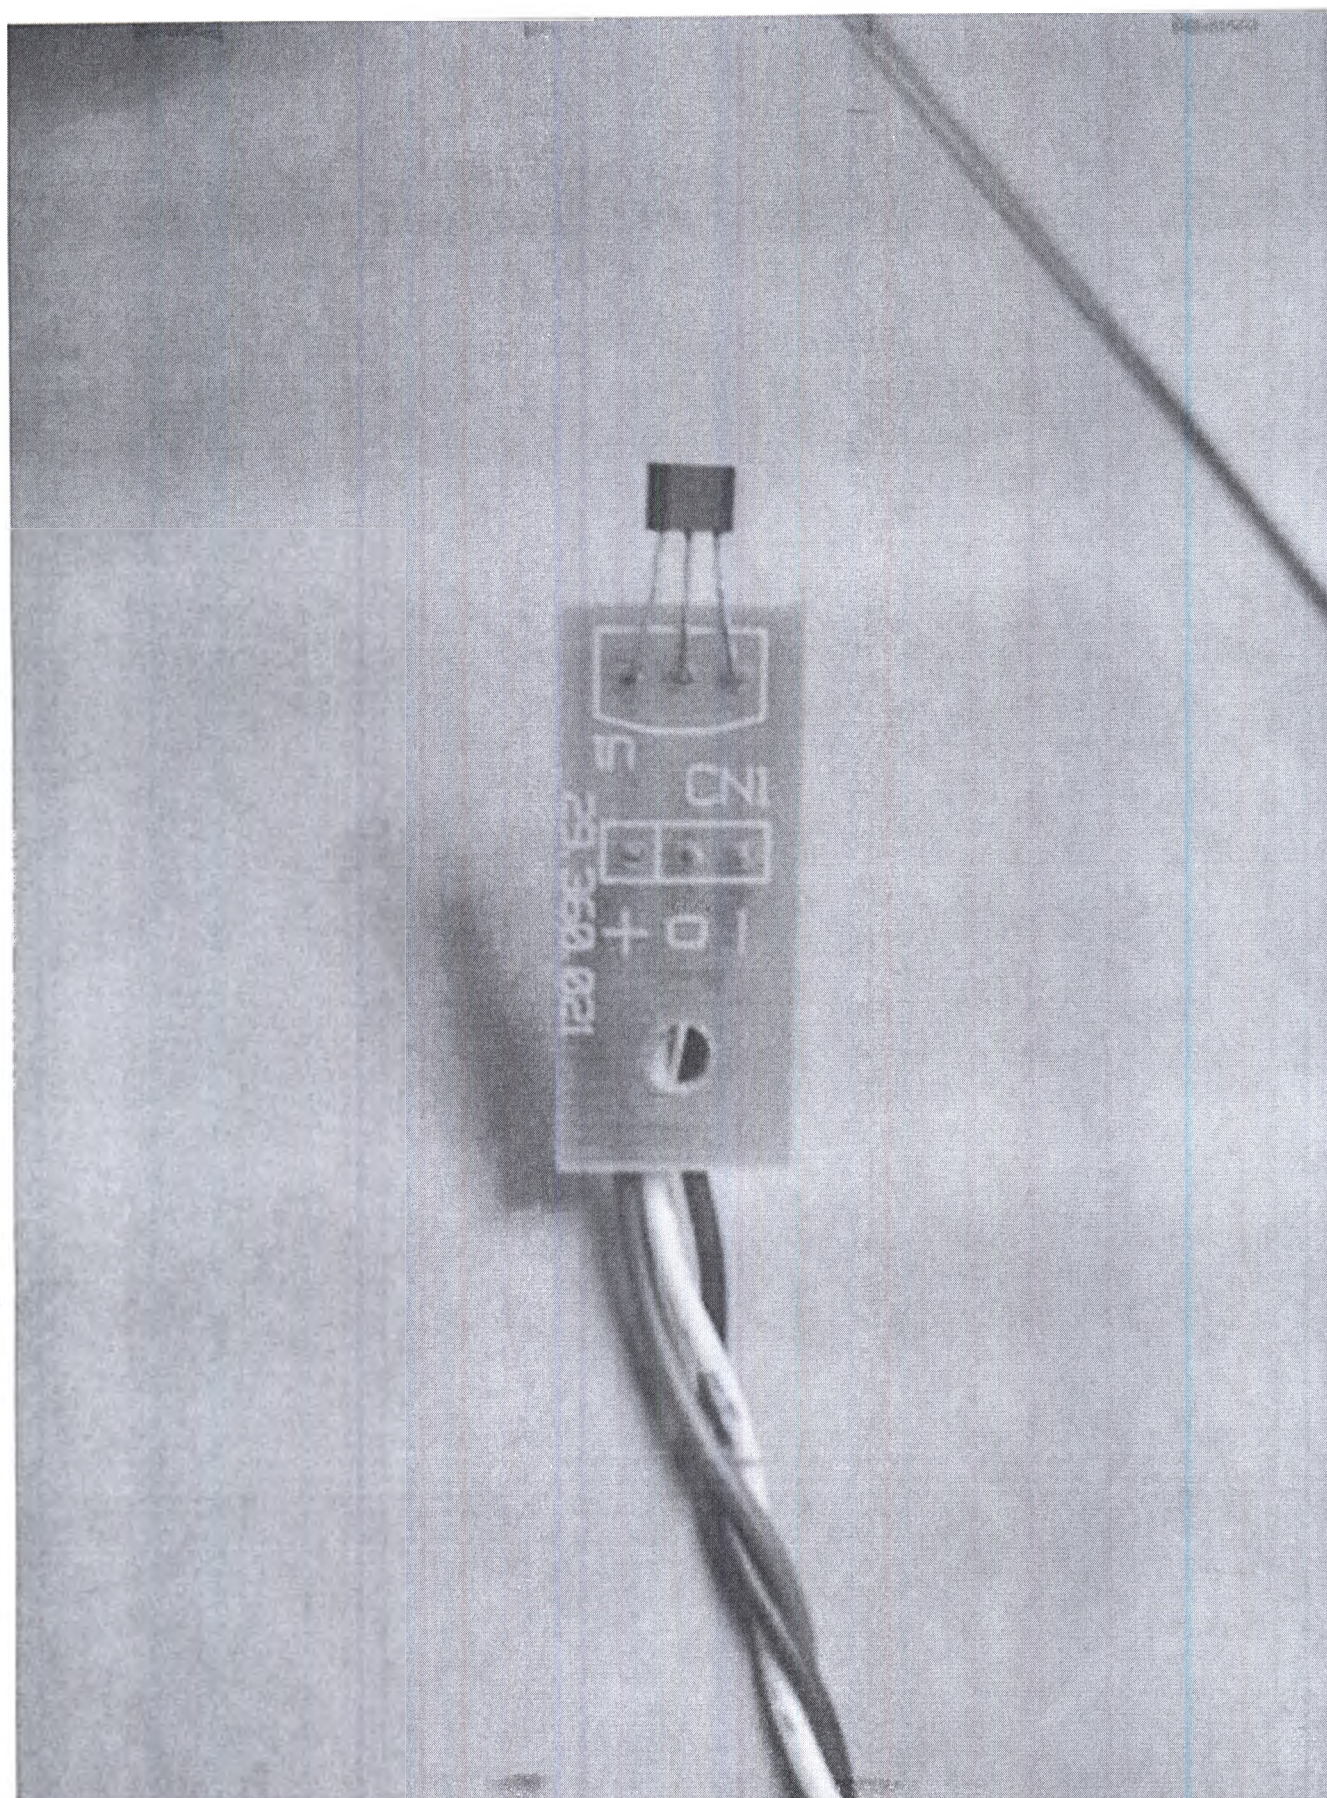


Датчик температуры

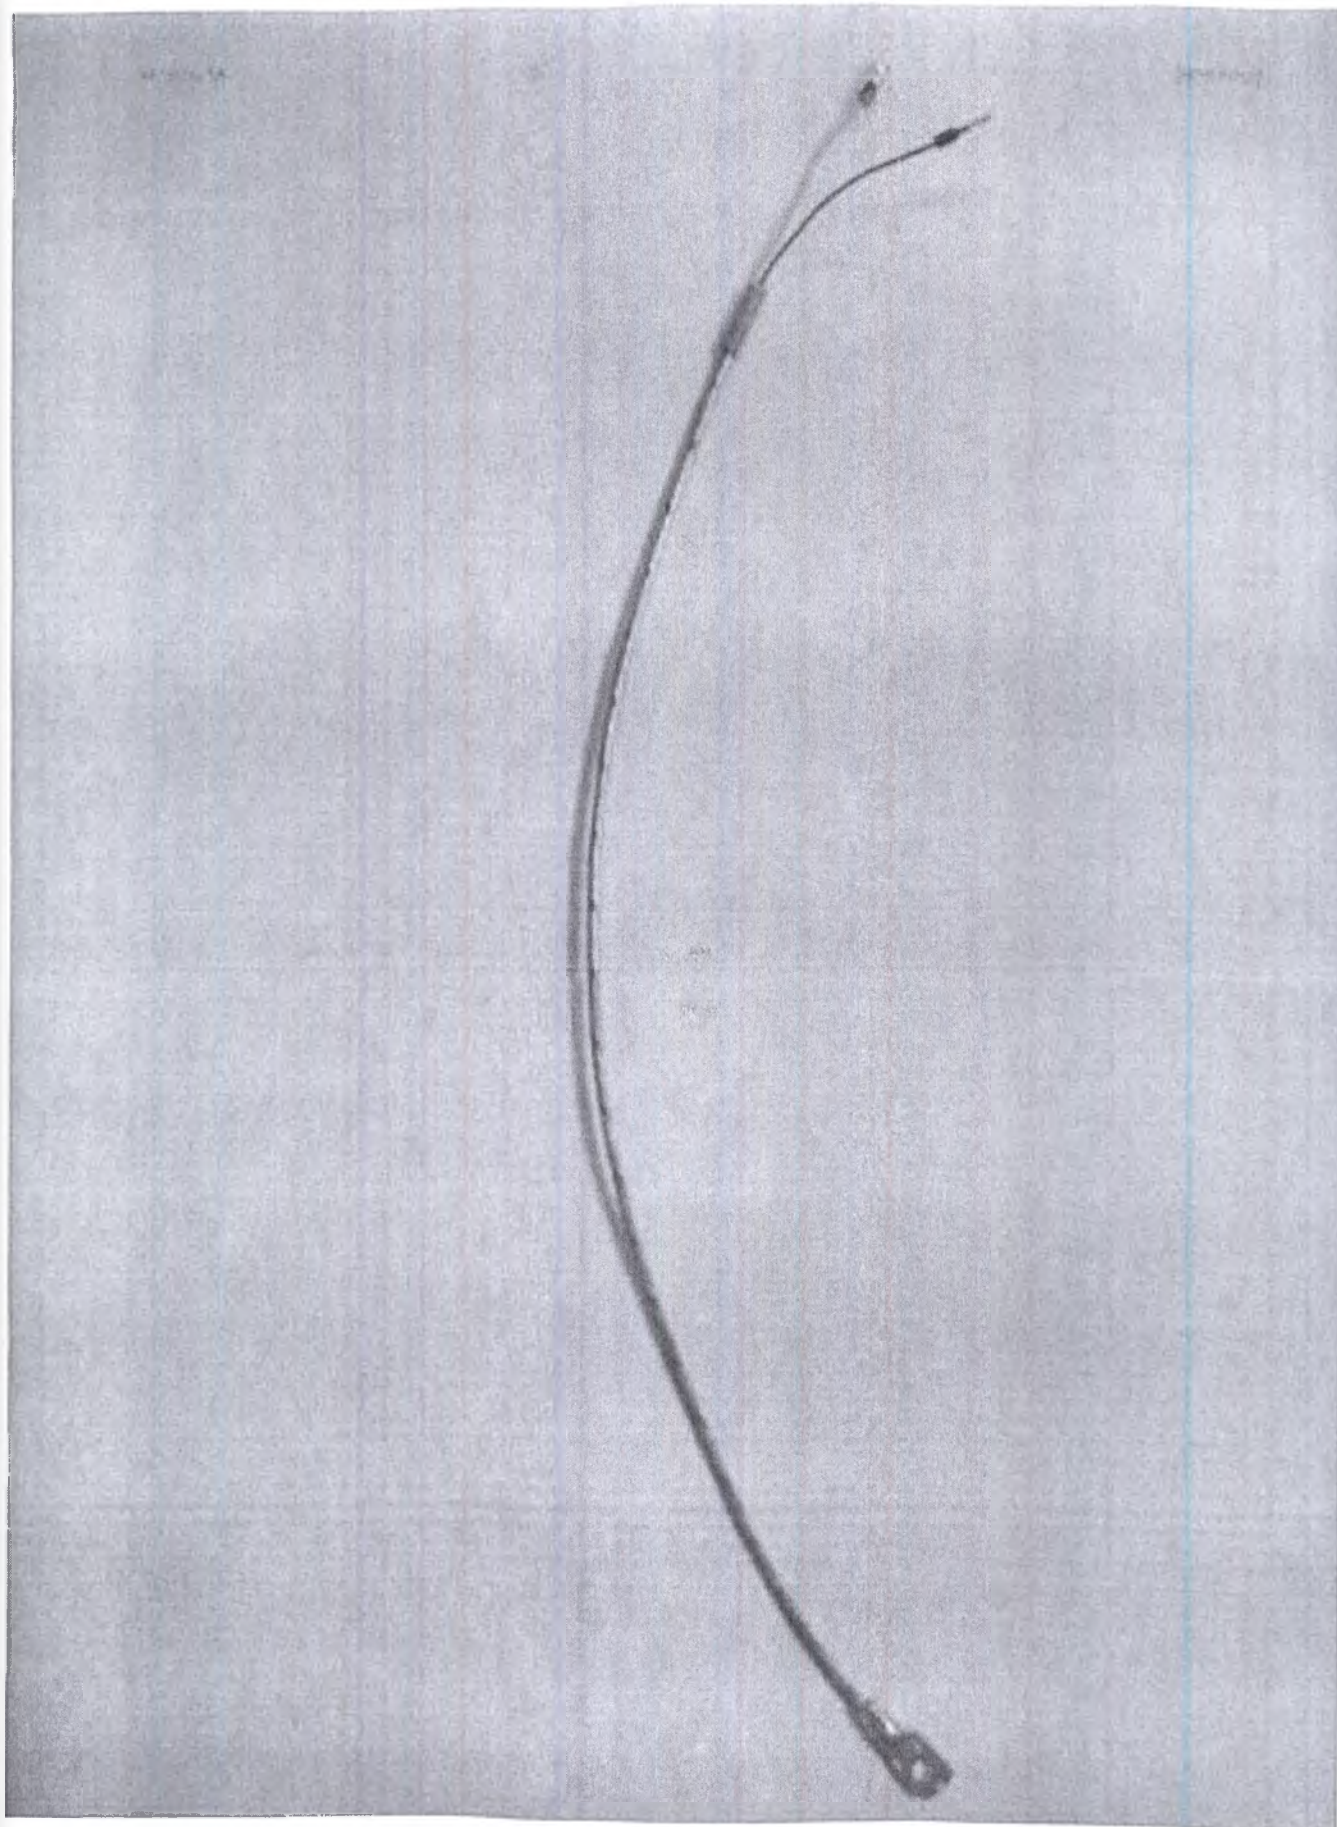

Датчик усилия

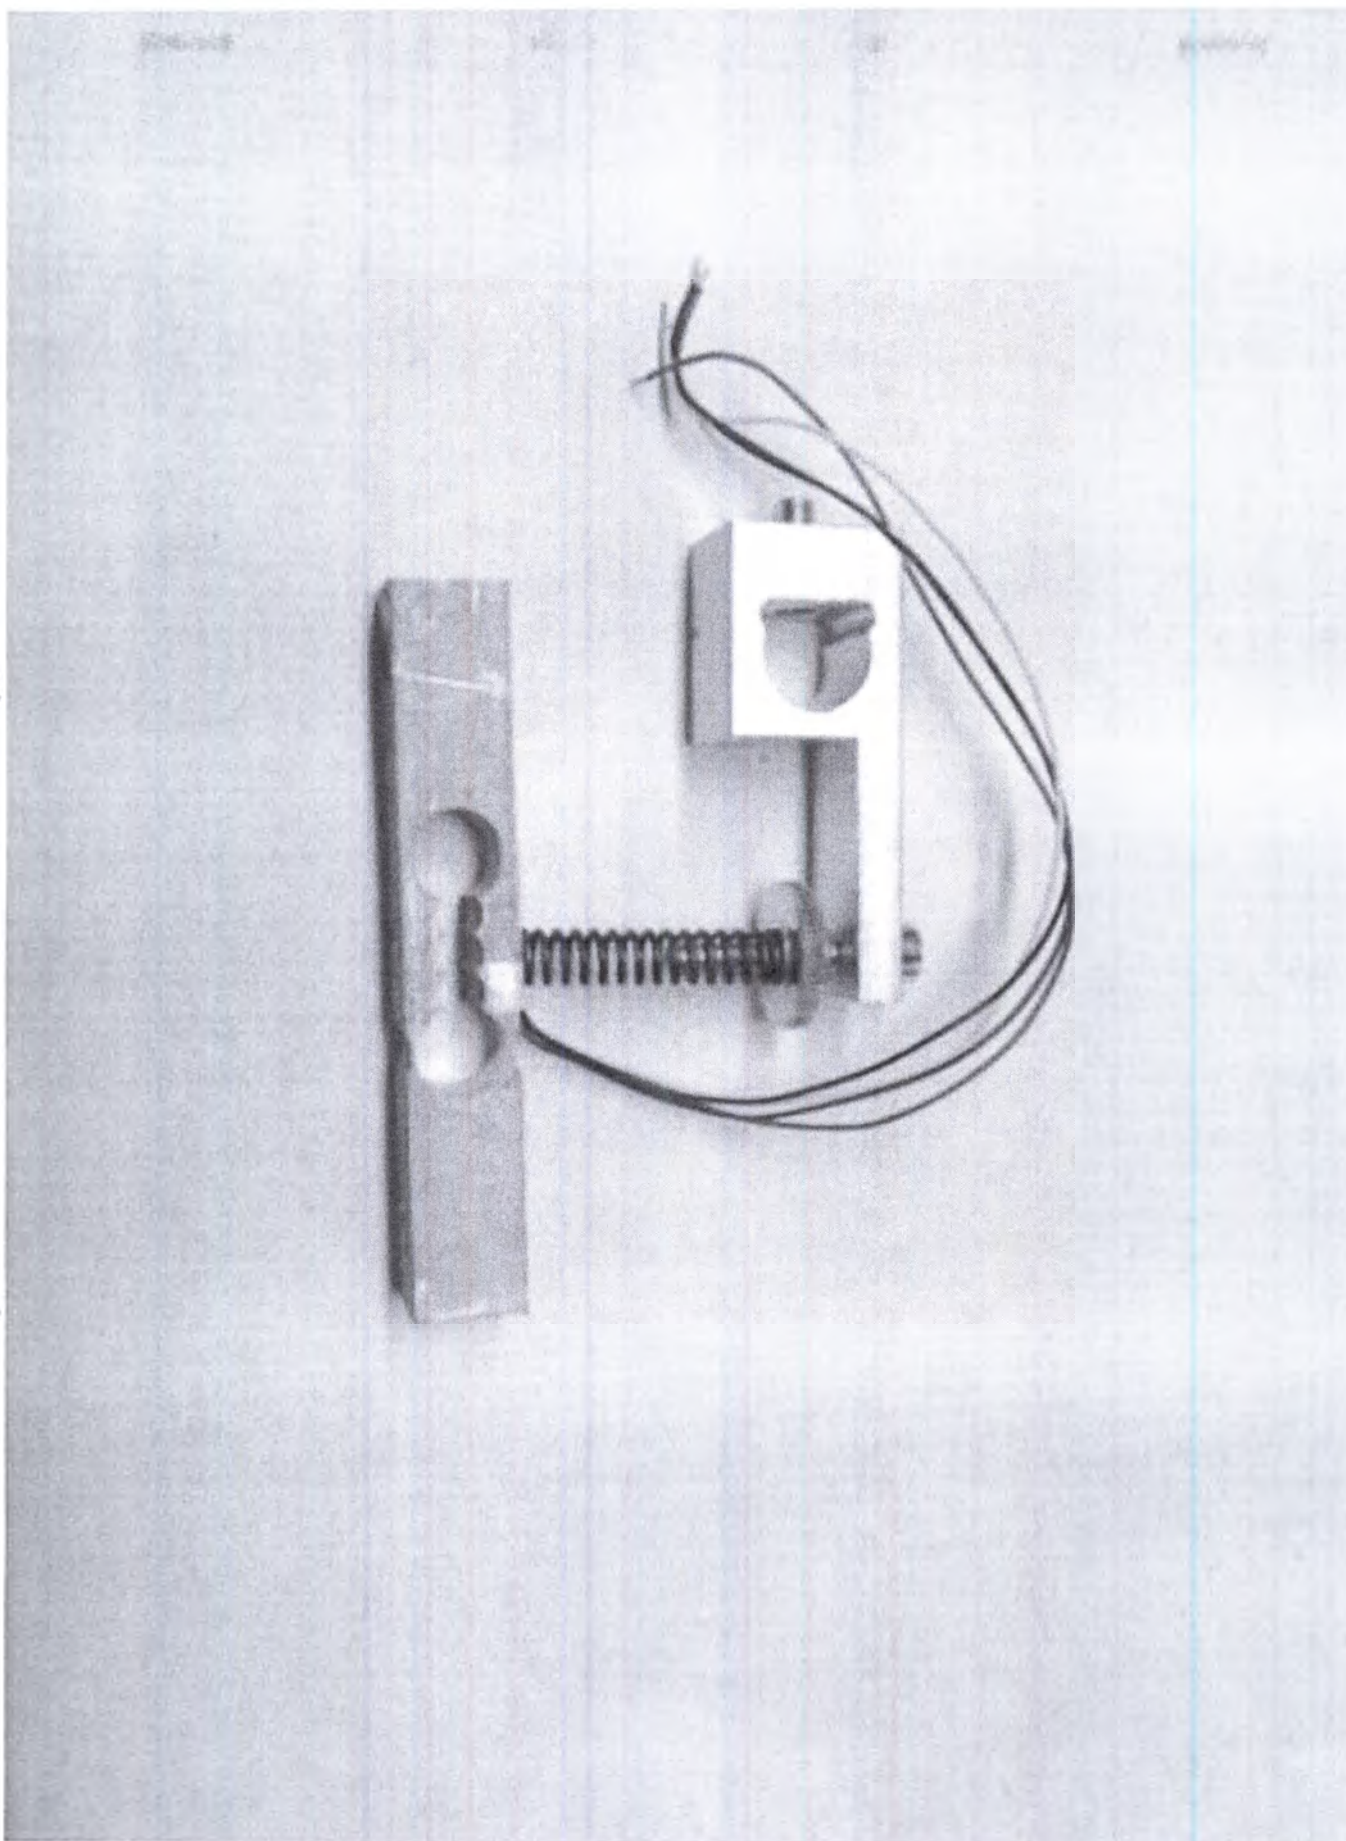


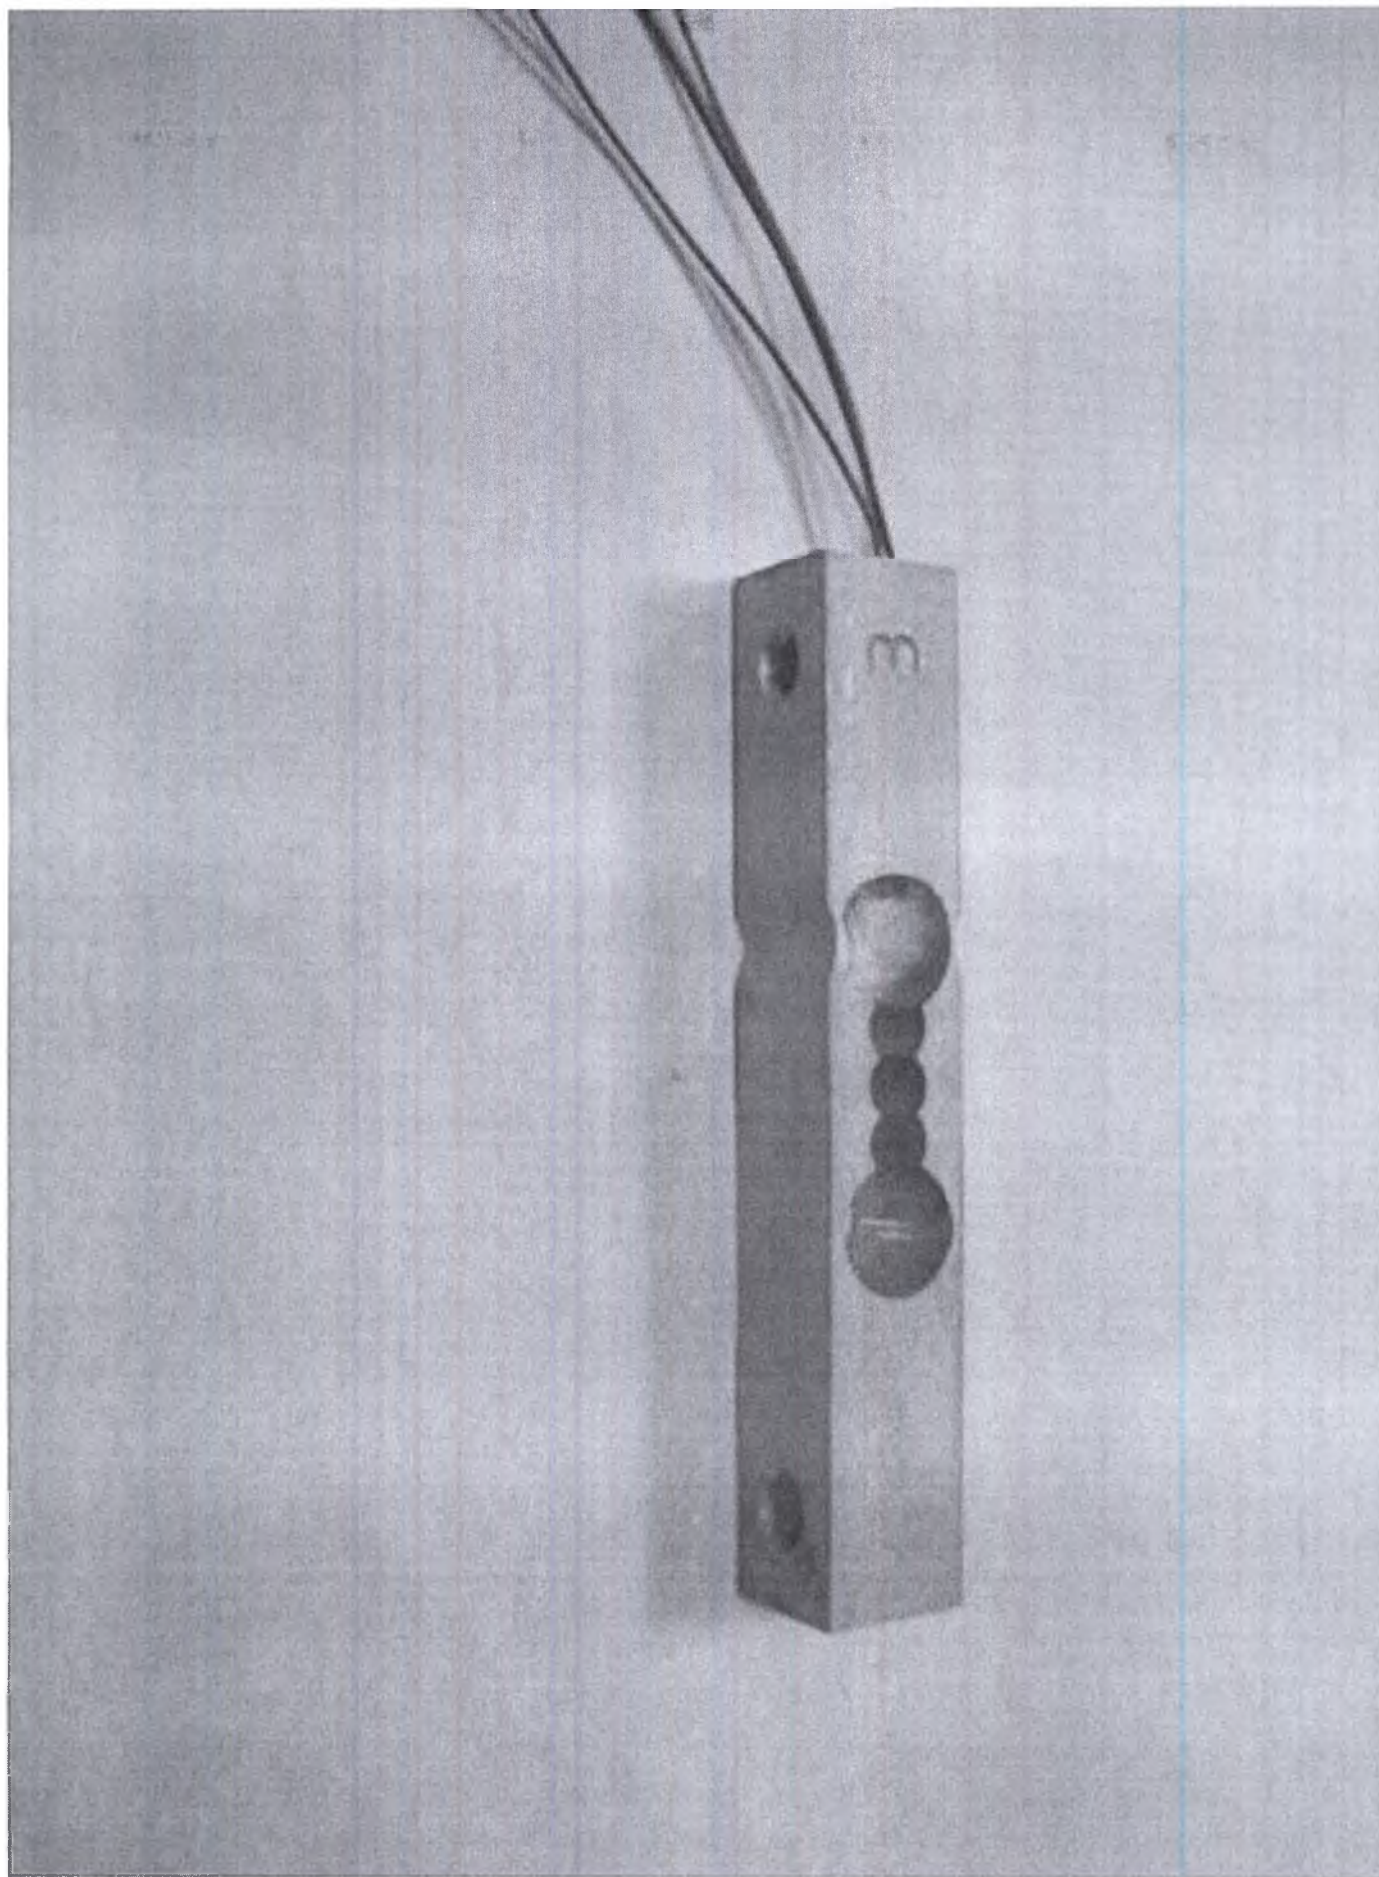


Двигатель




Держатель рулонов

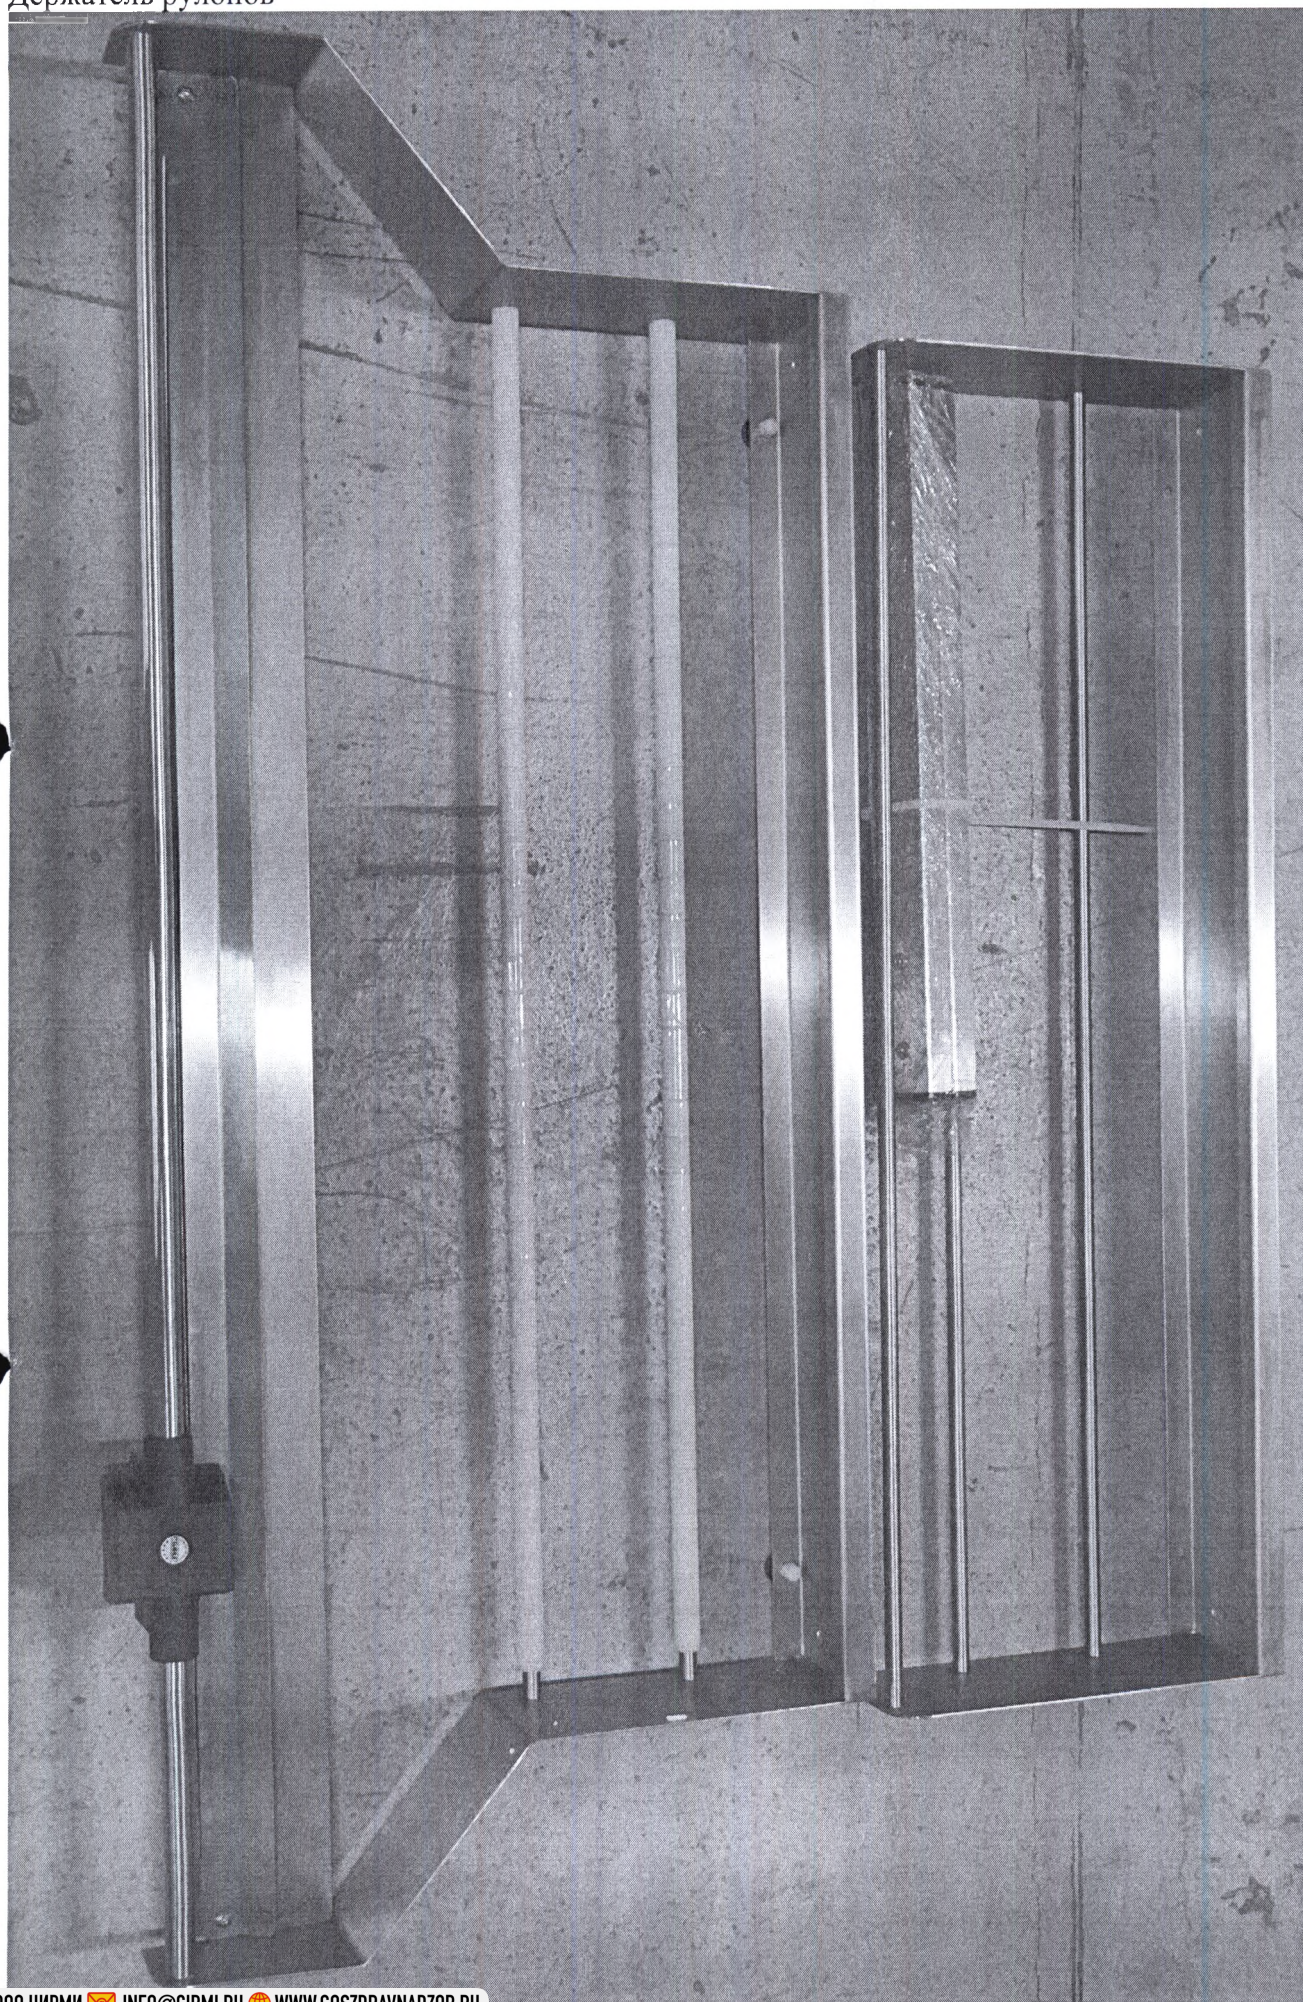

Дисплей жидкокристаллический

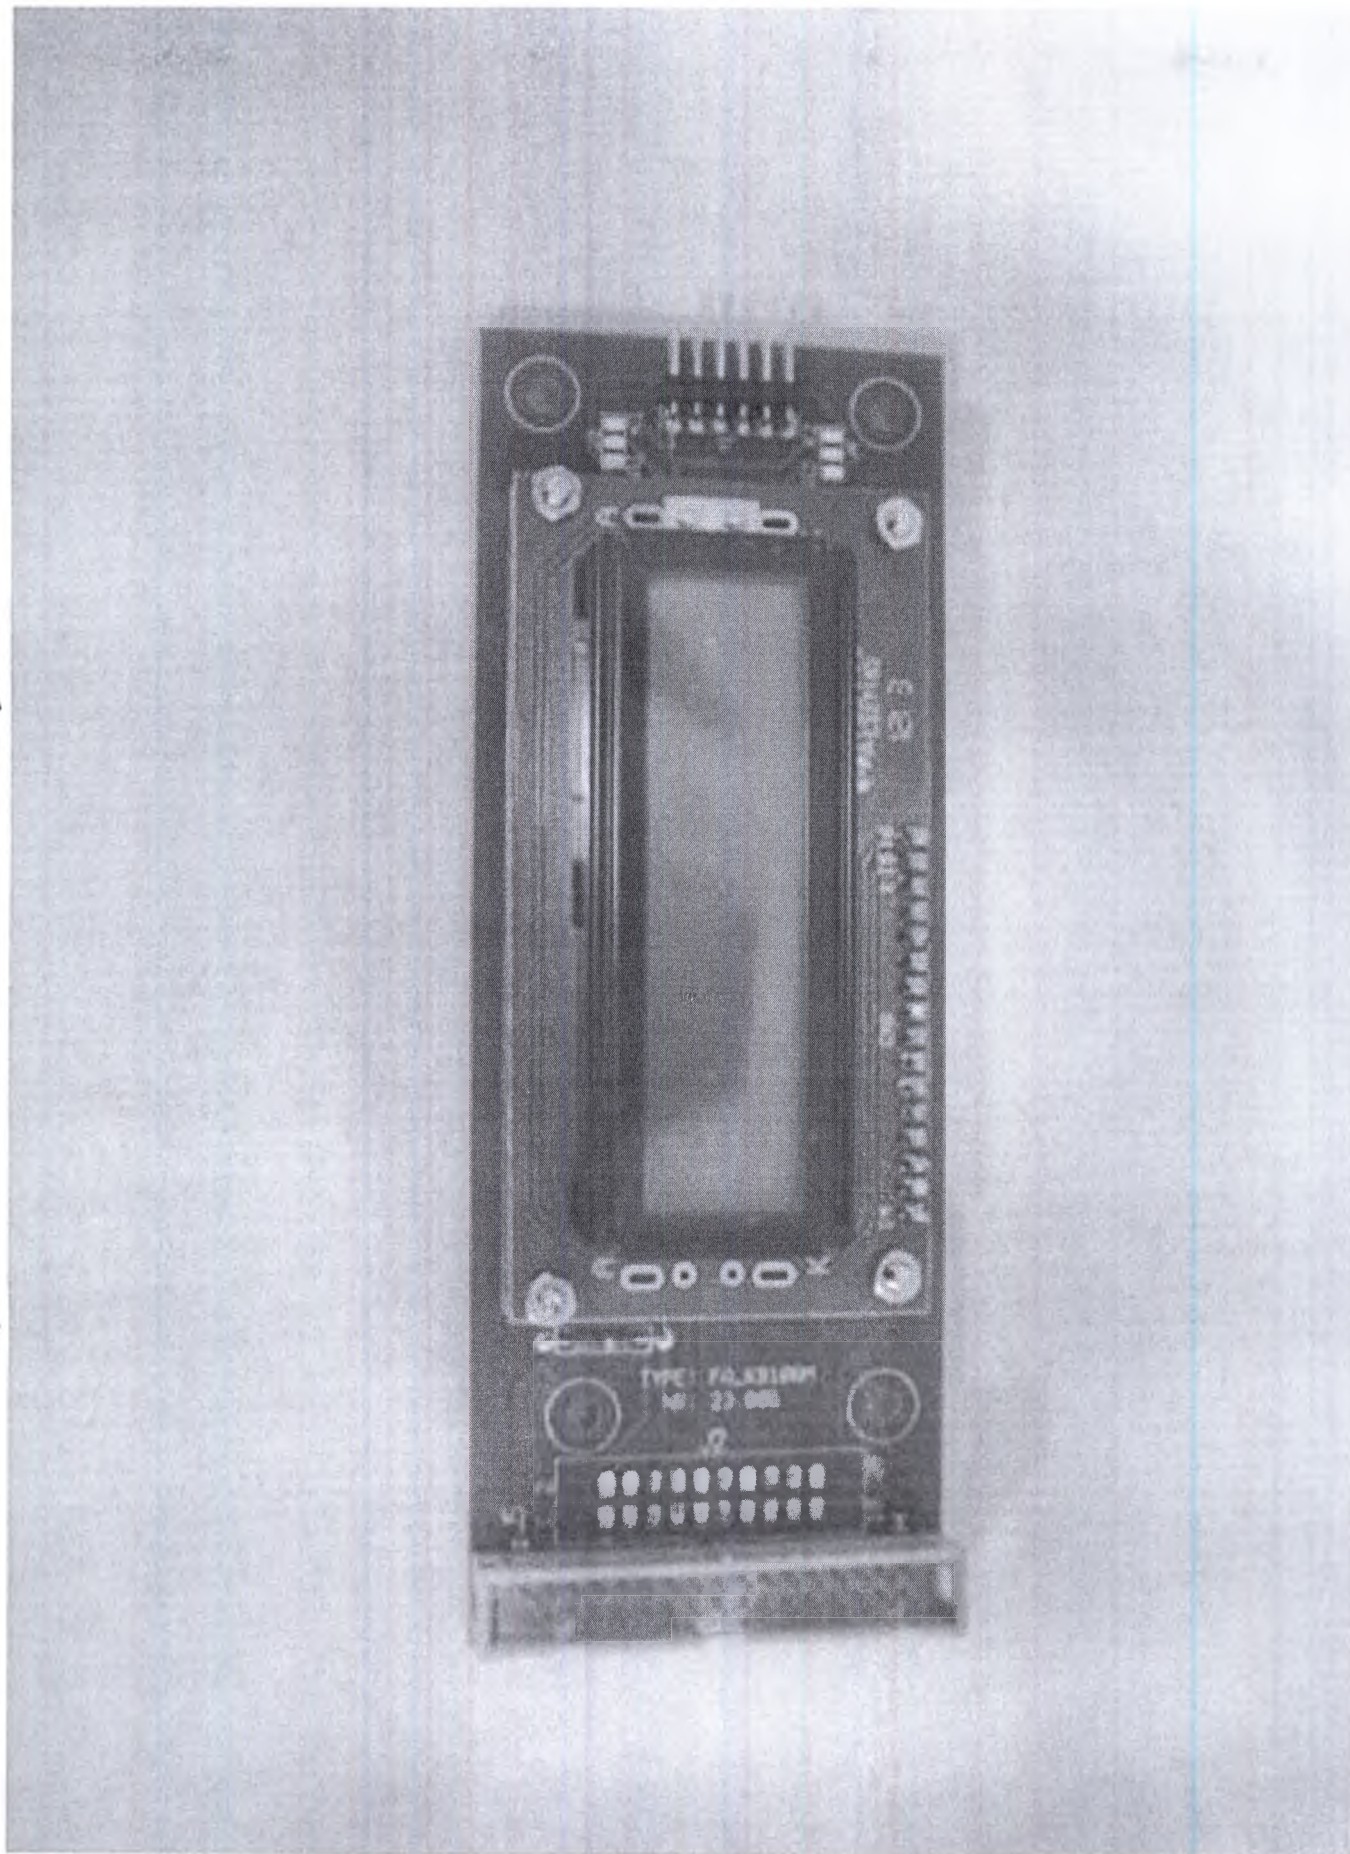

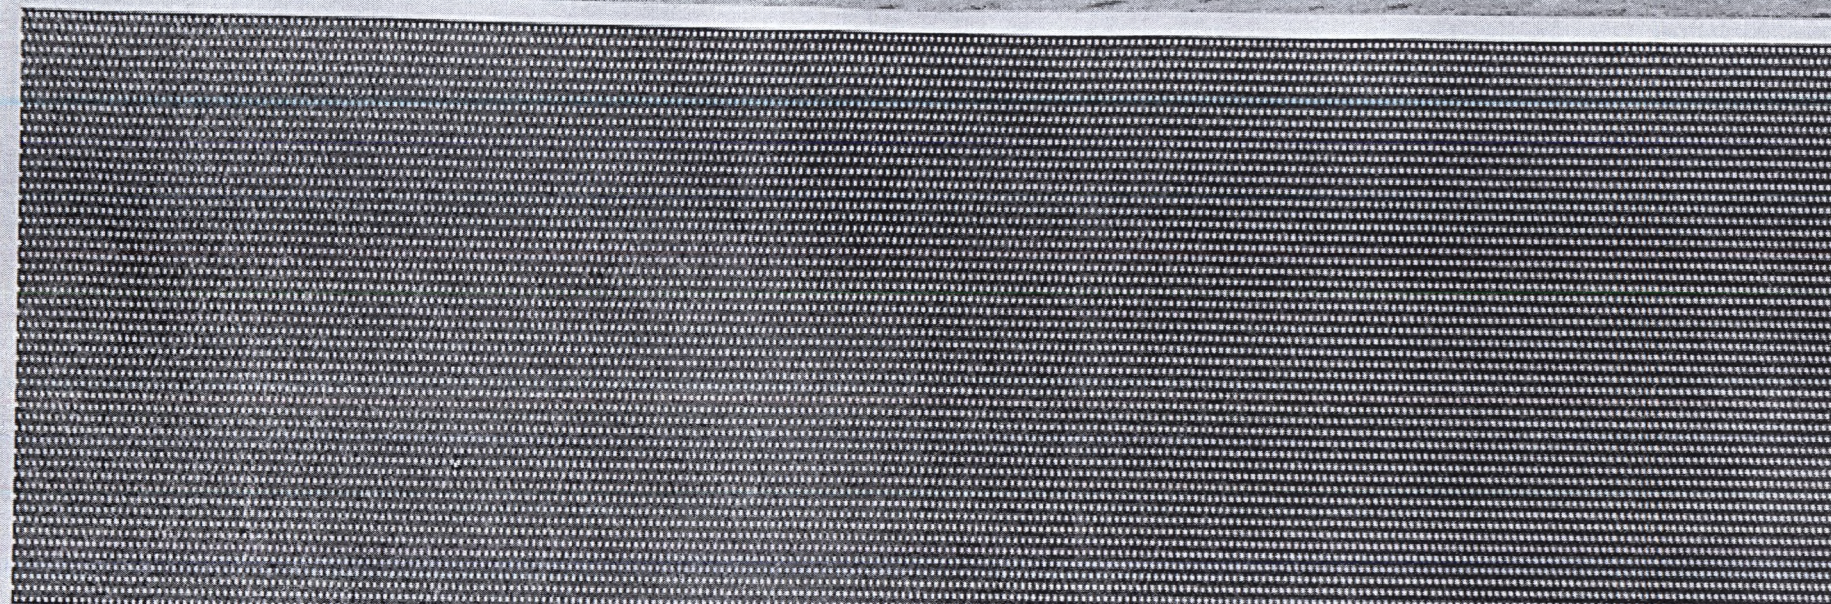


 Nr.:		 / ____ /20	Seal OK? OK: ☒ Not OK: ☐ → 	
--	---	--	--	---

 Put this test sheet into your pouch and pass it through the sealer once. The seal must be darker than the environment throughout.

 Testblatt in einen Klarsichtbeutel einstecken und 1 mal durch das Siegelgerät laufen lassen. Die Siegelnaht muss ununterbrochen dunkler als die Umgebung sein.

Seal Test REF 15.300.043	LOT 61000078		
	 2016-04		


Кабель панели управления

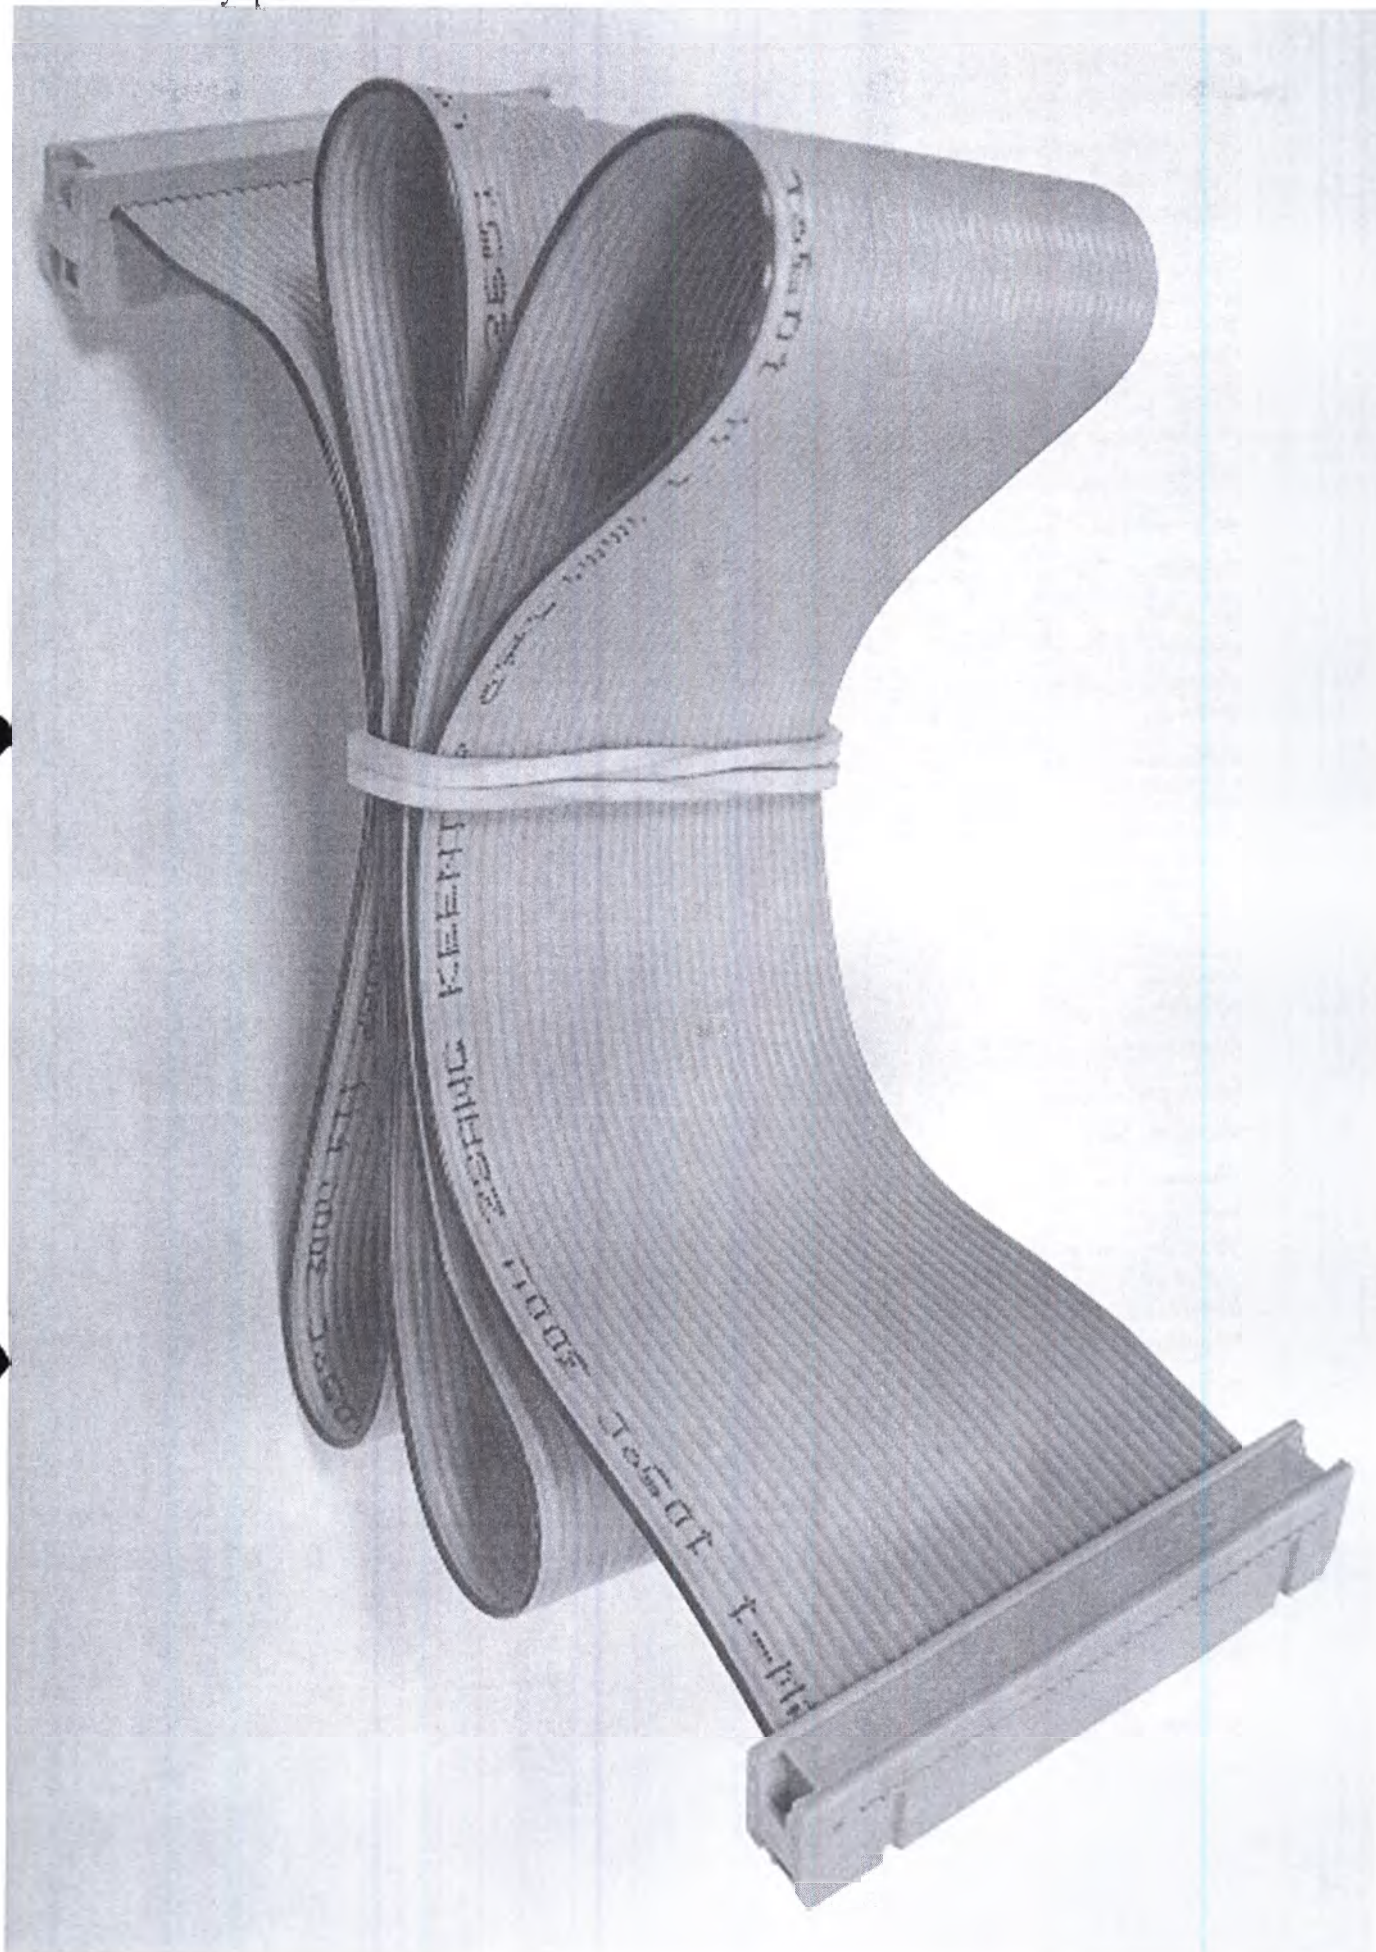


Кабель питания




Кабель сопряжения с компьютером

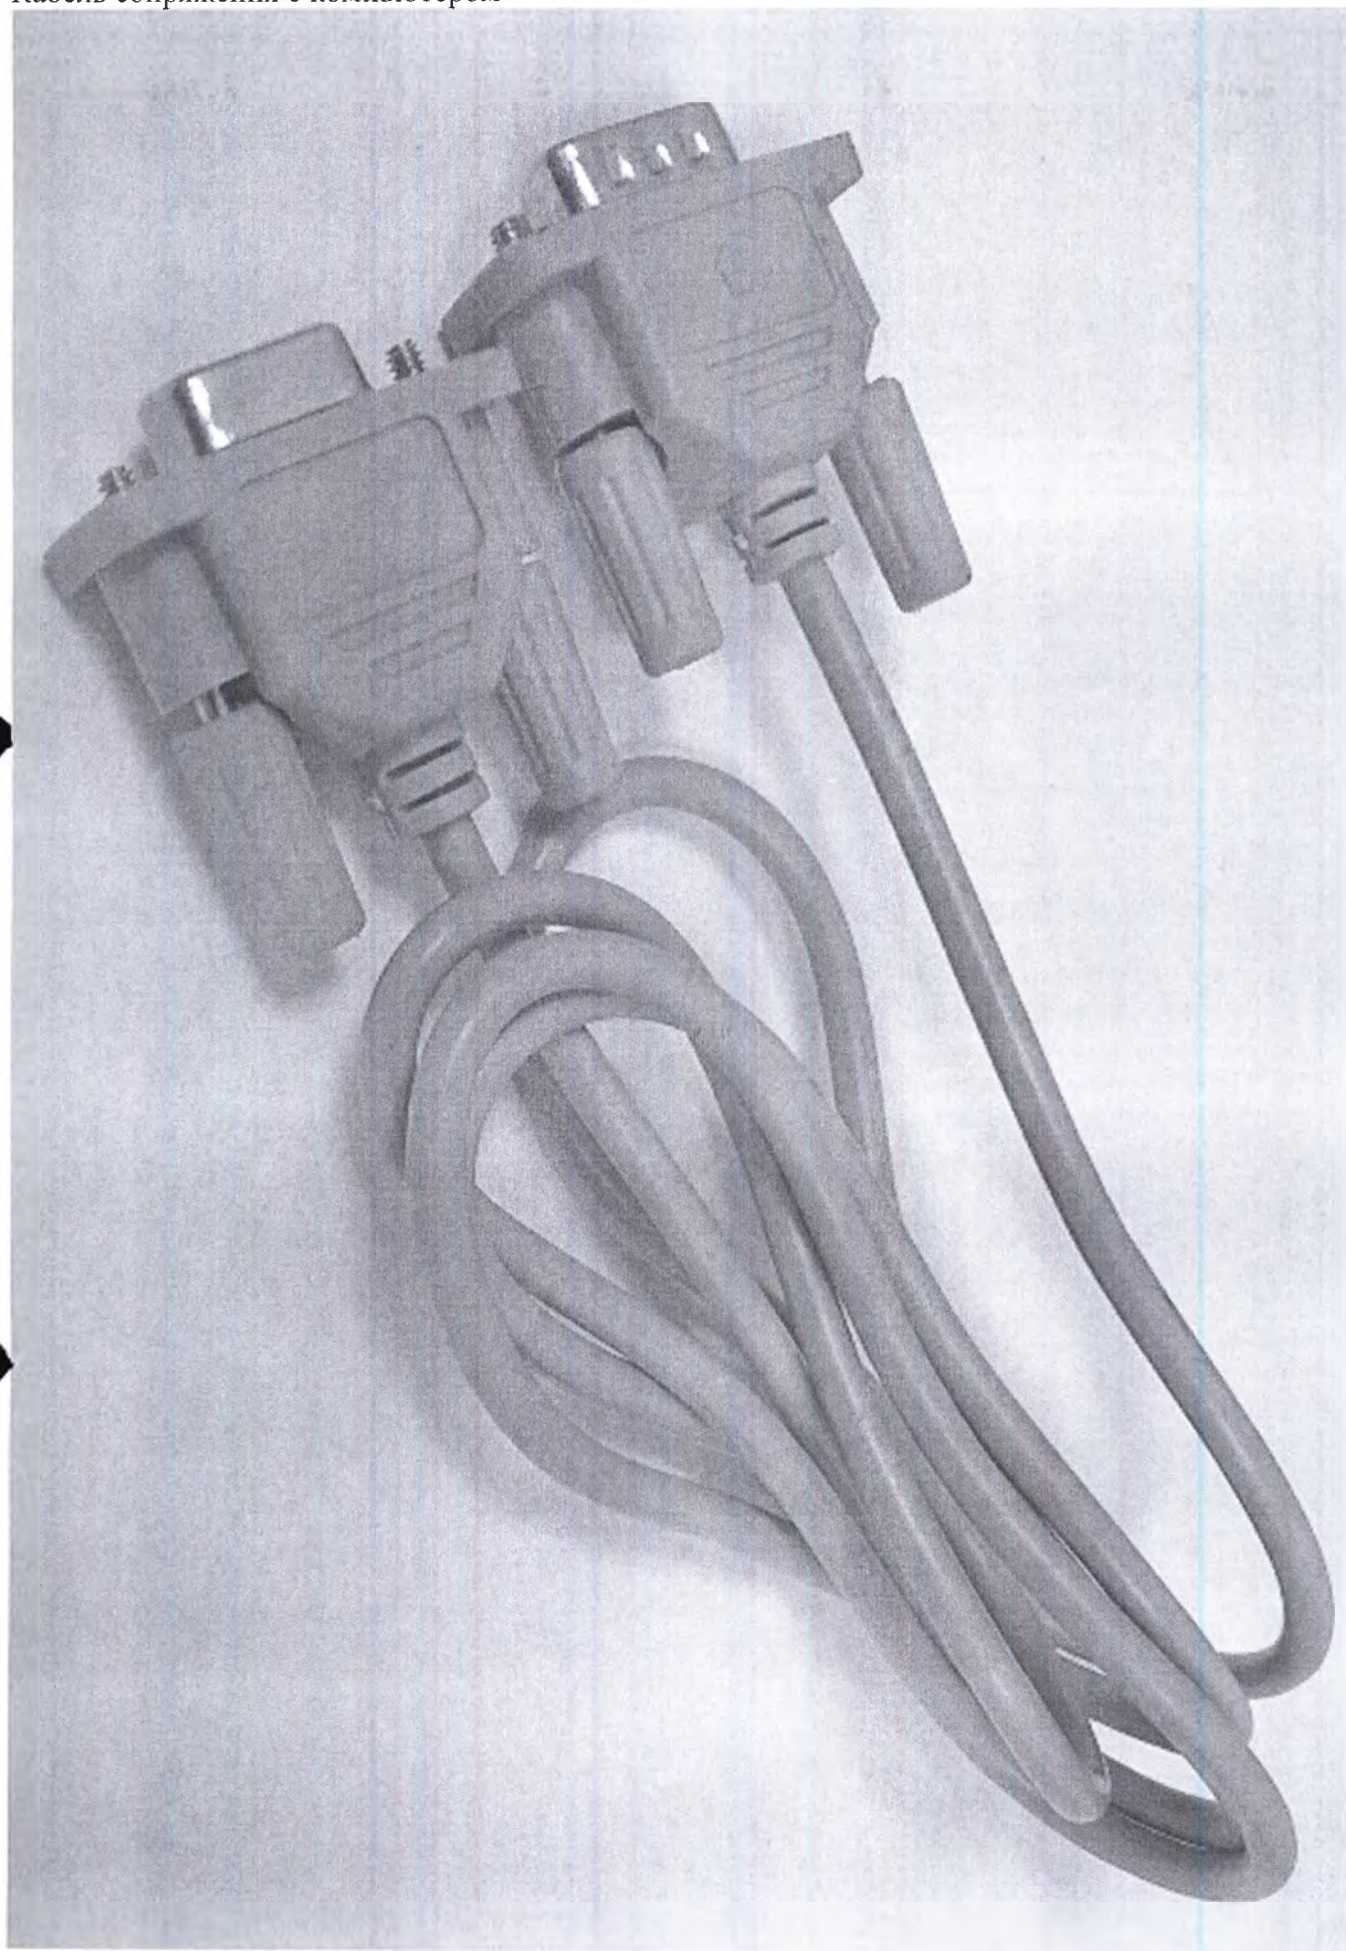



Картридж ленточный

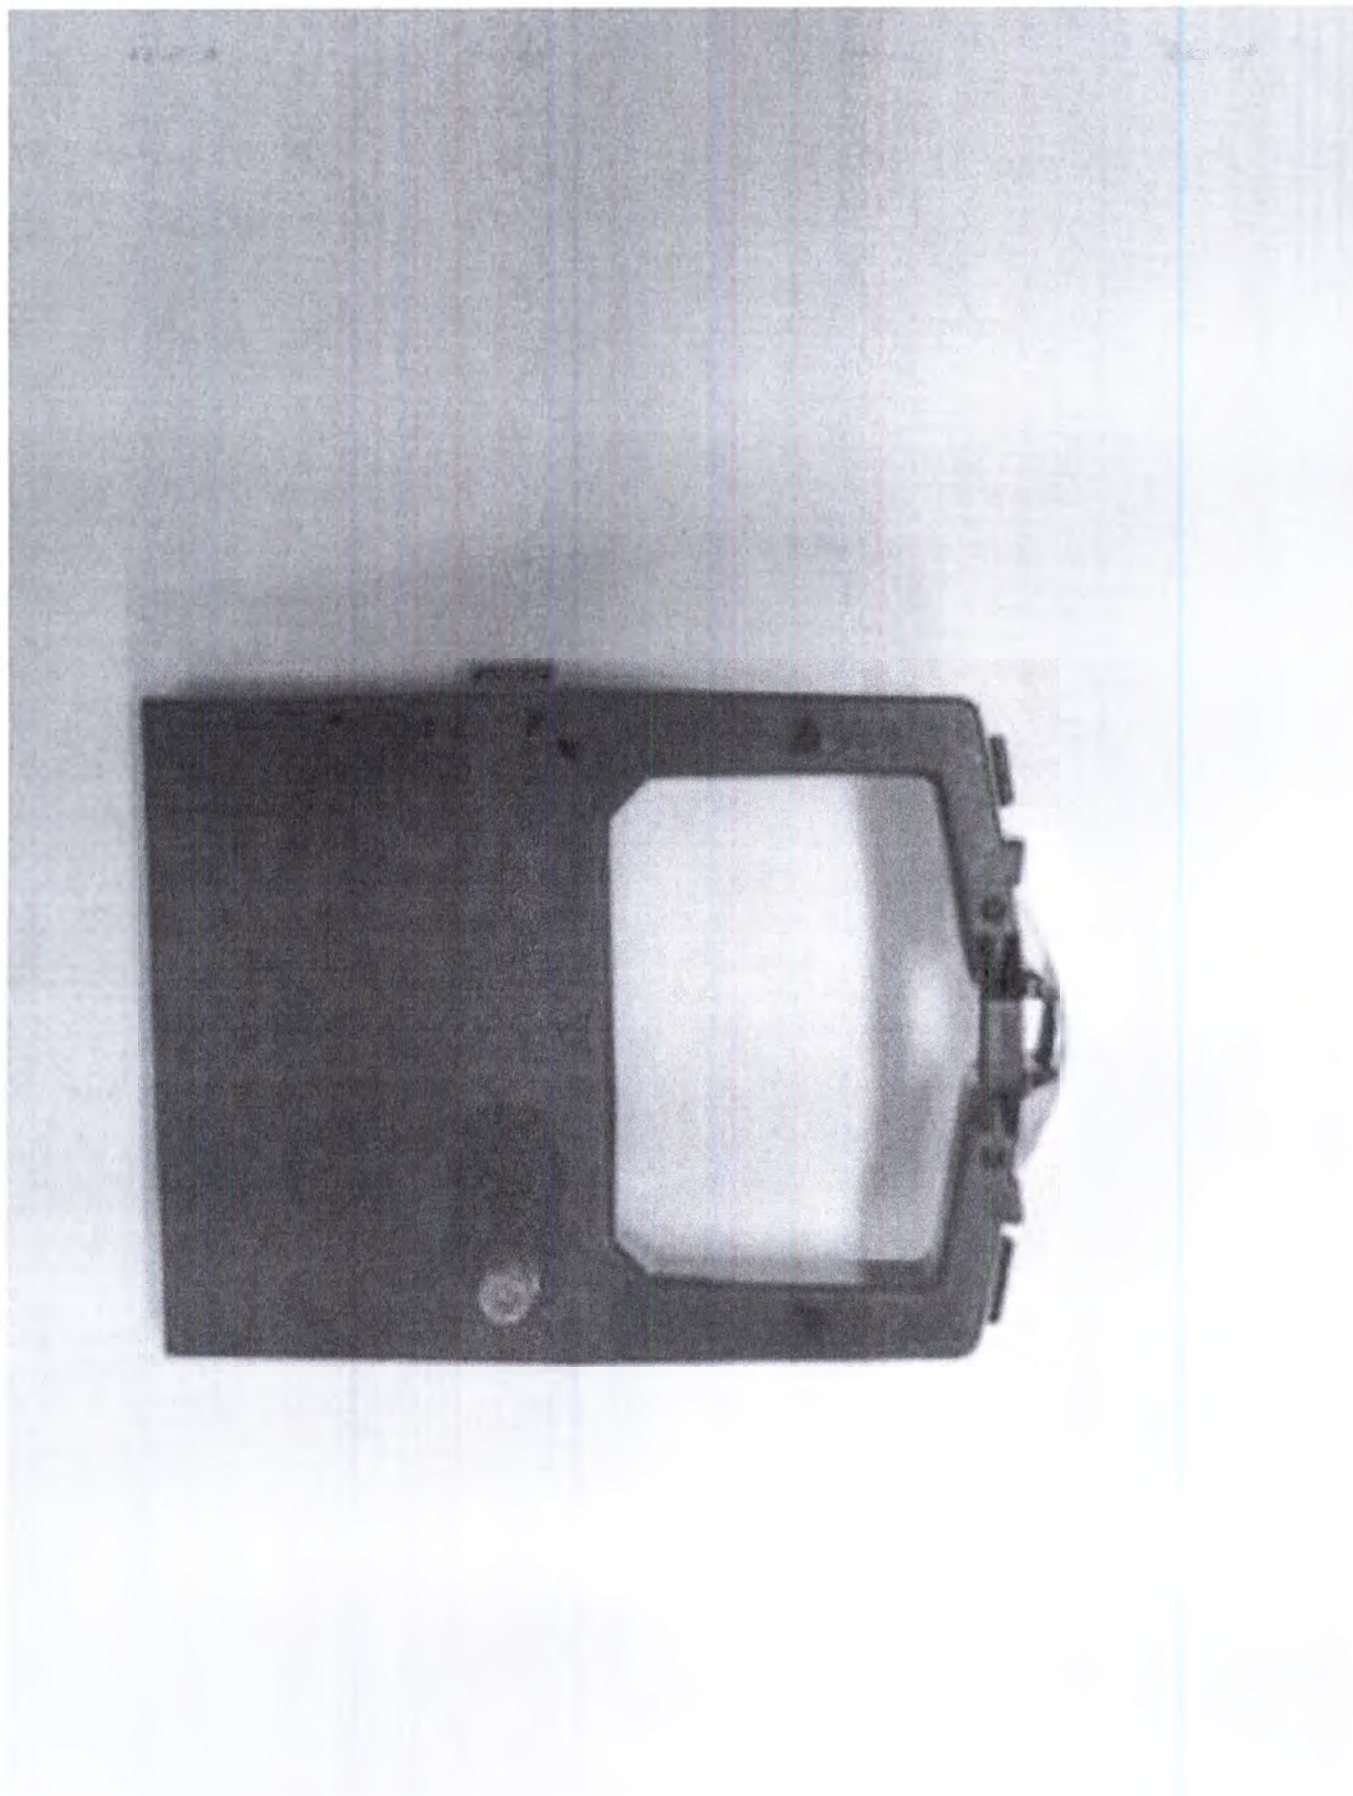


Клавишная панель управления

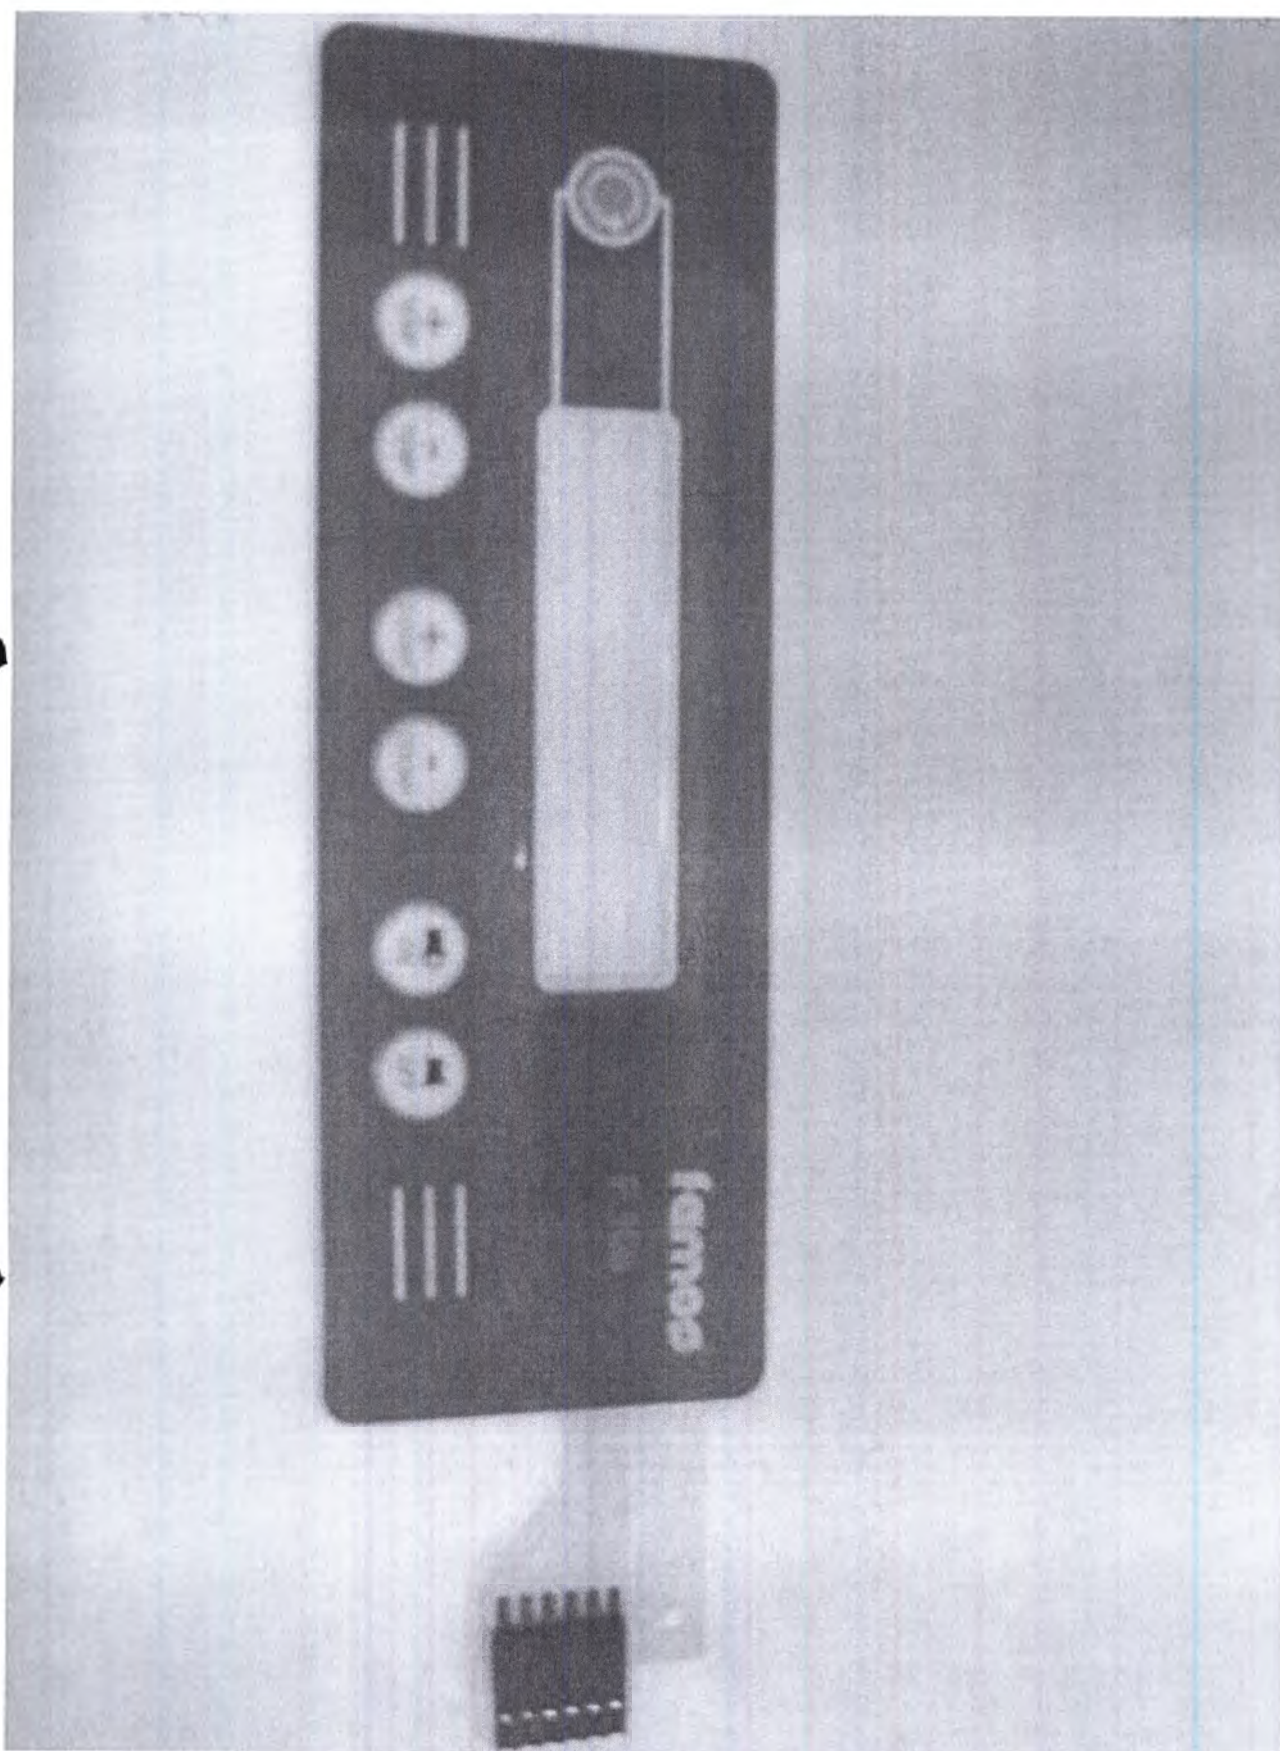


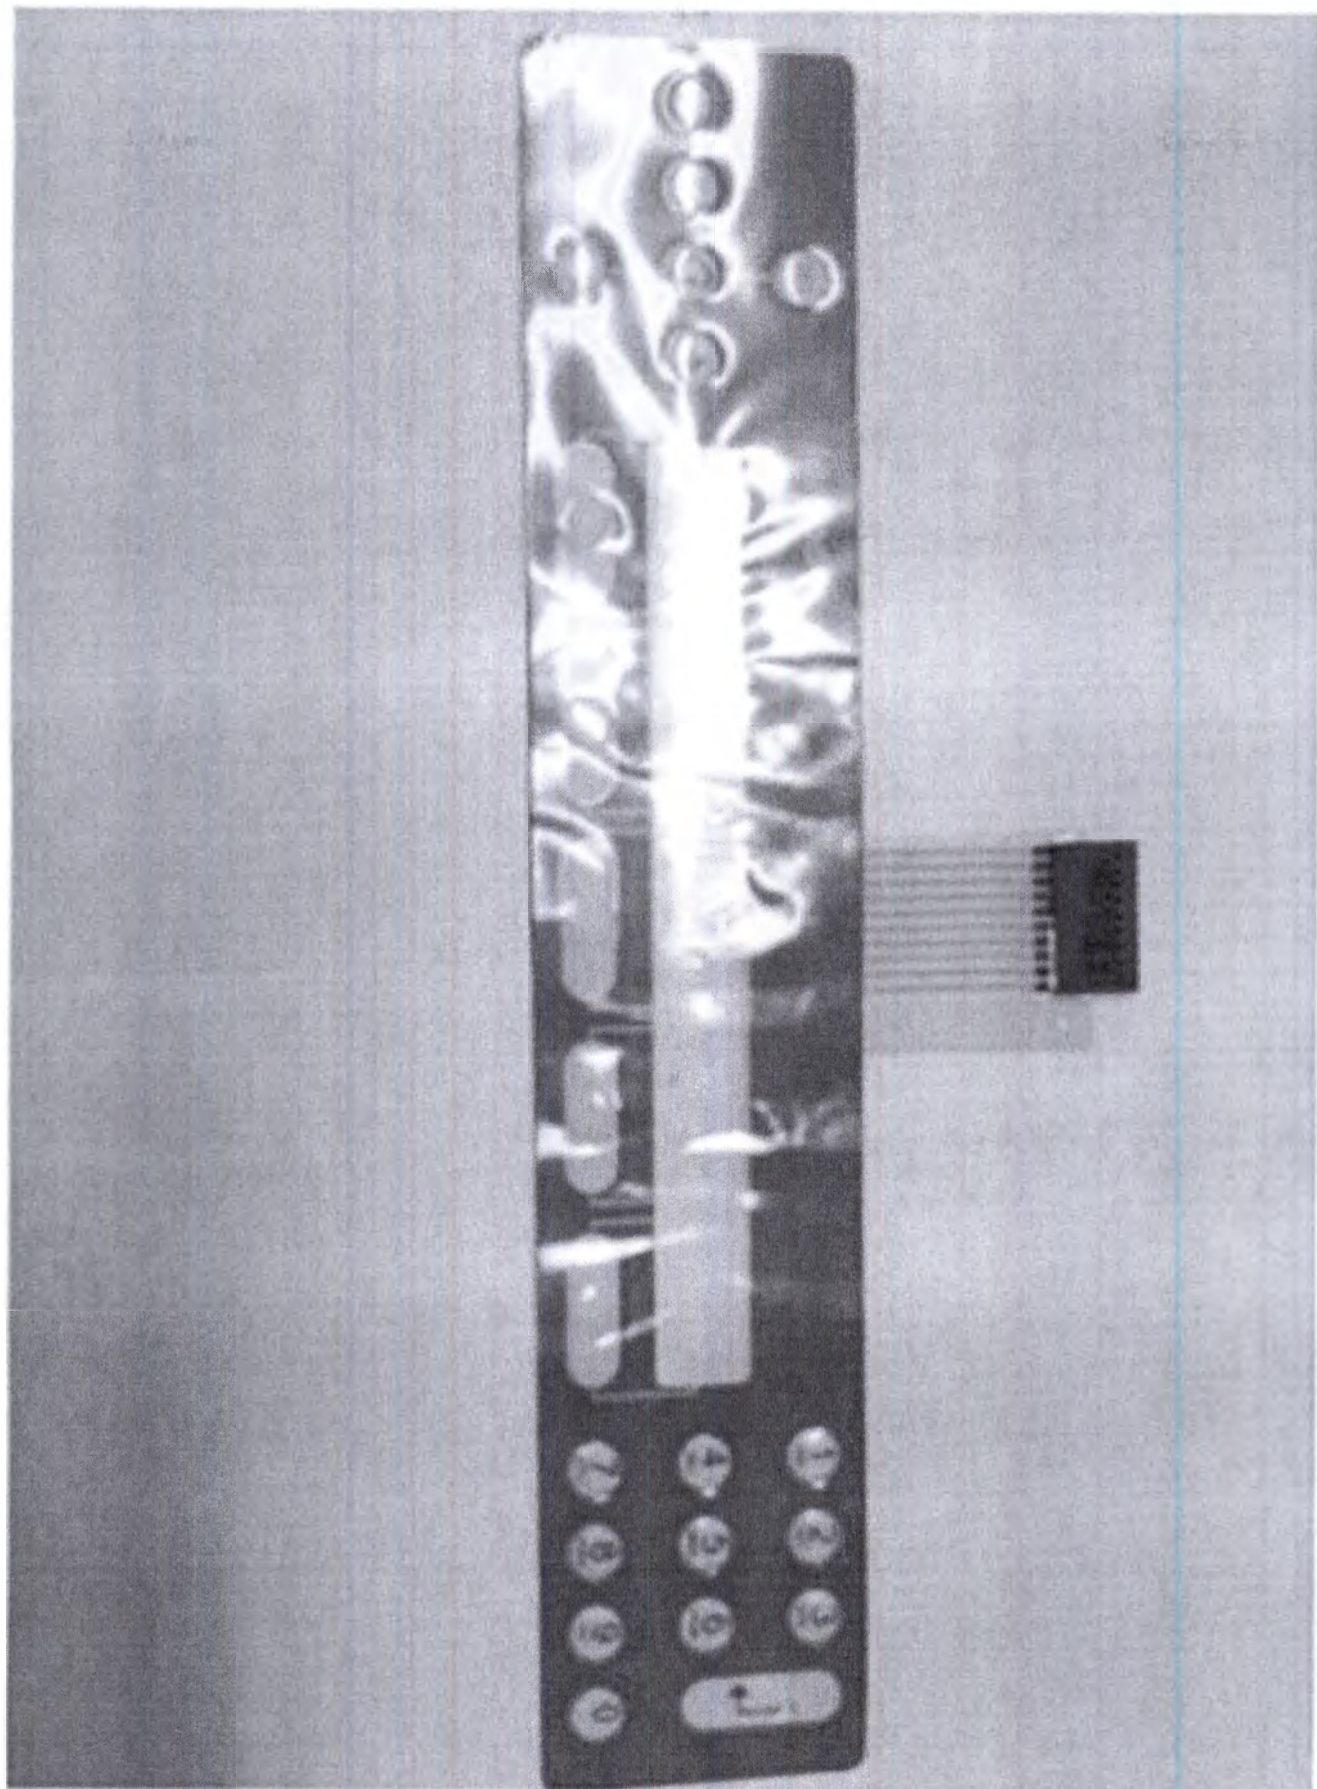


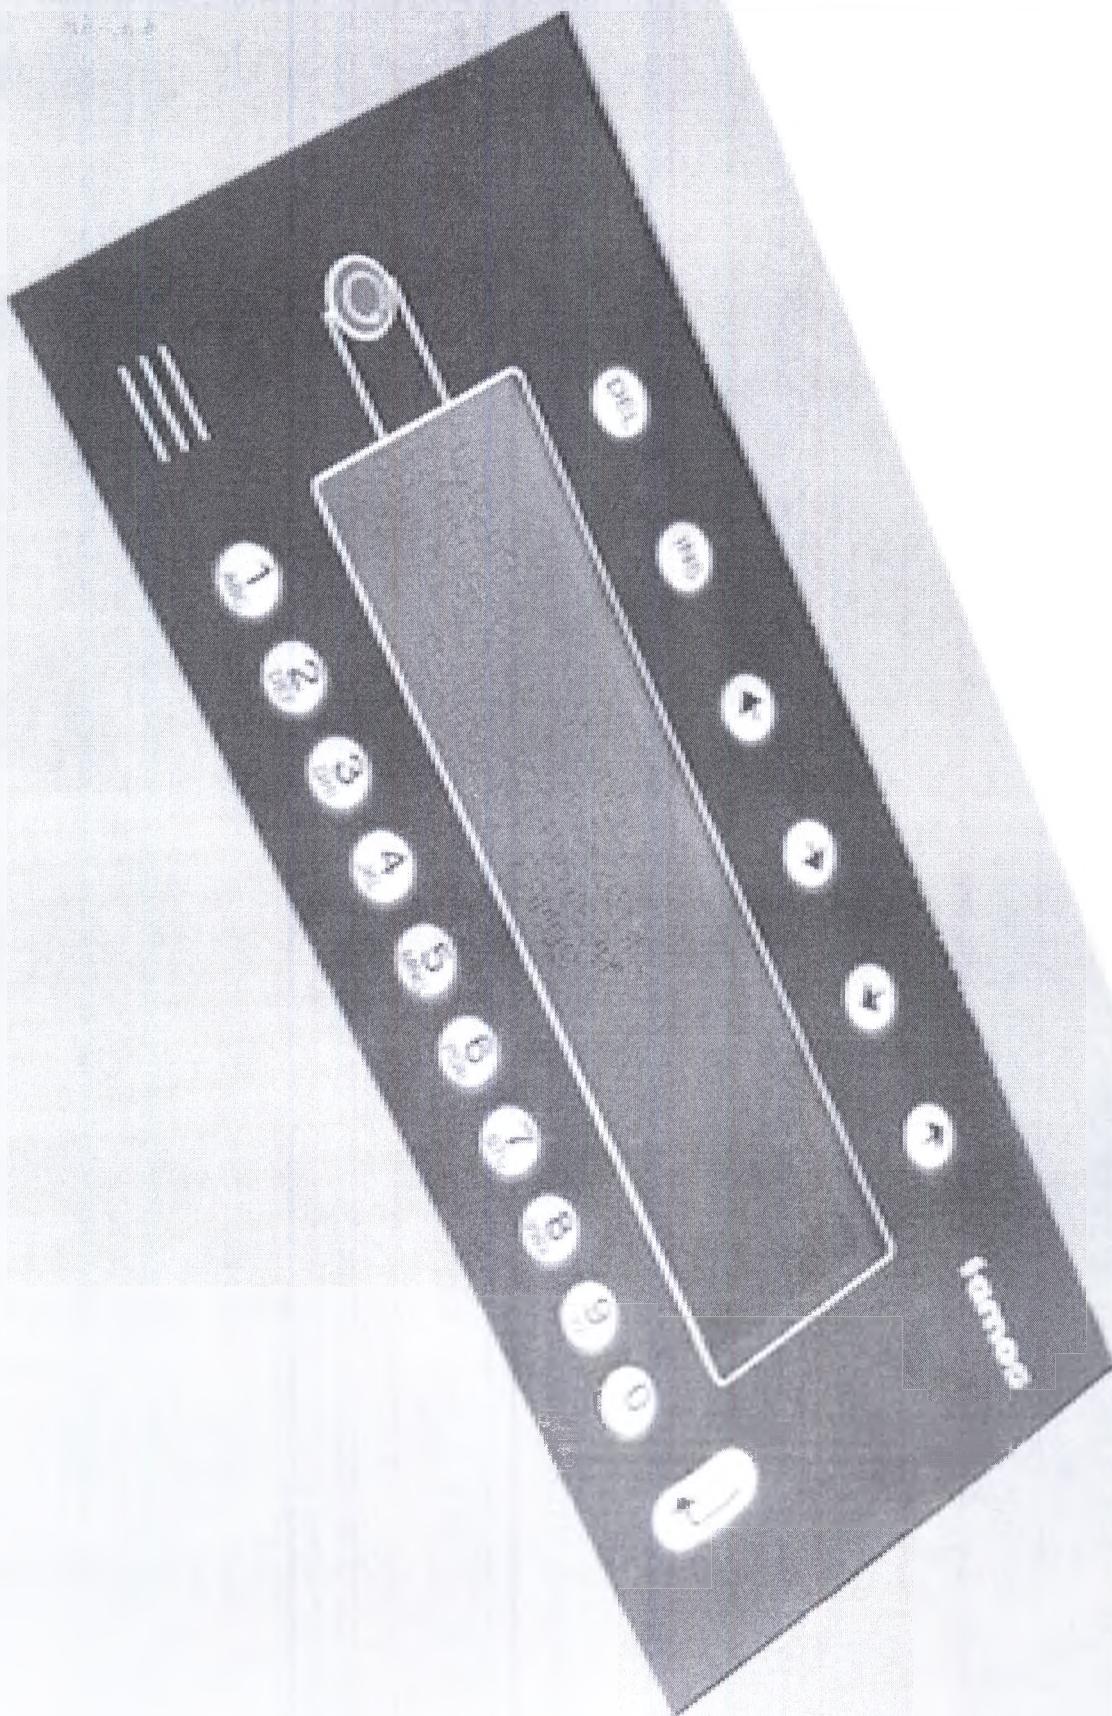


Колесо винтовое

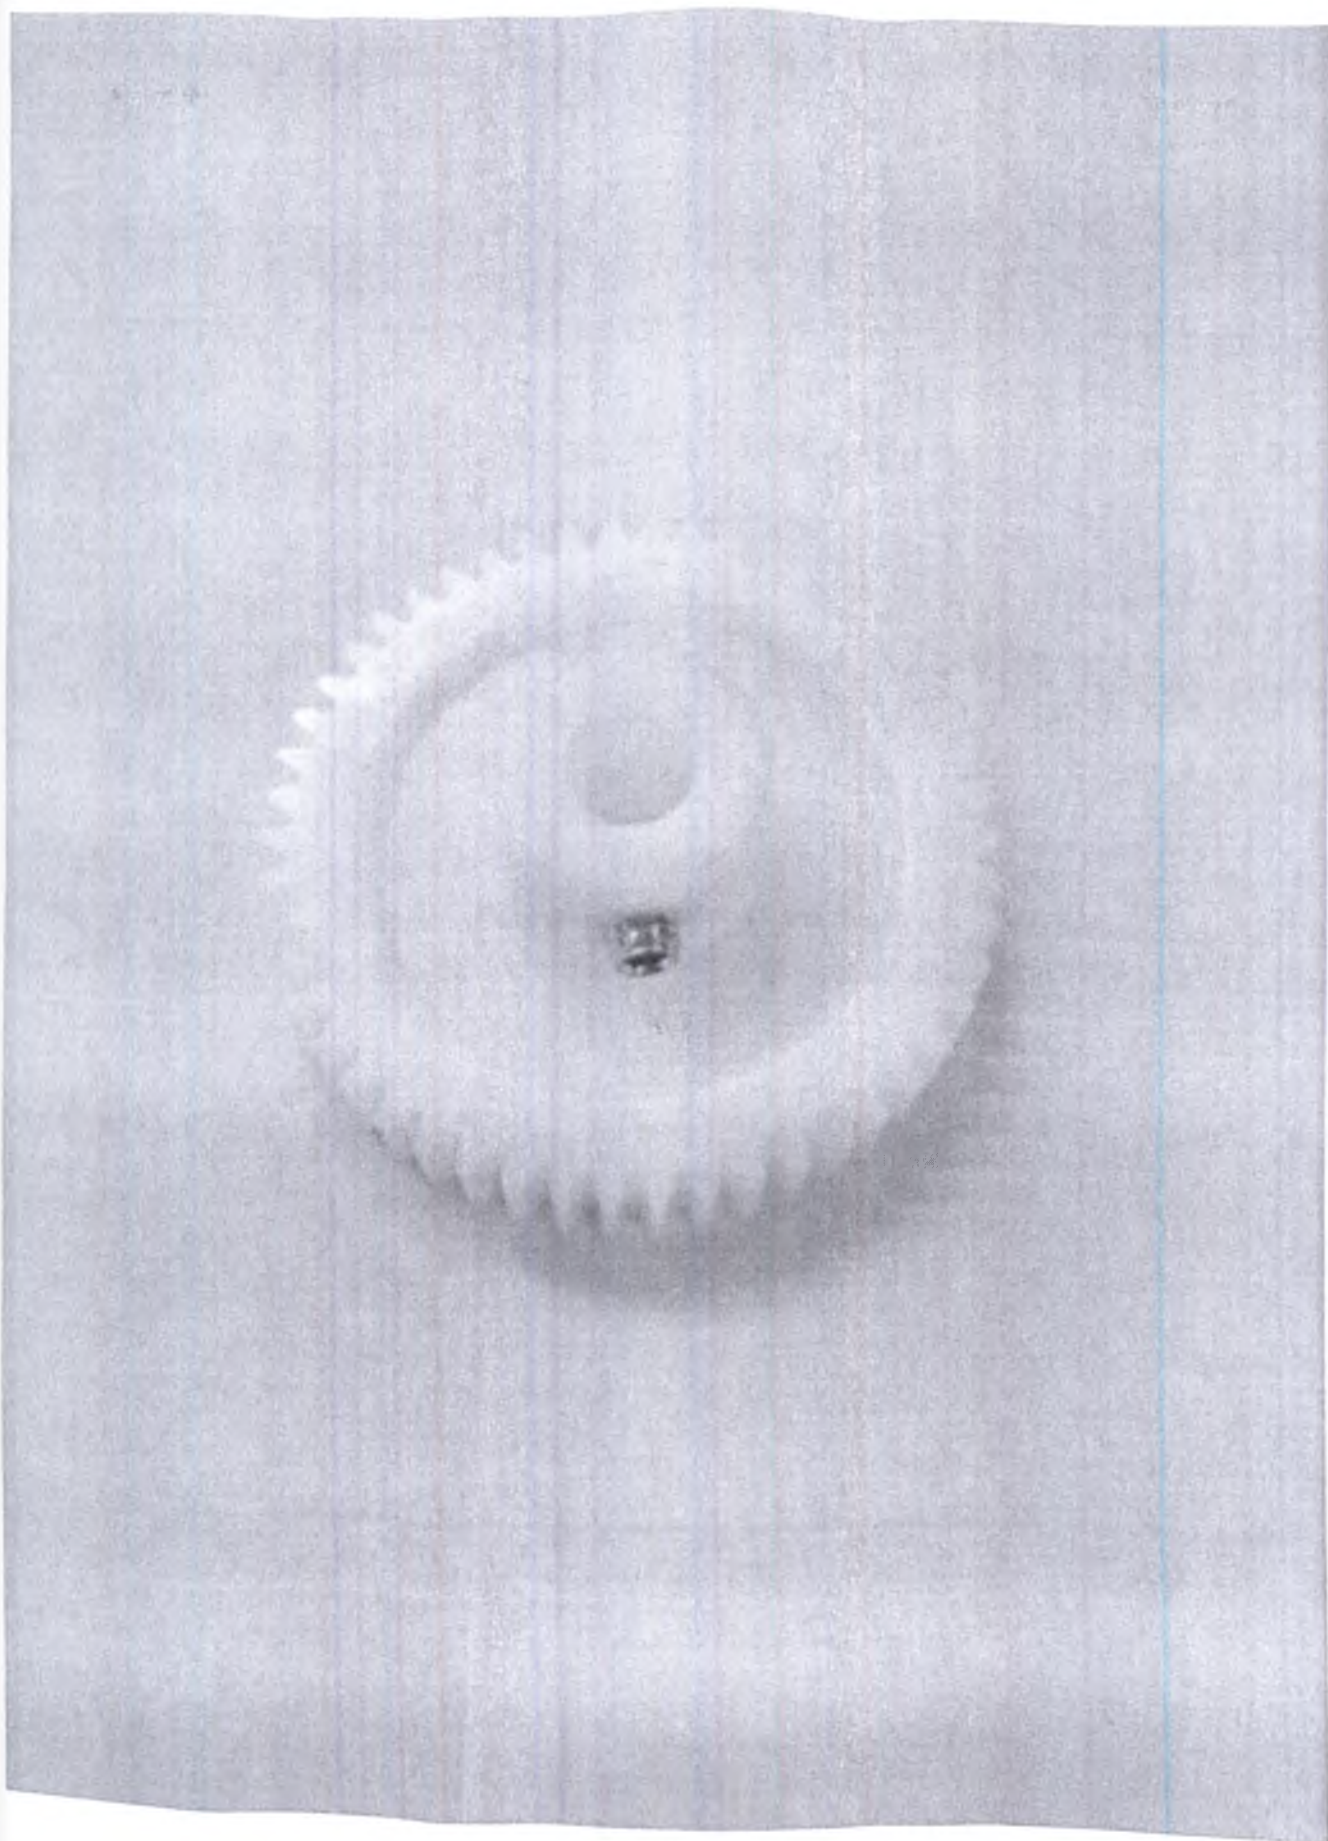


Кольцо уплотнительное

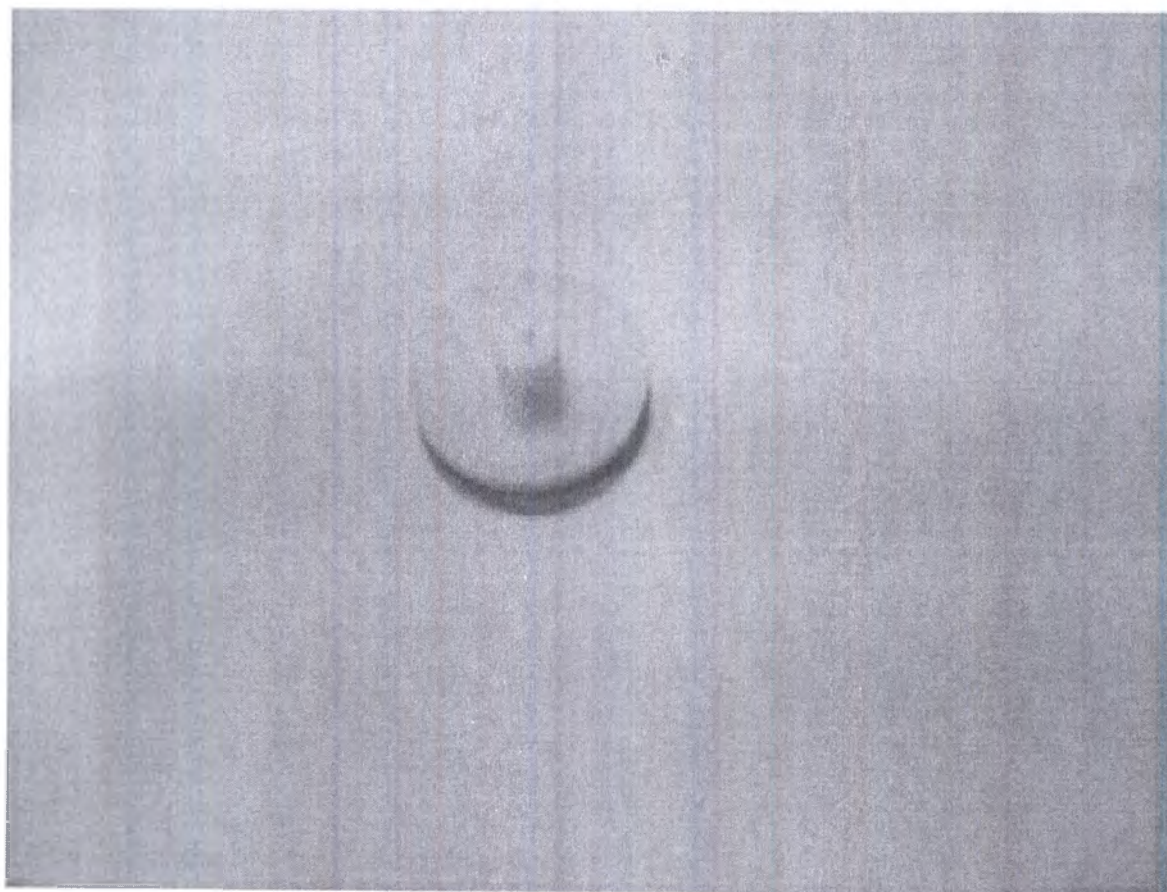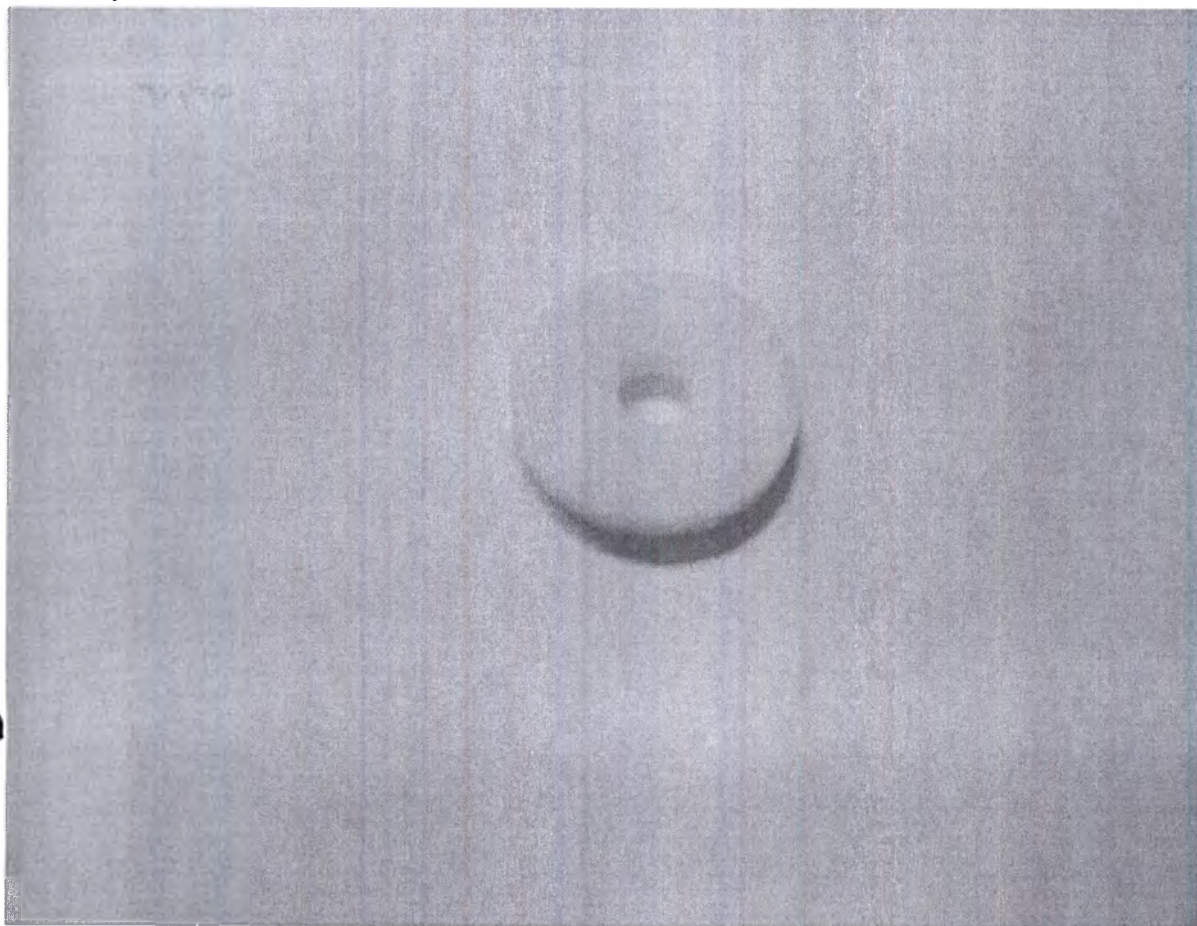

Лампа индикаторная

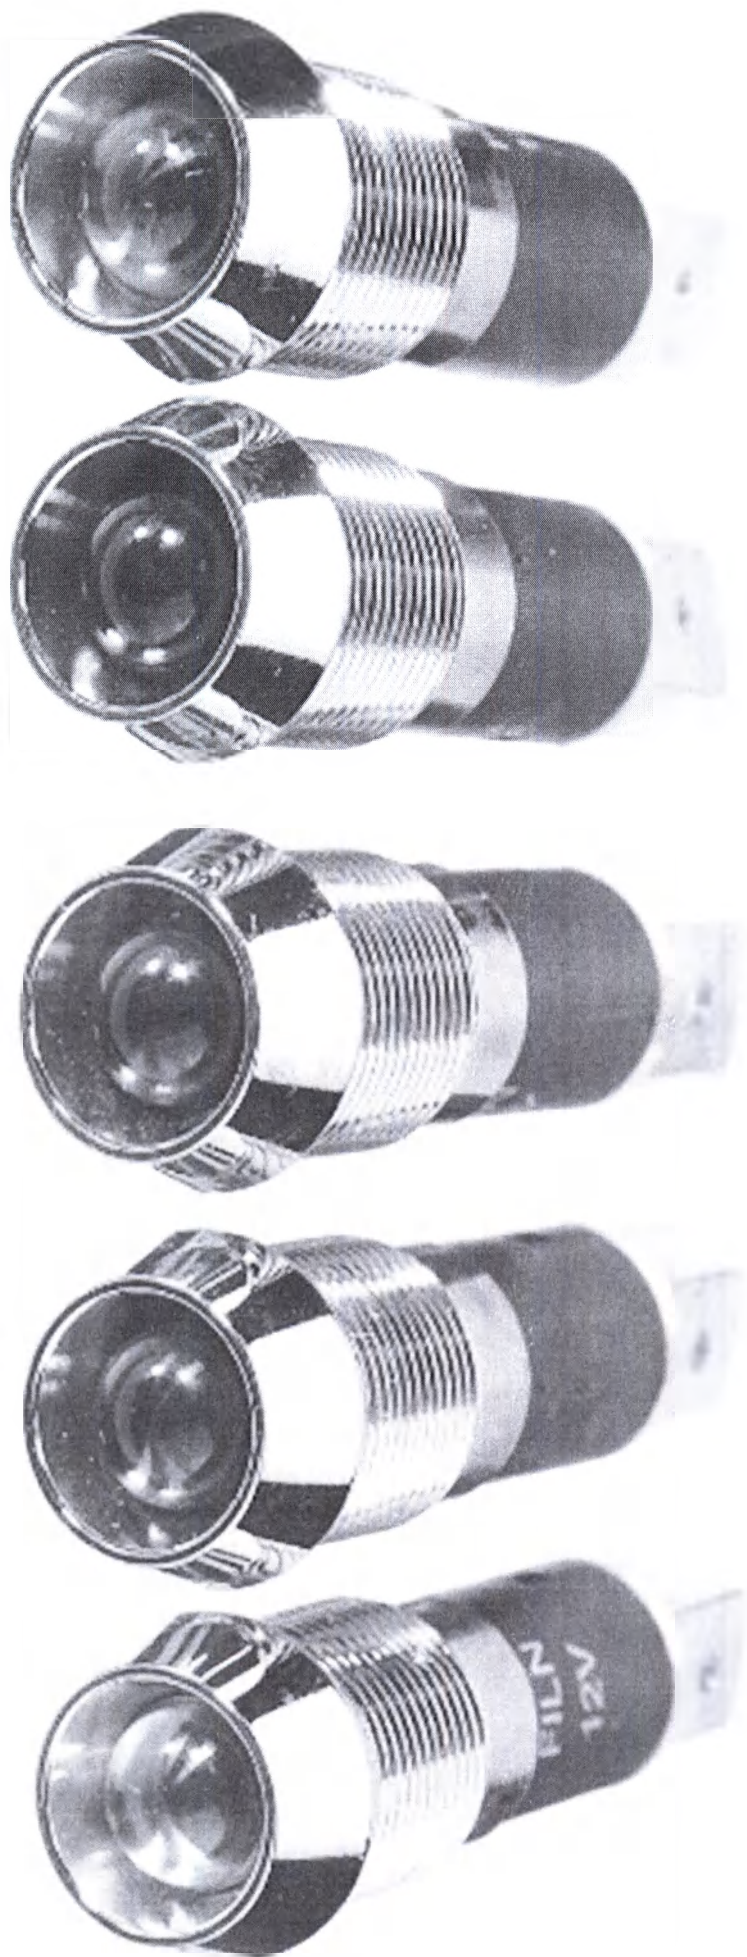


Лента тефлоновая

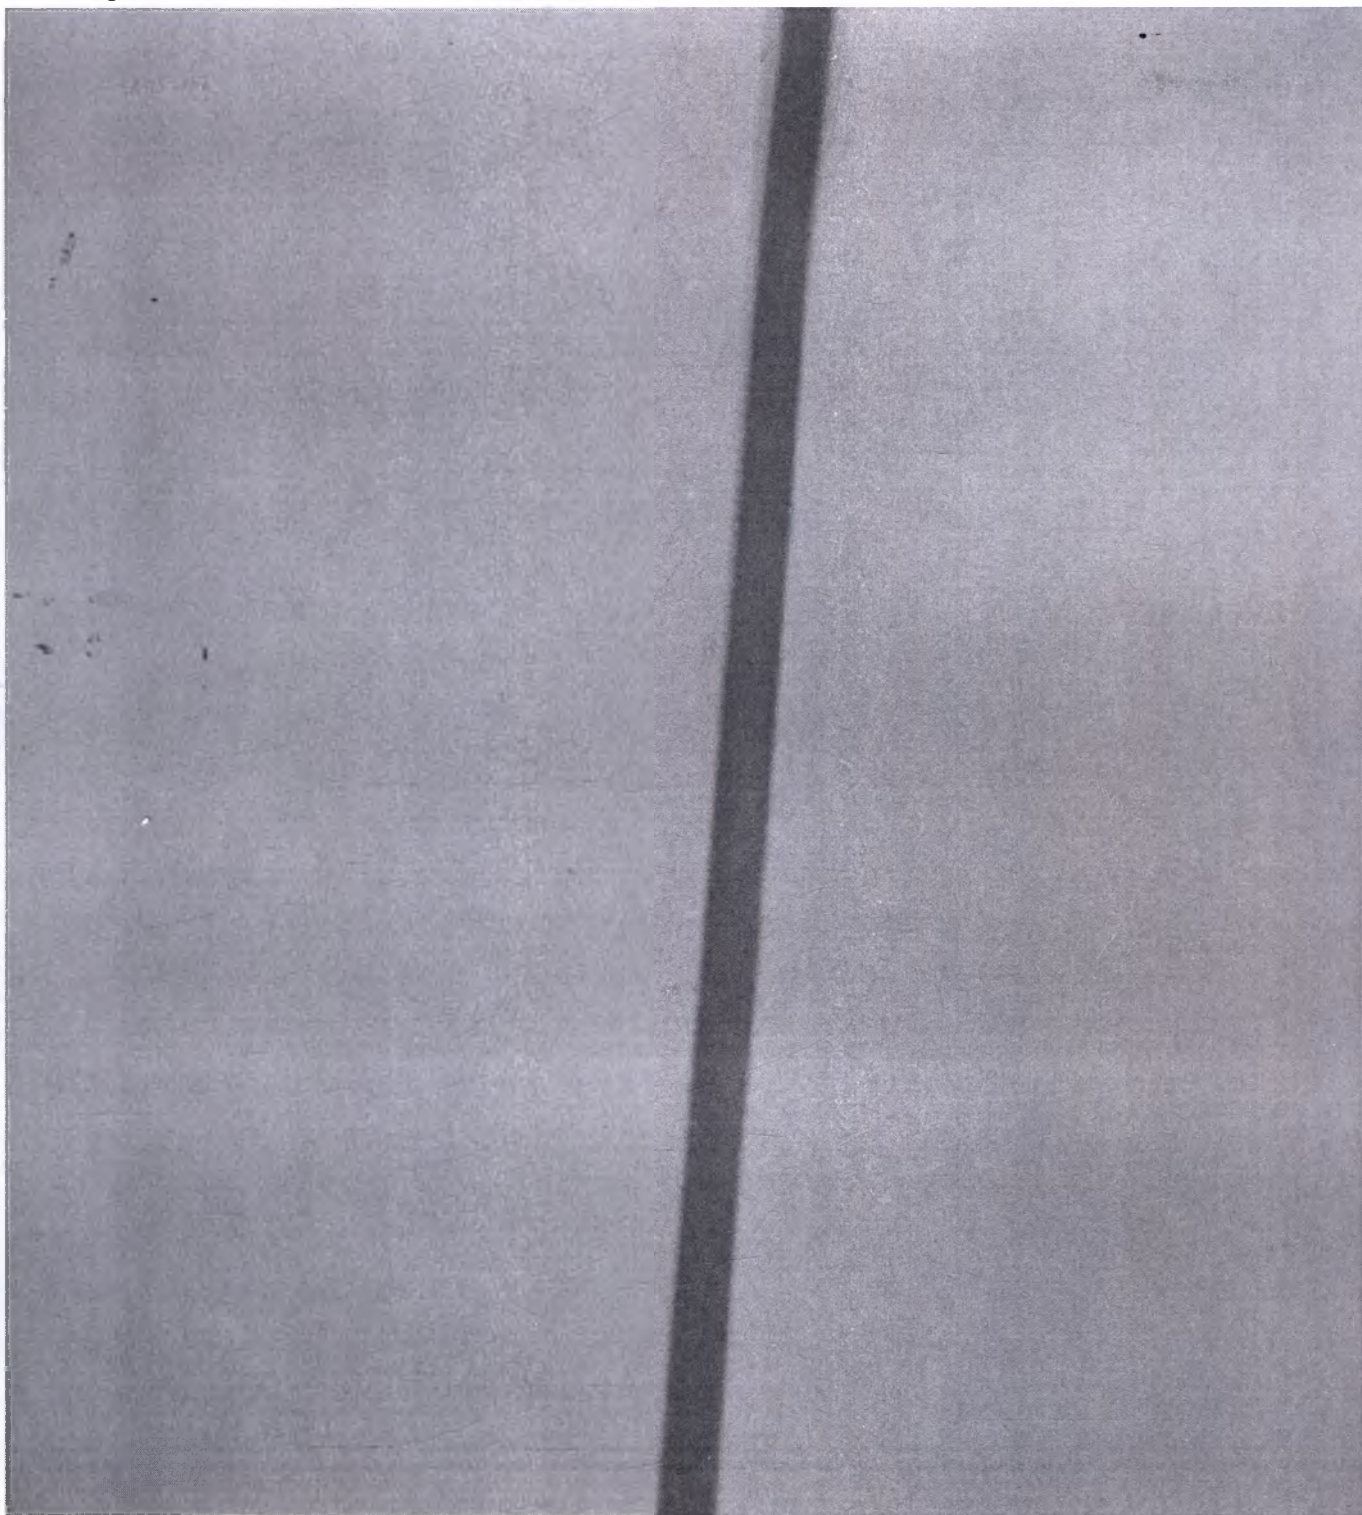



Лента фторопластовая



Микро выключатель

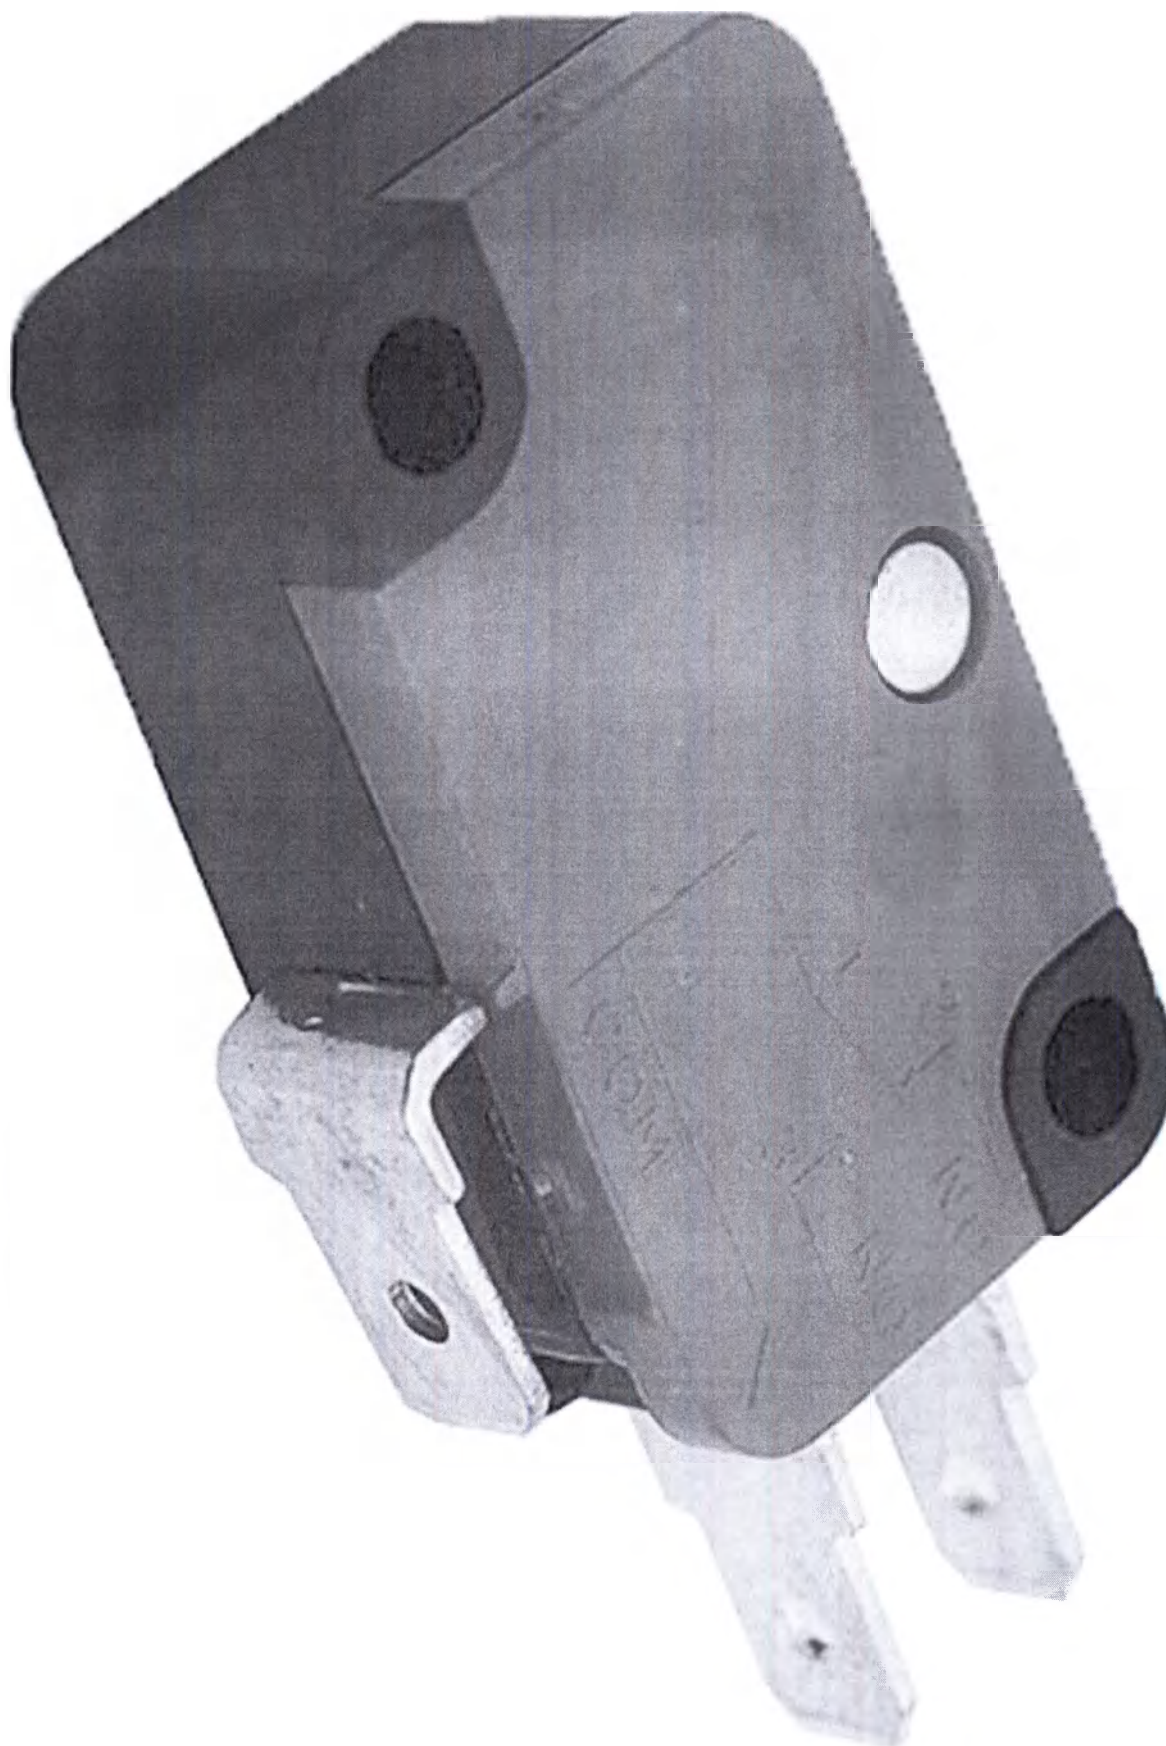


Нагревательный элемент

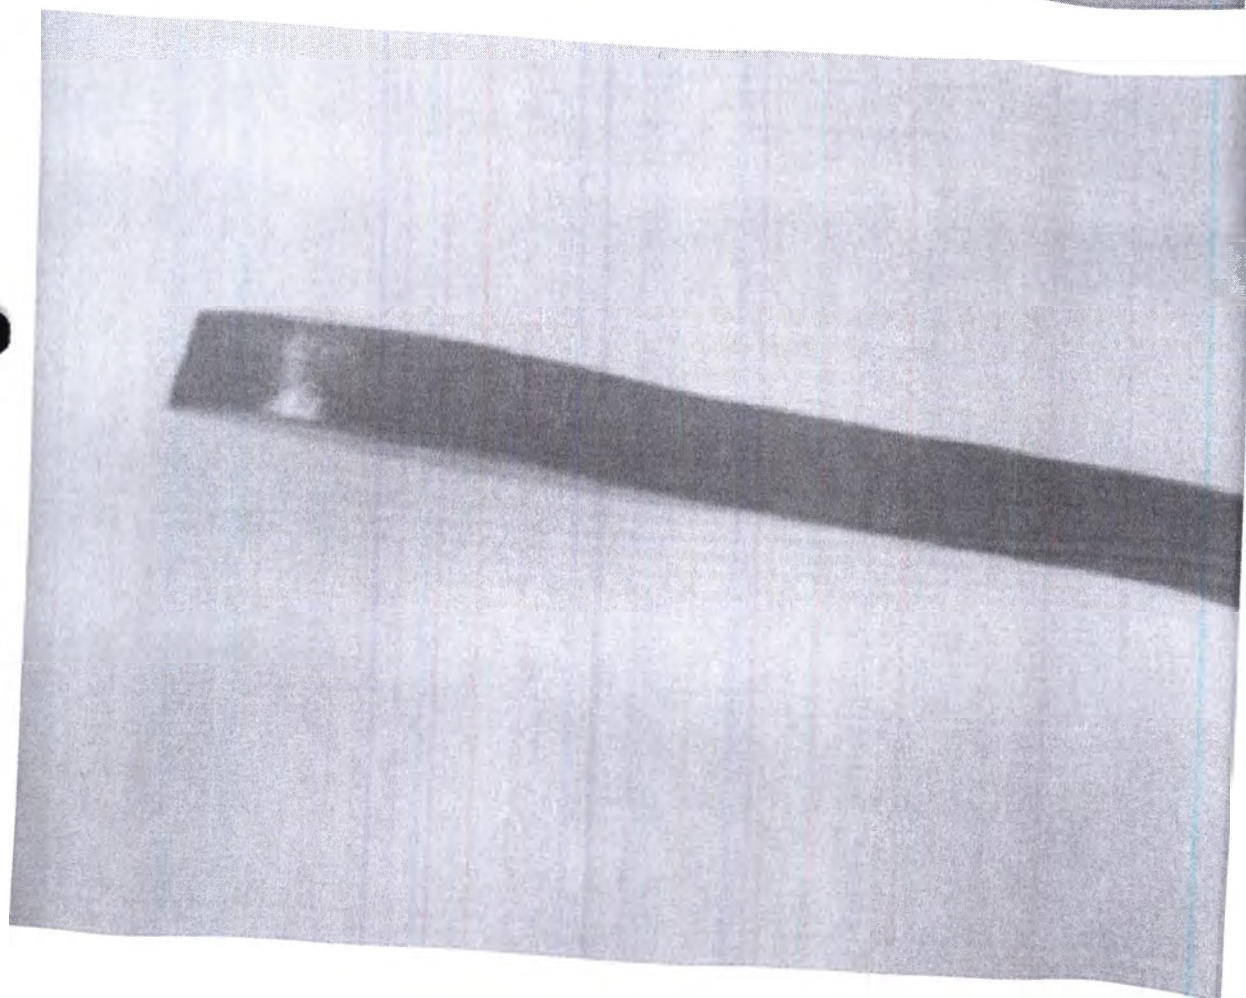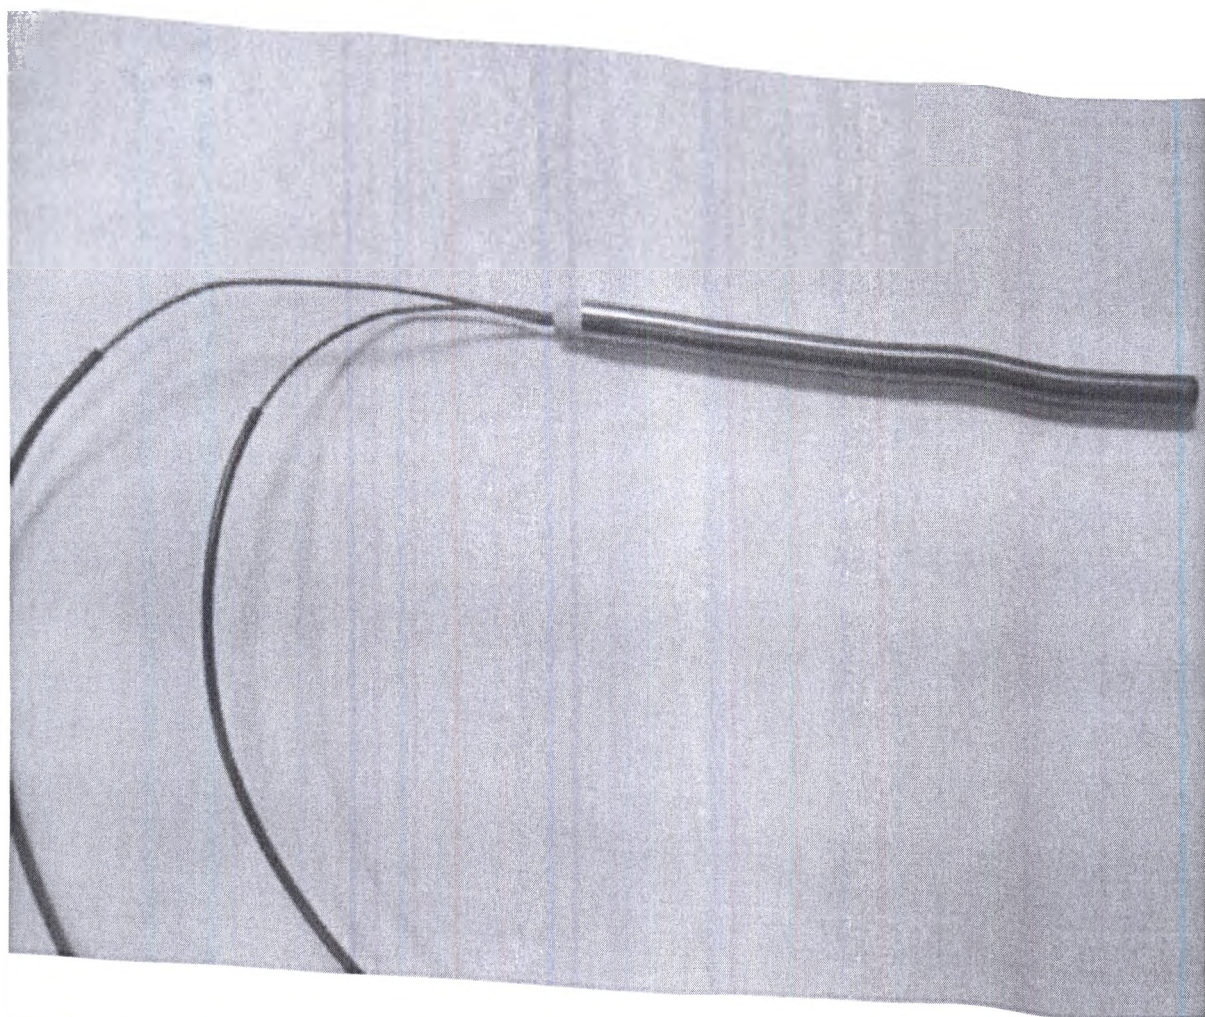


Направляющие



Панель внешняя

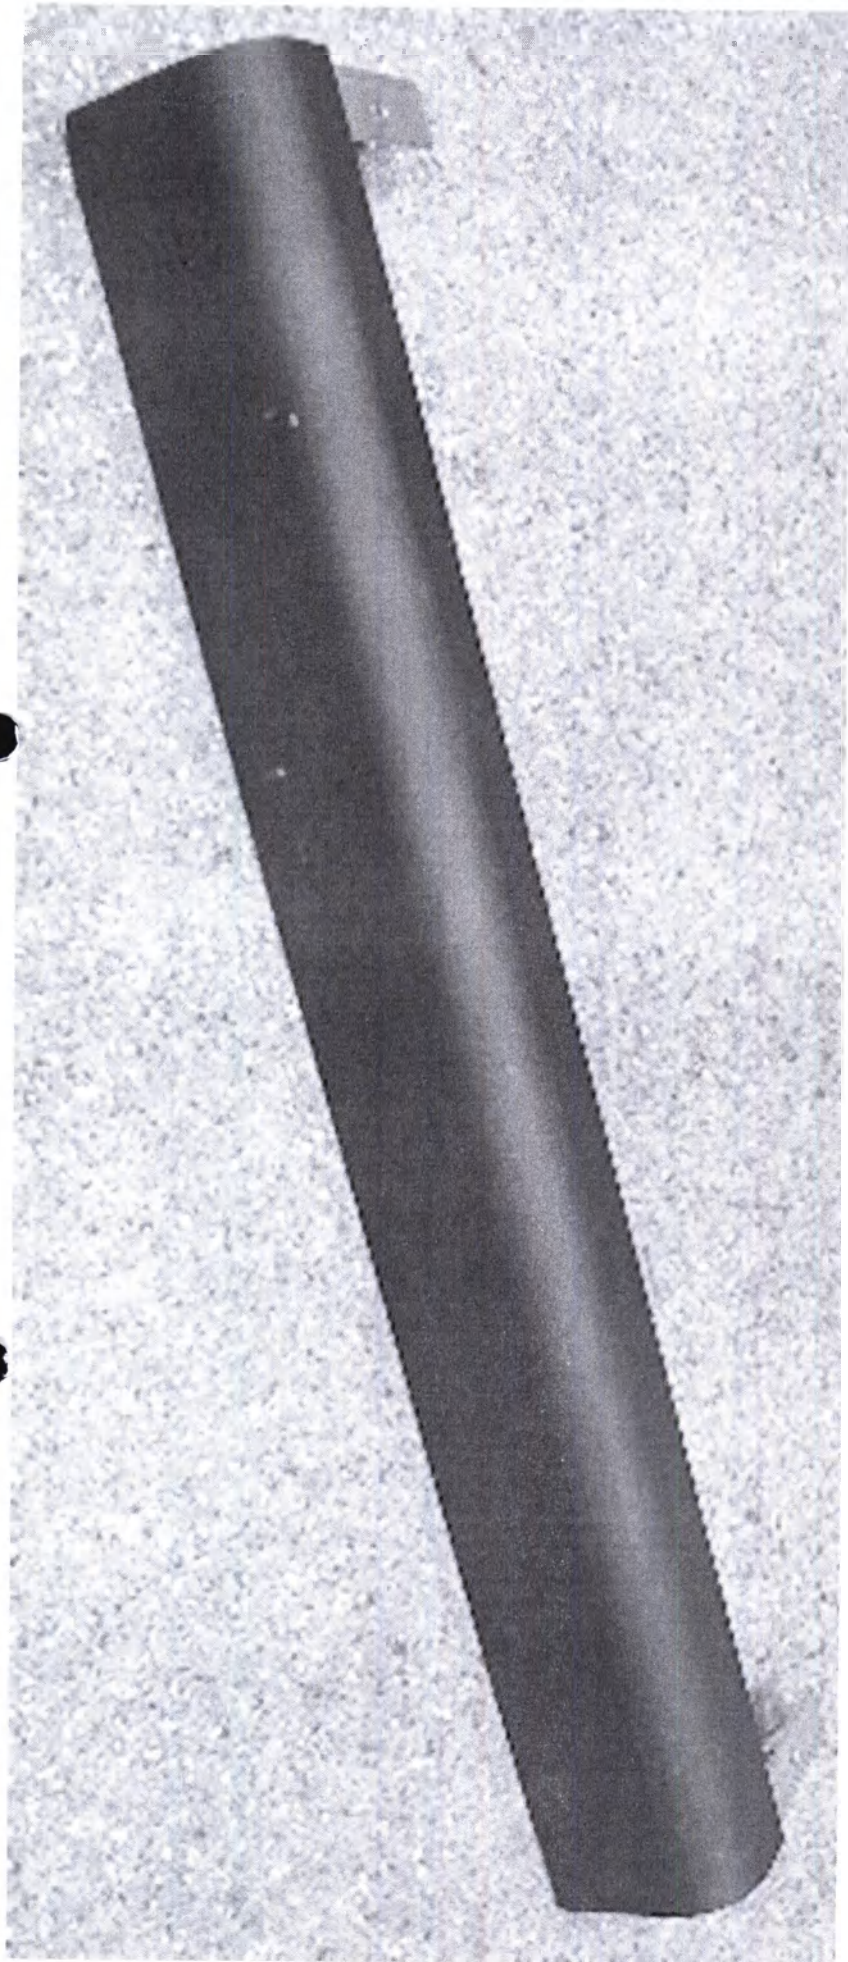


Панель облицовочная

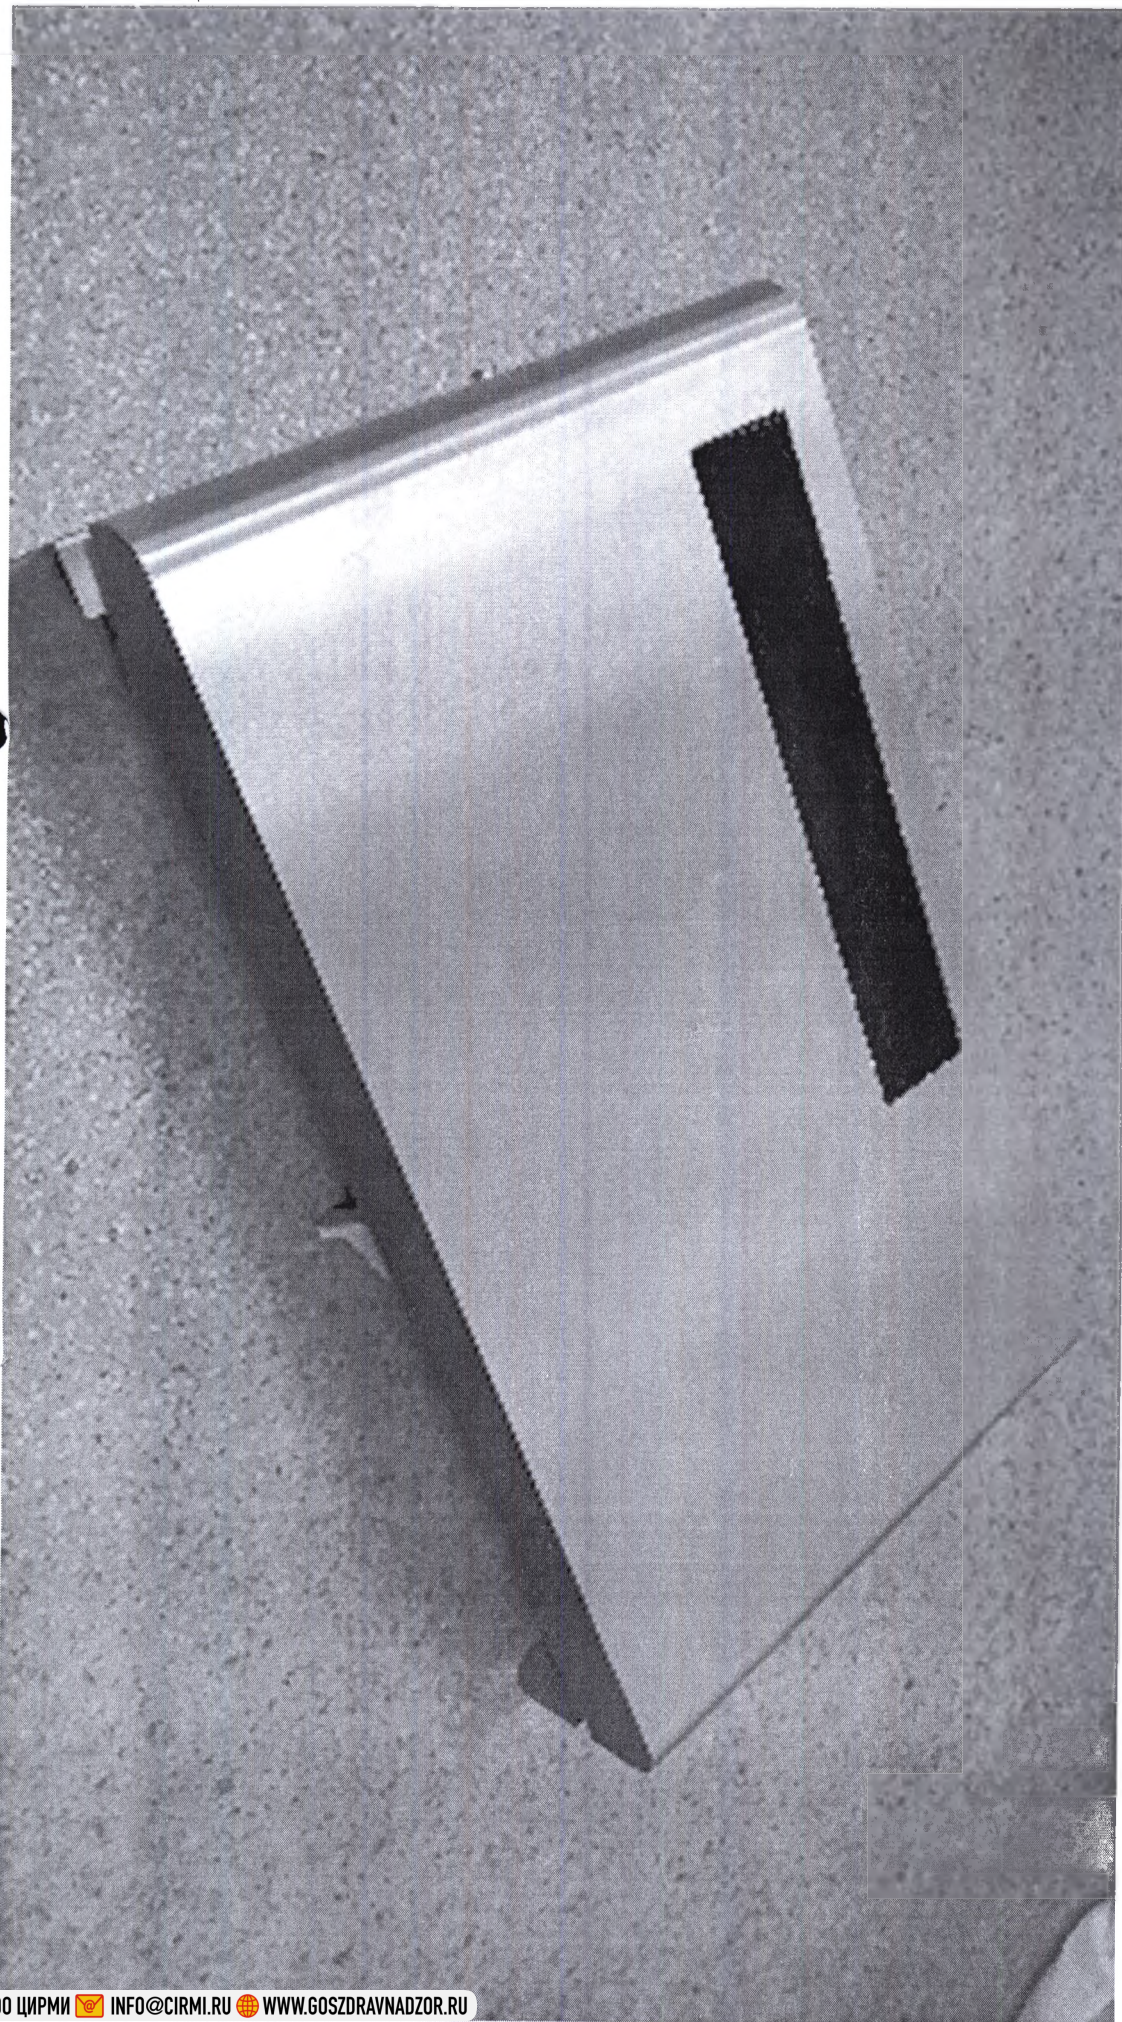


Пластина фторопластовая защитная




Пластина фторопластовая на нагревательных элементах

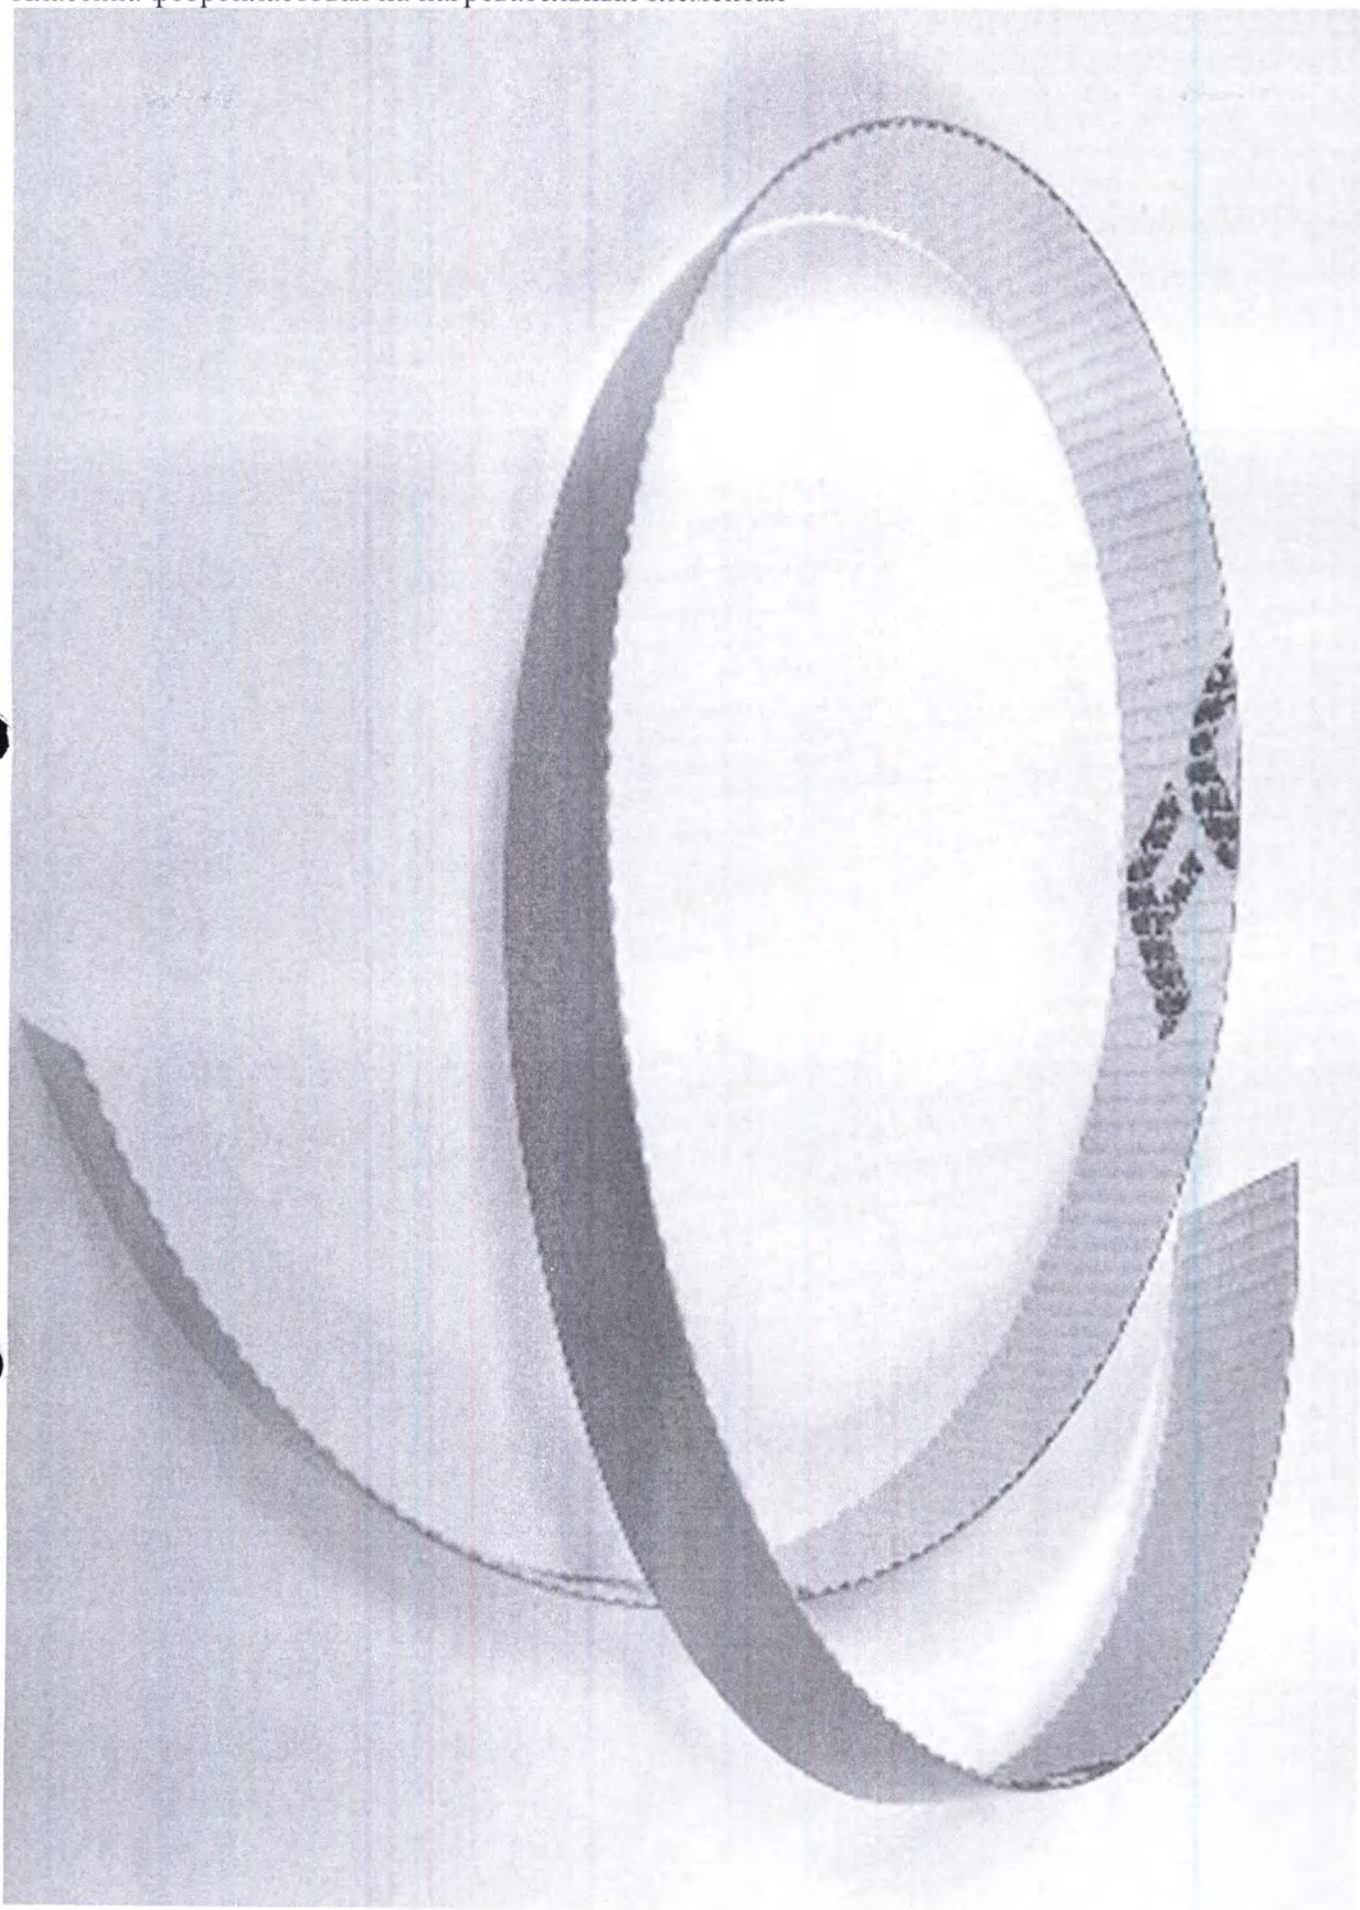


Пластина фторопластовая на направляющих

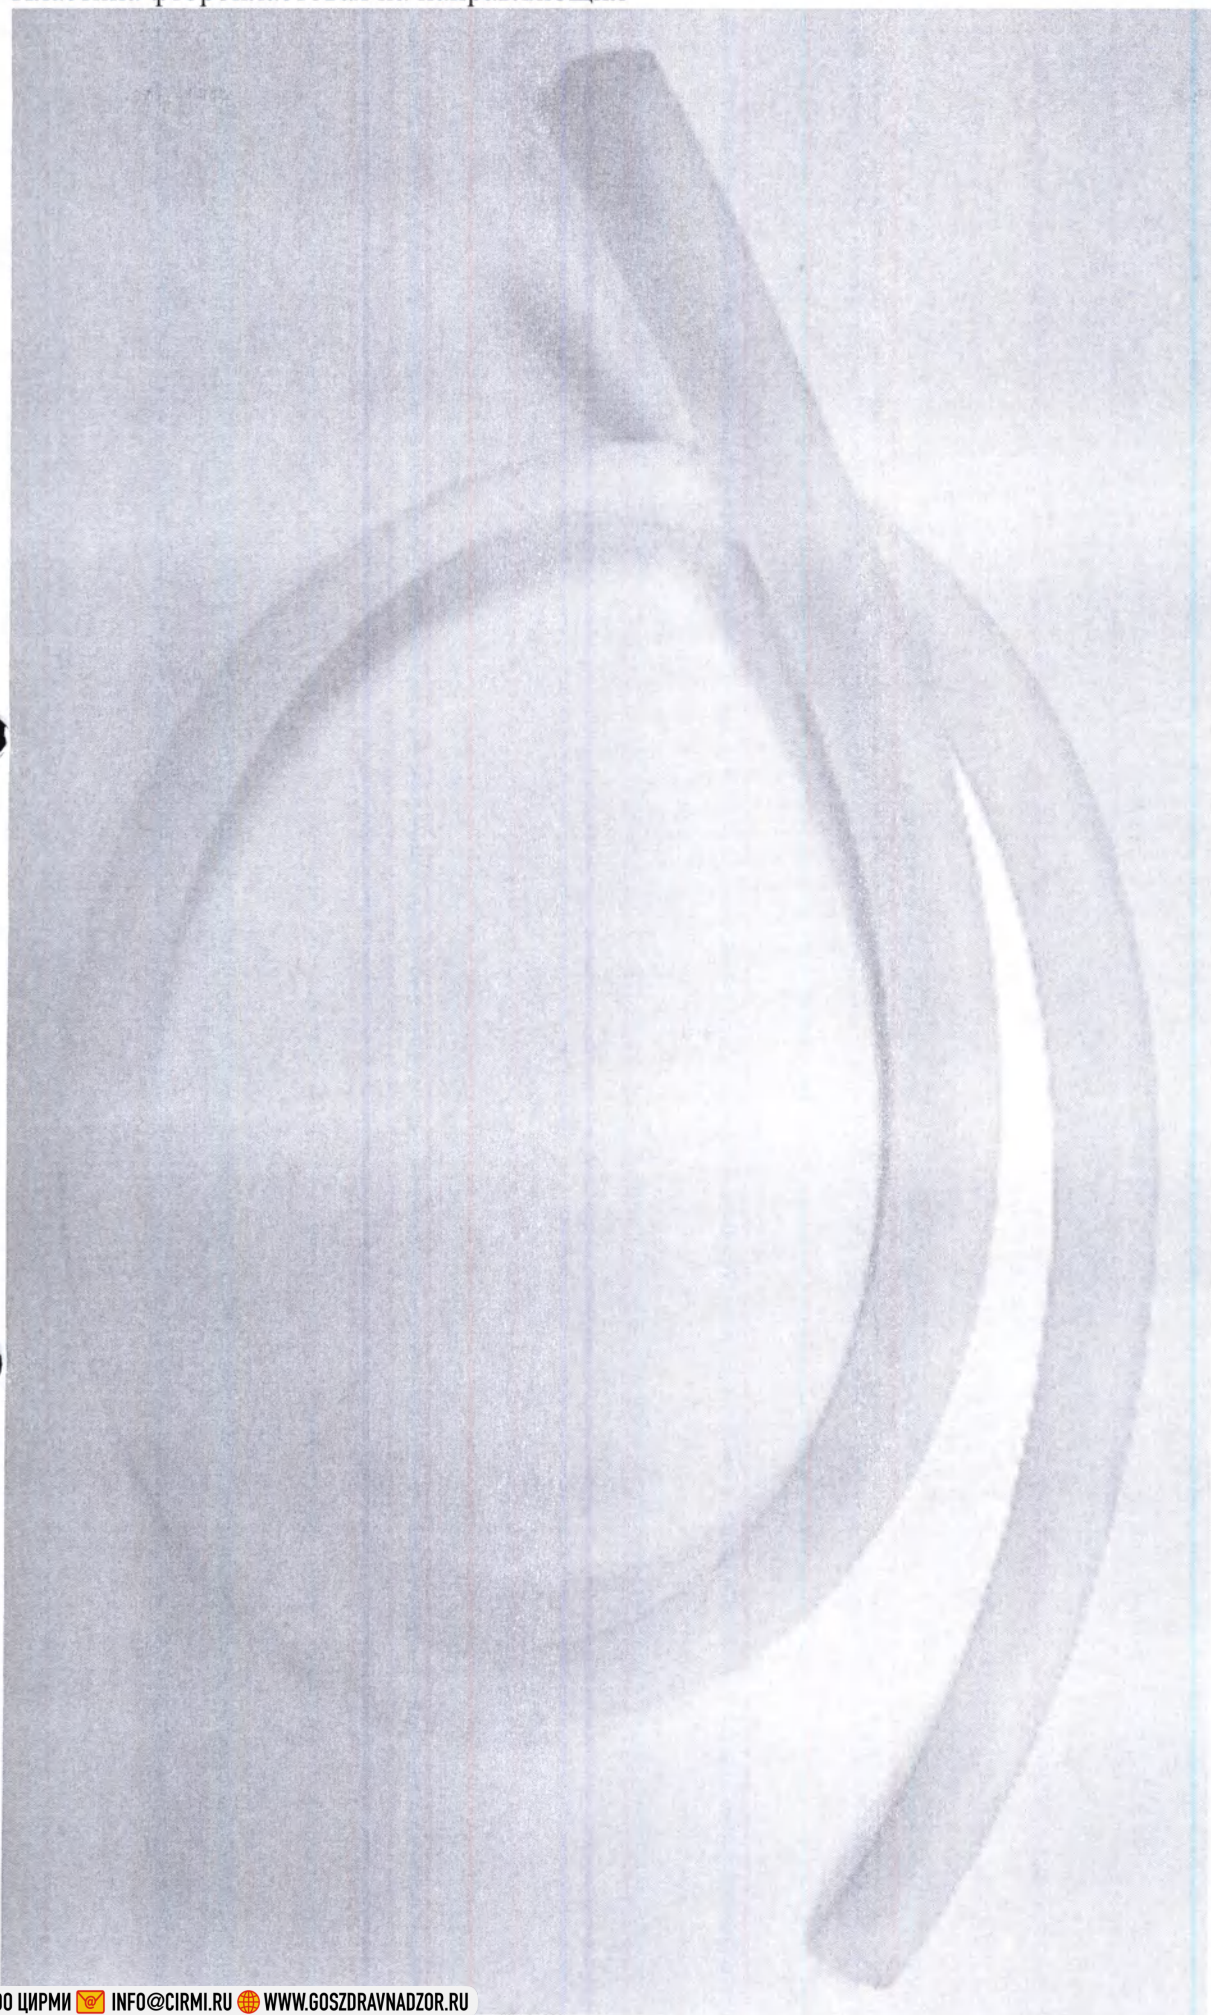


Плата микропроцессорная

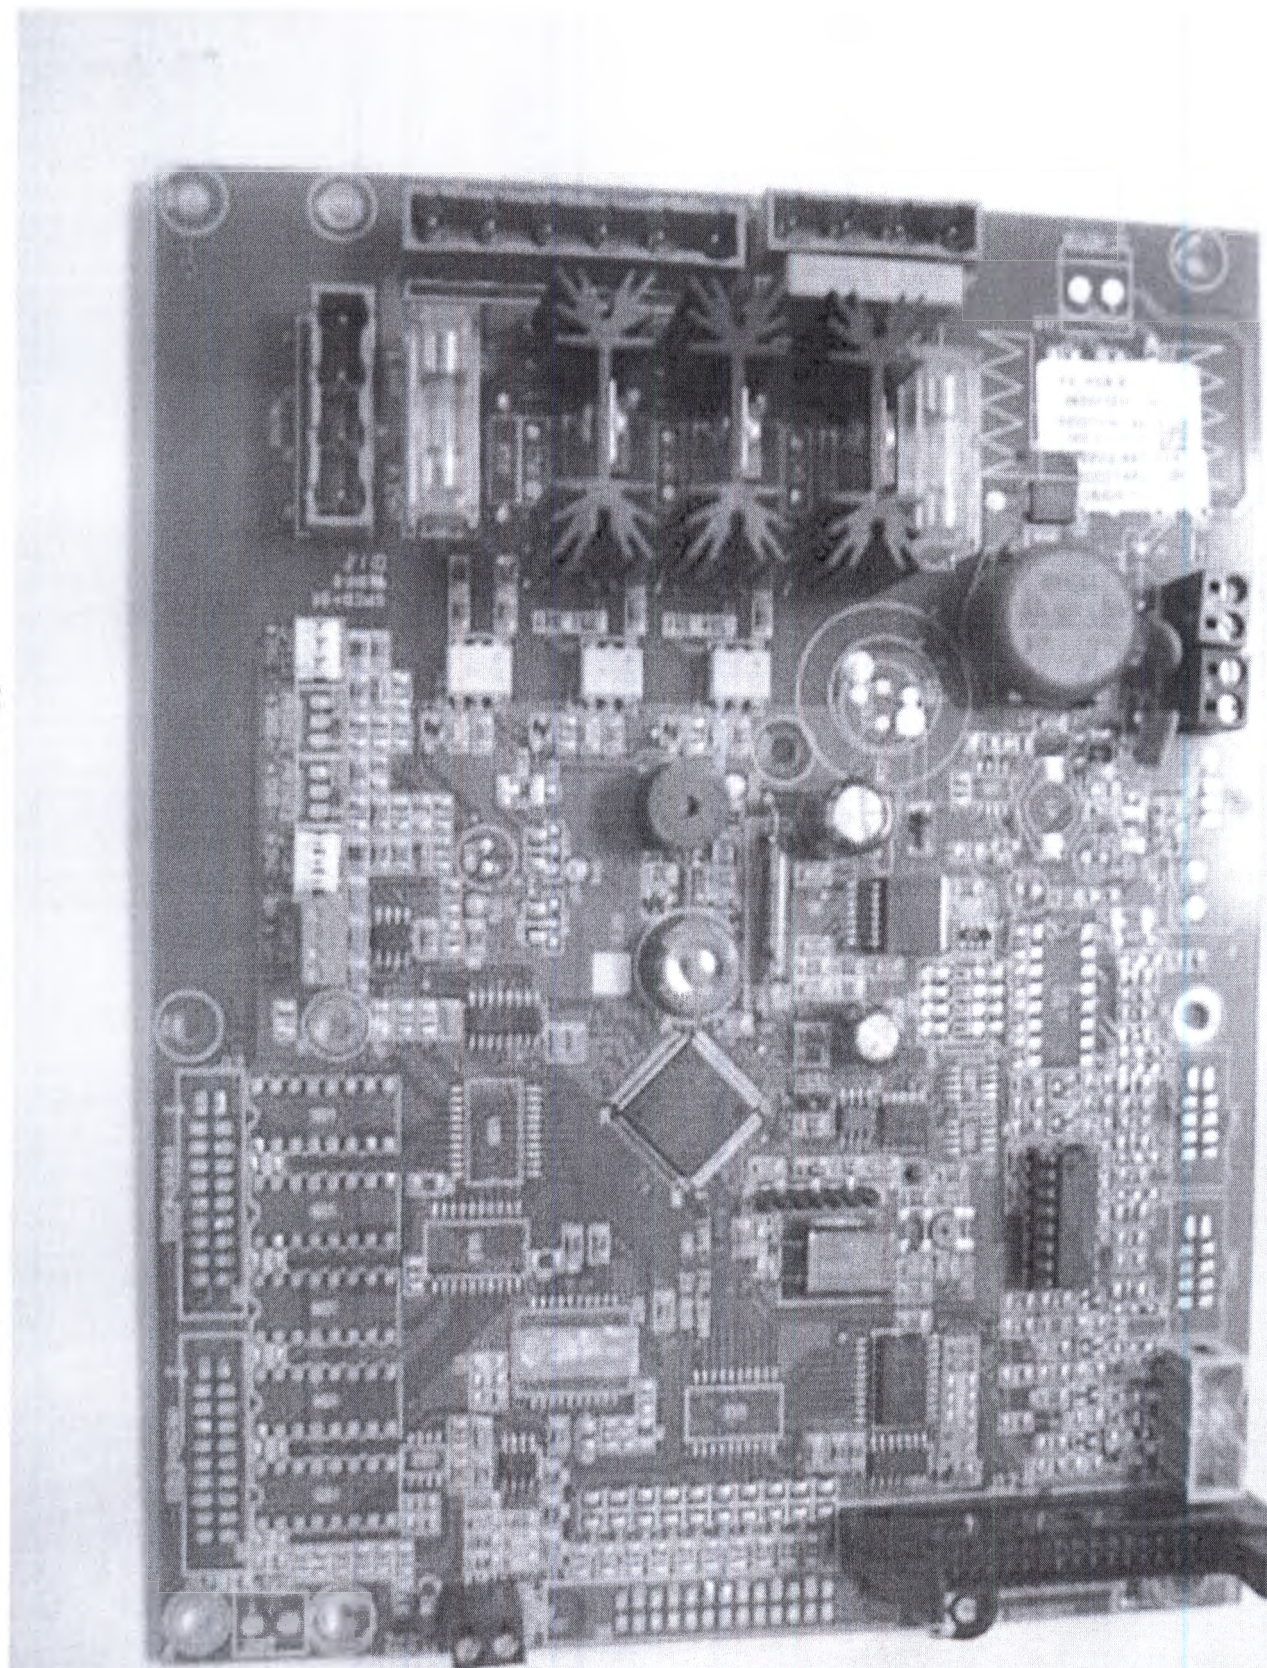


Подставка передняя для упаковок

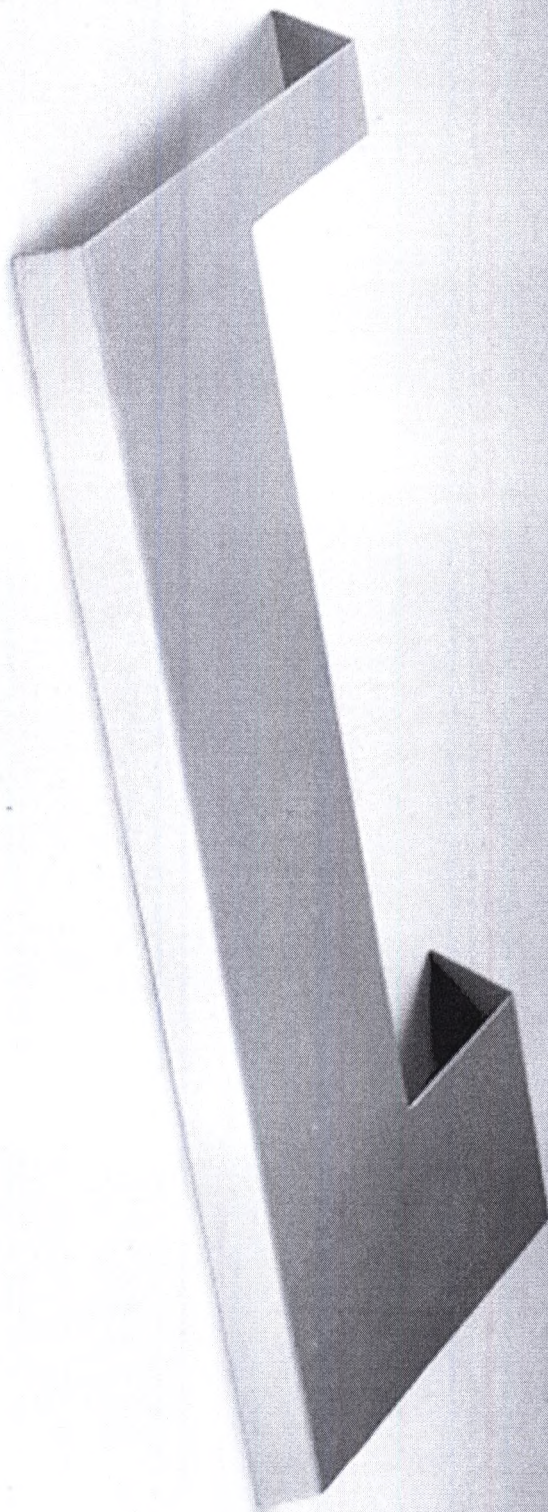

Подставка передняя для упаковок роликовая

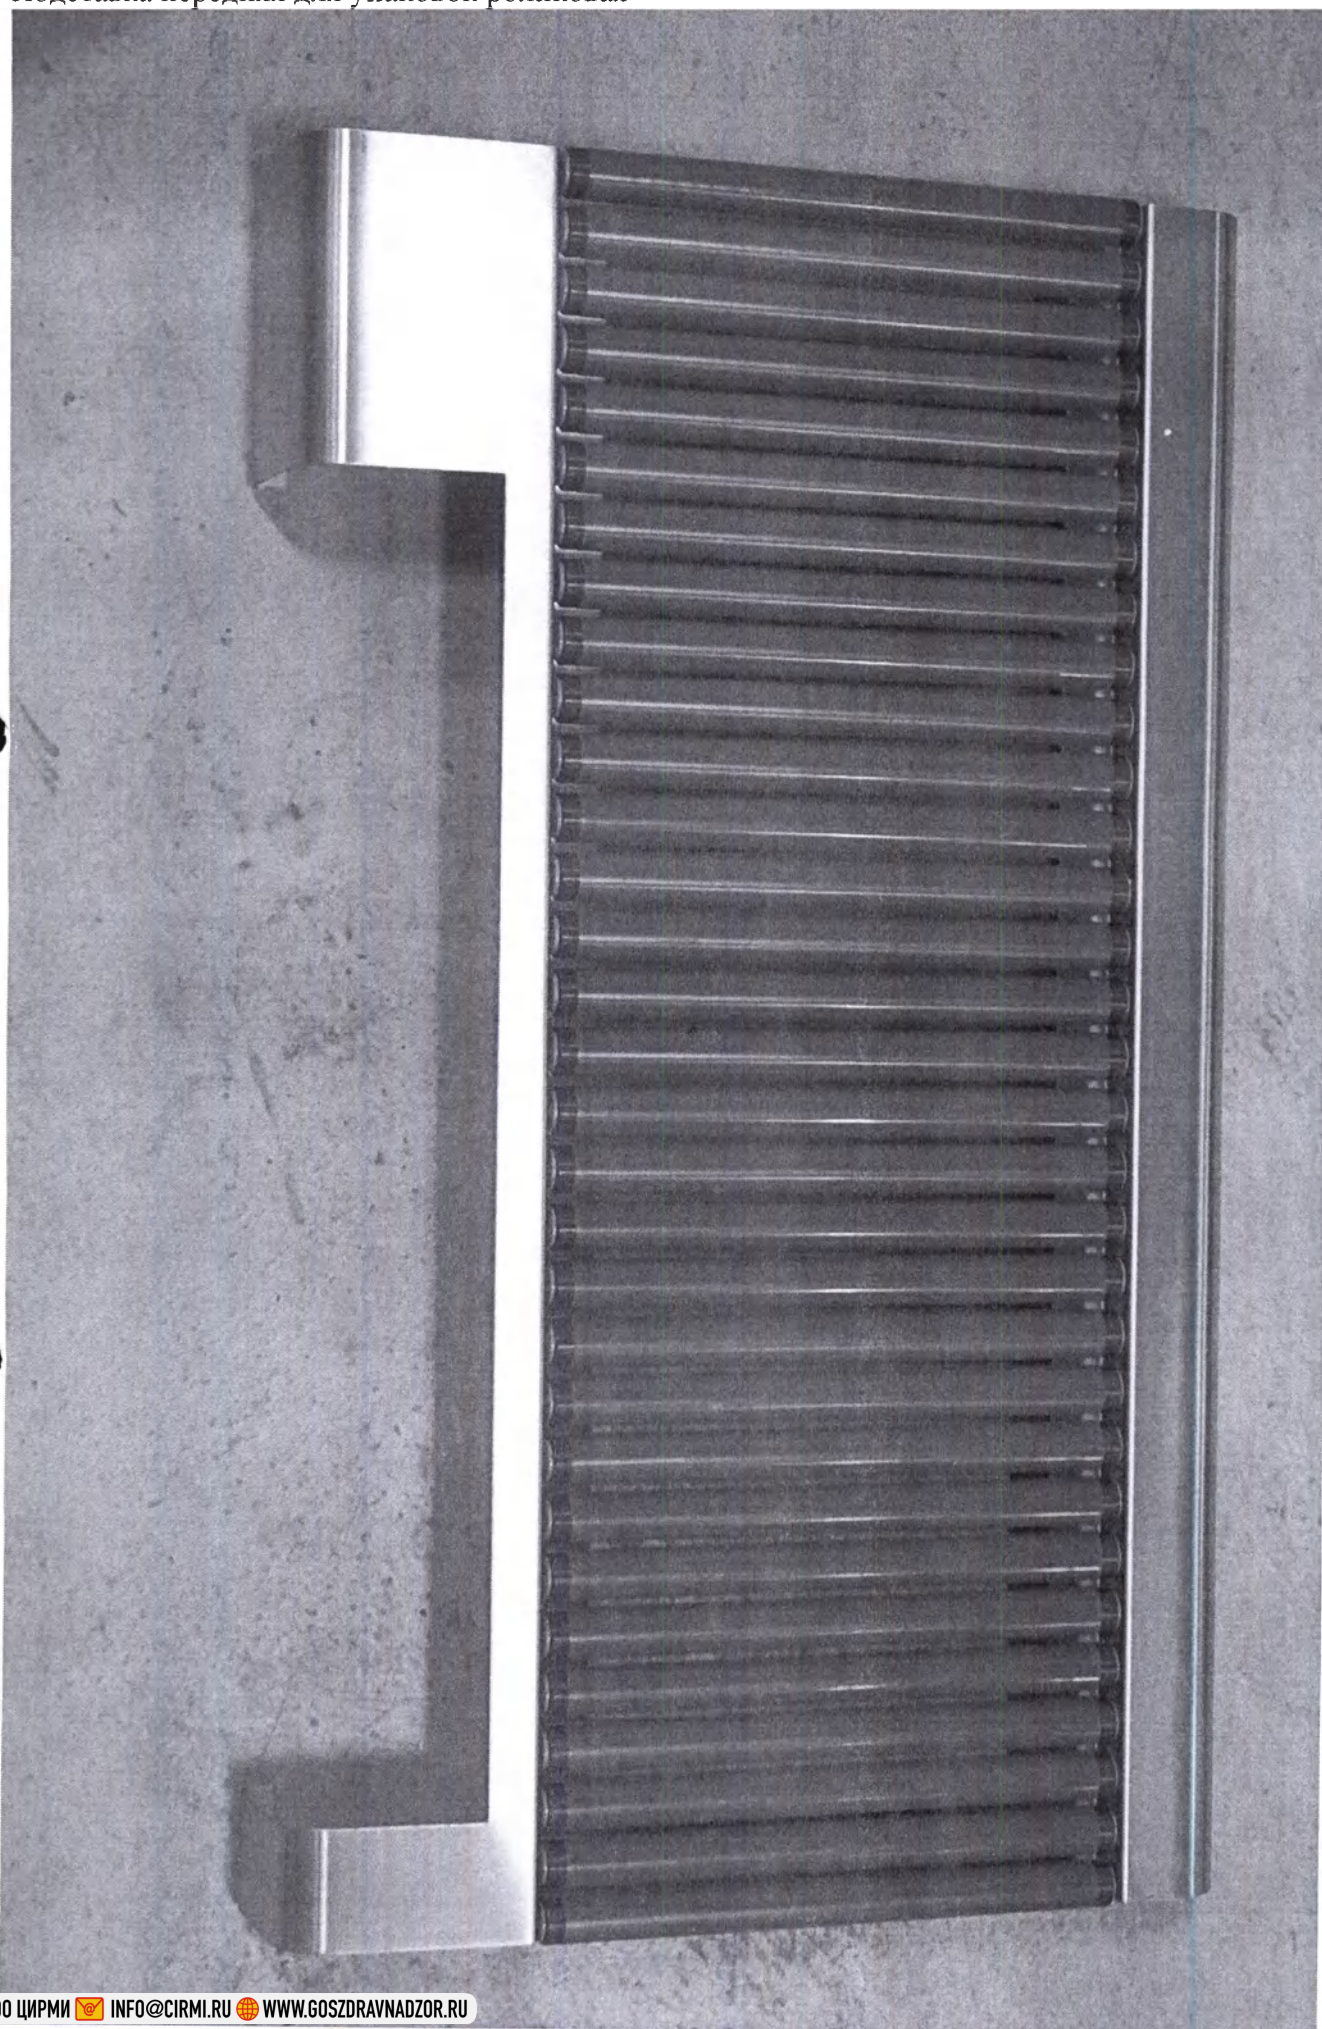


Подшипник

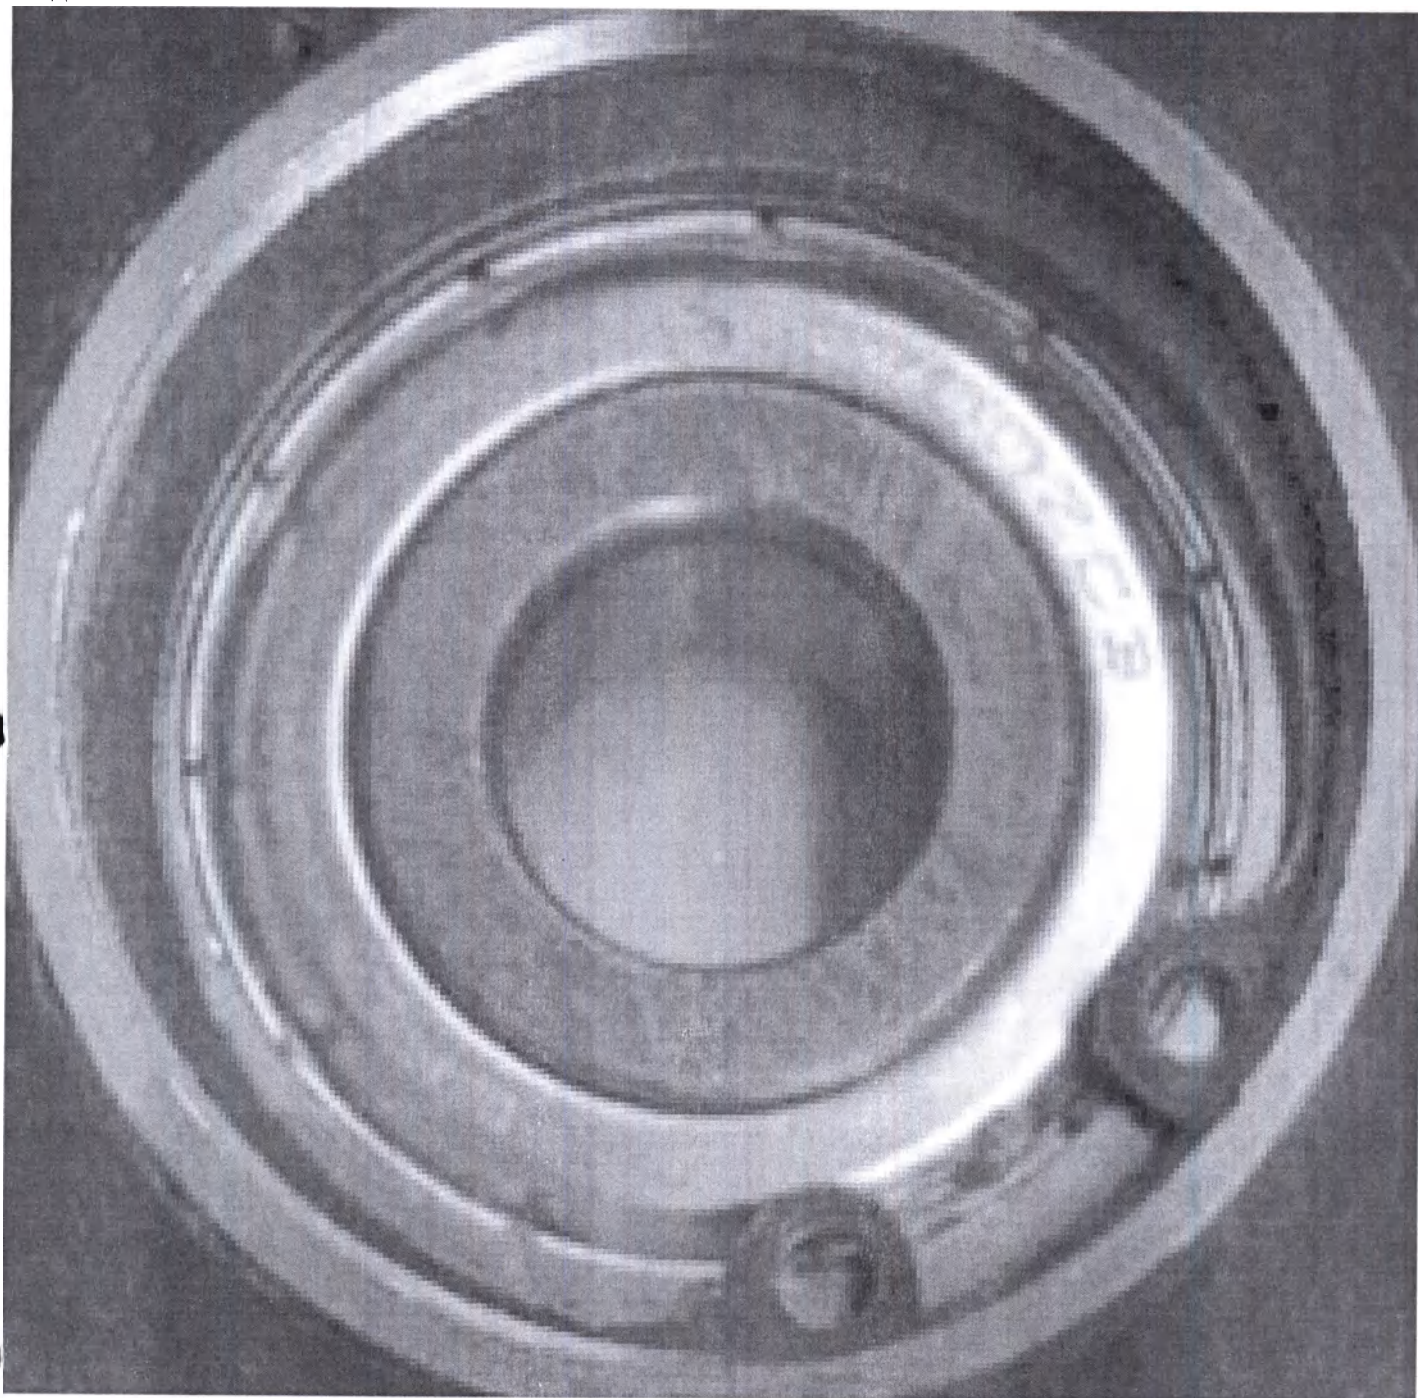


Предохранитель




Принтер внешний для распечатки этикеток

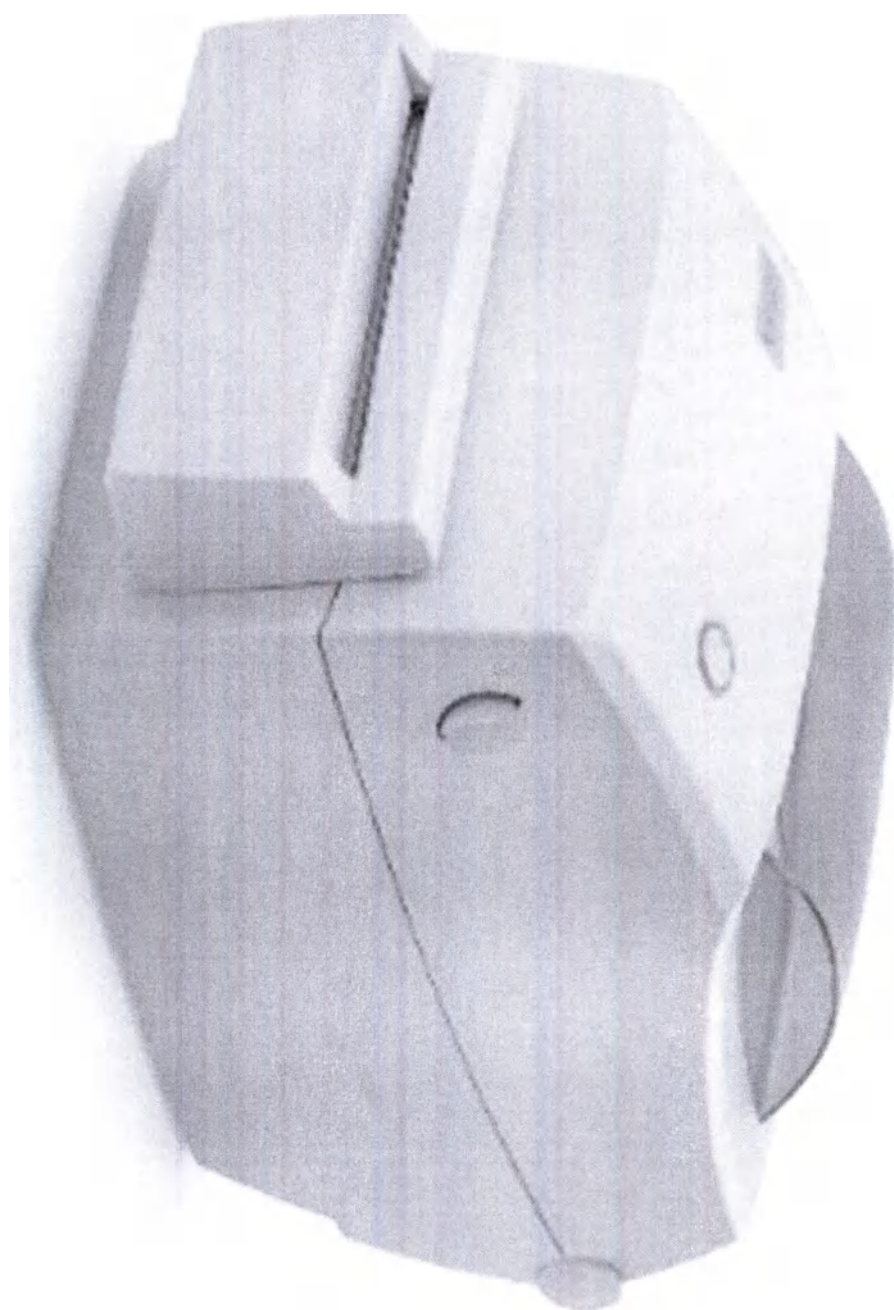


Принтер встроенный для распечатки информации о запайке

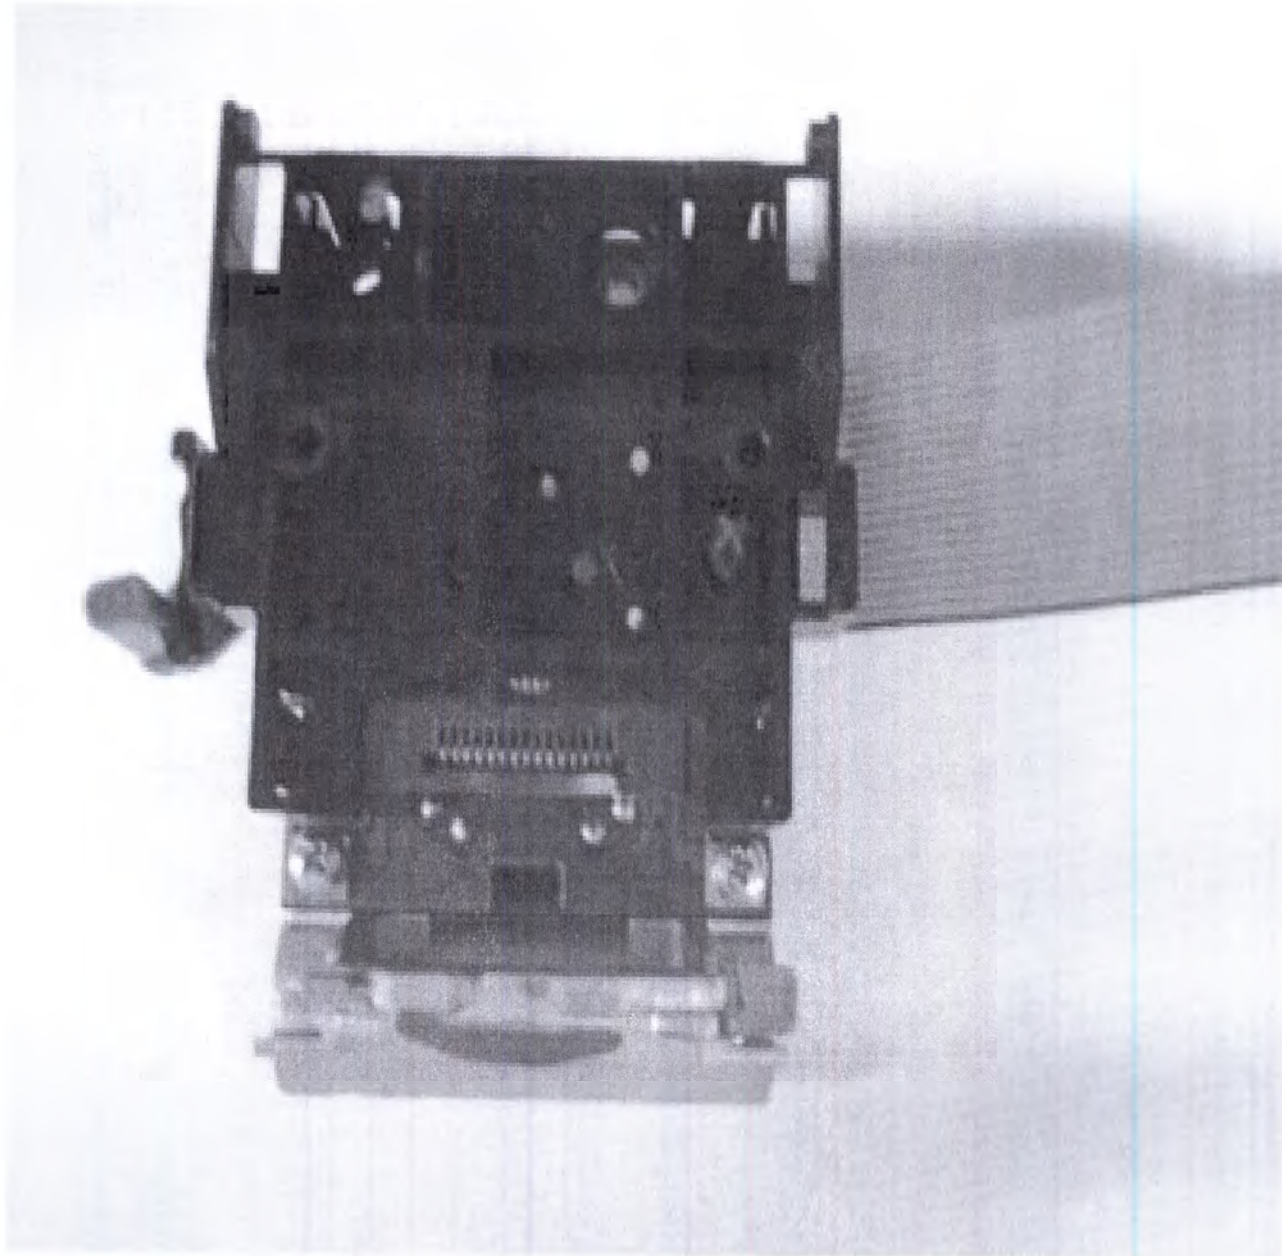


Пружина торсионная

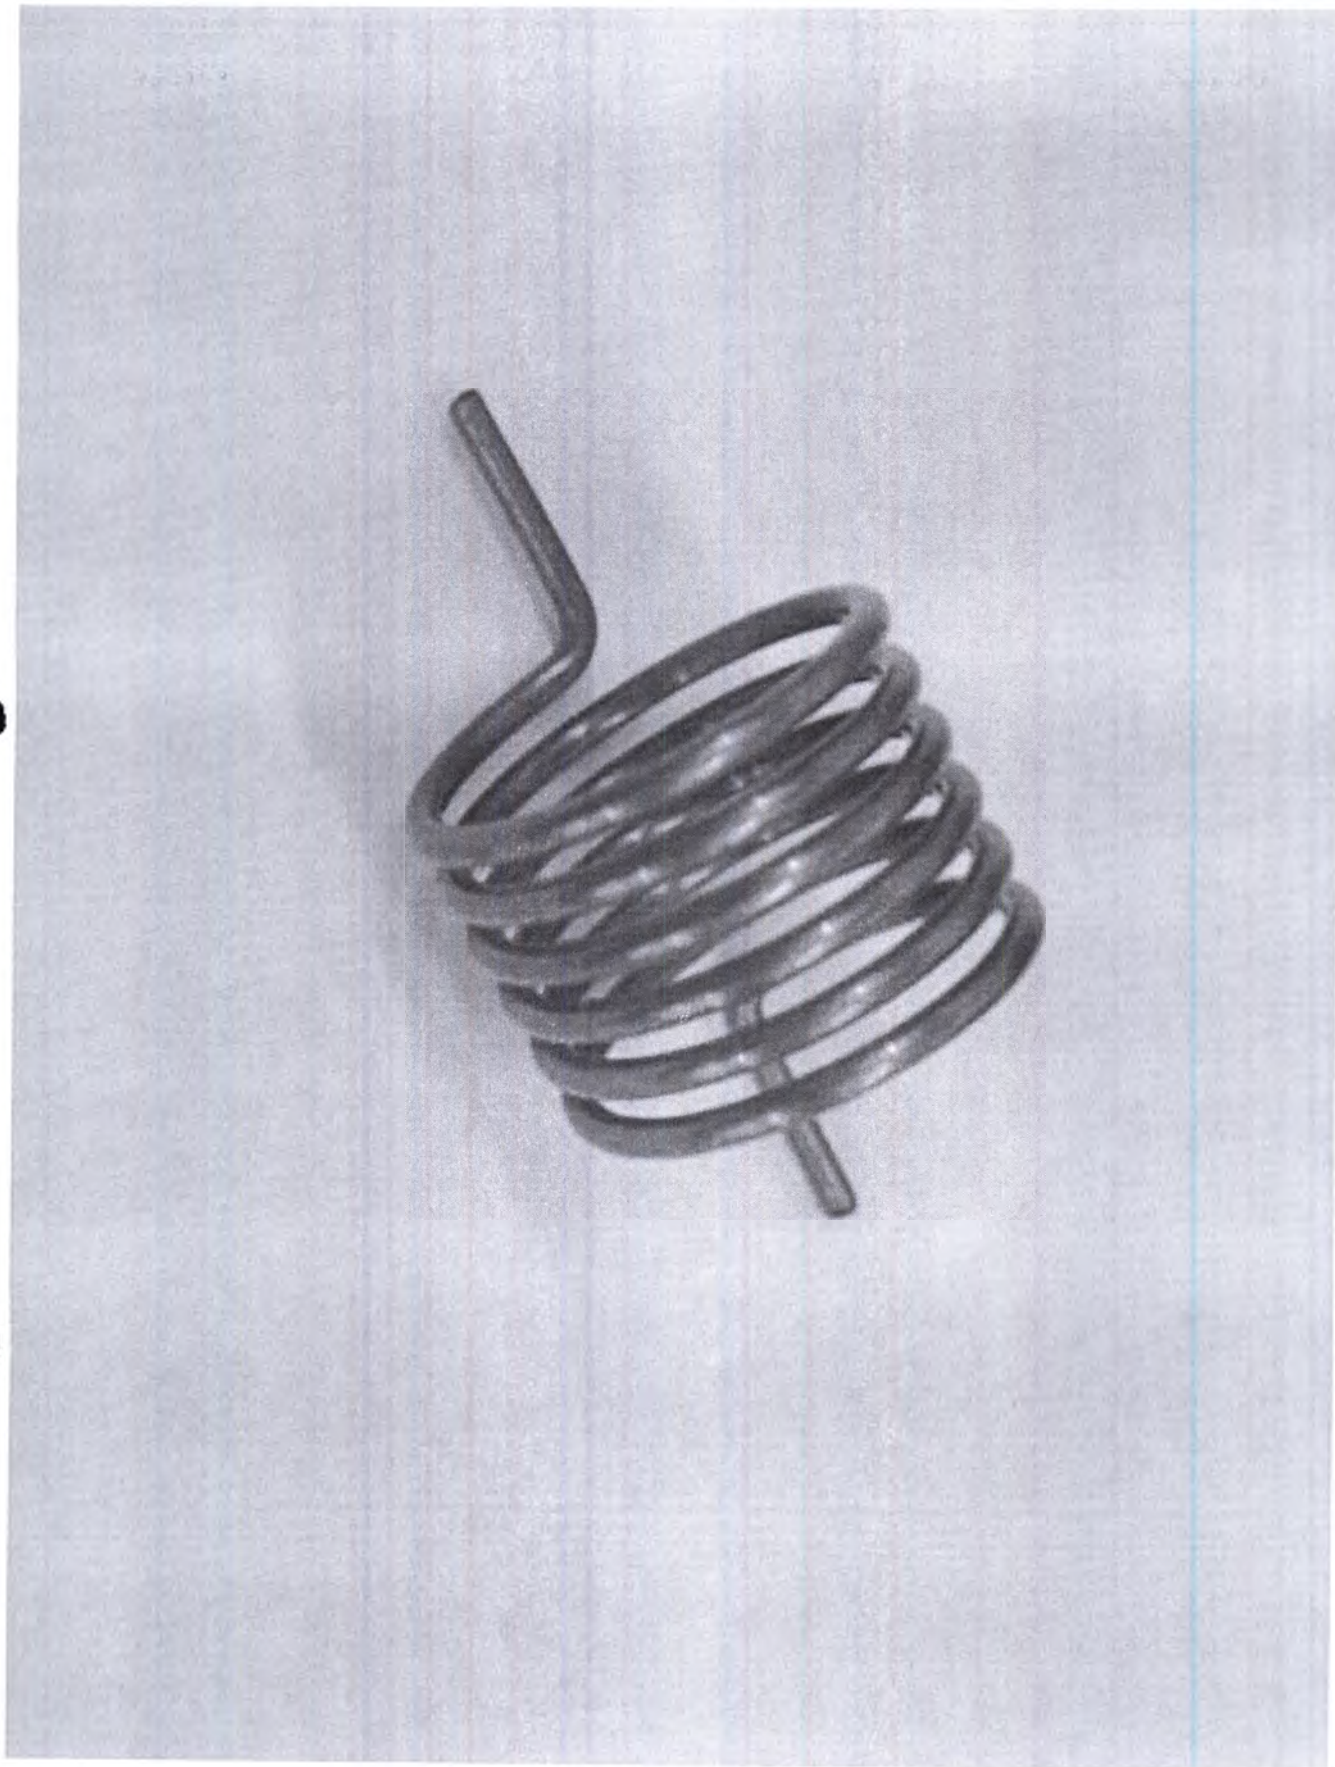


Регулятор времени

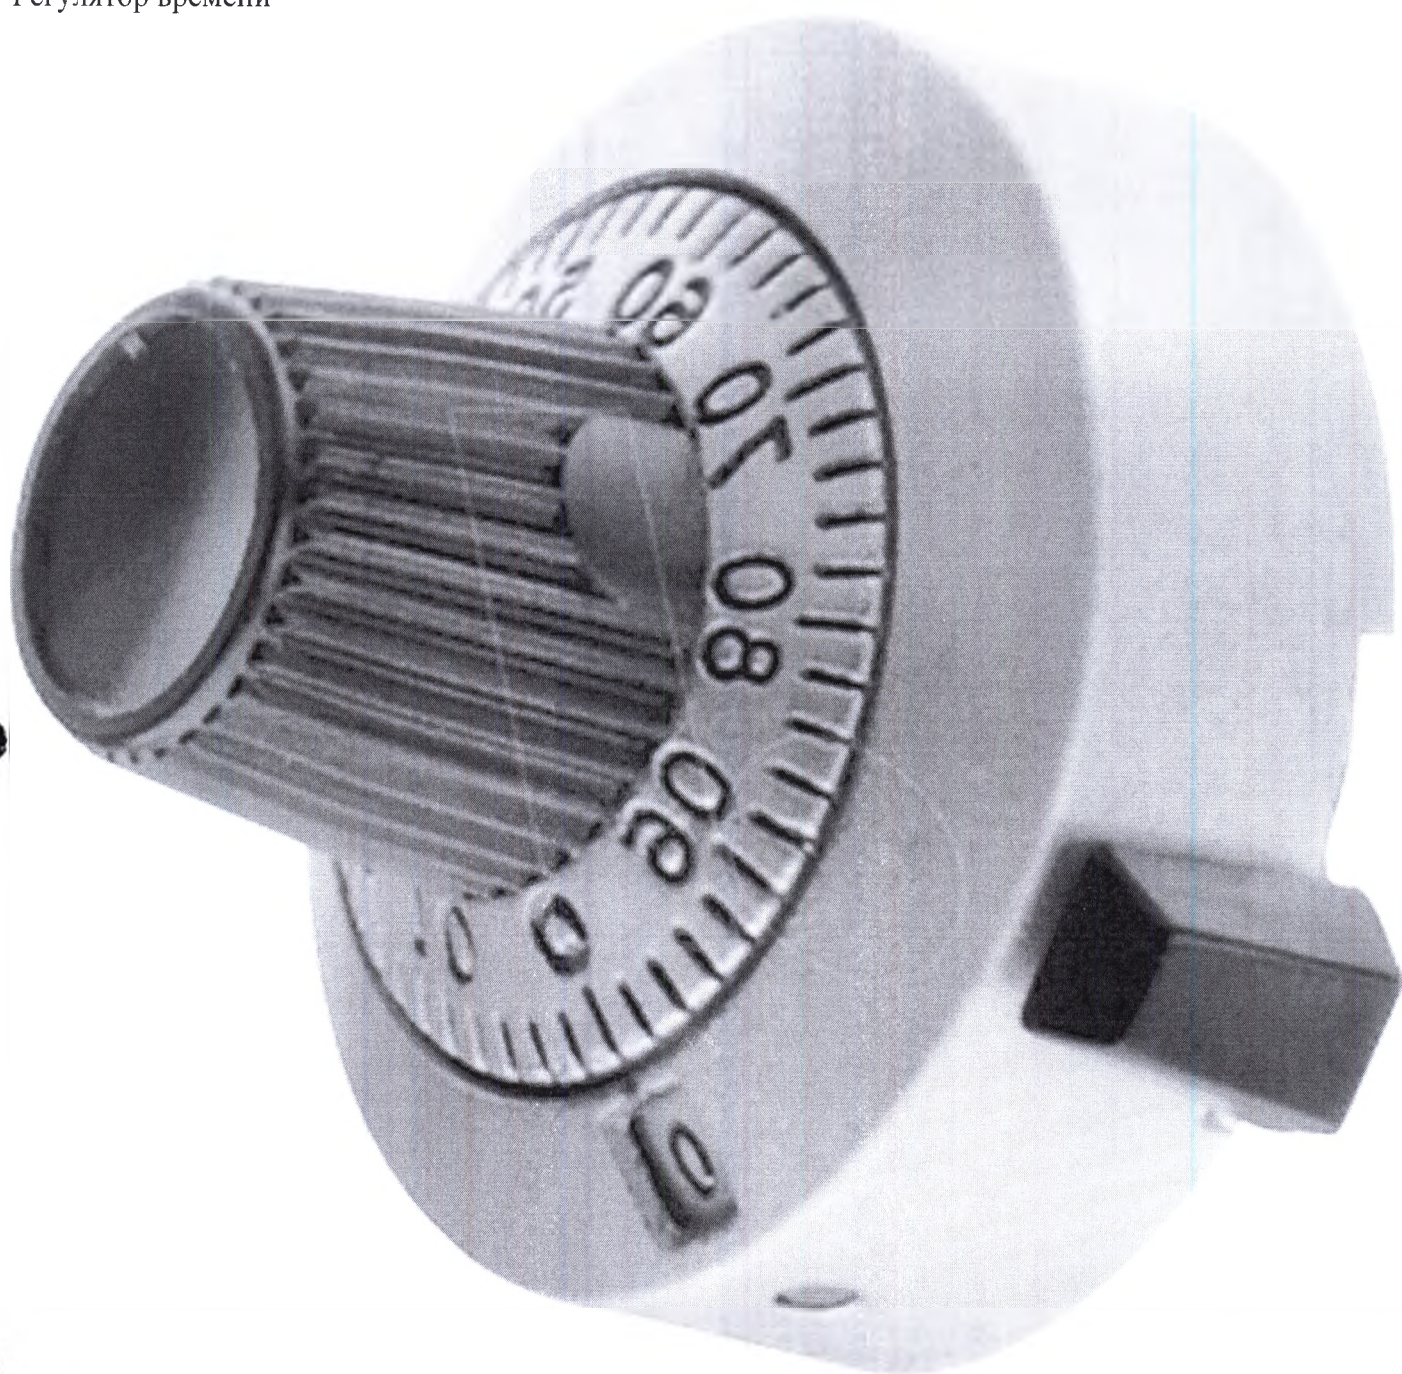


Регулятор температуры

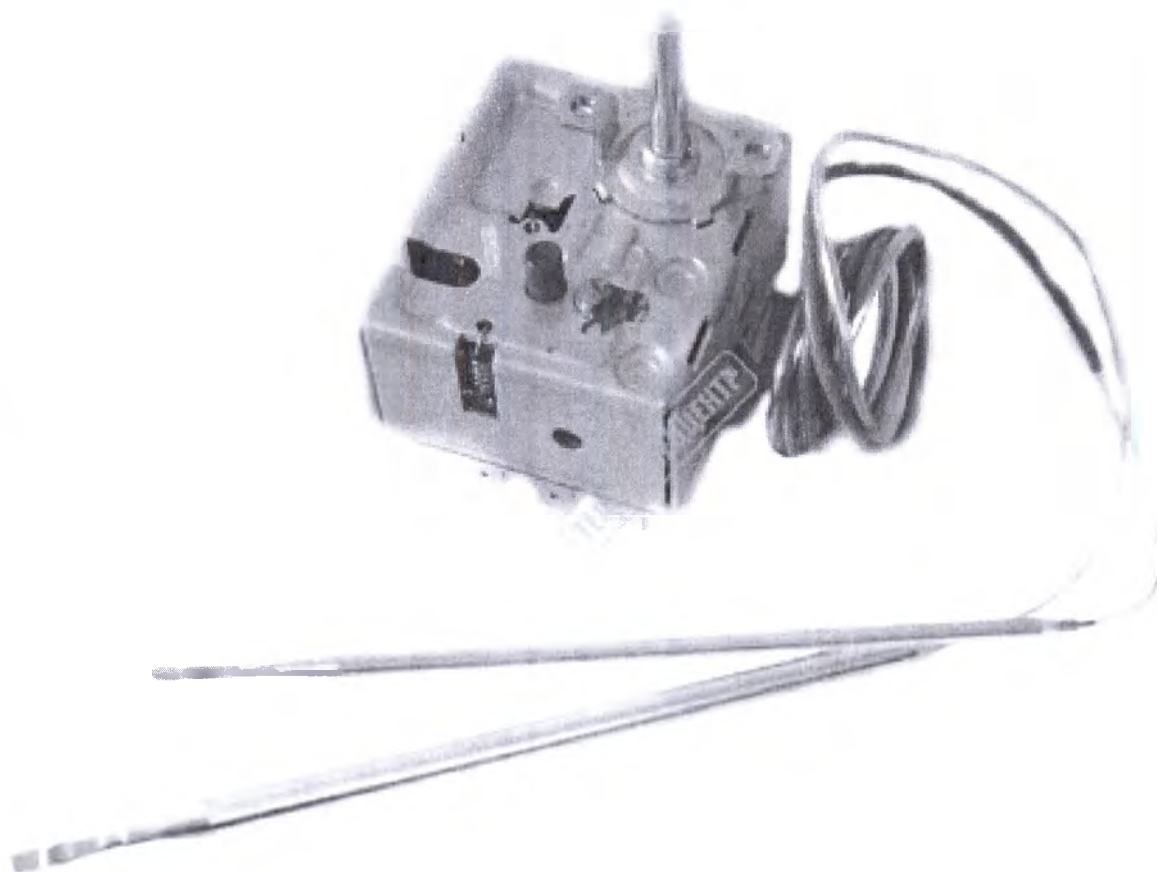


Резак упаковочного материала

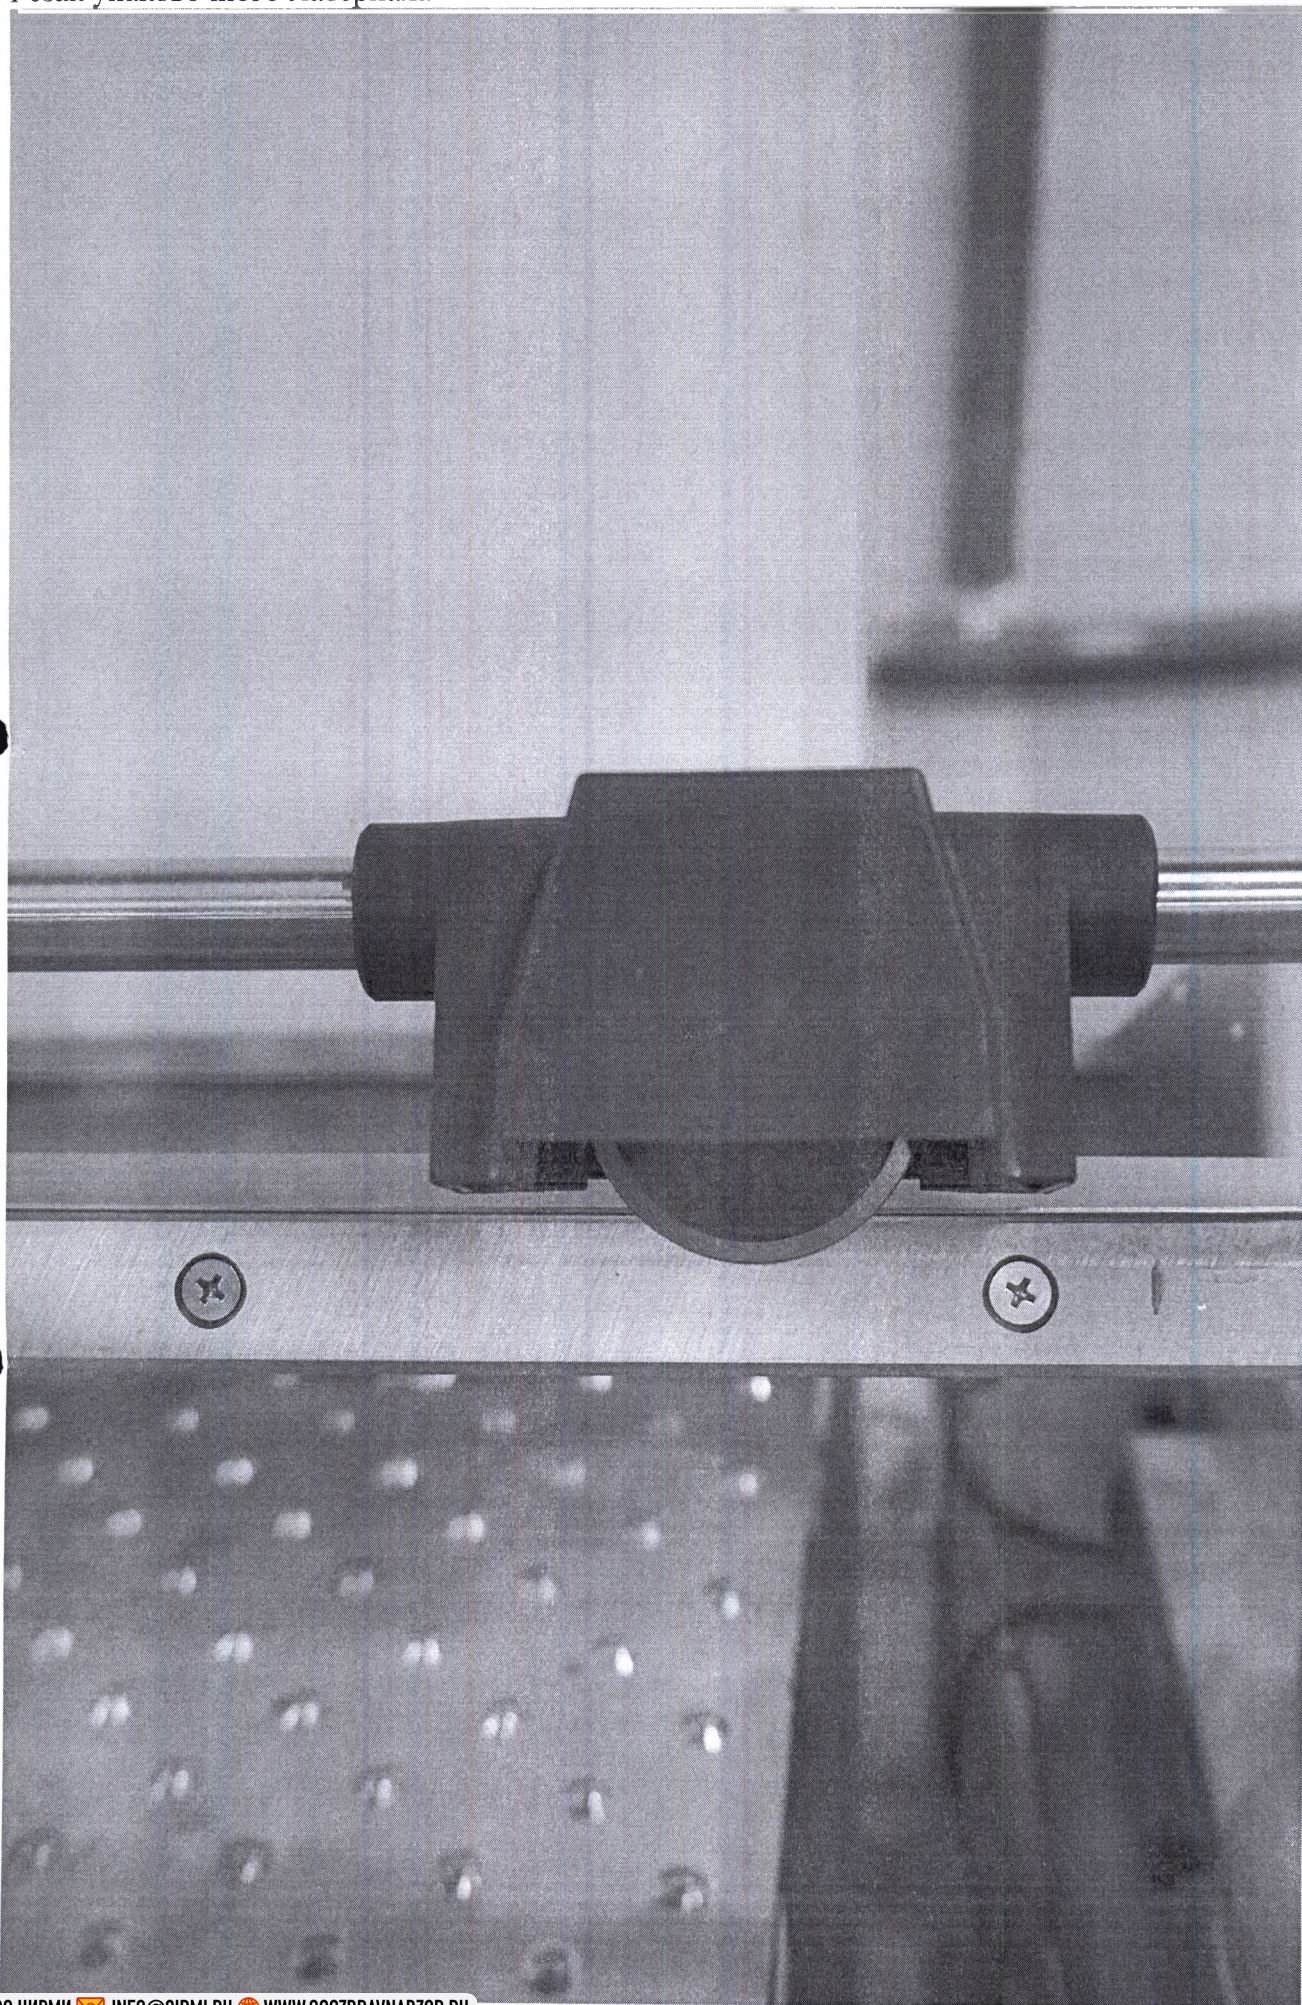



Реле нагревательного элемента

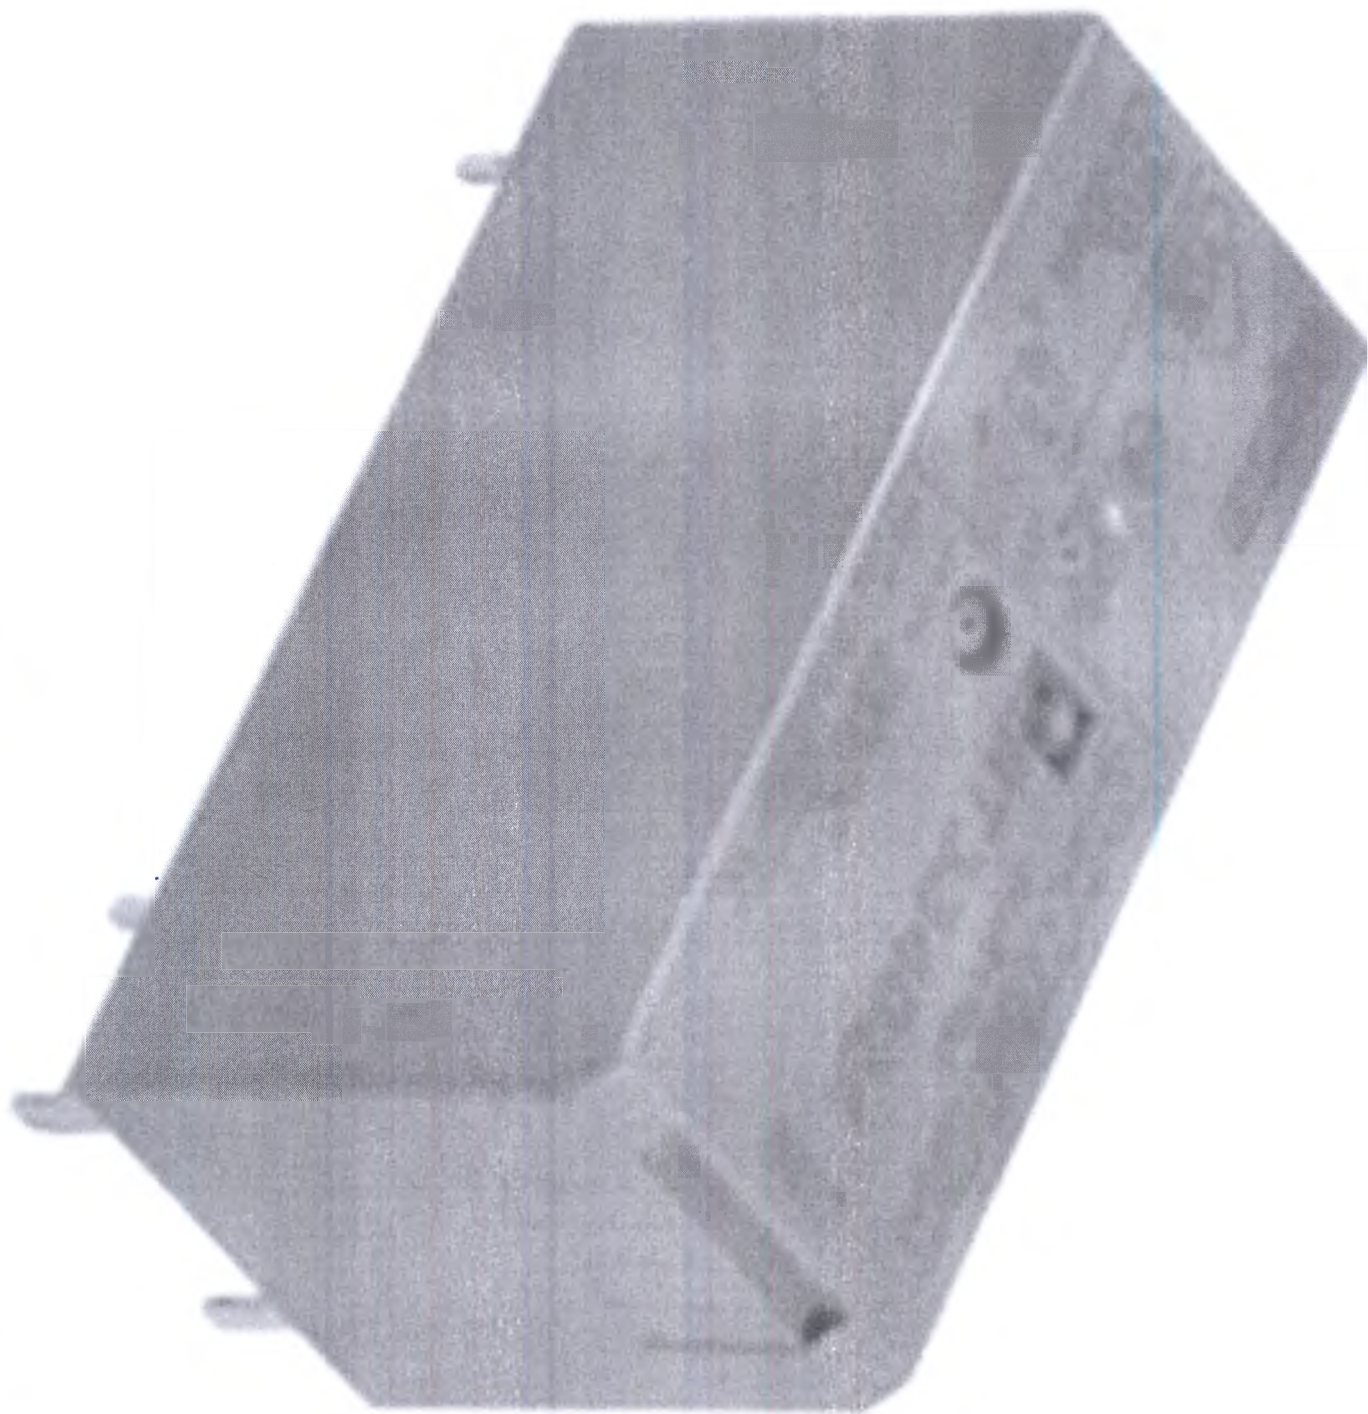



Ремень транспортировочный

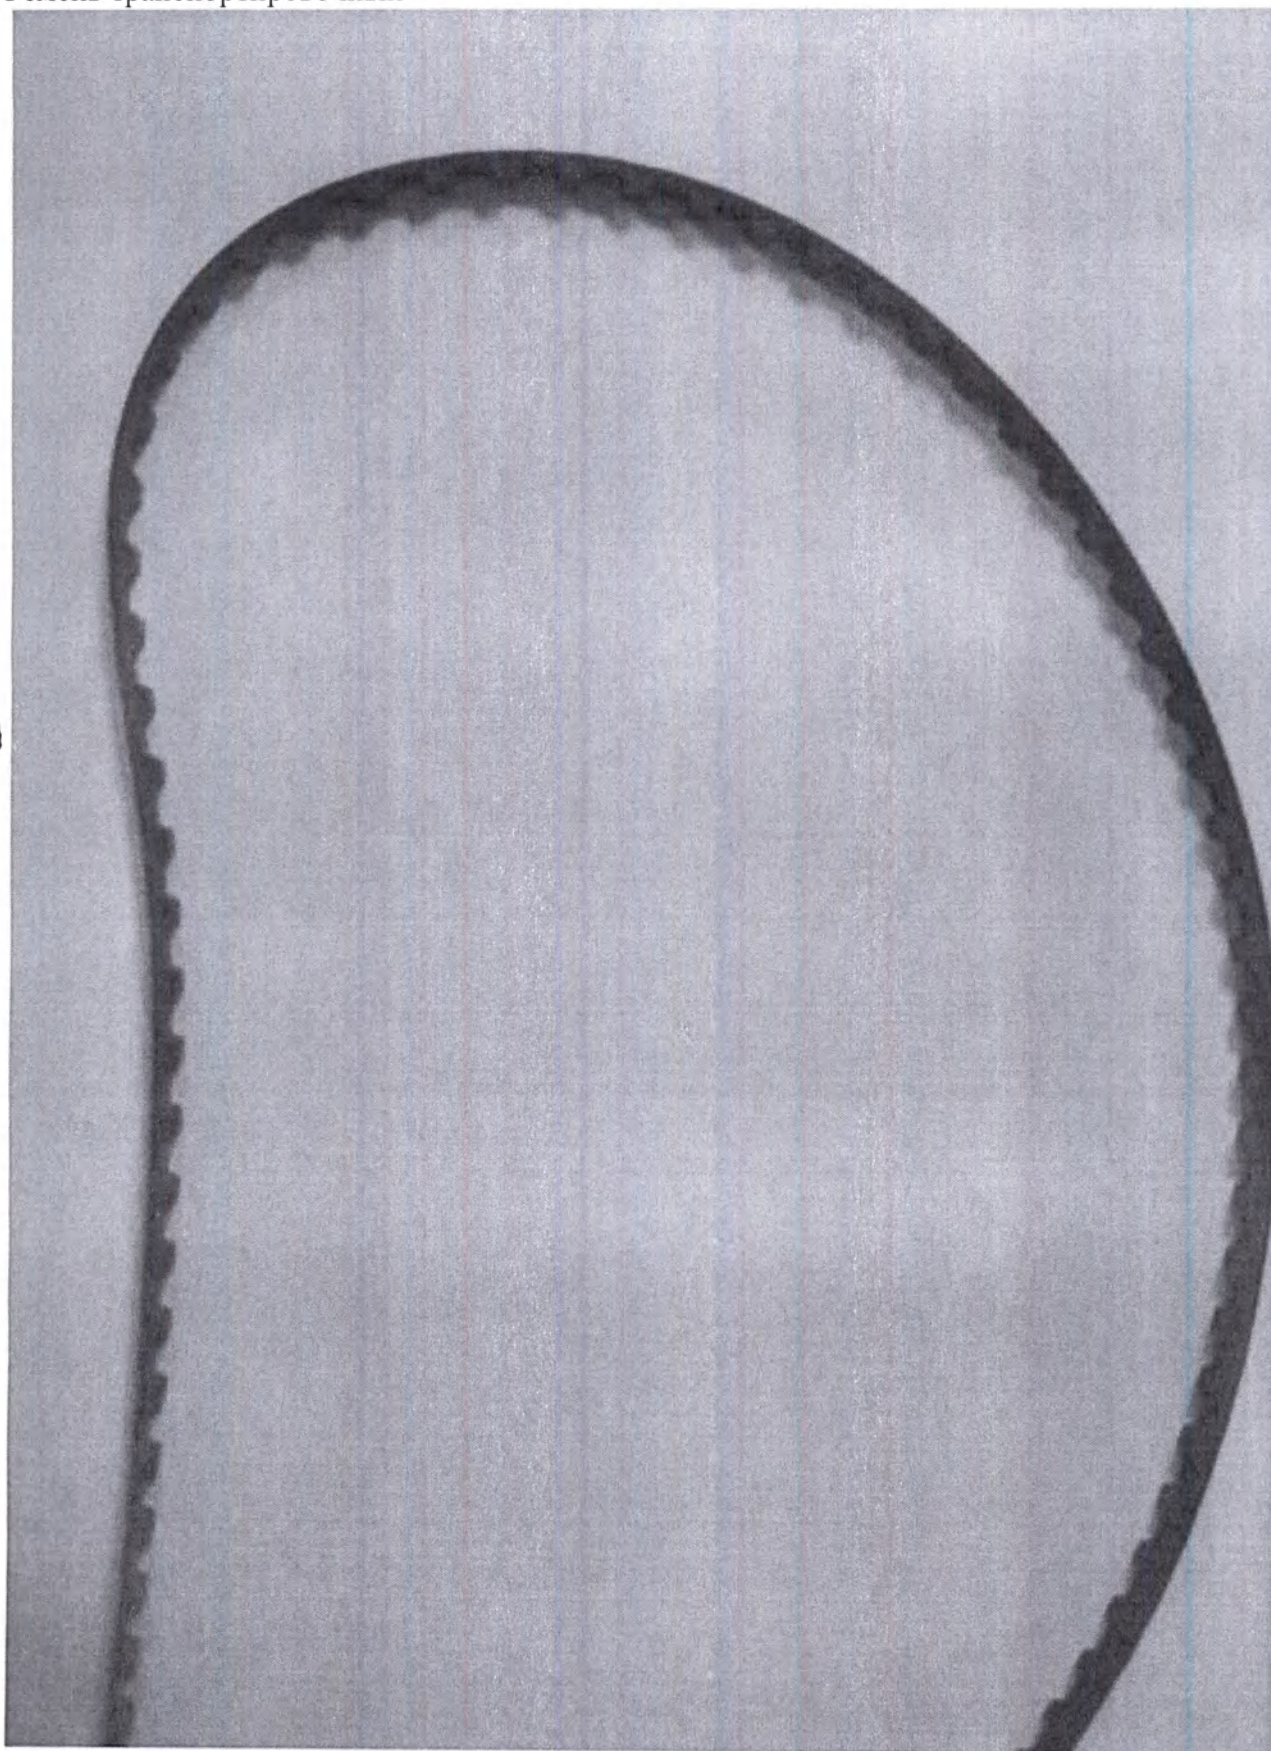

Ролик прижимной

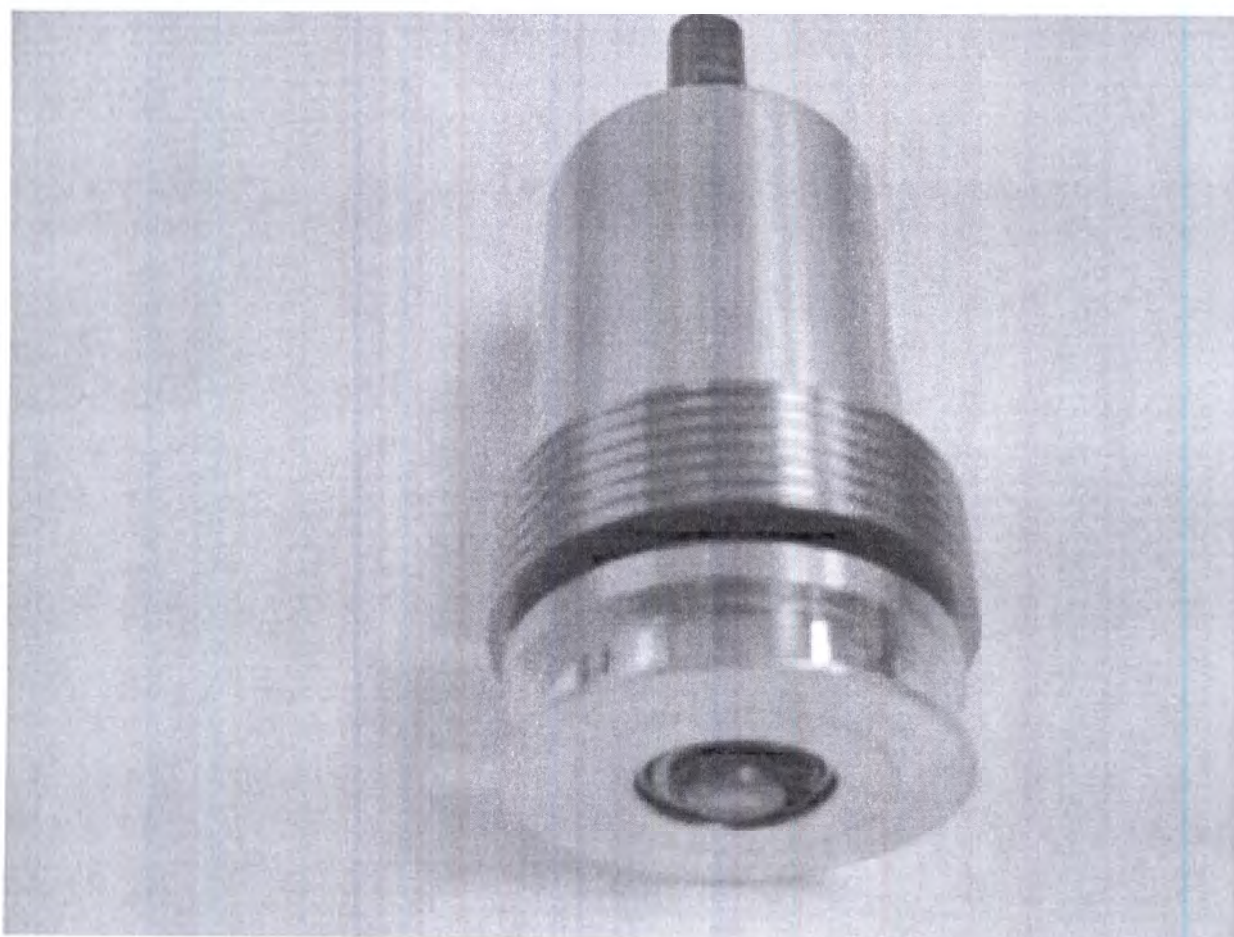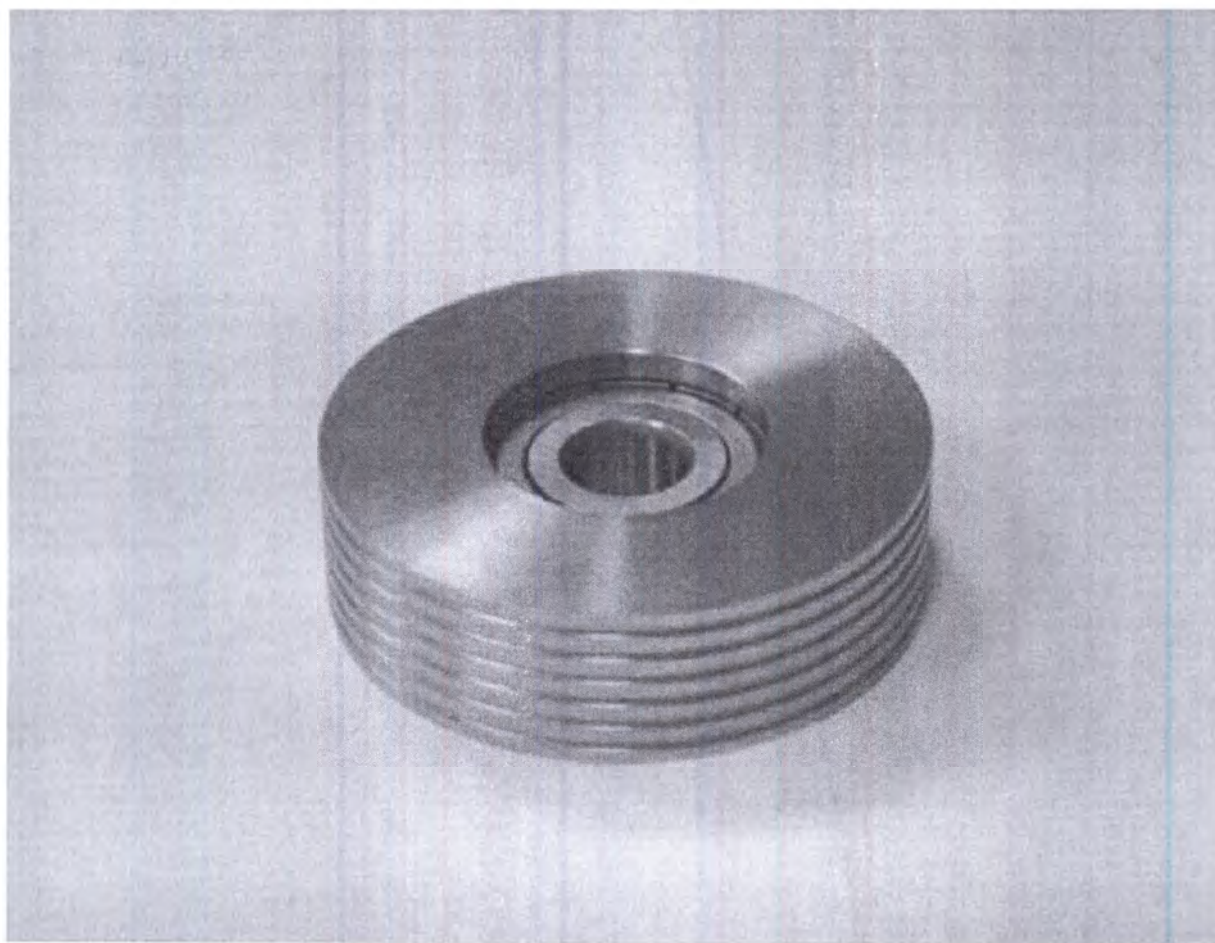


Ролик поддерживающий

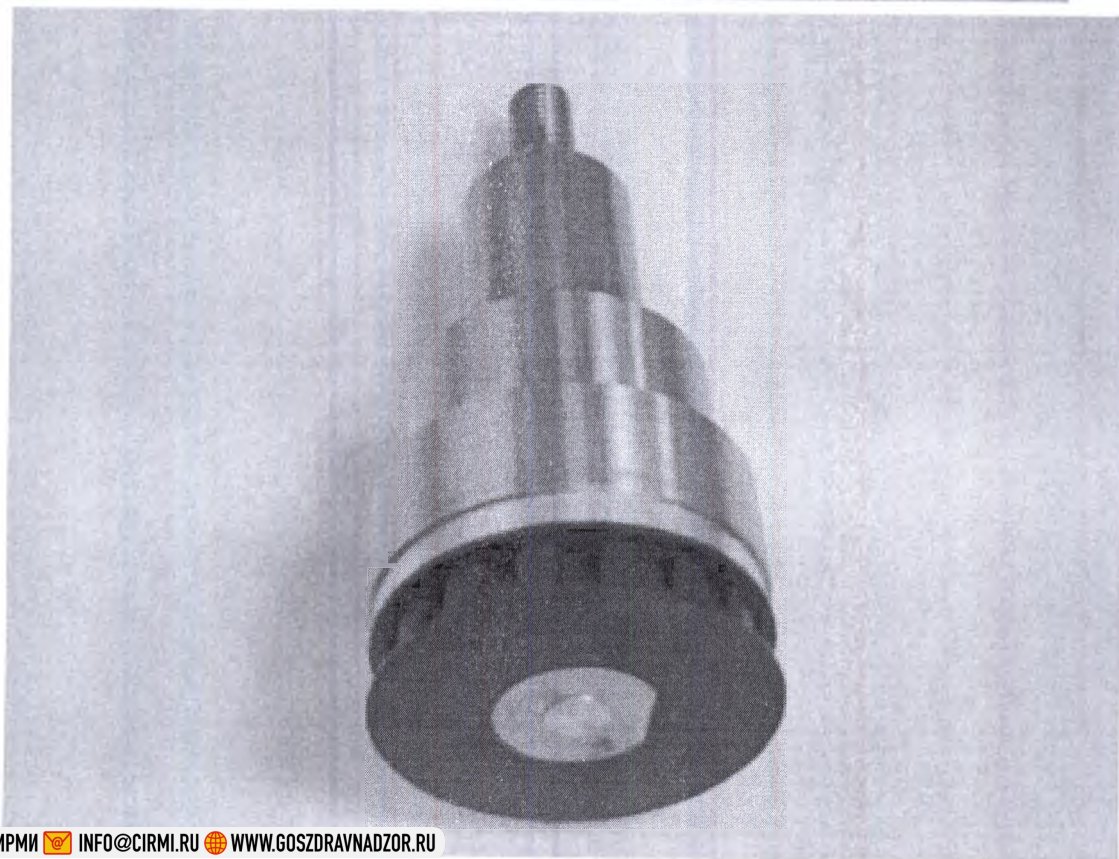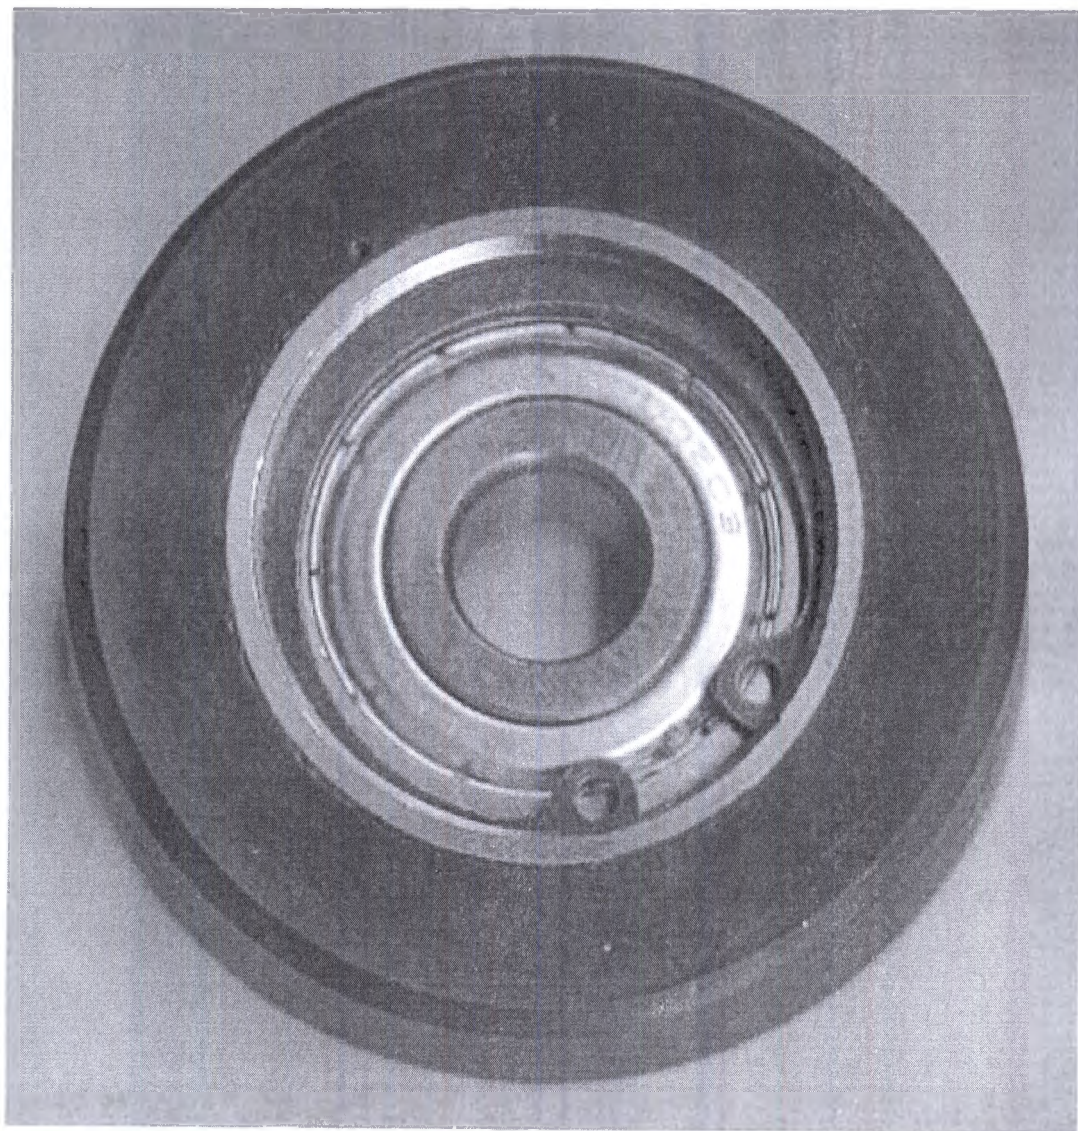


Рычаг запайки




Сканер штрих-кодов

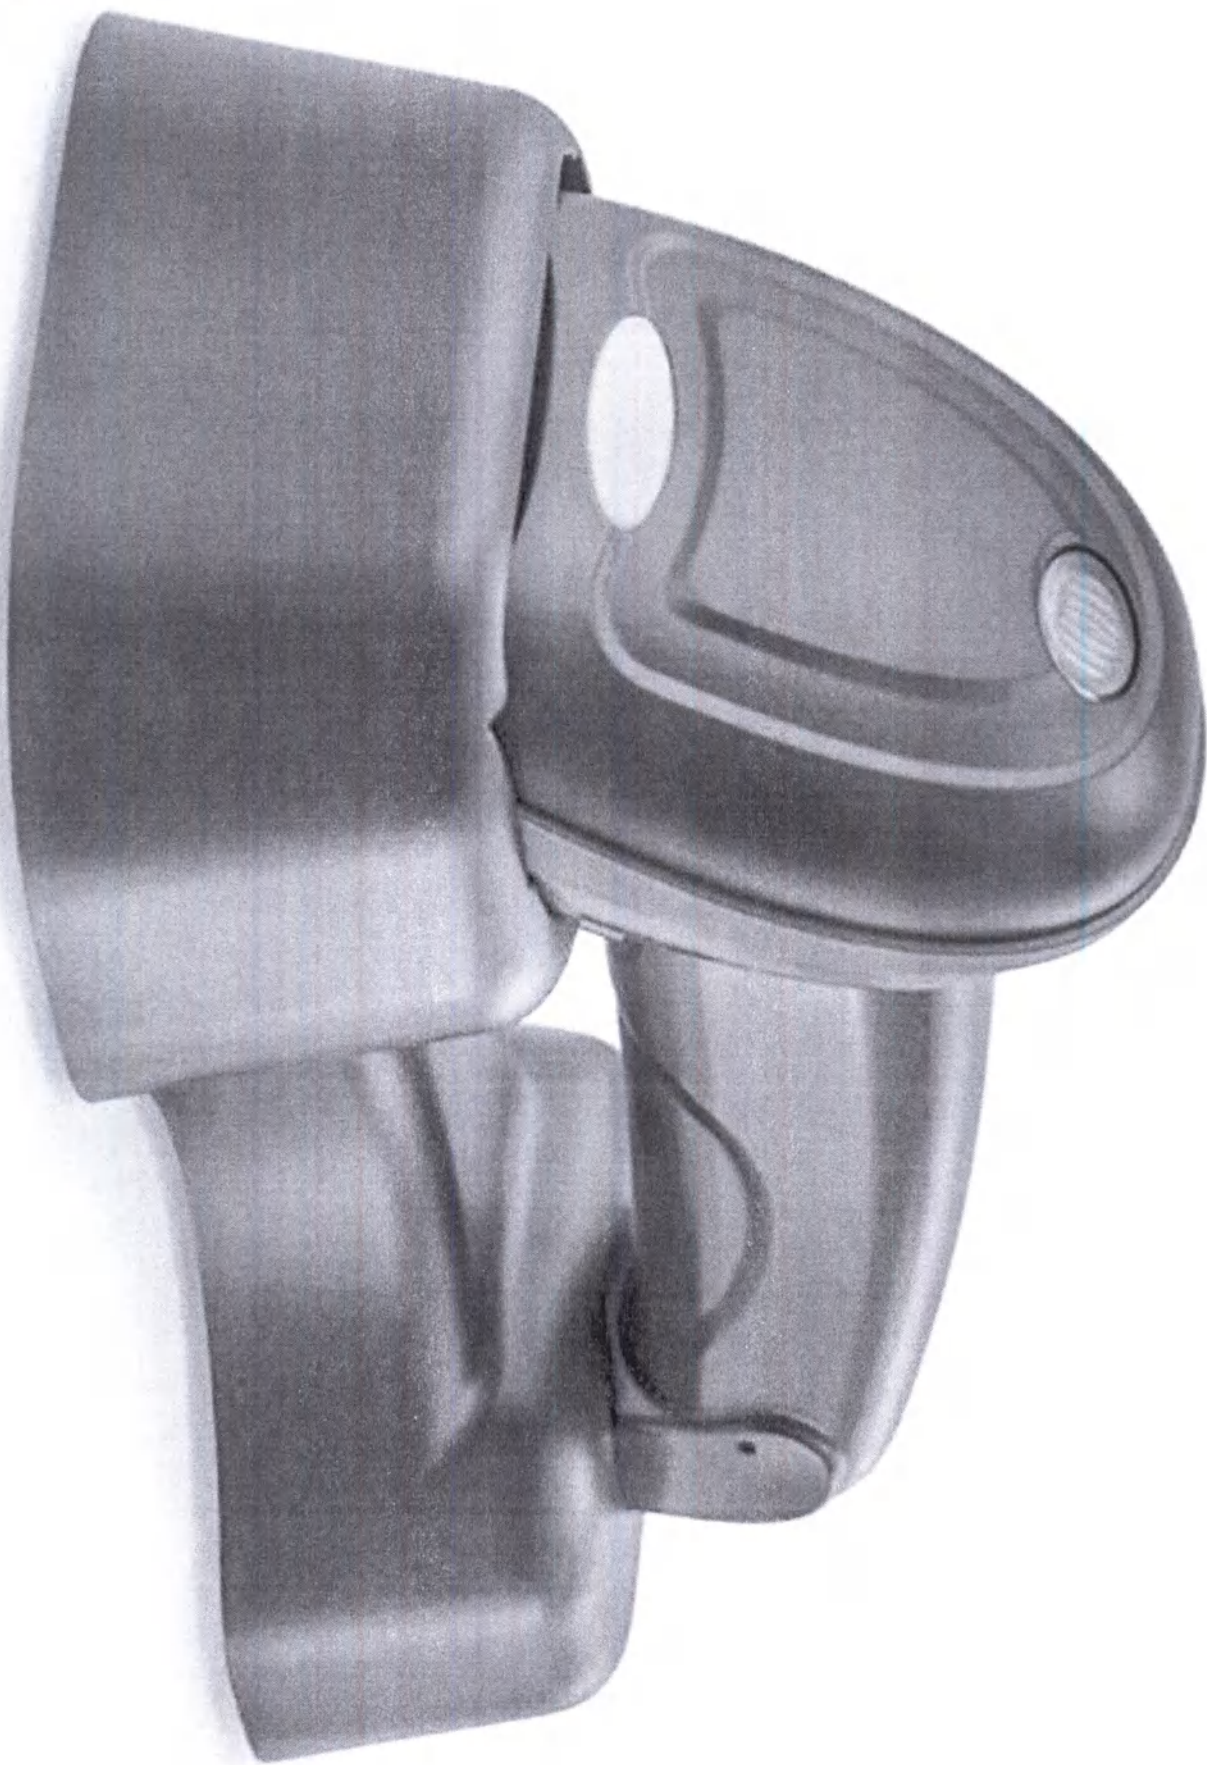


Таймер электромеханический

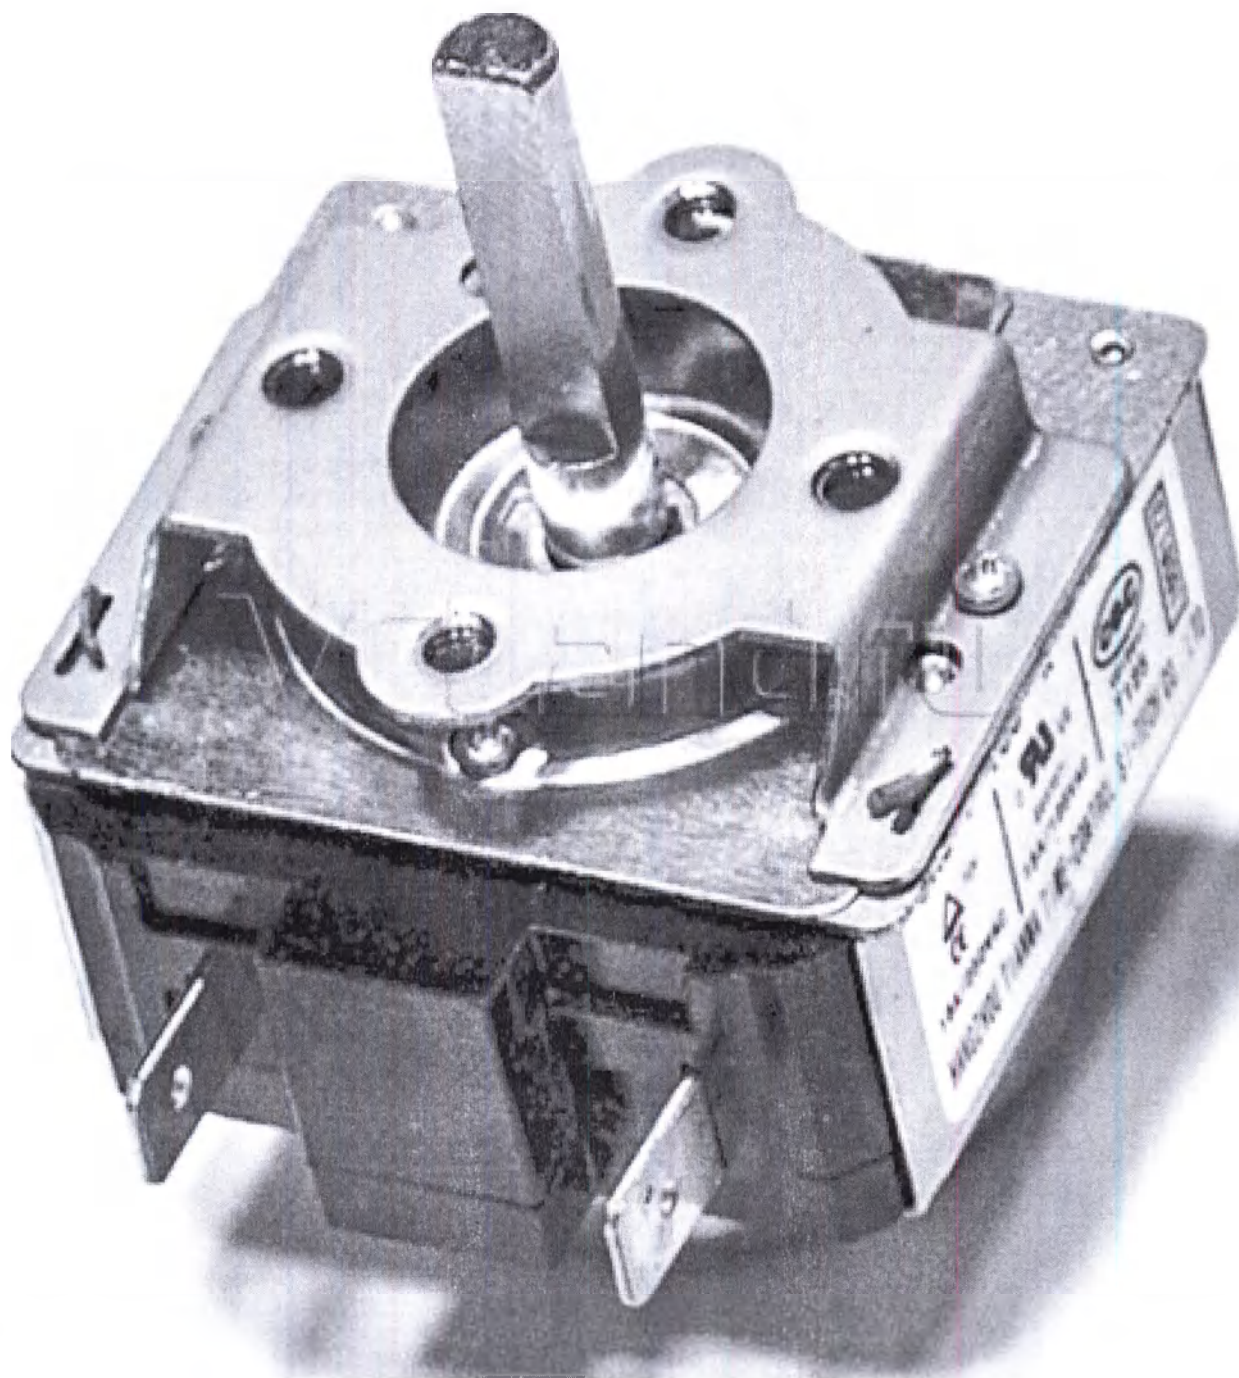


Термовыключатель

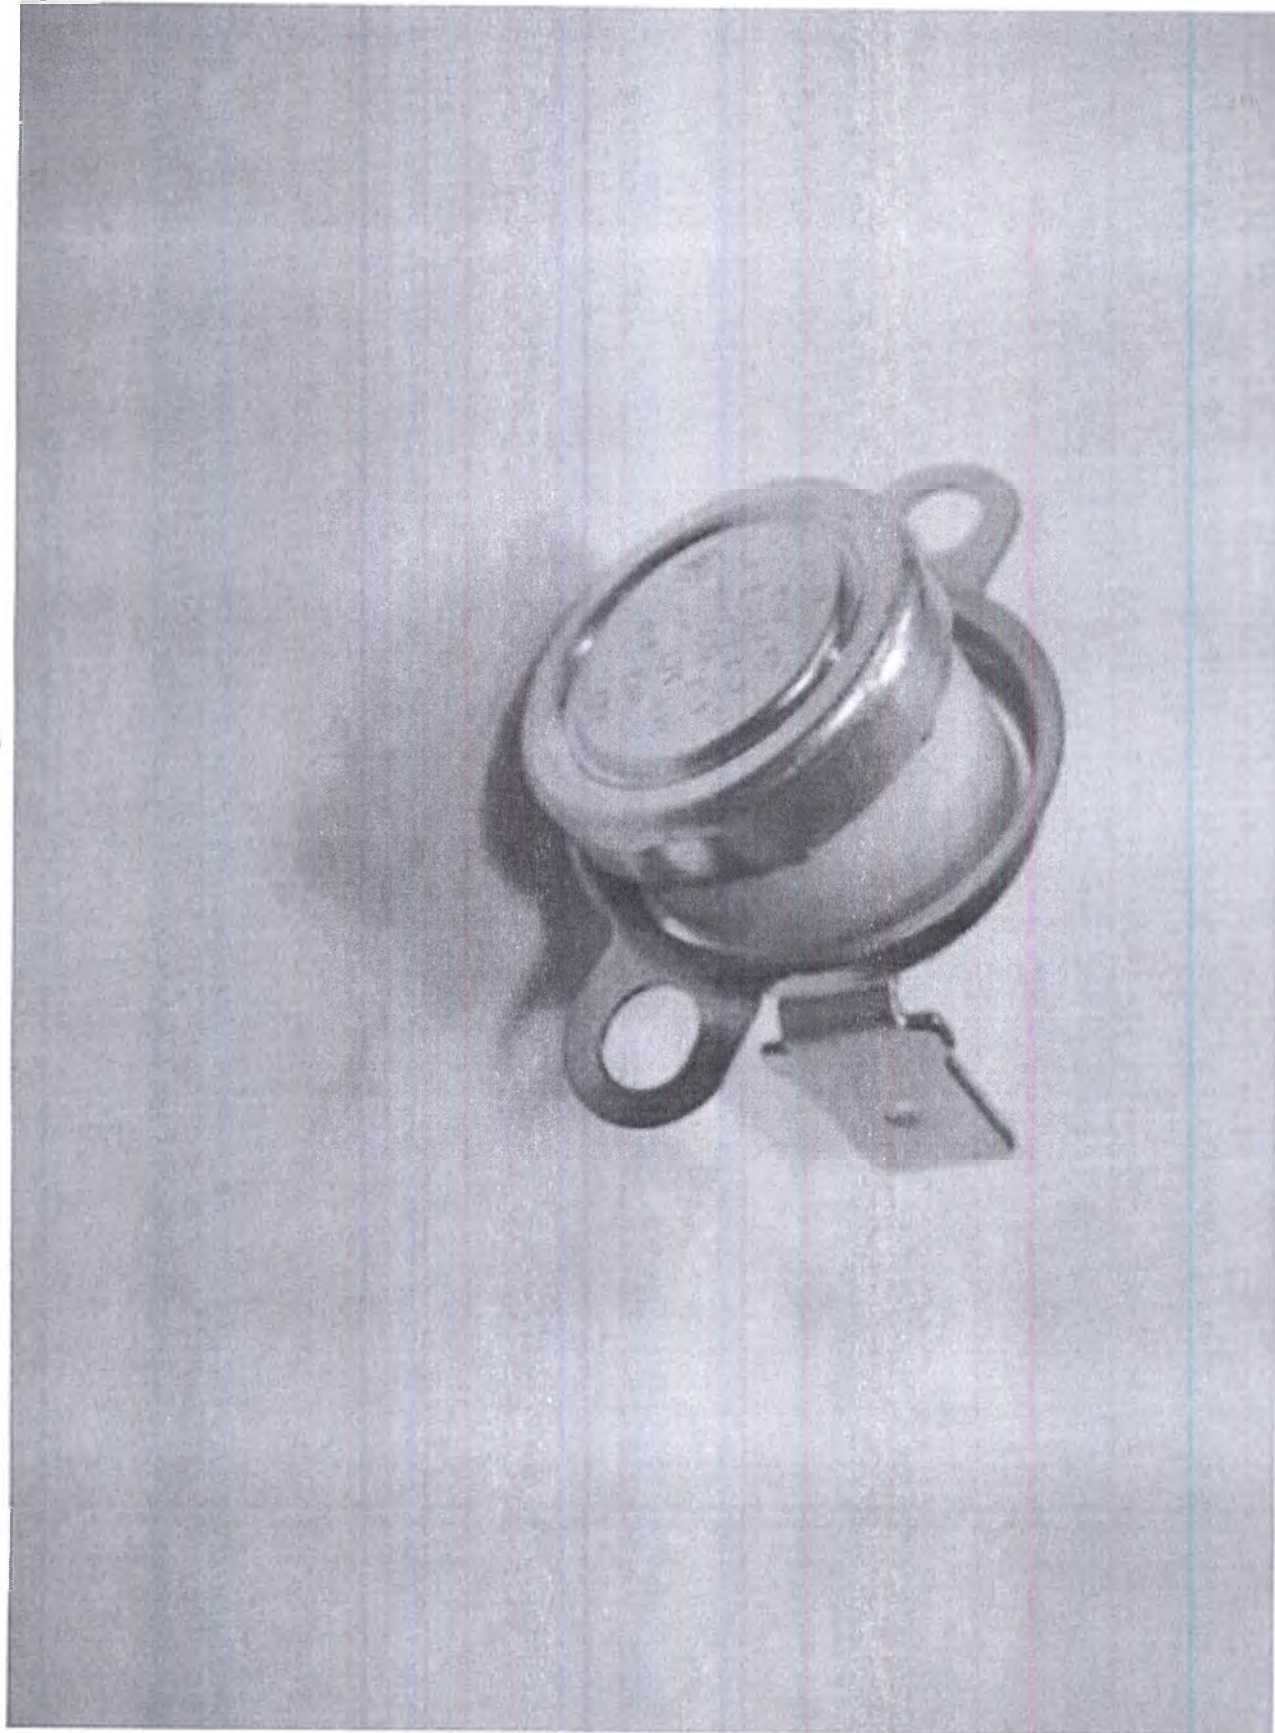


Трансформатор

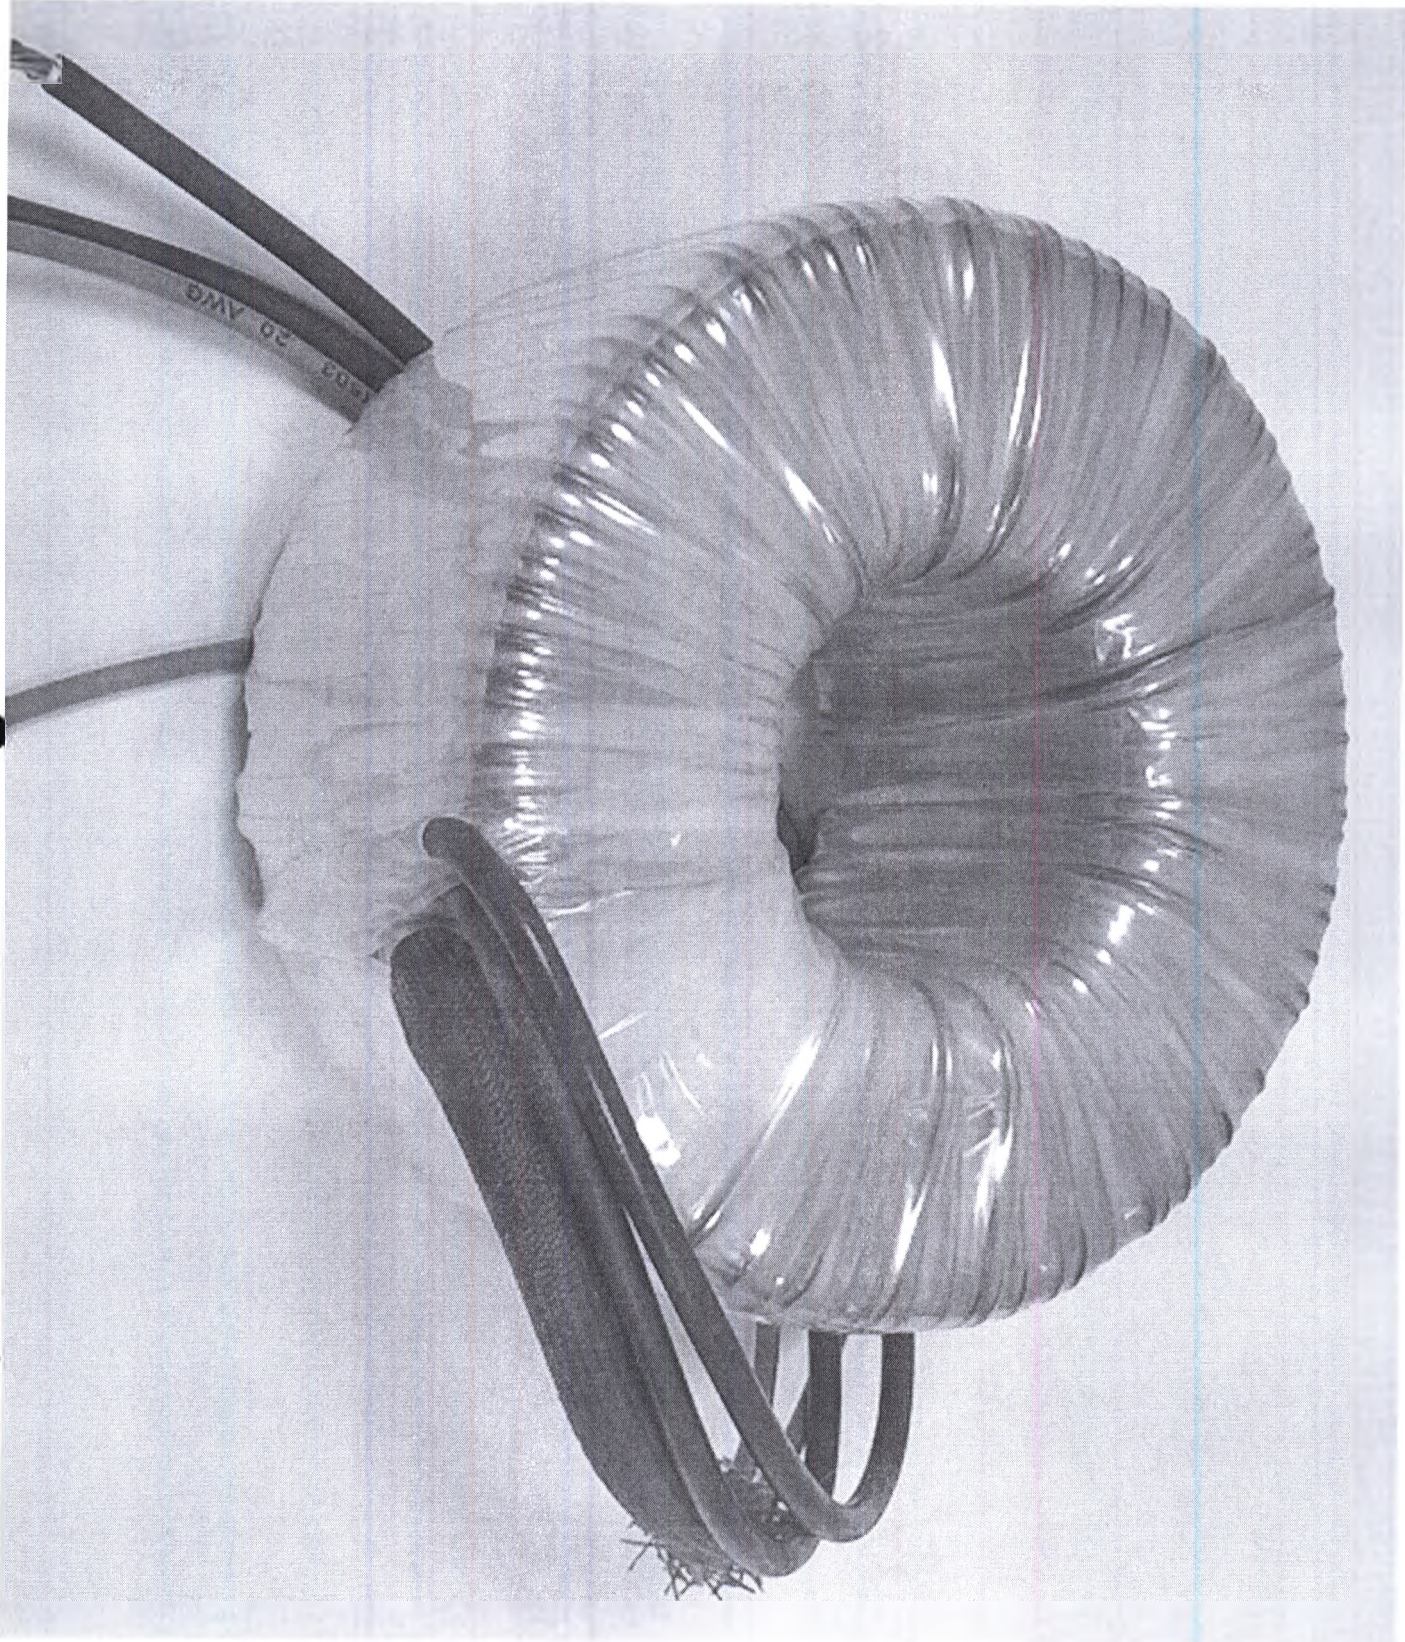

Цапфа

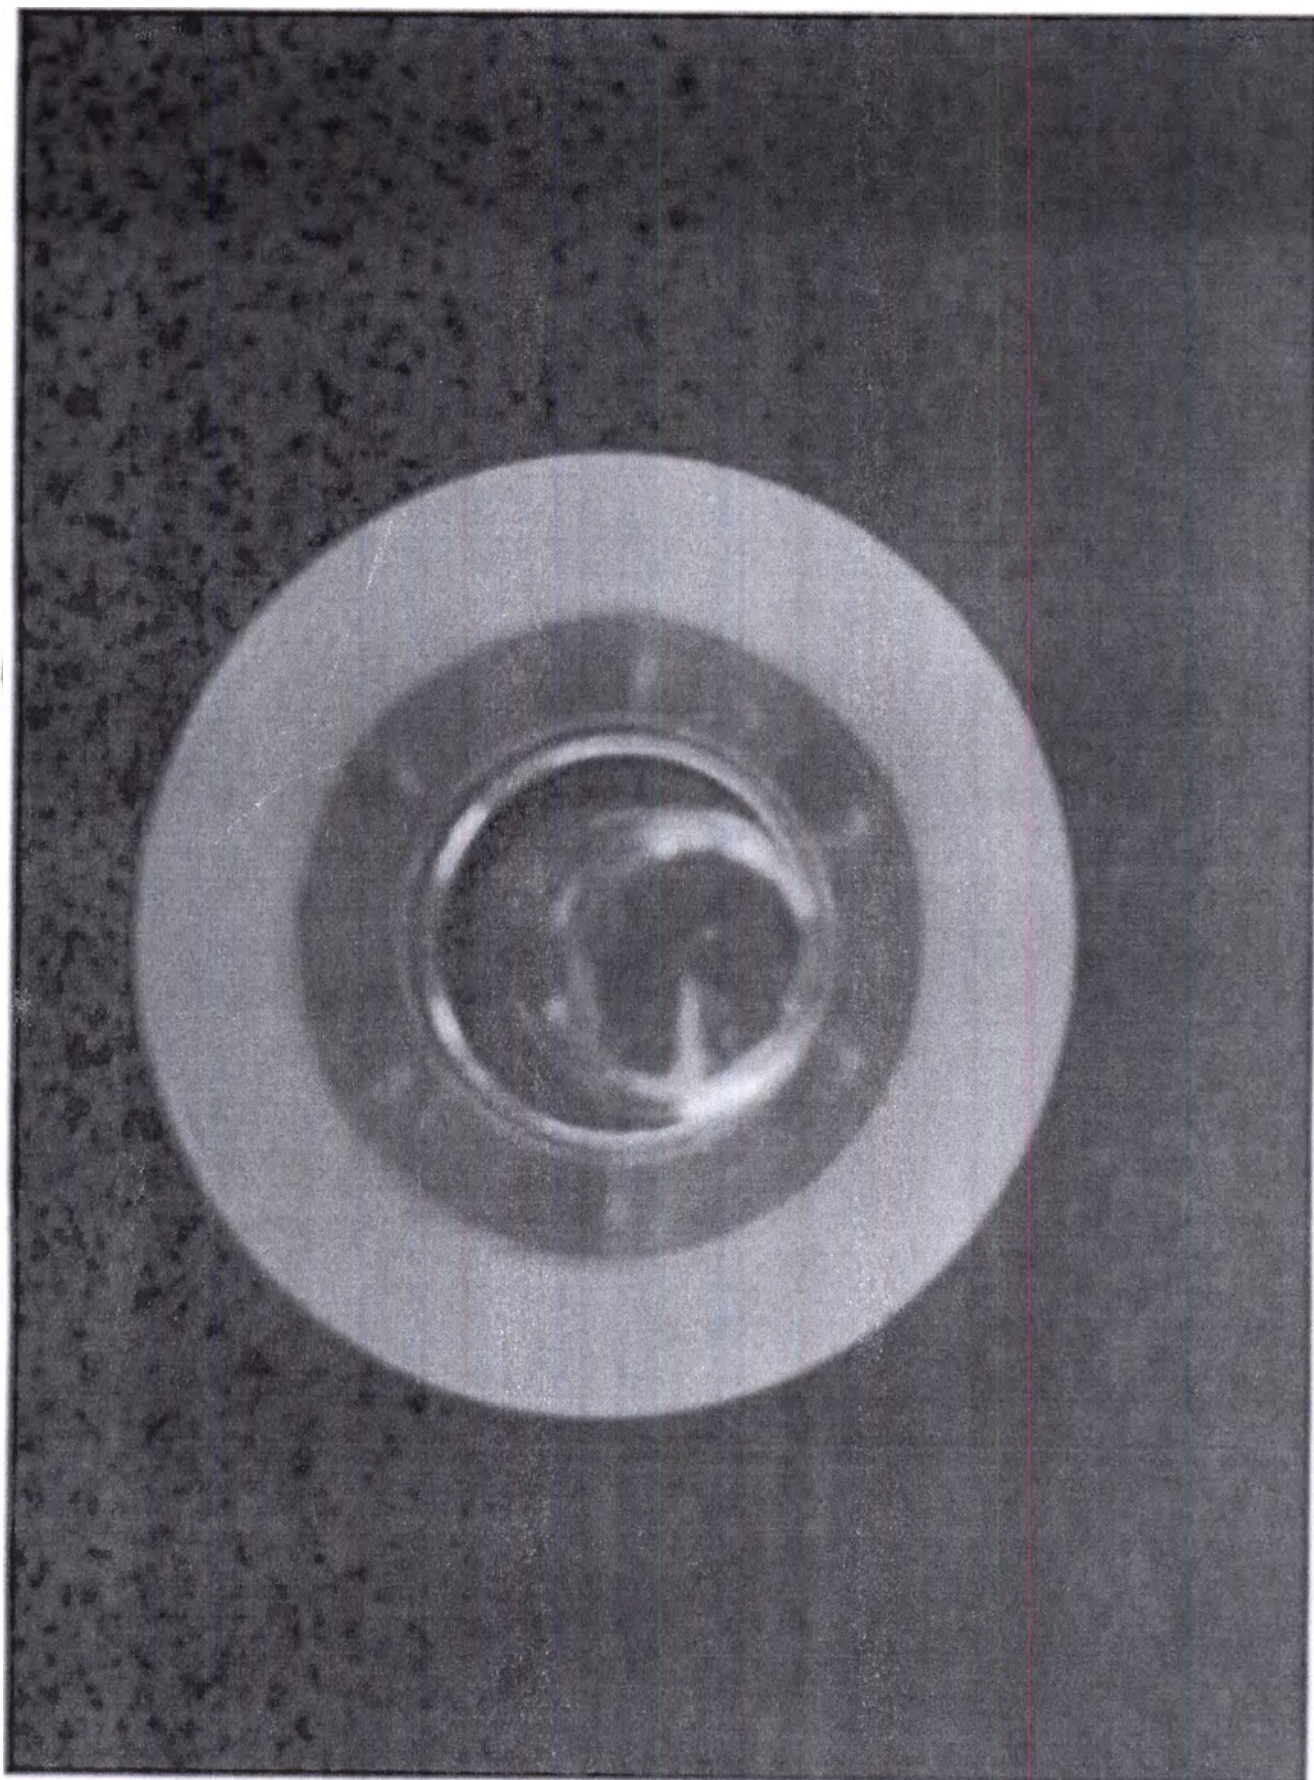

Шкив ремня

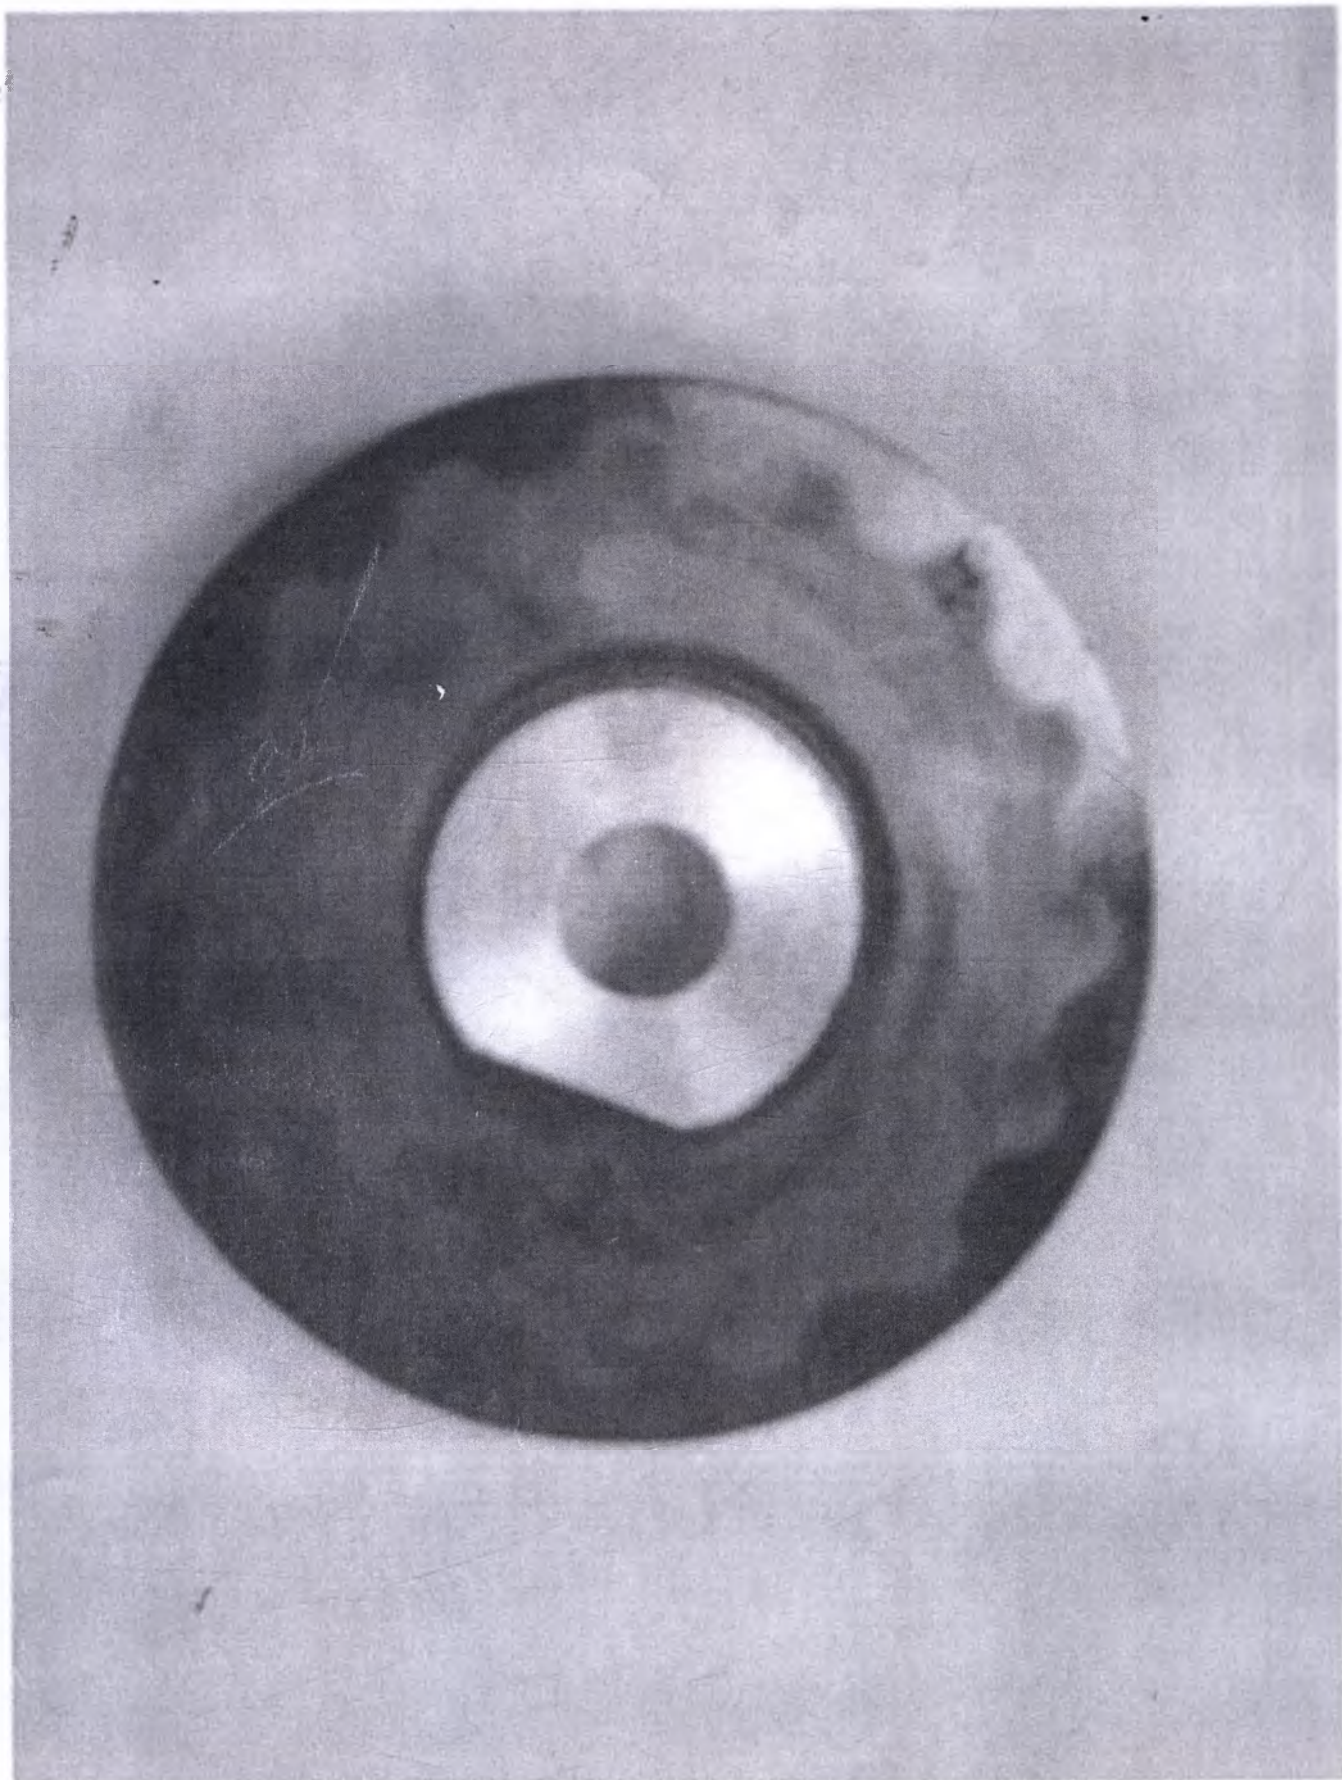

ПРОШНУРОВАНО 58 листов
Генеральный директор
ООО «Фармстандарт-Медтехника»



А.Ф. Зезуля

