

Фотографическое изображение медицинского изделия

Стерилизатор воздушный медицинский


«Ферреласт»

по ТУ 32.90.12-025-55307160-2010,

производства ООО «ФерреластНадман», Россия

Вариант 3

1

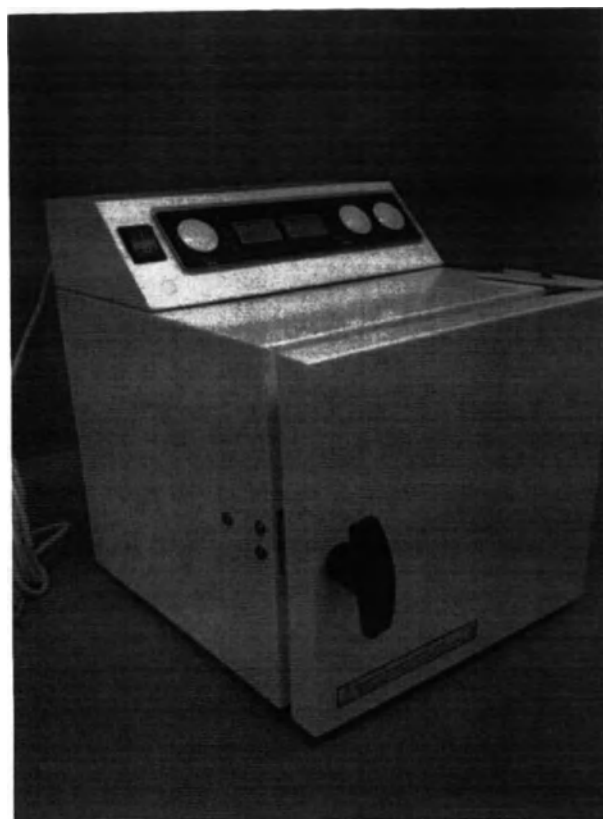

Фотография 1. Стерилизатор воздушный медицинский «Ферреласт»-5, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 5 дм³ по ТУ 32.90.12-025-55307160-2010, С/Файл 009.

2



Фотография 2. Стерилизатор воздушный медицинский «Ферреласт»-5, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 5 дм³ по ТУ 32.90.12-025-55307160-2010. Дверь открыта. (Фото внутреннее).

3



Фотография 3. Общий вид лотка (принадлежности) для стерилизатора воздушного медицинского «Ферреласт»-5, горизонтального, с прямоугольной камерой, одностороннего, объемом 5 дм³ по ТУ 32.90.12-025-55307160-2010

4



Фотография 4. Вставка плазменная 3А - 2шт., вставка плазменная 10А - 1 шт., принадлежности для стерилизатора воздушного медицинского «Ферропласт-5», горизонтального, с прямоугольной камерой, одностороннего, объемом 5 дм³ по ТУ 32.58.13-025-55387189-2018

5




Фотография 5. Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт-5», горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 5 дм³ по ТУ 32.58.13-025-55387189-2018. Маркировка.

6




Фотография 6. Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт-5», горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 20 дм³ по ТУ 32.58.13-025-56387189-2020. Общий вид.

7

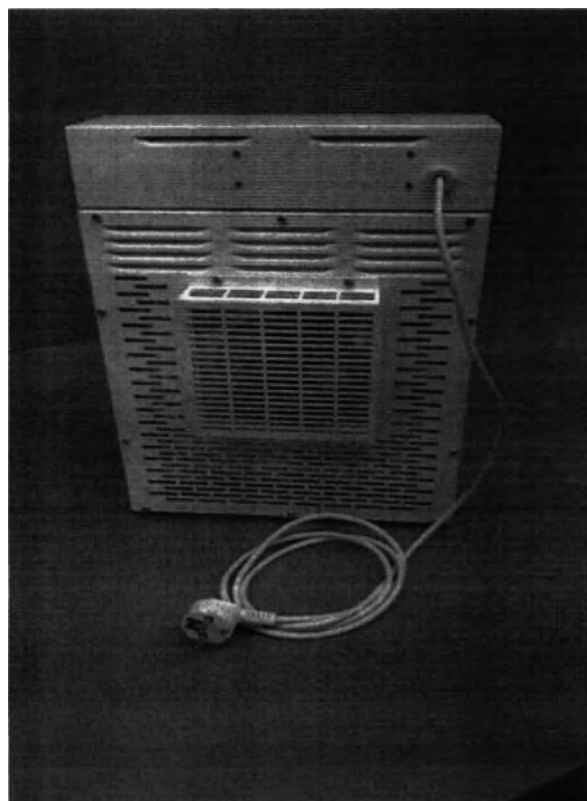


Фотография 7. Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт-5», горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 20 дм³ по ТУ 32.58.13-025-56387189-2020. Вид сзади.

8

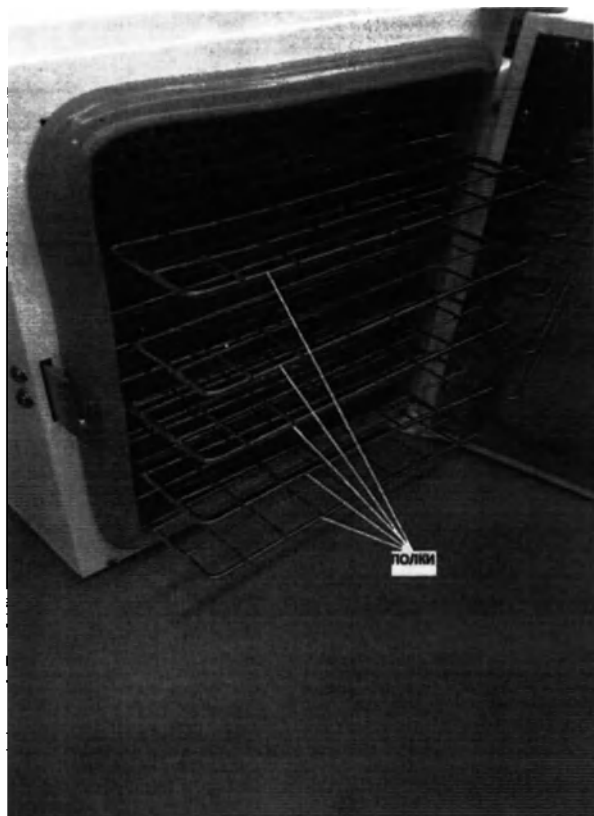


Фотография 8. Стерилизатор одноканальный медицинский «Фармацест-5», горизонтальный, с пригрузочной камерой, односторонний, объемом 20 дм³ по ТУ 32.99.13-025-86307562-2018. Дверь открыта.

9

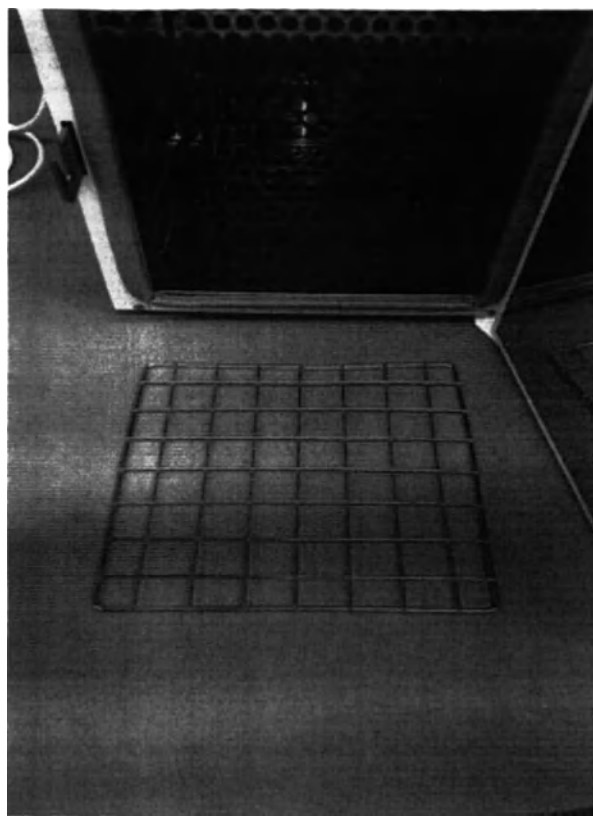

Фотография 9. Поднос (принадлежность) для стерилизатора одноканального медицинского «Фармацест-5», горизонтальный, с пригрузочной камерой, одностороннего, объемом 20 дм³ по ТУ 32.99.13-025-86307562-2018

10

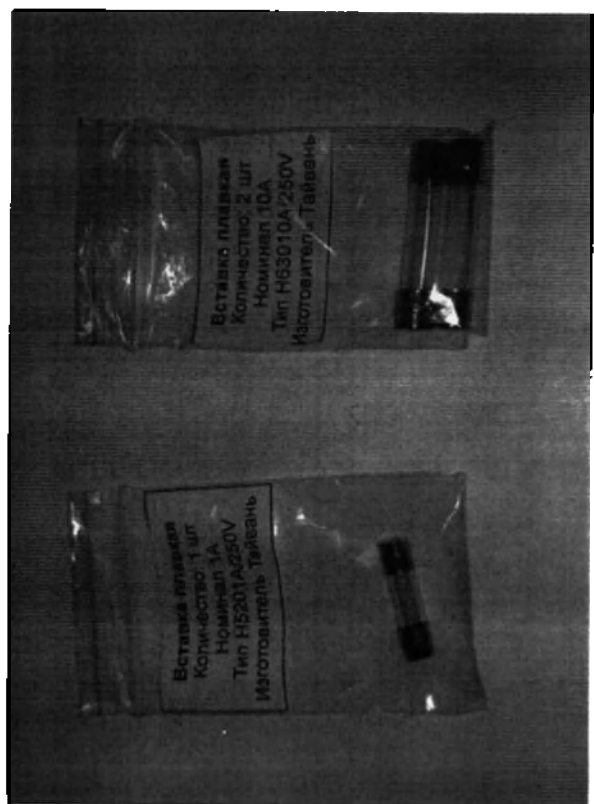


Фотография 10. Вставка плавкая 2А - 2шт, вставка плавкая 10А - 2 шт., принадлежности для стерилизатора одноканального медицинского «Фармацест-5», горизонтального, с пригрузочной камерой, одностороннего, объемом 20 дм³ по ТУ 32.99.13-025-86307562-2018

11




Фотография 11. Стерилизатор одноканальный медицинский «Фармацест-5», горизонтальный, с пригрузочной камерой, односторонний, объемом 20 дм³ по ТУ 32.99.13-025-86307562-2018. Маркировка. (Число серийного).

12

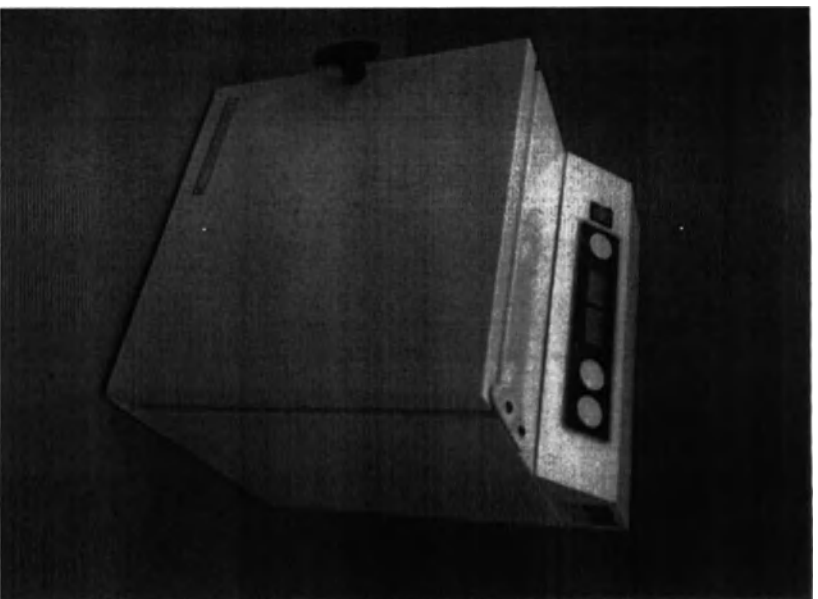


Фотография 12. Стерилизатор воздушный медицинский «Феронласт-20, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 20 дм³ по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018. Общий вид.

13

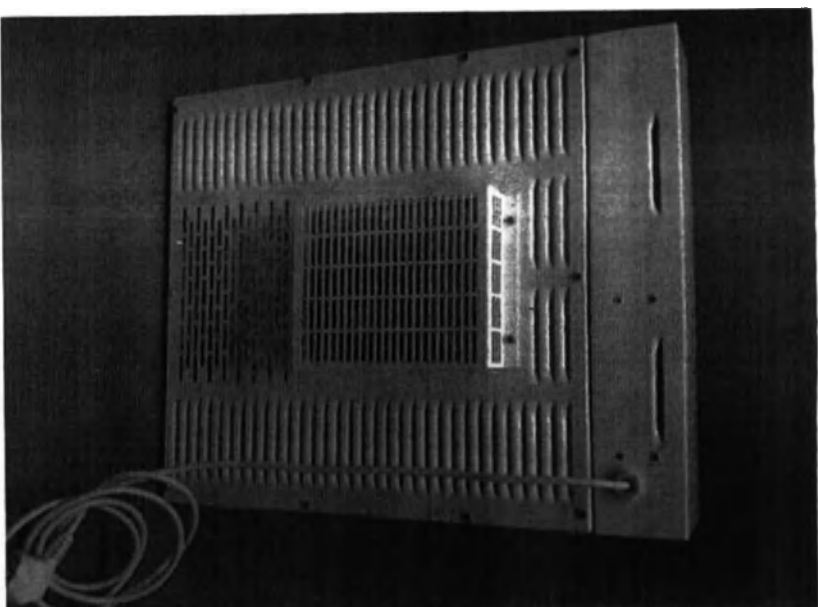


Фотография 13. Стерилизатор воздушный медицинский «Феронласт-20, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 20 дм³ по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018. Вид сзади.

14

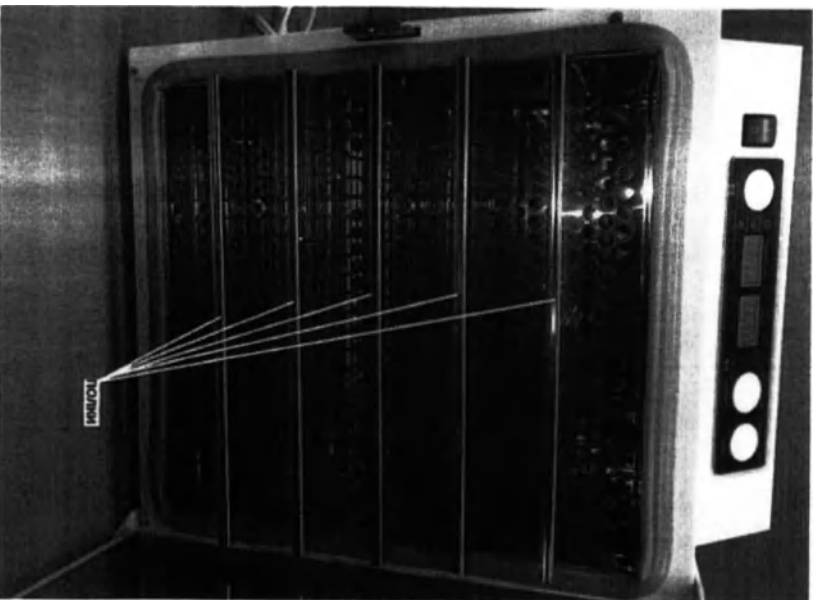


Фотография 14. Стерилизатор воздушный медицинский «Феронласт-20, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 20 дм³ по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018. Дверь открыта.

15

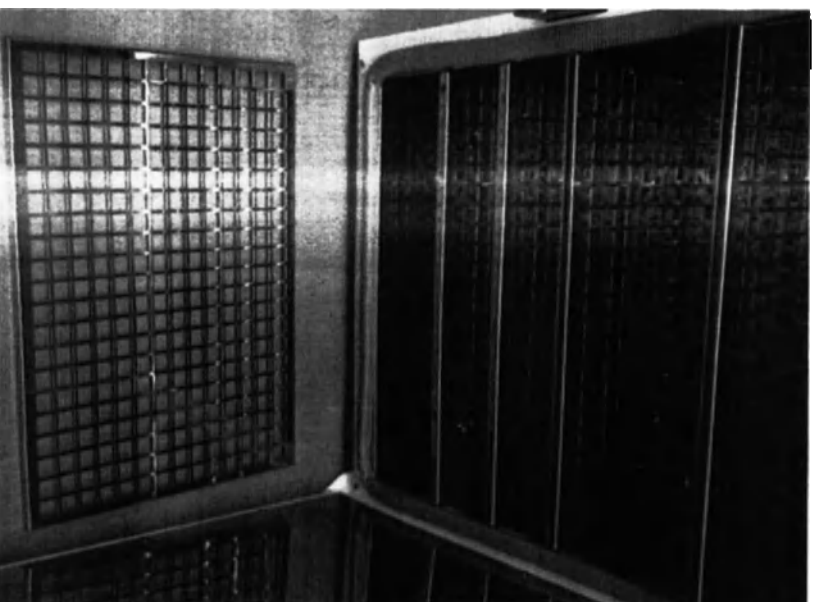

Фотография 15. Помещение (комната) для стерилизации воздушного медицинского «Феронласт-20, горизонтального, с прямоугольной камерой, одностороннего, объемом 20 дм³ по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018

16

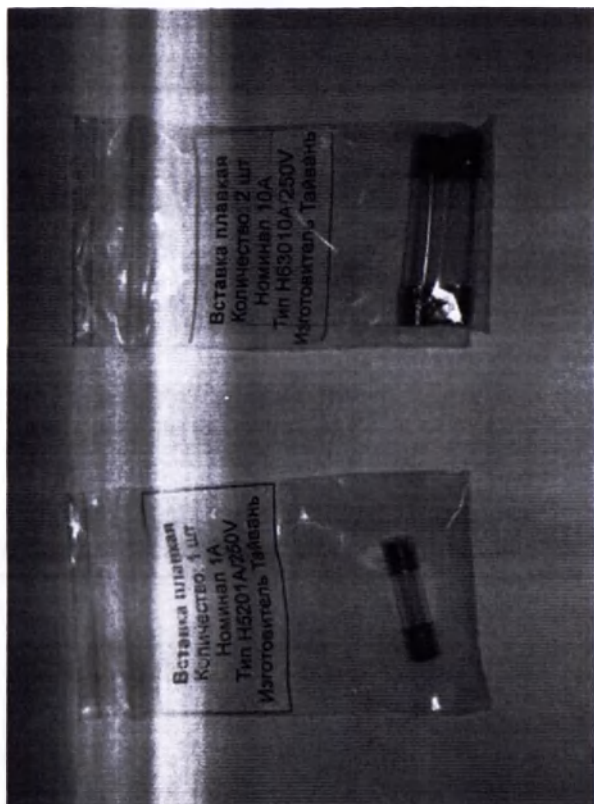


Фотография 16. Вставка плавкая 1А - 1шт, вставка плавкая 10А - 2 шт, принадлежности для стерилизатора воздушного медицинского «Ферропласт»-20, горизонтального, с прямоугольной камерой, одностороннего, объемом 20 дм³ по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018. (Фото повернуто).

17




Фотография 17. Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»-20, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 20 дм³ по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018. Маркировка. (Фото повернуто).

18

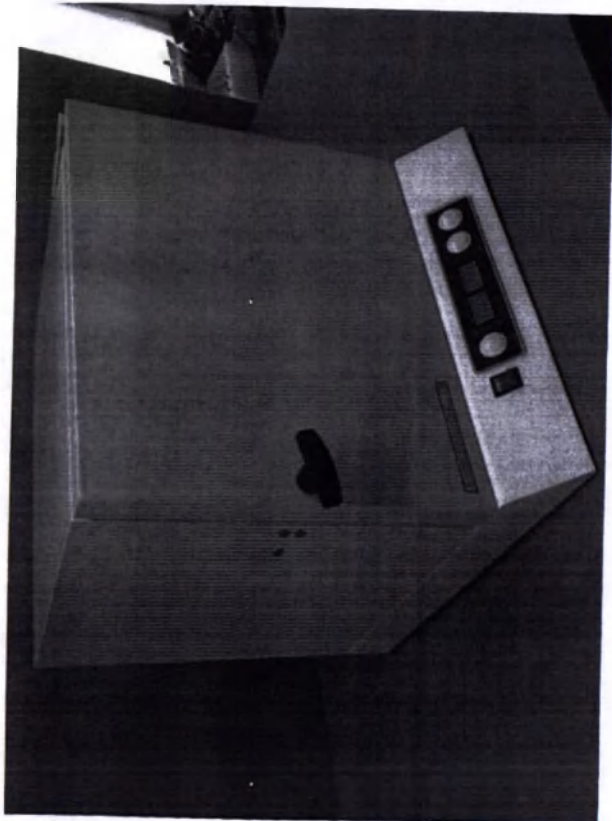


Фотография 18. Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»-40, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 40 дм³, модель «Ферропласт»-40-1 по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018. Общий вид. (Фото повернуто).

19

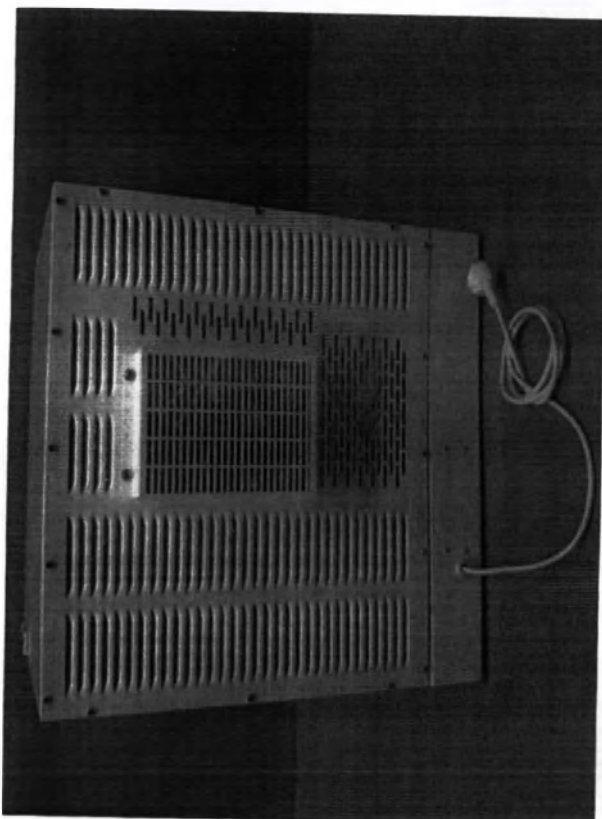


Фотография 19. Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»-40, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 40 дм³, модель «Ферропласт»-40-1 по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018. Вид сзади. (Фото повернуто).

20

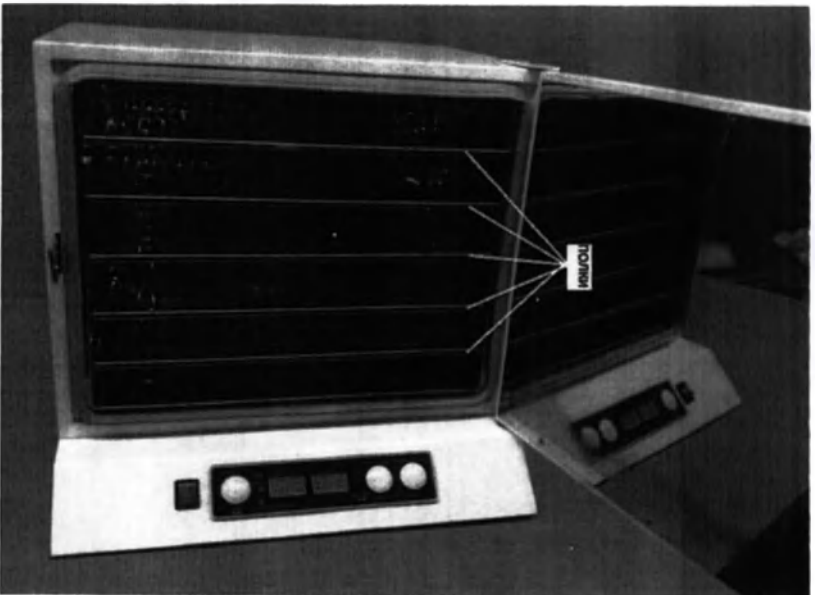


Фотография 20. Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»-40, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 40 дм³, модель «Ферропласт»-40-1 по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018. Дверь открыта. (фото повернуто).

21

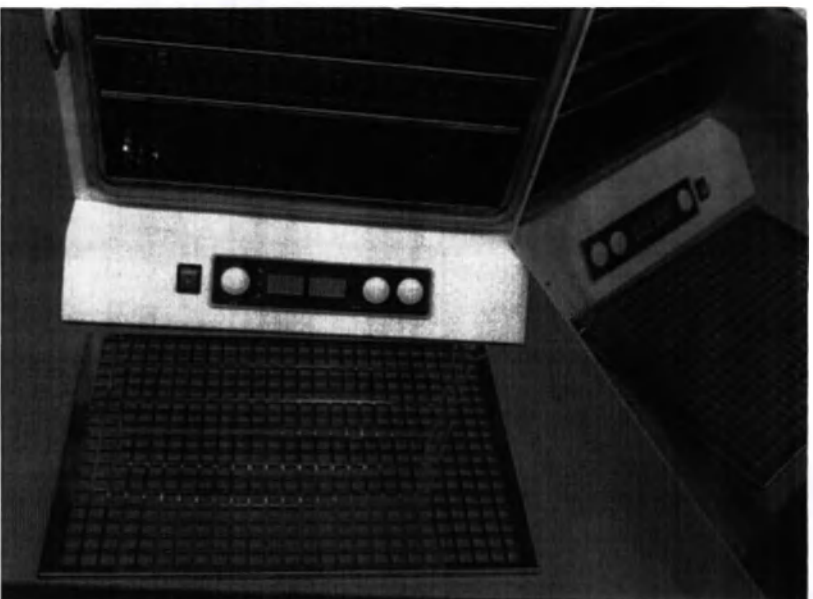


Фотография 21. Показ (применяемость) для стерилизатора воздушного медицинского «Ферропласт»-40, горизонтального, с прямоугольной камерой, одностороннего, объемом 40 дм³, модель «Ферропласт»-40-1 по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018. (фото повернуто).

22

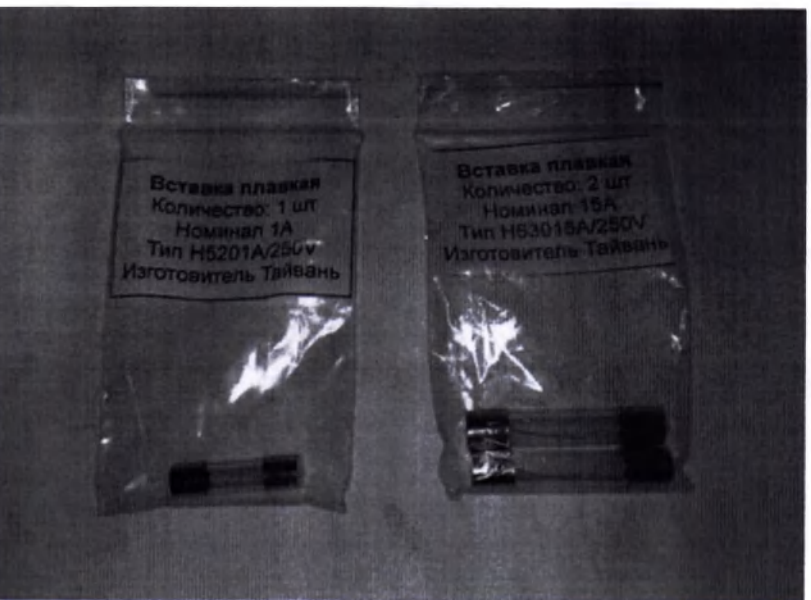


Фотография 22. Вставка плавкая 1А - 1шт., вставка плавкая 15А - 2 шт. принадлежность для стерилизатора воздушного медицинского «Ферропласт»-40, горизонтального, с прямоугольной камерой, одностороннего, объемом 40 дм³, модель «Ферропласт»-40-1 по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018. (фото повернуто).

23

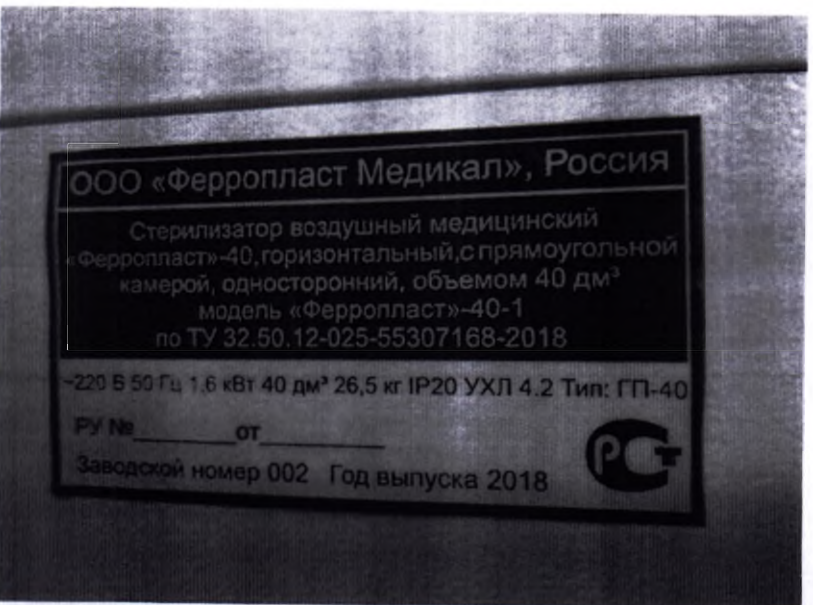


Фотография 23. Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»-40, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 40 дм³, модель «Ферропласт»-40-1 по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018. Пример маркировки. (фото повернуто).

24

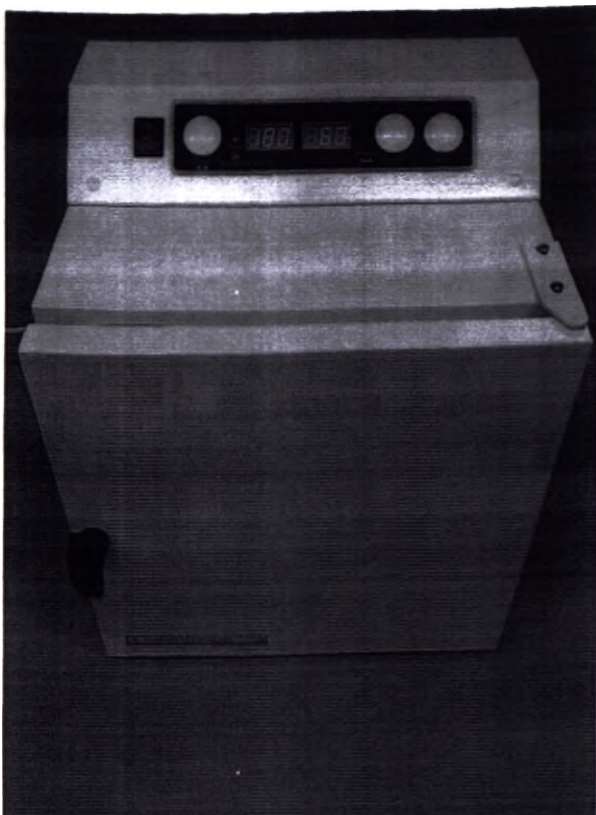


Фотография 24. Стерилизатор воздушный мембранный «Ферралест-40», горизонтальный, с приточной щелью, односторонний, объемом 40 дм³, модель «Ферралест-40-2 по ТУ 32.50.12-025-55307166-2018. (Фото предоставлено)

25

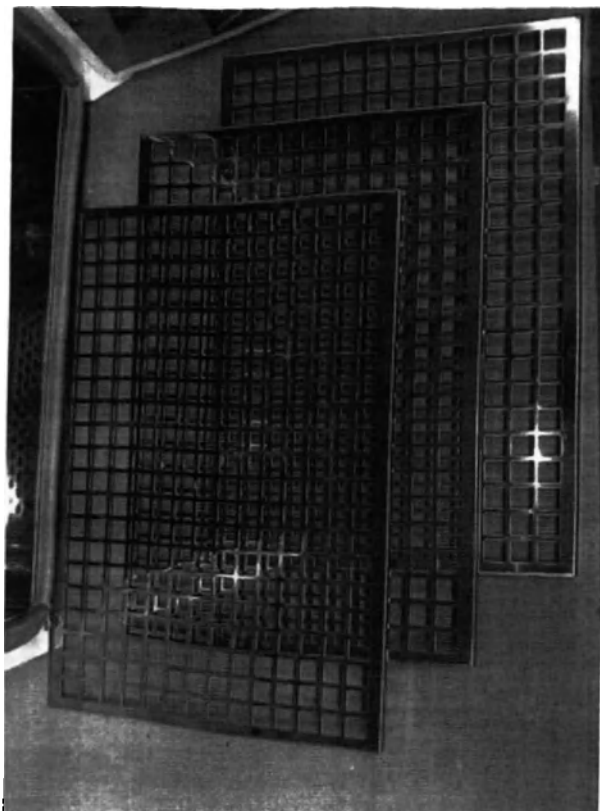

Фотография 25. Фильтры для стерилизатора воздушного мембранного «Ферралест-40», одностороннего, с приточной щелью, одностороннего, объемом 40 дм³, модель «Ферралест-40-2 по ТУ 32.50.12-025-55307166-2018. (Фото предоставлено)

26

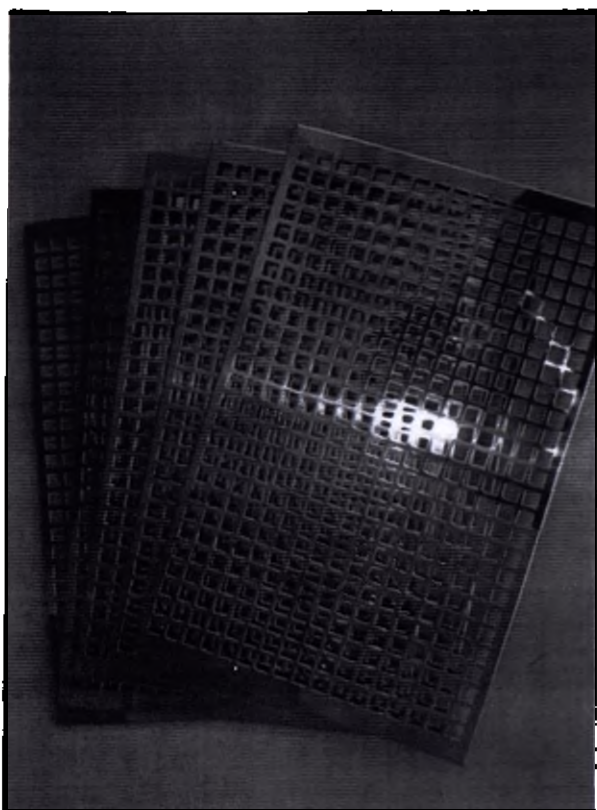


Фотография 26. Фильтры (мембранные) для стерилизатора воздушного мембранного «Ферралест-40», горизонтального, с приточной щелью, одностороннего, объемом 40 дм³, модель «Ферралест-40-2 по ТУ 32.50.12-025-55307166-2018. (Фото предоставлено)

27



Фотография 27. Вставка плавкая 1А - 2шт, вставка плавкая 15А - 2 шт, принадлежности для стерилизатора воздушного мембранного «Ферралест-40», одностороннего, с приточной щелью, одностороннего, объемом 40 дм³, модель «Ферралест-40-2 по ТУ 32.50.12-025-55307166-2018. (Фото предоставлено)

28

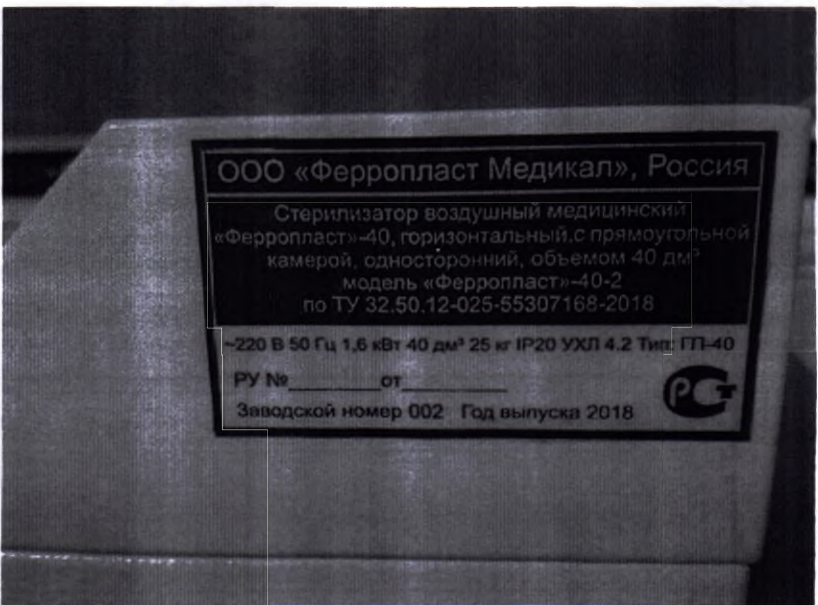


Фотография 28. Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»-40, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 40 дм³, модель «Ферропласт»-40-2 по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018. Маркировка. (фото повернуто).

29



Фотография 29. Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»-40, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 40 дм³, модель «Ферропласт»-40-2 по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018. Общий вид. (фото повернуто).

30

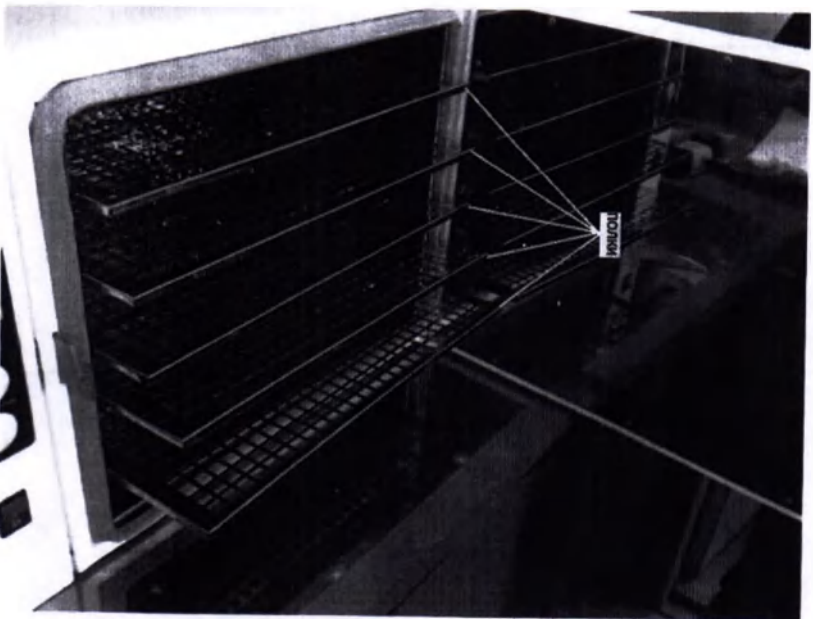

Фотография 30. Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»-40, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 40 дм³, модель «Ферропласт»-40-2 по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018. Дверь открыта. (фото повернуто).

31



Фотография 31. Полки (принадлежности) для стерилизатора воздушного медицинского «Ферропласт»-40, горизонтального, с прямоугольной камерой, одностороннего, объемом 40 дм³, модель «Ферропласт»-40-2 по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018.

32




Фотография 32. Вставка плавкая 1А - 1шт, вставка плавкая 15А - 2шт, принадлежности для стерилизатора воздушного наддувного «Ферропаст-40», горизонтальный, с прикуривательной камерой, односторонний, объемом 40 дм³, модель «Ферропаст-40-3» по ТУ 32.50.12-025-55307165-2016. (Фото подорвано).

33



Фотография 33. Стерилизатор воздушный наддувный «Ферропаст-40», горизонтальный, с прикуривательной камерой, односторонний, объемом 40 дм³, модель «Ферропаст-40-3» по ТУ 32.50.12-025-55307165-2016. (Фото подорвано).

34

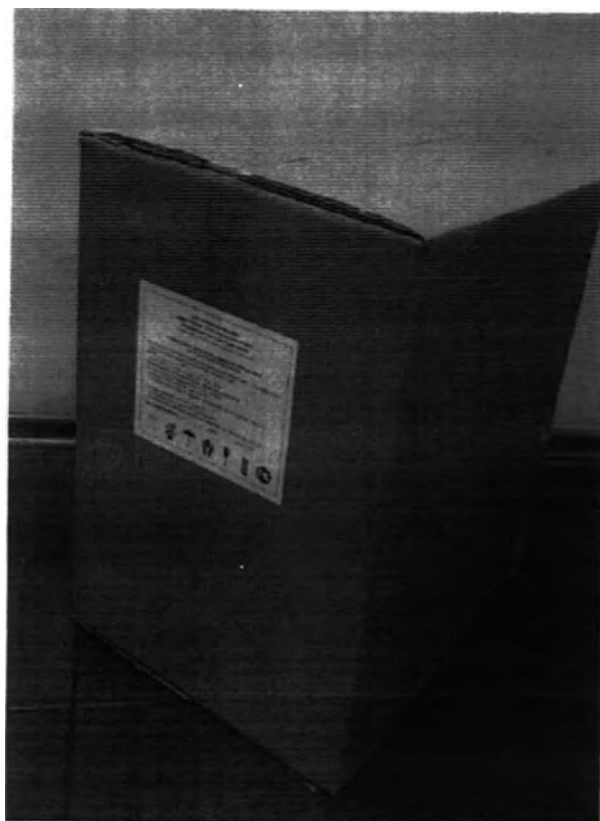

Фотография 34. Упаковка.




Фотография 35. Пример этикетки на упаковке. (Фото подорвано).

35

Директор ООО ЦИРМИ
С. Турман
Принят

Образцы маркировки медицинского изделия
Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»
 по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018

1. Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»-5, горизонтальный, с прямоугольной камерой односторонней, объемом 5 дм³ по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018

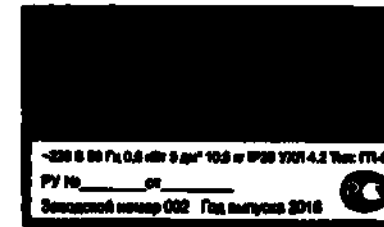

1.1.Маркировка, наносимая на этикетку (стикер), которая прикрепляется на корпус стерилизатора

Множеты маркировки
медицинского изделия

Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»
 по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018,
 производства ООО «Ферропласт Медикал», Россия

ООО «Ферропласт Медикал»
 Адрес: Россия, 182280, Ярославская область,
 Некouzовский район, пос. Привокзальный
 Т/факс: (4852) 58-45-61; 58-45-62; 58-45-63; 58-45-64.

Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»
 по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018

Исполнение: Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»-5 горизонтальный, с прямоугольной камерой односторонней, объемом 5 дм³ по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018

РУ № _____ от _____

~220 В 50 Гц, 0,6 кВт, 5 дм³ Тип: ГТ-5 IP 20
 Масса: брутто 12 кг, нетто 10,5 кг. Объем упаковки 6,07 м³.

Условия транспортирования 5 по ГОСТ 15150-80:

- температура от минус 50°C до плюс 50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре плюс 25°C.

Условия хранения 2 по ГОСТ 15150-80:

- при температуре от минус 50°C до плюс 40°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре плюс 25°C.


Дата упаковки «__» _____ 2018 г. Штамп ОТК:



1.2.Маркировка, наносимая на транспортную упаковку

(Версия 3)

2. Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»-10, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 10 дм³ по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018

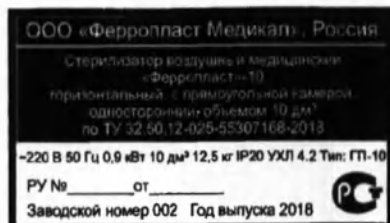

2.1.Маркировка, наносимая на этикетку (шильдик), которая прикрепляется на корпус стерилизатора

ООО «Ферропласт Медикал»
Адрес: Россия, 152260, Ярославская область, Некрасовский район, пос. Приволжский
Т/факс: (4852) 58-45-61; 58-45-62; 58-45-63; 58-45-64.

Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт» по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018

Исполнение: Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»-10 горизонтальный, с прямоугольной камерой односторонний, объемом 10 дм³ по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018

РУ № _____ от _____


~220 В 50 Гц 0,9 кВт 10 дм³ Тип: ГП-10 IP 20
Масса: брутто 14 кг, нетто 12,5 кг. Объем упаковки 0,09 м³.
Условия транспортирования 5 по ГОСТ 15150-69:
- температура от минус 50°C до плюс 50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре плюс 25°C.

Условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69:
- при температуре от минус 50°C до плюс 40°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре плюс 25°C.

Дата упаковывания «__» _____ 2018 г Штамп ОТК:

2.2.Маркировка, наносимая на транспортную упаковку

3. Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»-20, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 20 дм³ по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018

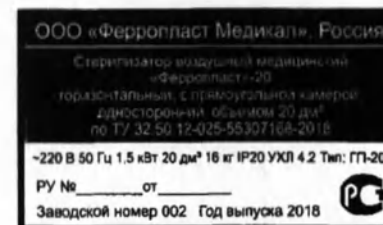

3.1.Маркировка, наносимая на этикетку (шильдик), которая прикрепляется на корпус стерилизатора

ООО «Ферропласт Медикал»
Адрес: Россия, 152260, Ярославская область, Некрасовский район, пос. Приволжский
Т/факс: (4852) 58-45-61; 58-45-62; 58-45-63; 58-45-64.

Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт» по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018

Исполнение: Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»-20 горизонтальный, с прямоугольной камерой односторонний, объемом 20 дм³ по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018

РУ № _____ от _____


~220 В 50 Гц 1,5 кВт 20 дм³ Тип: ГП-20 IP 20
Масса: брутто 18 кг, нетто 16 кг. Объем упаковки 0,11 м³.
Условия транспортирования 5 по ГОСТ 15150-69:
- температура от минус 50°C до плюс 50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре плюс 25°C.

Условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69:
- при температуре от минус 50°C до плюс 40°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре плюс 25°C.

Дата упаковывания «__» _____ 2018 г Штамп ОТК:

3.2.Маркировка, наносимая на транспортную упаковку

4. Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»-40, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонней, объемом 40 дм³, модель «Ферропласт»-40-1 по ТУ 32.90.12-025-55307168-2018

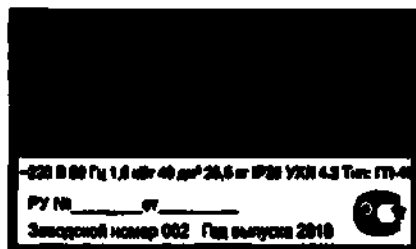

4.1. Маркировка, наносимая на этикетку (минимум), которая прикрепляется на корпус стерилизатора

ООО «Ферропласт Медикал»
 Адрес: Россия, 162200, Ярославская область,
 Некрасовский район, пос. Привольный
 Т/факс: (4852) 58-45-61; 58-45-62; 58-45-63; 58-45-64.

**Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»
 по ТУ 32.90.99-025-55307168-2018**

Исполнение: Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»-40, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонней, объемом 40 дм³, модель «Ферропласт»-40-1 по ТУ 32.90.12-025-55307168-2018;

РУ № _____ от _____
 ~220 В 50 Гц 1,8 кВт 40 дм³ Тип: ГП-40 IP 20
 Масса: брутто 26,5 кг, нетто 26,5 кг. Объем упаковки 0,18 м³.
 Условия транспортирования 5 по ГОСТ 15150-09:
 - температура от минус 50°C до плюс 50°C;
 - относительная влажность воздуха не более 95% при температуре плюс 25°C.


Условия хранения 2 по ГОСТ 15150-09:
 - при температуре от минус 50°C до плюс 40°C;
 - относительная влажность воздуха не более 95% при температуре плюс 25°C.

Дата упаковки «_» _____ 2018 г Штамп ОТК:

4.2. Маркировка, наносимая на транспортную упаковку

5

5. Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»-40, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонней, объемом 40 дм³, модель «Ферропласт»-40-2 по ТУ 32.90.12-025-55307168-2018

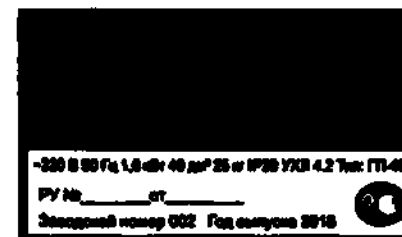

5.1. Маркировка, наносимая на этикетку (минимум), которая прикрепляется на корпус стерилизатора

ООО «Ферропласт Медикал»
 Адрес: Россия, 162200, Ярославская область,
 Некрасовский район, пос. Привольный
 Т/факс: (4852) 58-45-61; 58-45-62; 58-45-63; 58-45-64.

**Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»
 по ТУ 32.90.12-025-55307168-2018**

Исполнение: Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»-40, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонней, объемом 40 дм³, модель «Ферропласт»-40-2 по ТУ 32.90.12-025-55307168-2018;

РУ № _____ от _____
 ~220 В 50 Гц 1,8 кВт 40 дм³ Тип: ГП-40 IP 20
 Масса: брутто 26,5 кг, нетто 26 кг. Объем упаковки 0,18 м³.
 Условия транспортирования 5 по ГОСТ 15150-09:
 - температура от минус 50°C до плюс 50°C;
 - относительная влажность воздуха не более 95% при температуре плюс 25°C.


Условия хранения 2 по ГОСТ 15150-09:
 - при температуре от минус 50°C до плюс 40°C;
 - относительная влажность воздуха не более 95% при температуре плюс 25°C.

Дата упаковки «_» _____ 2018 г Штамп ОТК:

5.2. Маркировка, наносимая на транспортную упаковку

6

6. Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»-40, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонней, объемом 40 дм³, модель «Ферропласт»-40-3 по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018

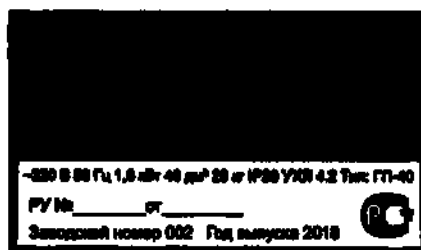

6.1.Маркировка, наносимая на этикетку (наклейку), которая прикрепляется на корпус стерилизатора

ООО «Ферропласт Медикал»
Адрес: Россия, 162288, Ярославская область,
Никитинский район, пос. Приволжский
Т/факс: (4852) 58-45-61; 58-45-62; 58-45-63; 58-45-64.

Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»
по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018

Исполнение: Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»-40, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонней, объемом 40 дм³, модель «Ферропласт»-40-3 по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018;

РУ № _____ от _____

~220 В 50 Гц 1,5 кВт 40 дм³ Тик: ГТ-40 IP 20

Масса: брутто 28,5 кг, нетто 26 кг. Объем упаковки 0,16м³.

Условия транспортирования 6 по ГОСТ 15150-89:

- температура от минус 50°C до плюс 50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре плюс 25°C.

Условия хранения 2 по ГОСТ 15150-89:

- при температуре от минус 50°C до плюс 40°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре плюс 25°C.

Дата упаковки _____ 2018 г

Штамп ОТК:



6.2.Маркировка, наносимая на транспортную упаковку

