



nemc CE 0197	
Balloon Inflation Devices YB-A-20	
Content: 1. Balloon Inflation Devices Type A, 20ml, IPCS 500PSI/OFF, IPCS 2. Sticker	
REF: 30100104	LOT: 31704007
2017-04-13	2020-04-12
STERILE	
Warning: Contents sterile and non pyrogen in undamaged package	
Xujian New Concept Medical Technology Co., LTD ADD Floor 1-2, No.7 Haicang Biomedicine Building No.2026 West Wengjiao Road Haicang District Xiamen Fujian China TEL: +86 592 6263841 FAX: +86 592 6269987 Post: 361012	
[CE REP] CHC Medical Devices & Drugs S.L. ADD C/ Horacio Langa Nº18 CP 28006, Madrid, Spain TEL: +34 951214054 Email: info@chcmrmedicaldevices.com	
Ver A.01	

Фото 1. Устройство для раздувания баллона в наборах (исполнение - Устройство для раздувания баллона в наборах тип А объемом 20 мл)
в индивидуальной (стерилизационной) упаковке – лицевая сторона

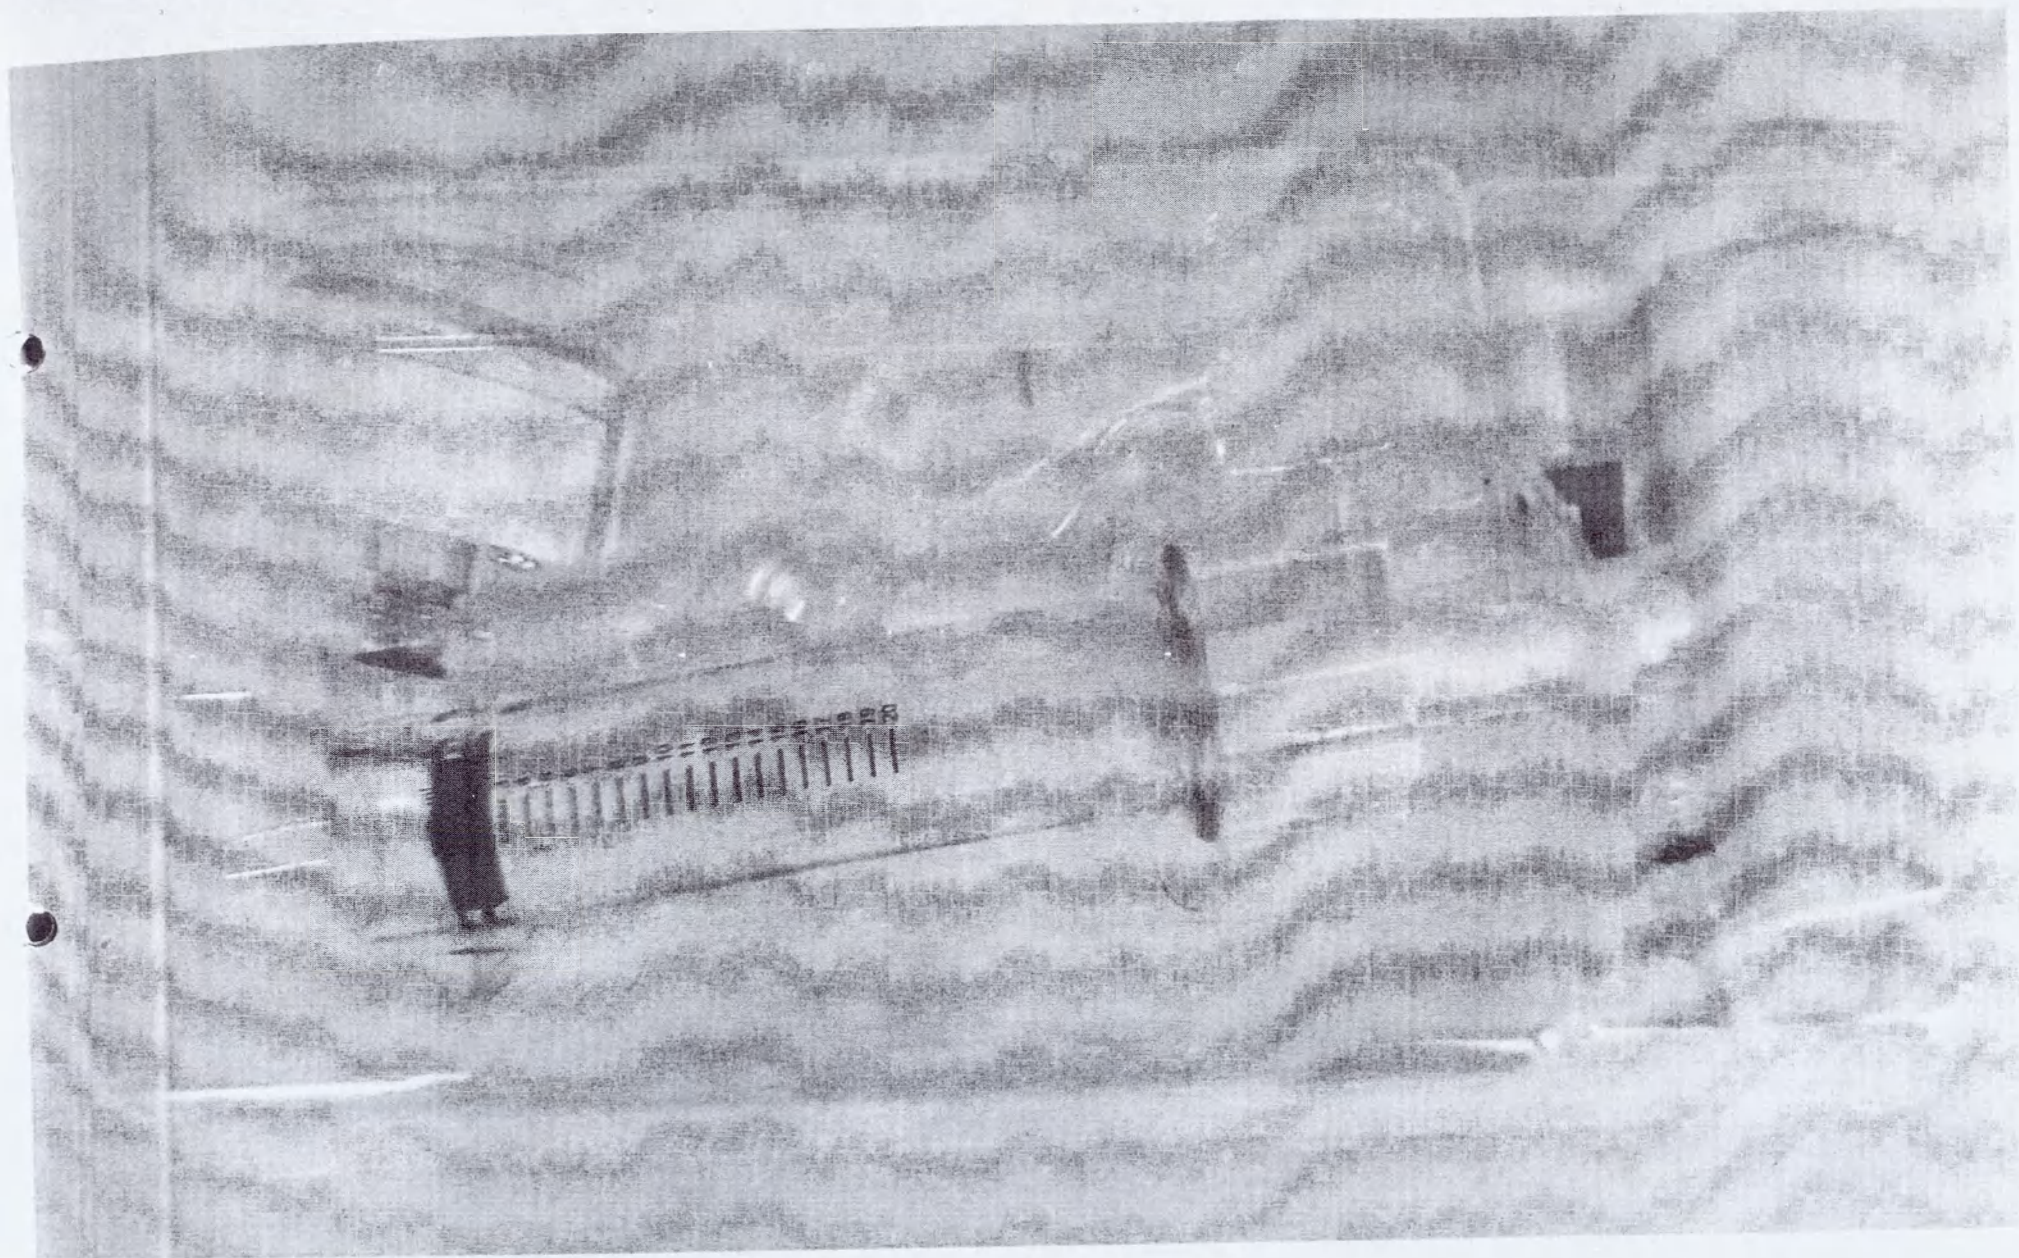


Фото 2. Устройство для раздувания баллона в наборах (исполнение - Устройство для раздувания баллона в наборах тип А объемом 20 мл)
в индивидуальной (стерилизационной) упаковке – оборотная сторона

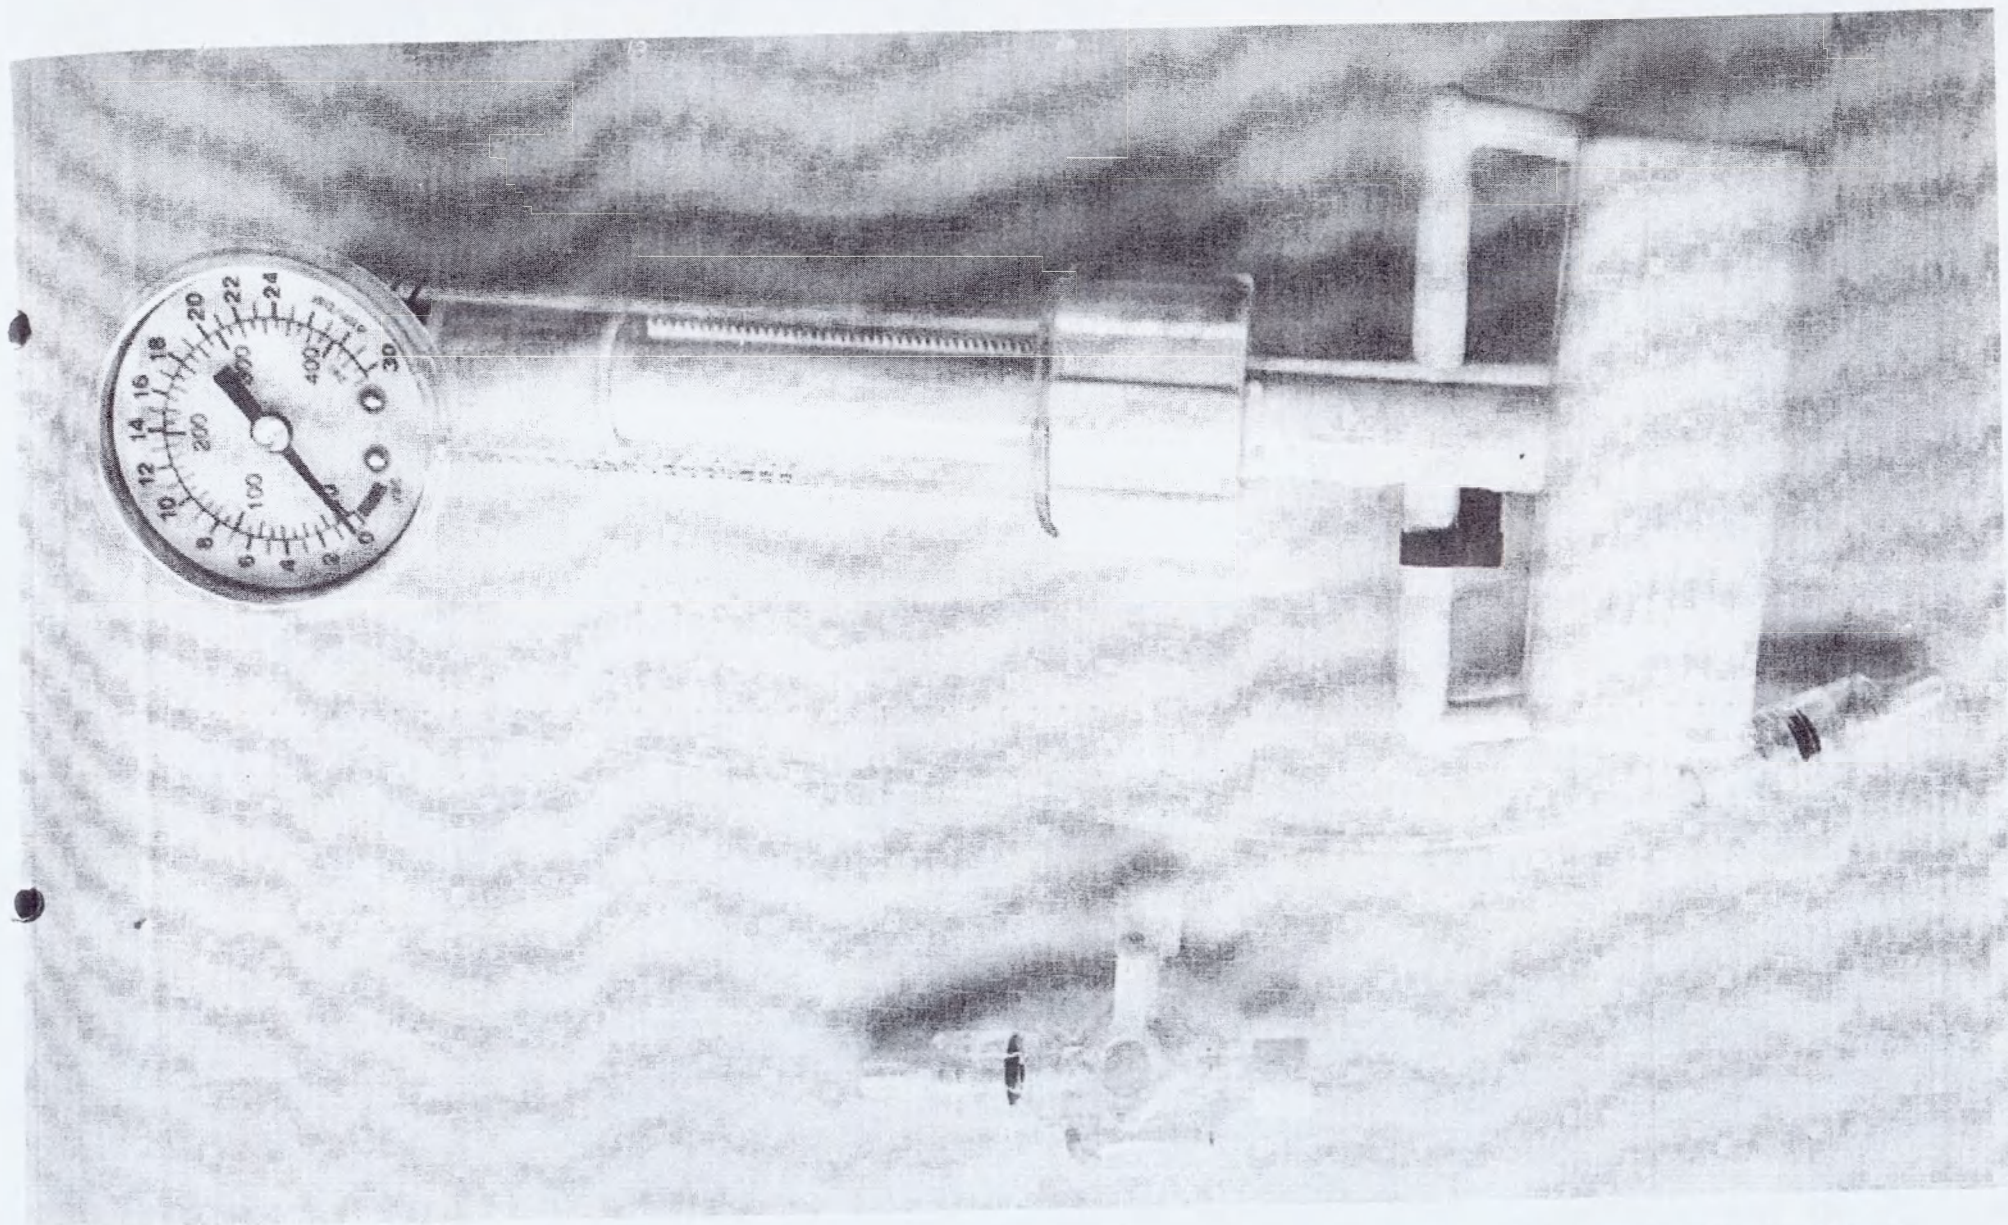


Фото 3. Устройство для раздувания баллона в наборах (исполнение - Устройство для раздувания баллона в наборах тип А объемом 20 мл)
Набор

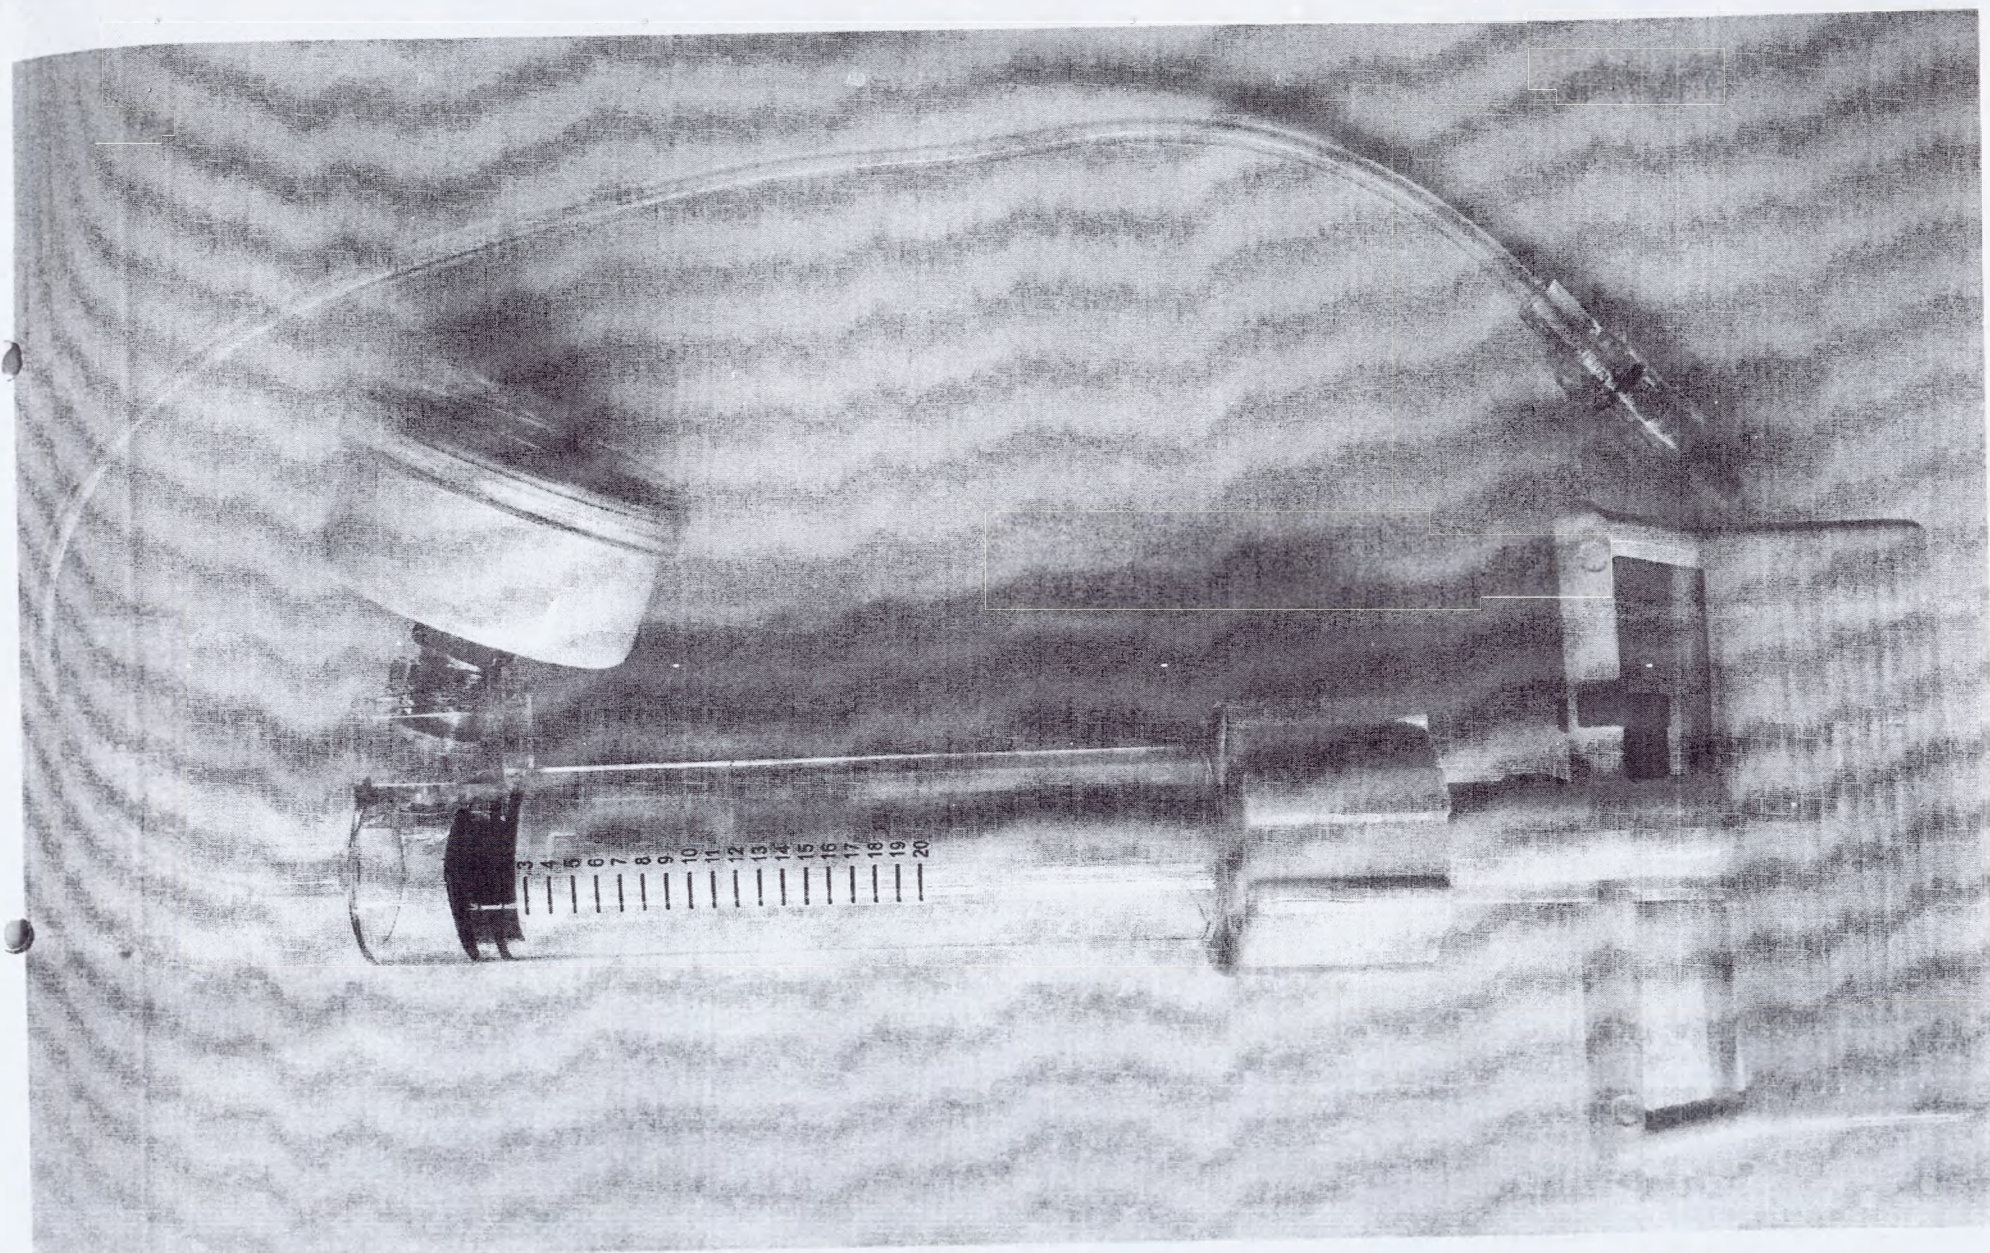


Фото 4. Устройство для раздувания баллона в наборах (исполнение - Устройство для раздувания баллона в наборах тип А объемом 20 мл)
Устройство для раздувания баллона тип А объемом 20 мл

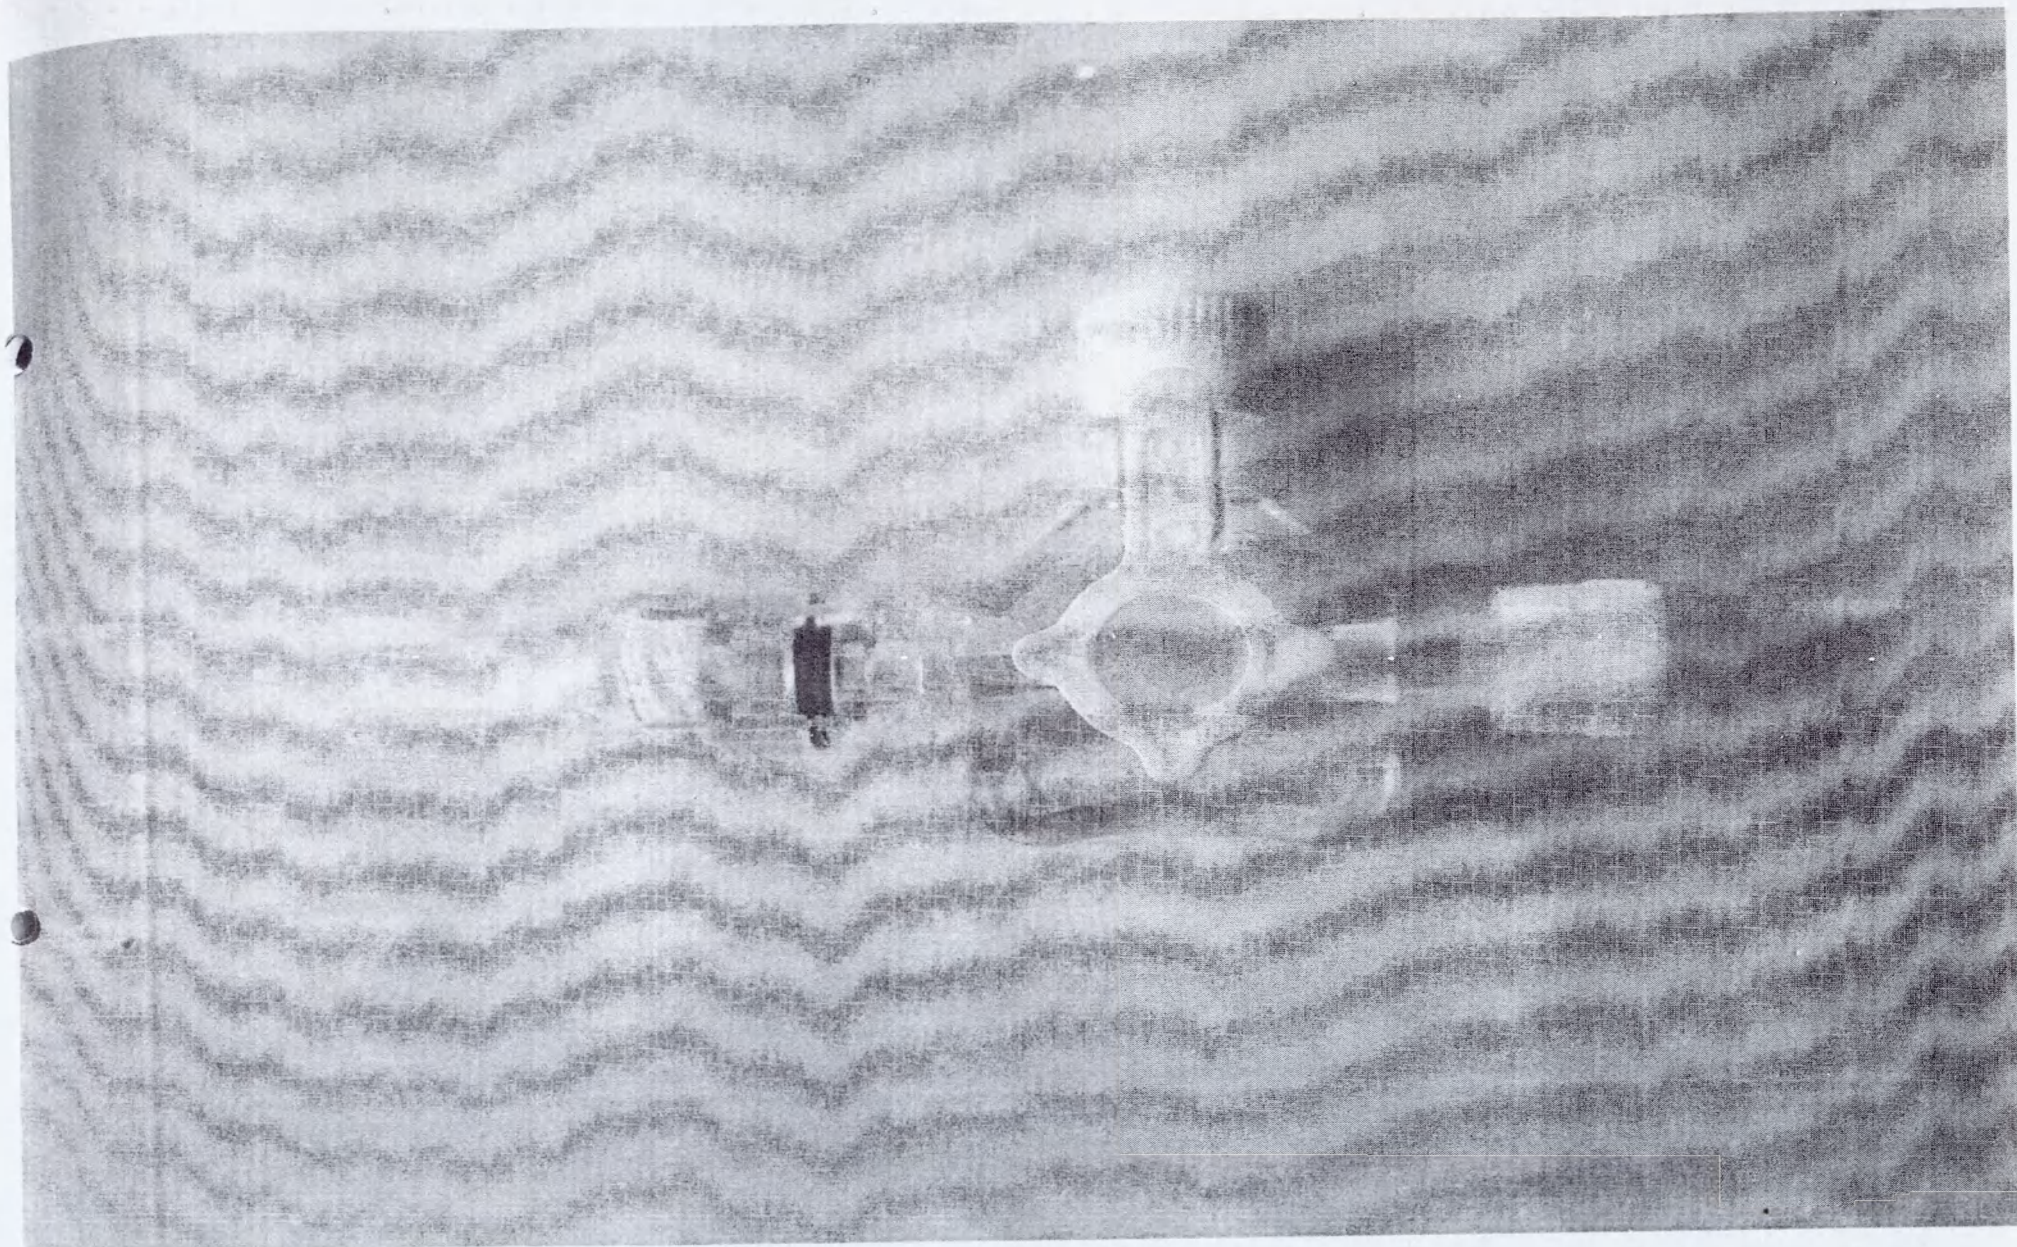


Фото 5. Устройство для раздувания баллона в наборах (исполнение - Устройство для раздувания баллона в наборах тип А объемом 20 мл)
Краник

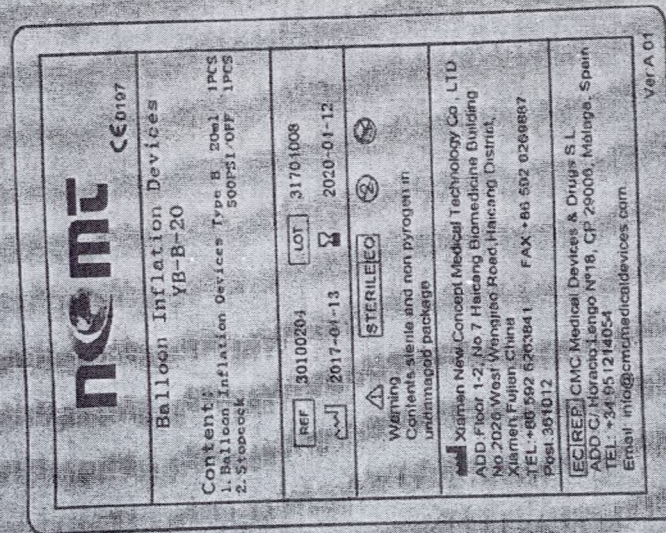


Фото 6. Устройство для раздувания баллона в наборах (исполнение - Устройство для раздувания баллона в наборах тип В объемом 20 мл) в индивидуальной (стерилизационной) упаковке – лицевая сторона

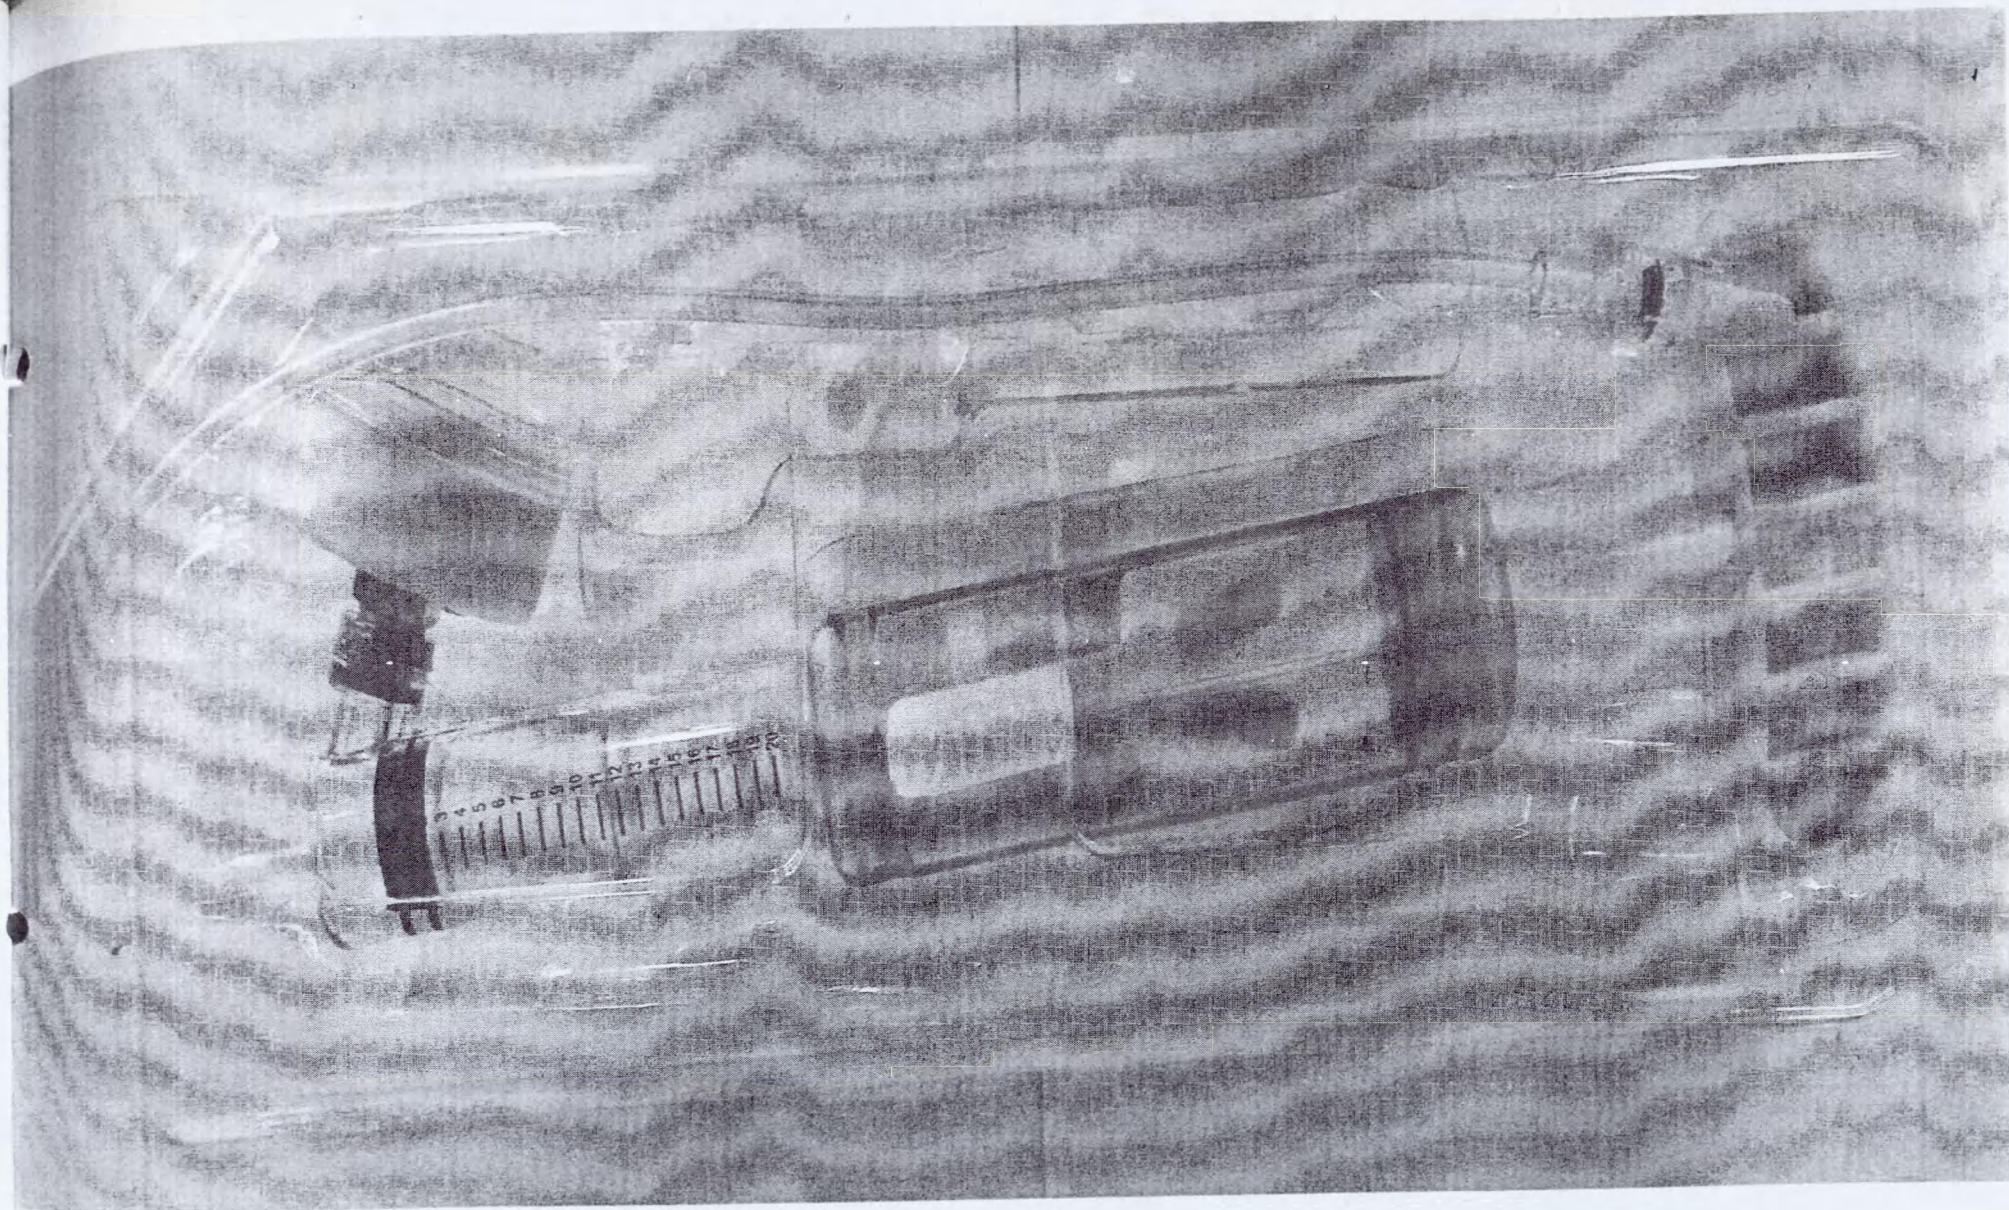


Рис. 7. Устройство для раздувания баллона в наборах (исполнение - Устройство для раздувания баллона в наборах тип В объемом 20 мл)
в индивидуальной (стерилизационной) упаковке – оборотная сторона

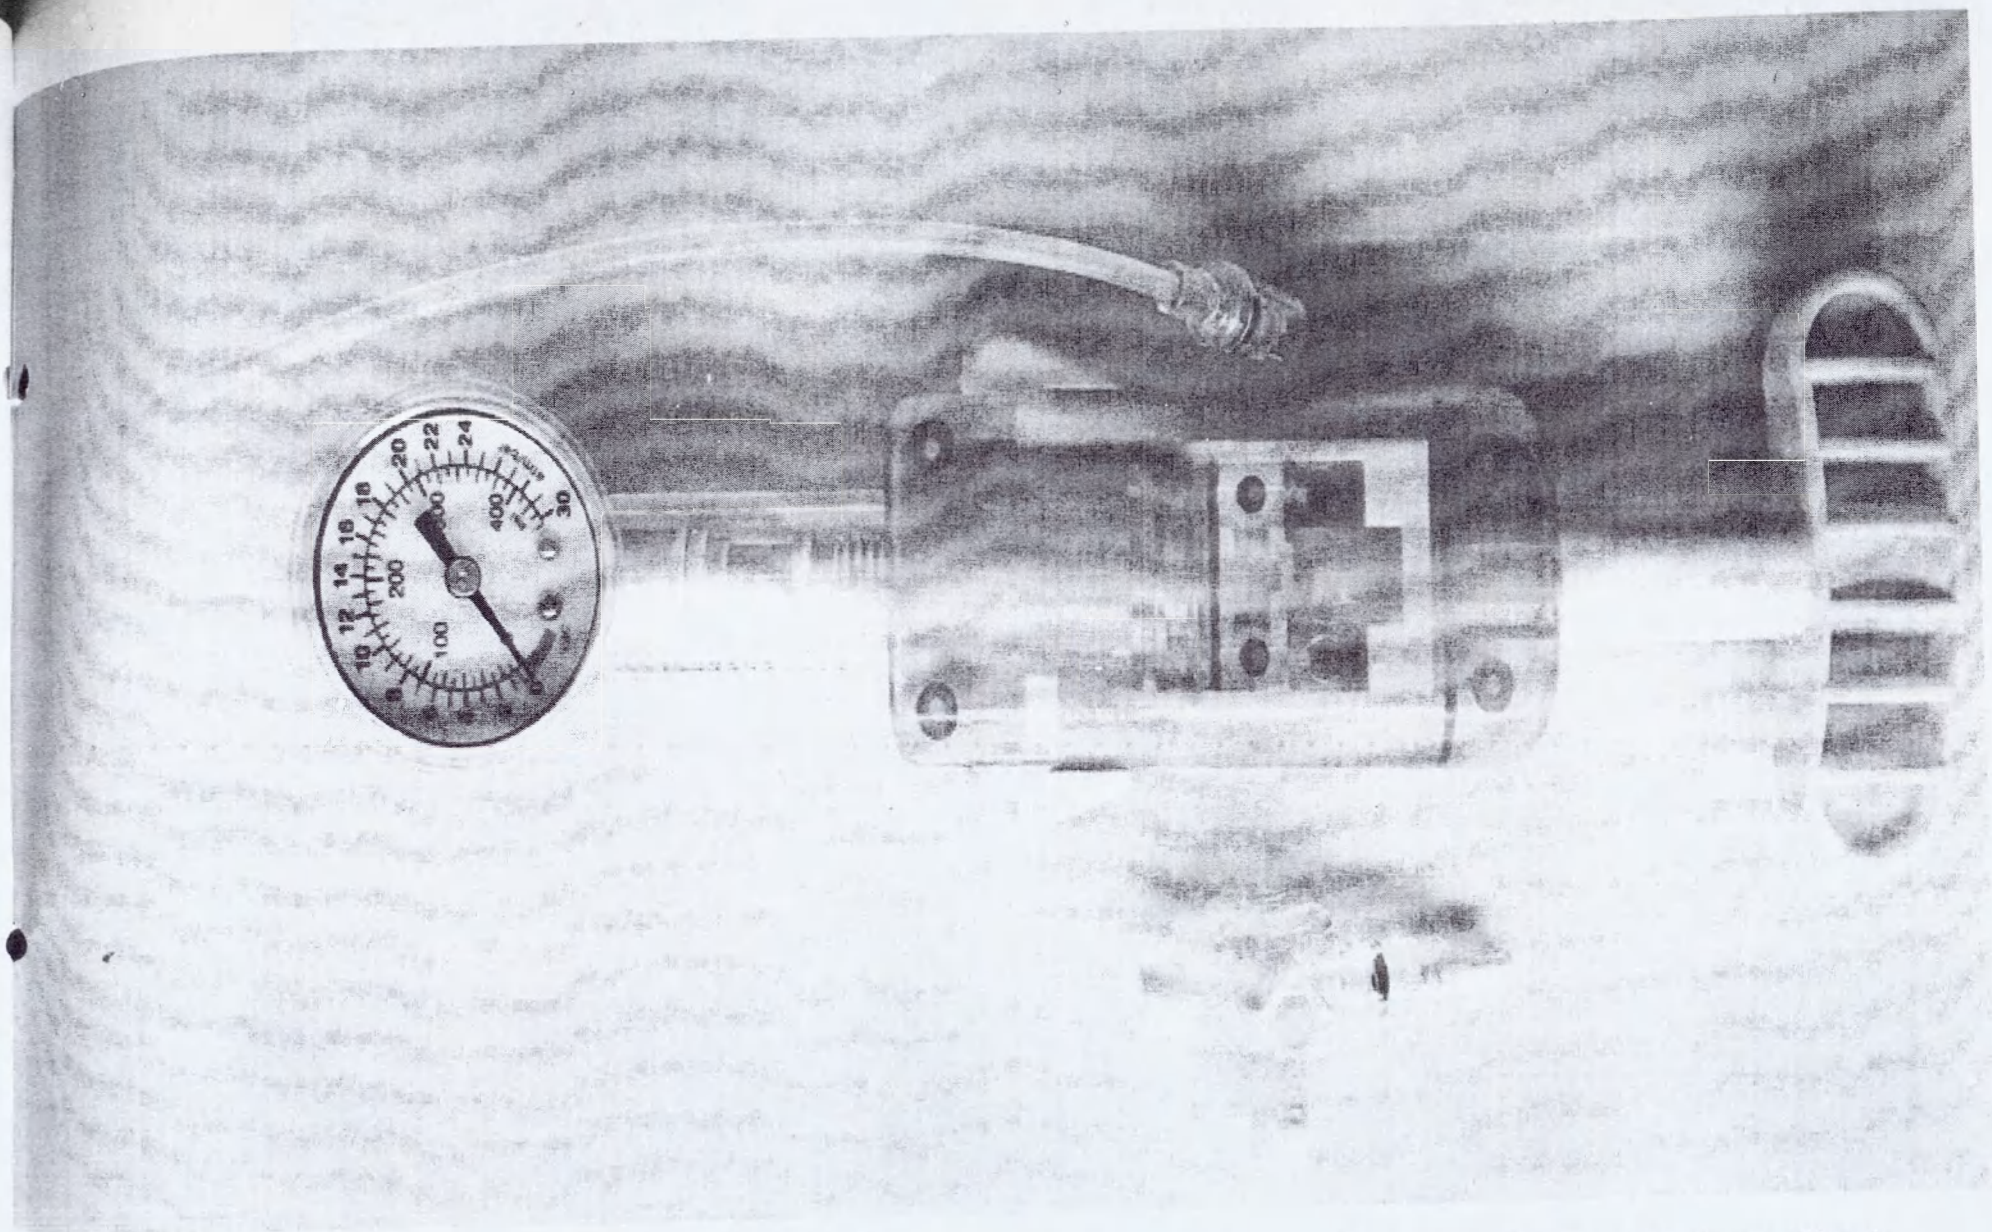


Фото 8. Устройство для раздувания баллона в наборах (исполнение - Устройство для раздувания баллона в наборах тип В объемом 20 мл)
Набор

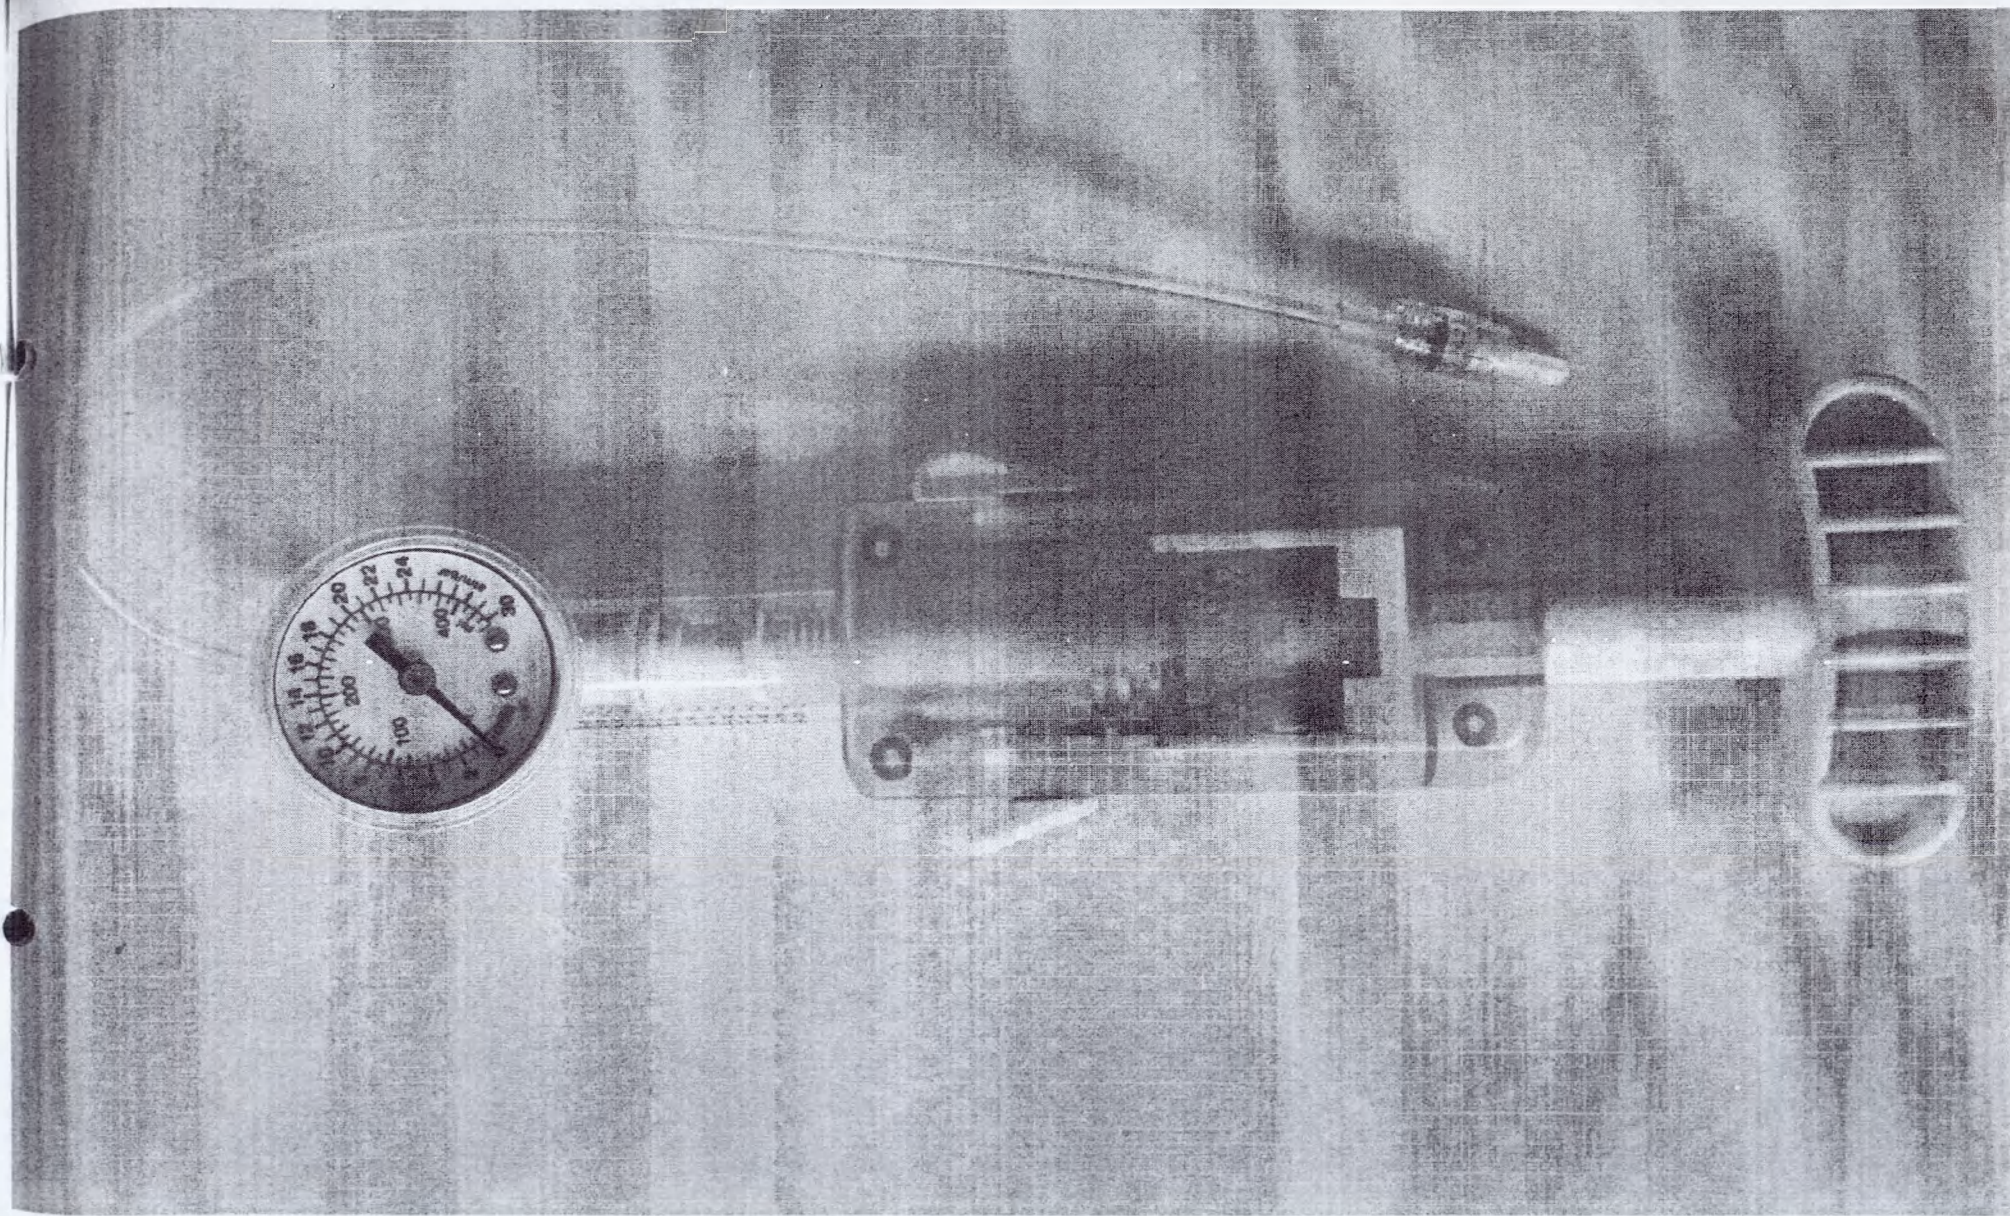


Фото 9. Устройство для раздувания баллона в наборах (исполнение - Устройство для раздувания баллона в наборах тип В объемом 20 мл)
Устройство для раздувания баллона тип В объемом 20 мл

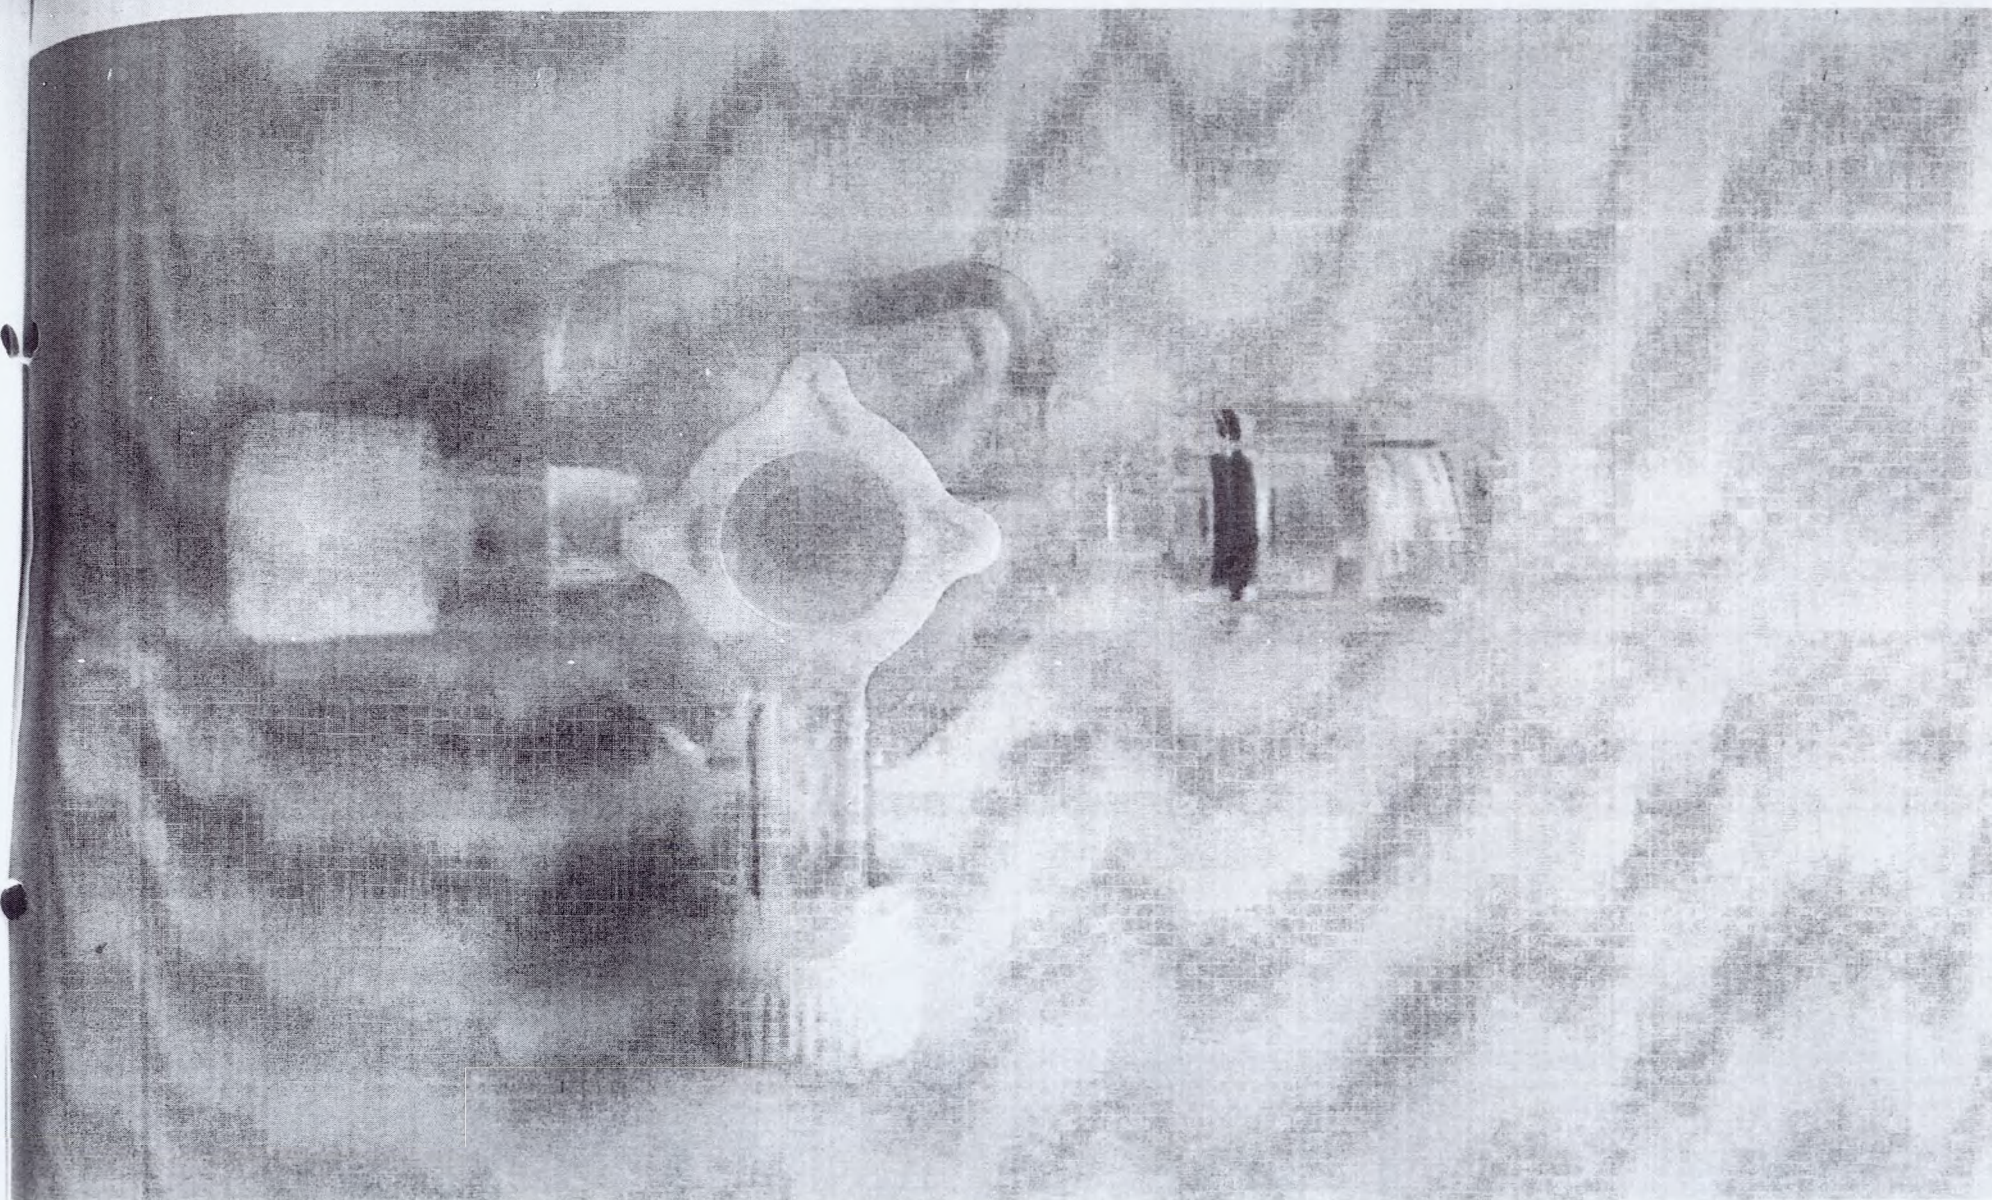


Фото 10. Устройство для раздувания баллона в наборах (исполнение - Устройство для раздувания баллона в наборах тип В объемом 20 мл)
Краник