

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Аппарат ультразвуковой диагностический цифровой (см. Приложение)

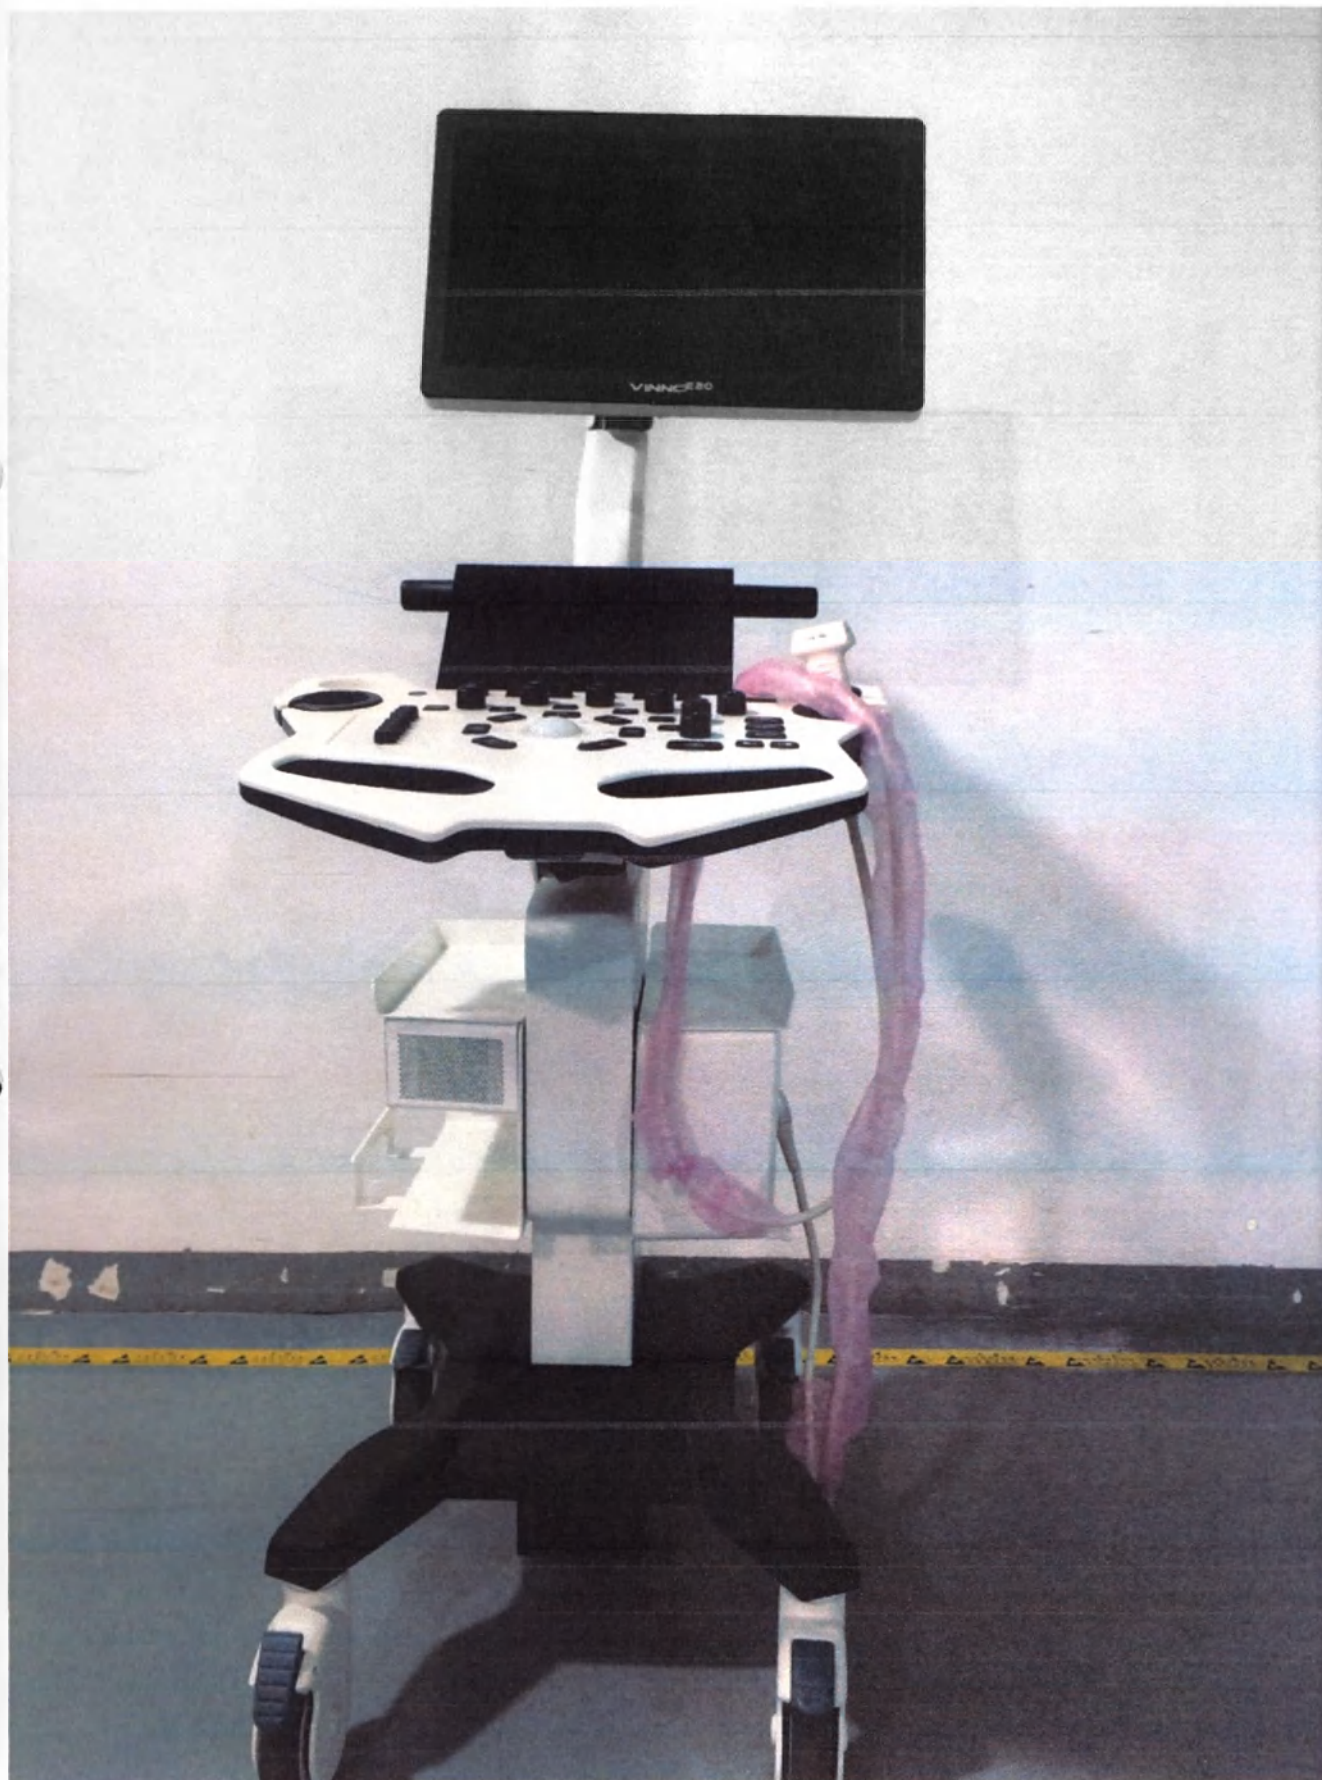


Рисунок 1 - Внешний вид изделия в варианте исполнения VINNO E20 с подключенным датчиком УЗ

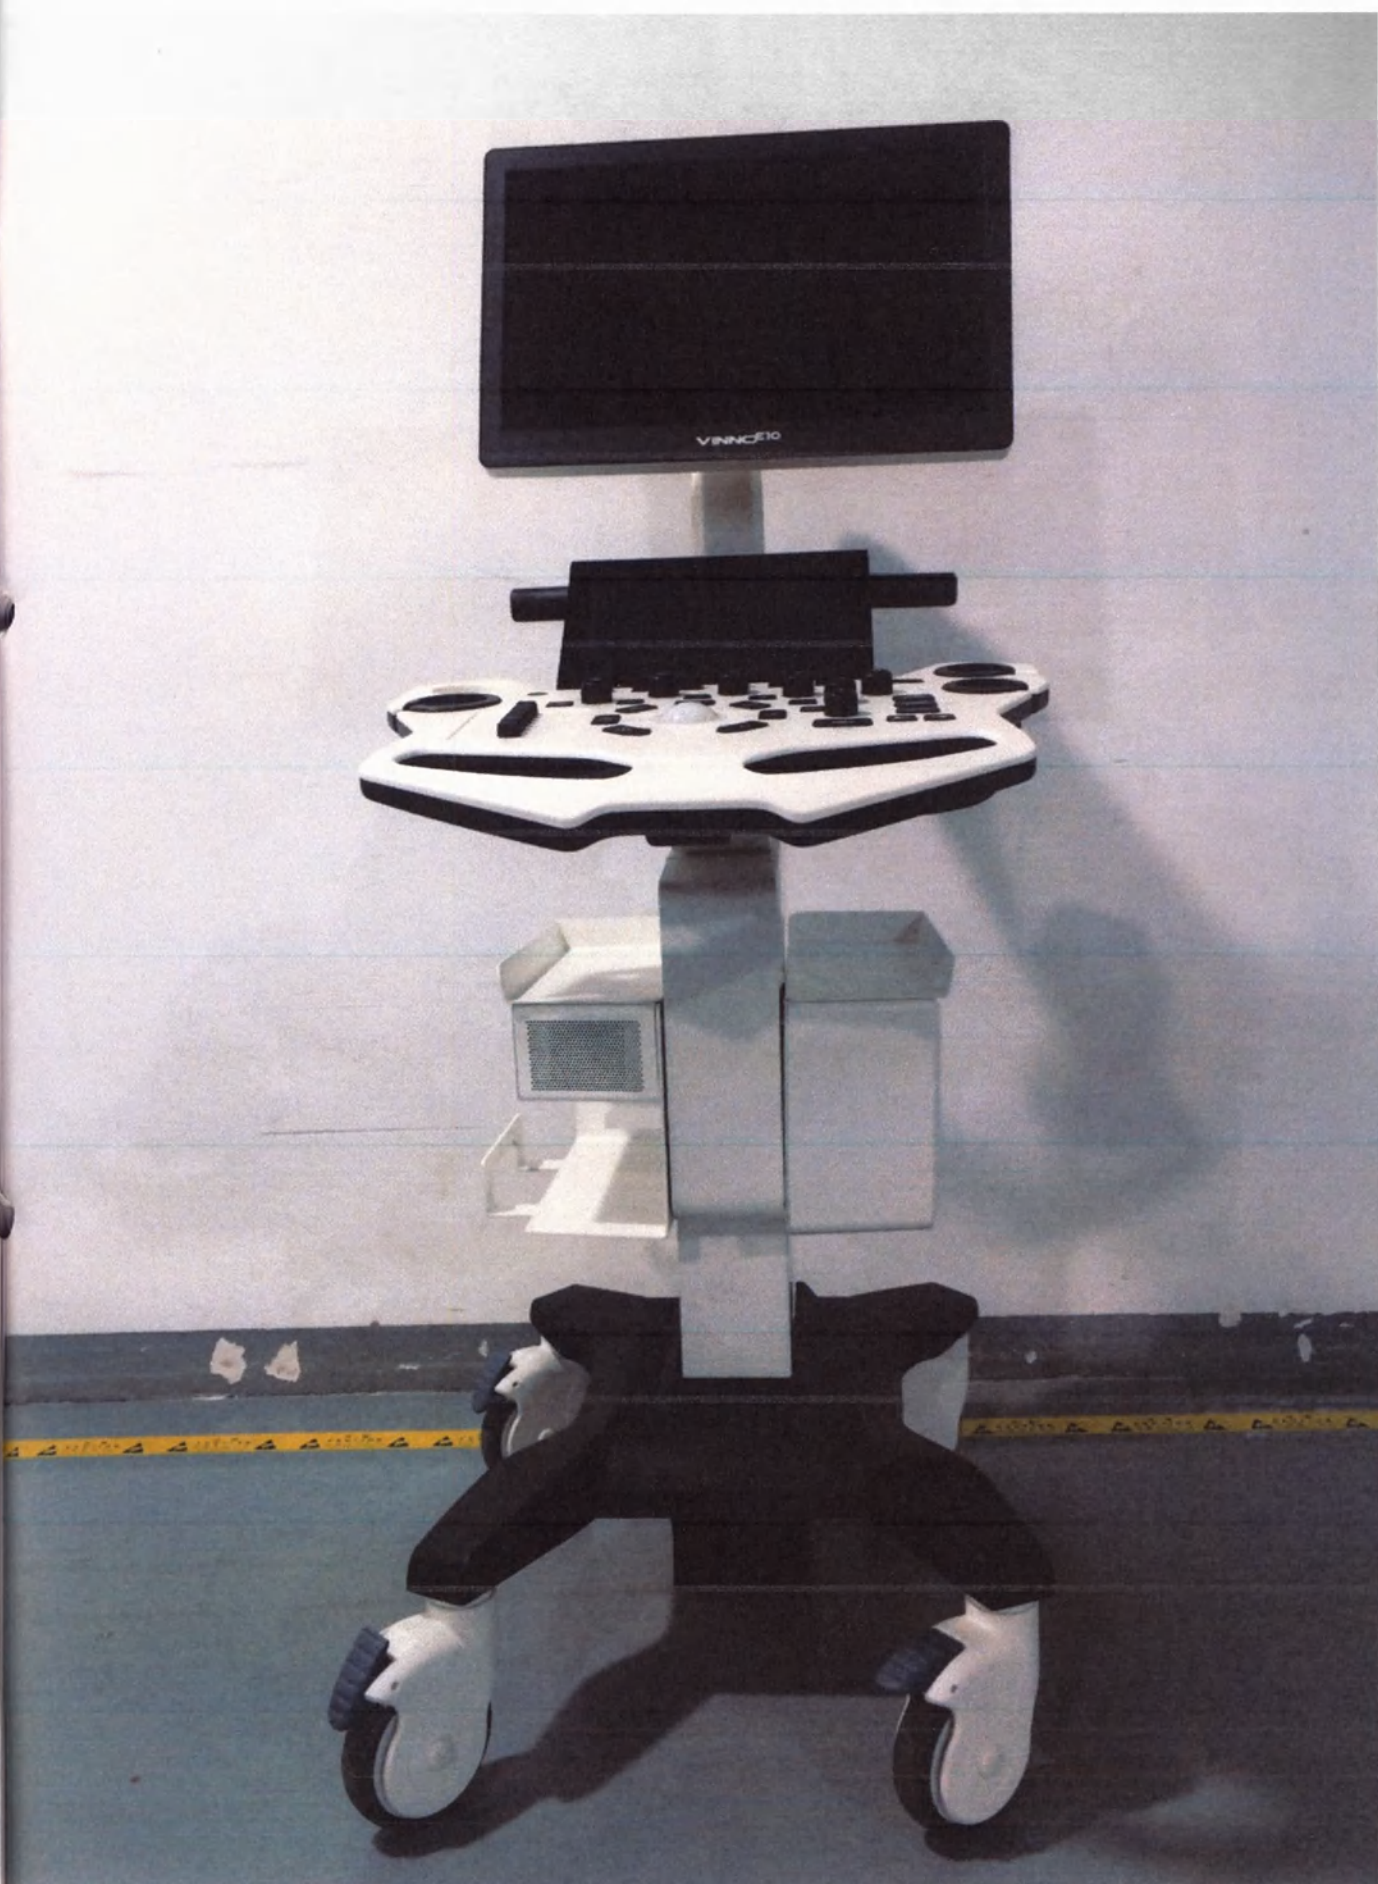


Рисунок 2 - Внешний вид изделия в варианте исполнения VINNO E10

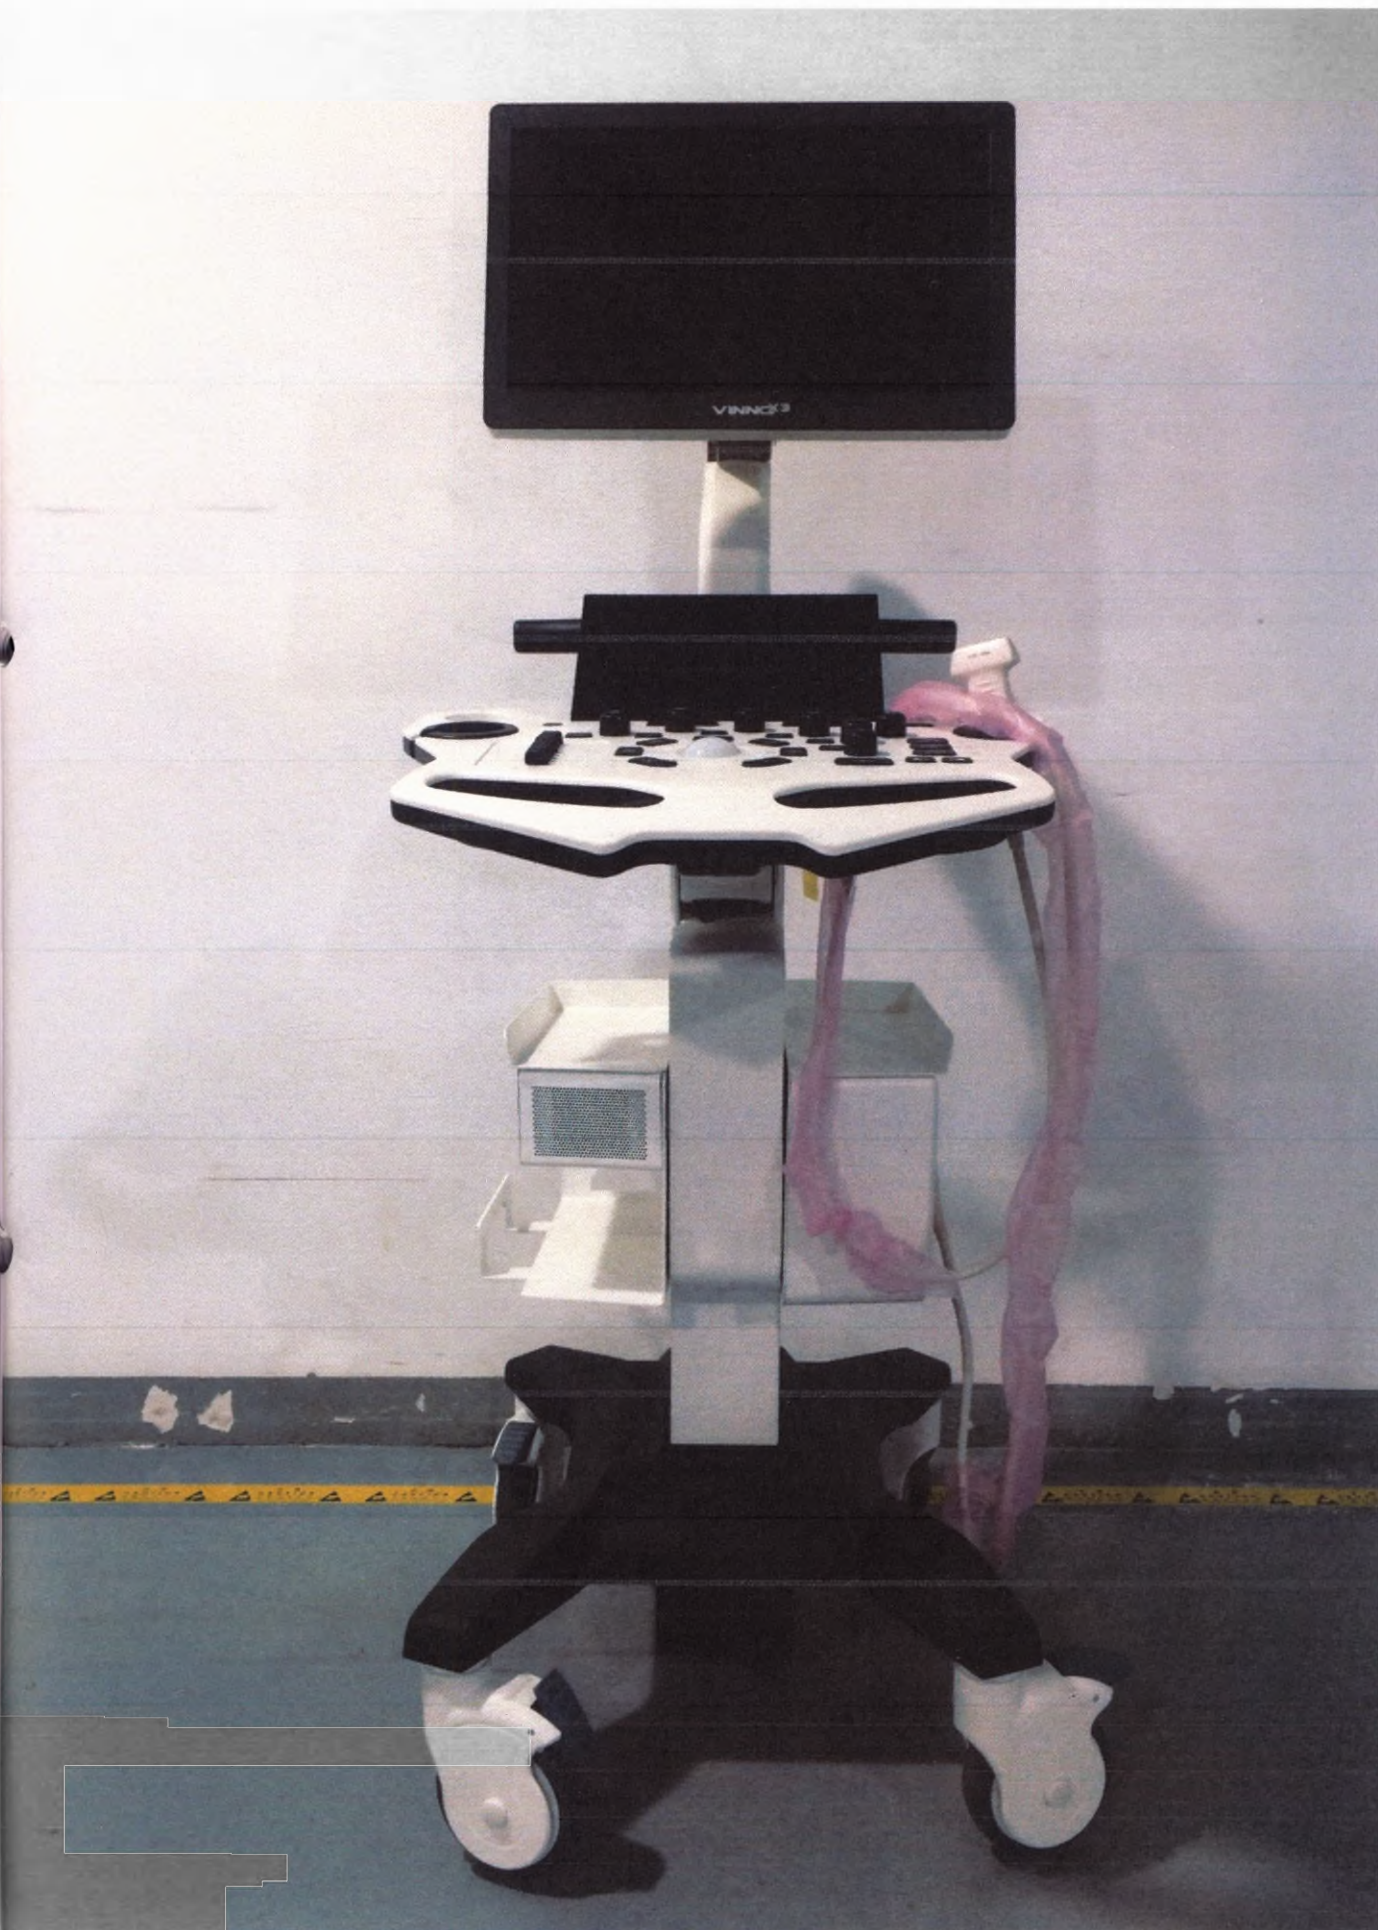


Рисунок 3 - Внешний вид изделия в варианте исполнения VINNO X3

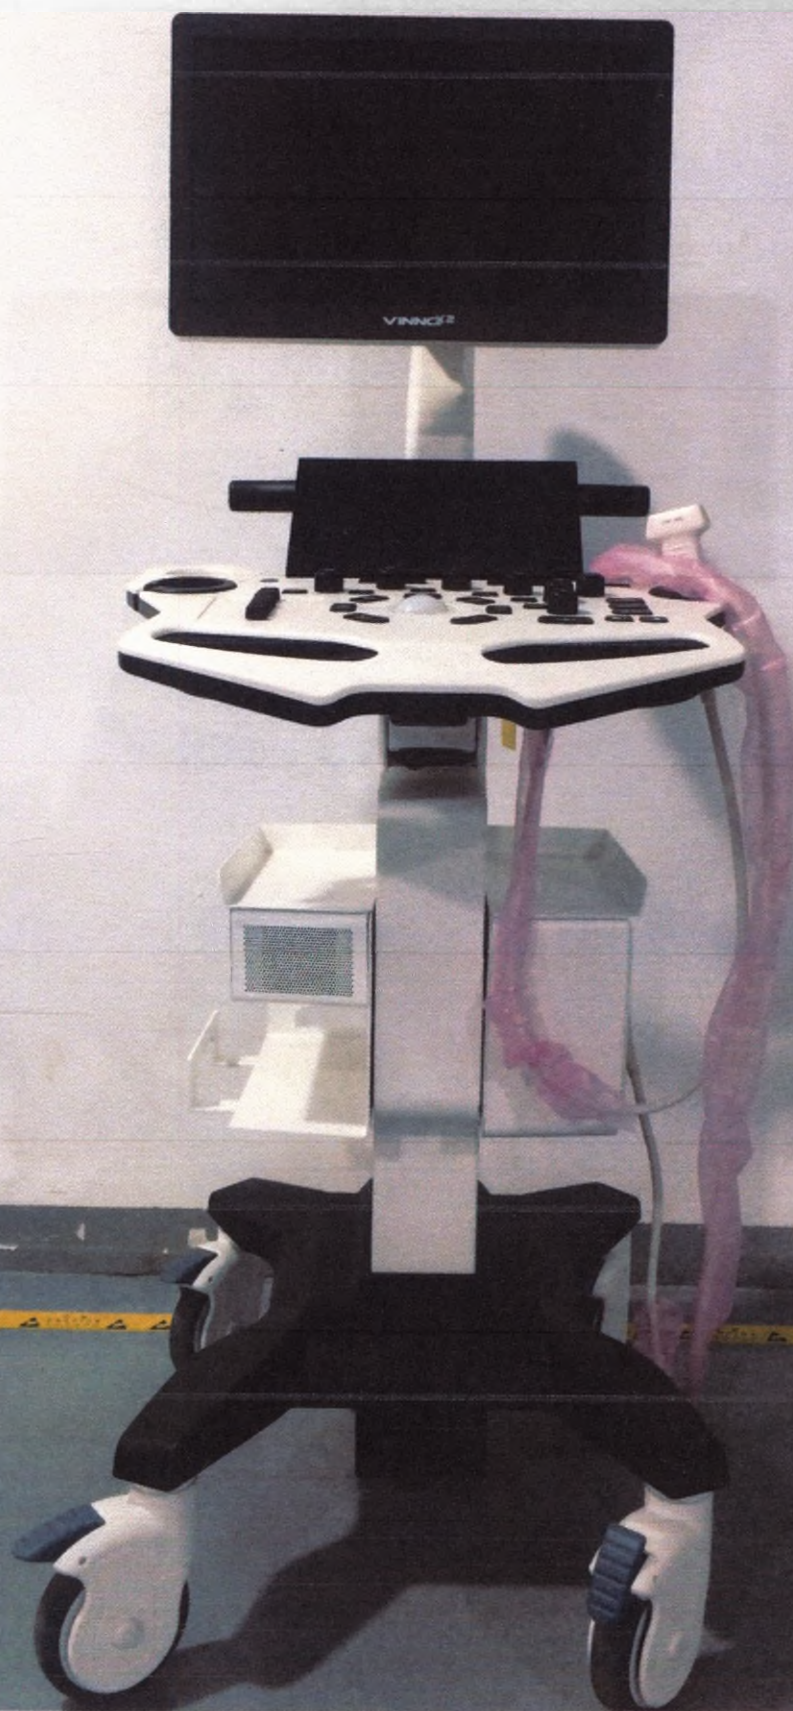


Рисунок 4 - Внешний вид изделия в варианте исполнения VINNO X2 с подключенным датчиком УЗ

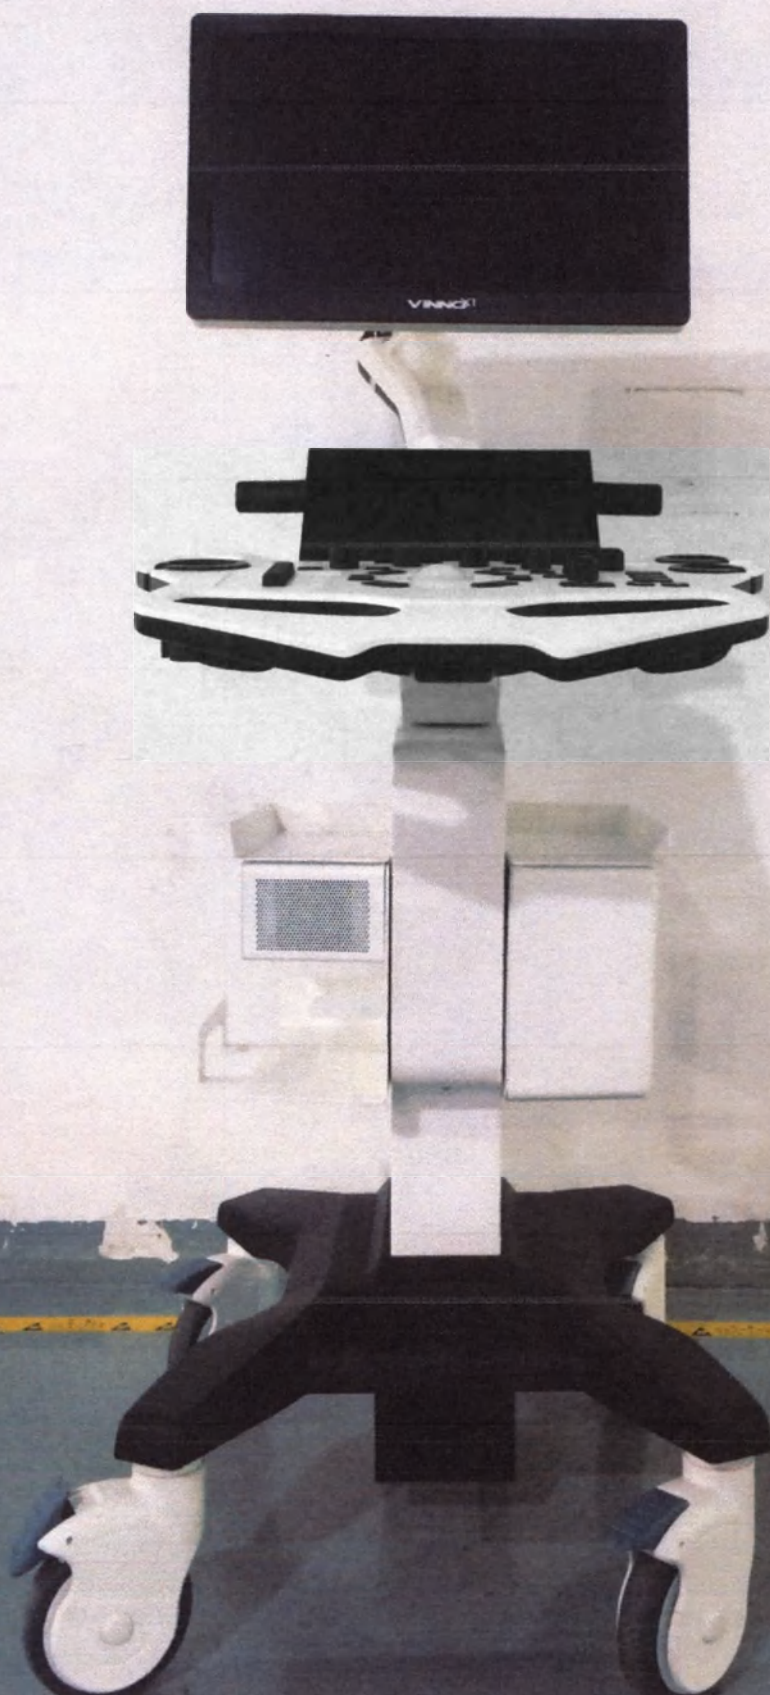


Рисунок 5 - Внешний вид изделия в варианте исполнения VINNO X1



Рисунок 6 - Насадка биопсийная LPGF, REF 3100096, идет в наборе с двумя иглопроводниками 16G и 18G.



Рисунок 7 - Насадка биопсийная LPEN

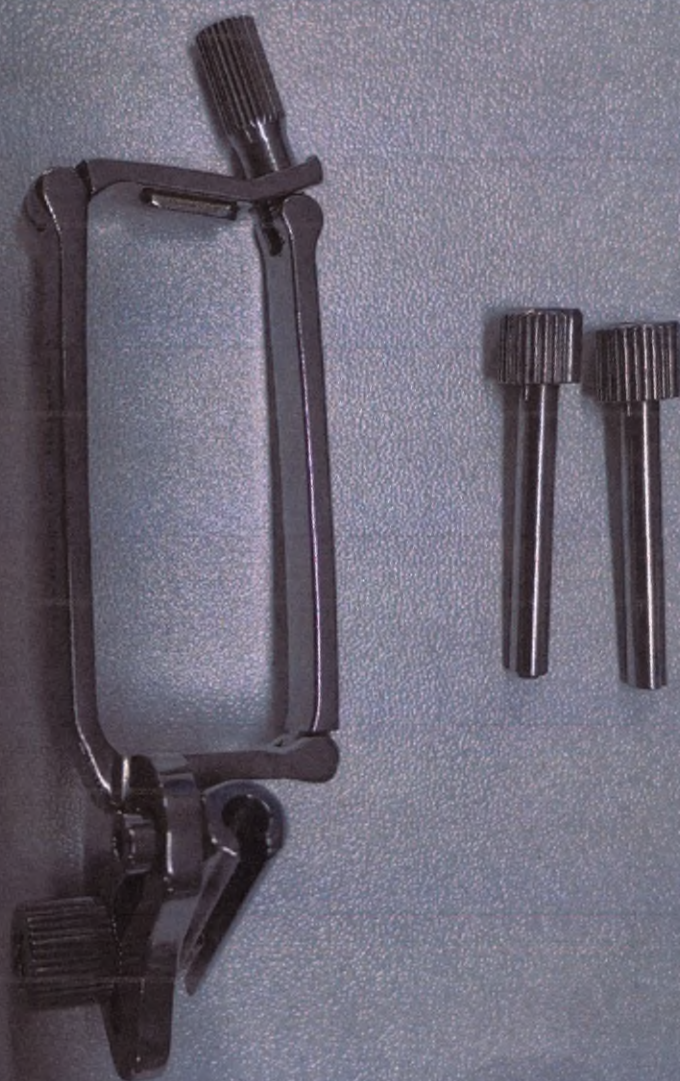


Рисунок 8 - Насадка биопсийная LPGF, REF 3100130, идет в наборе с двумя иглопроводниками 16G и 18G

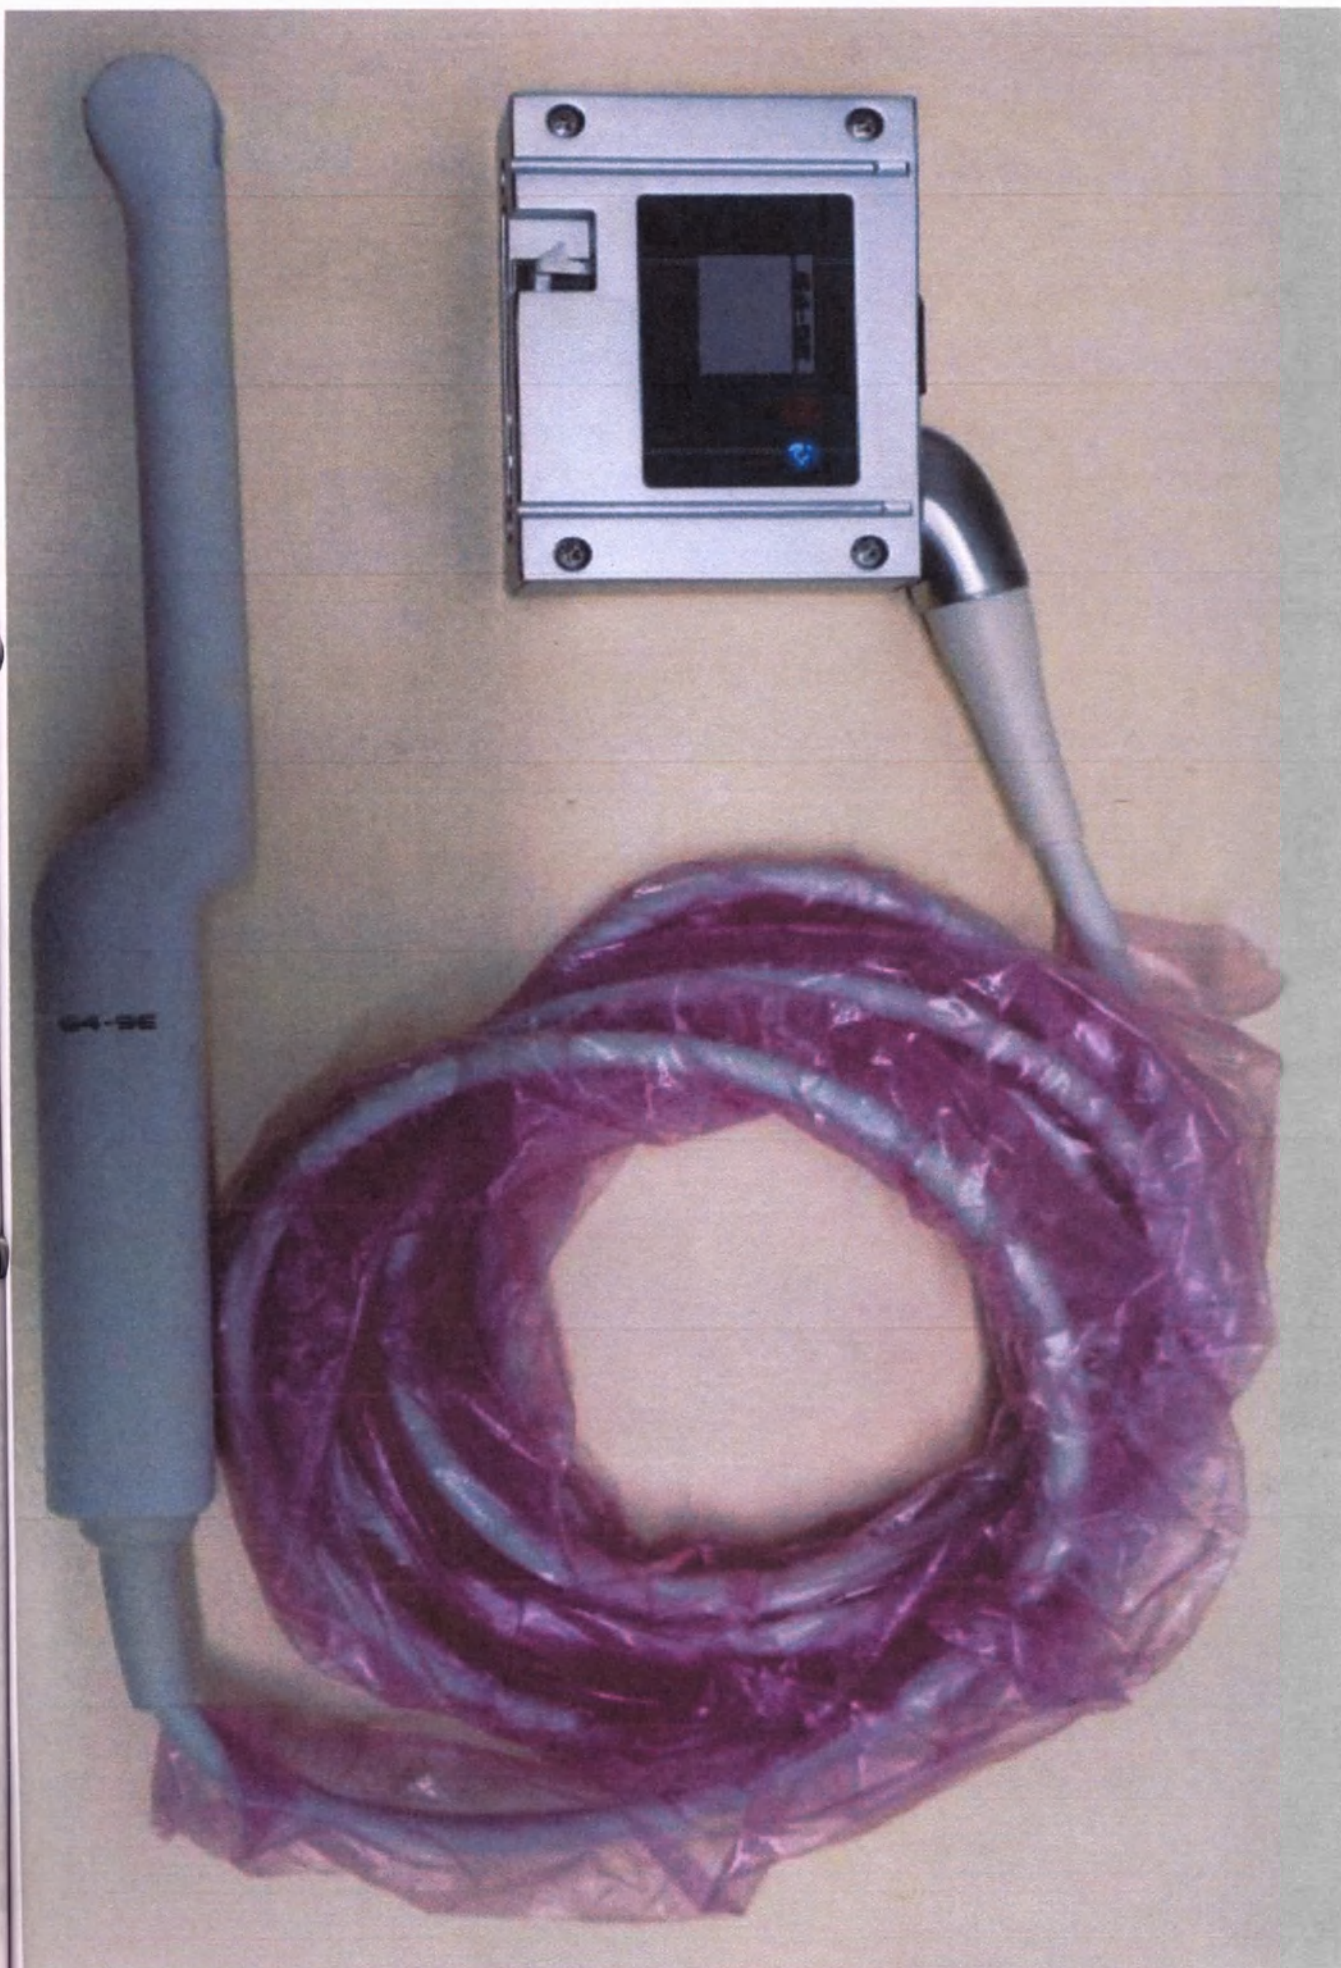


Рисунок 9 - Датчик УЗ G4-9E (в транспортировочной защитной пленке)

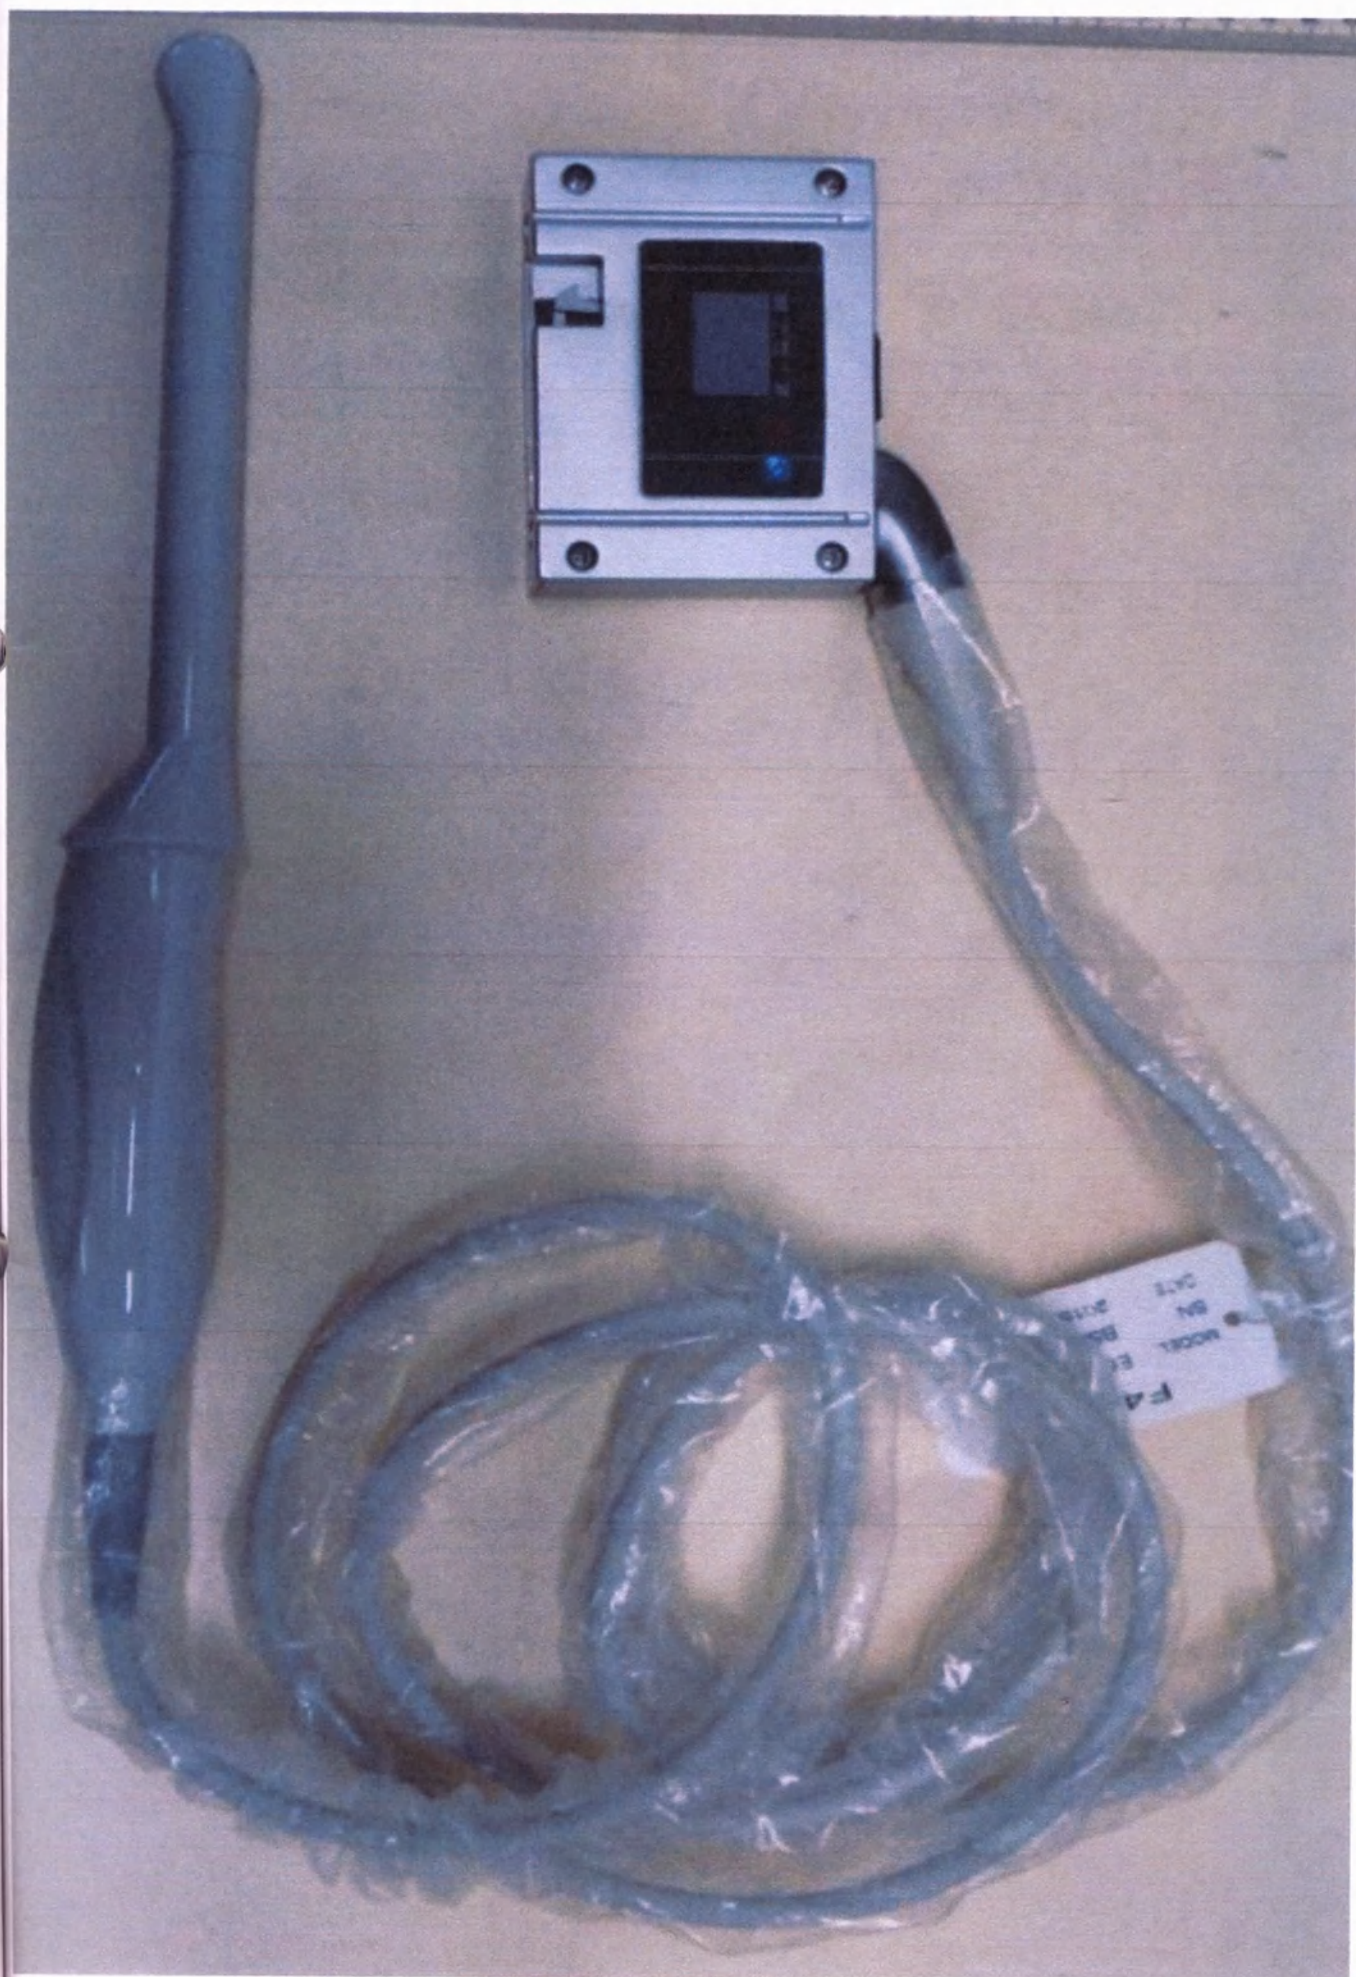


Рисунок 10 - Датчик УЗ F4-9E (в транспортировочной защитной пленке)

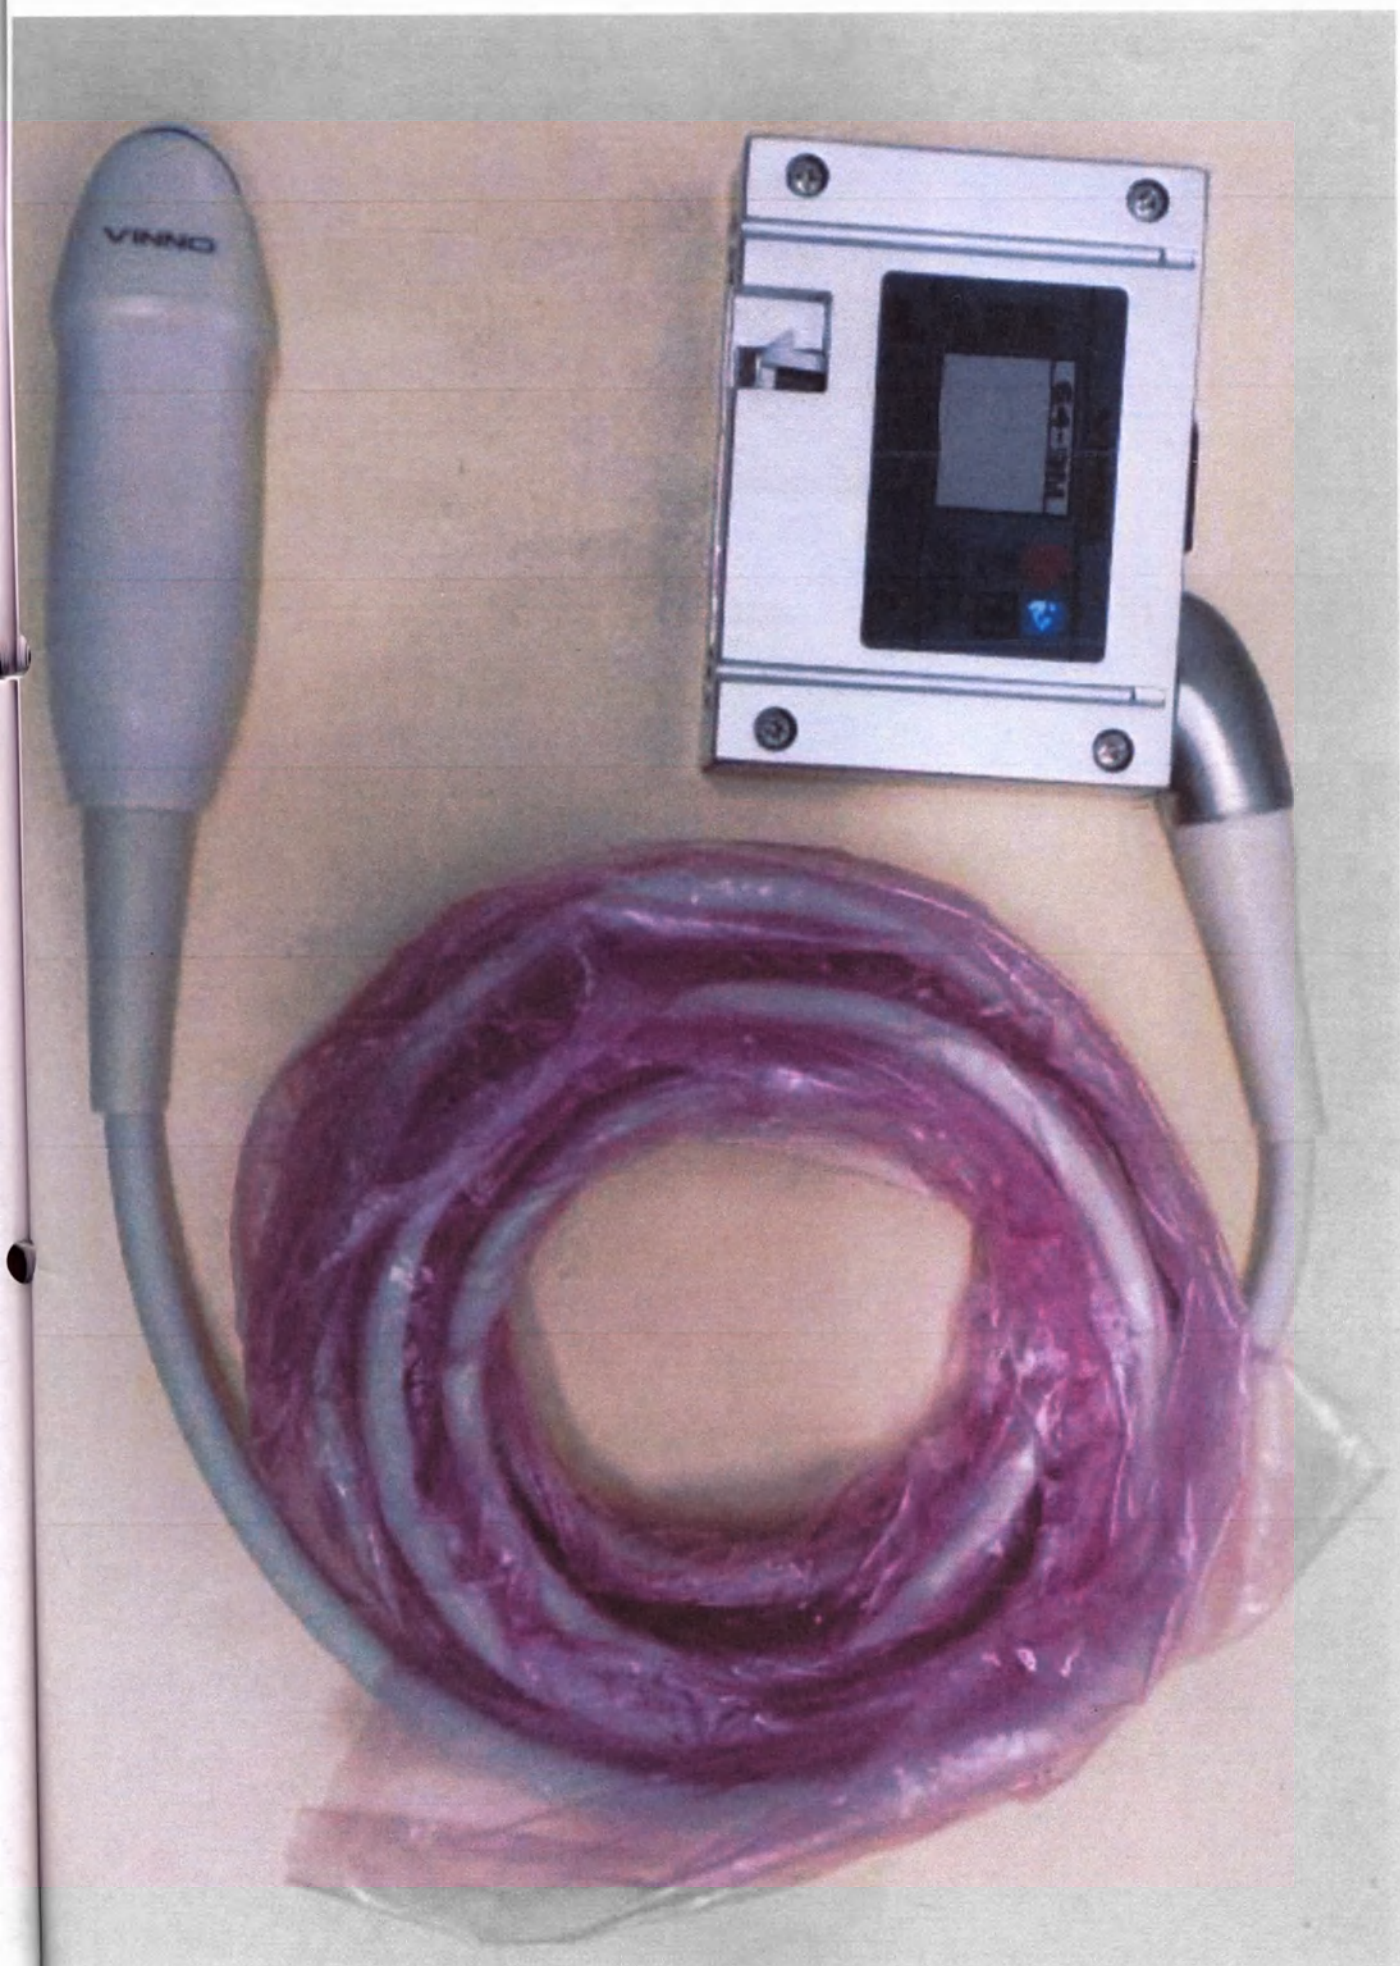


Рисунок 11 - Датчик УЗ G4-9М (в транспортировочной защитной пленке)

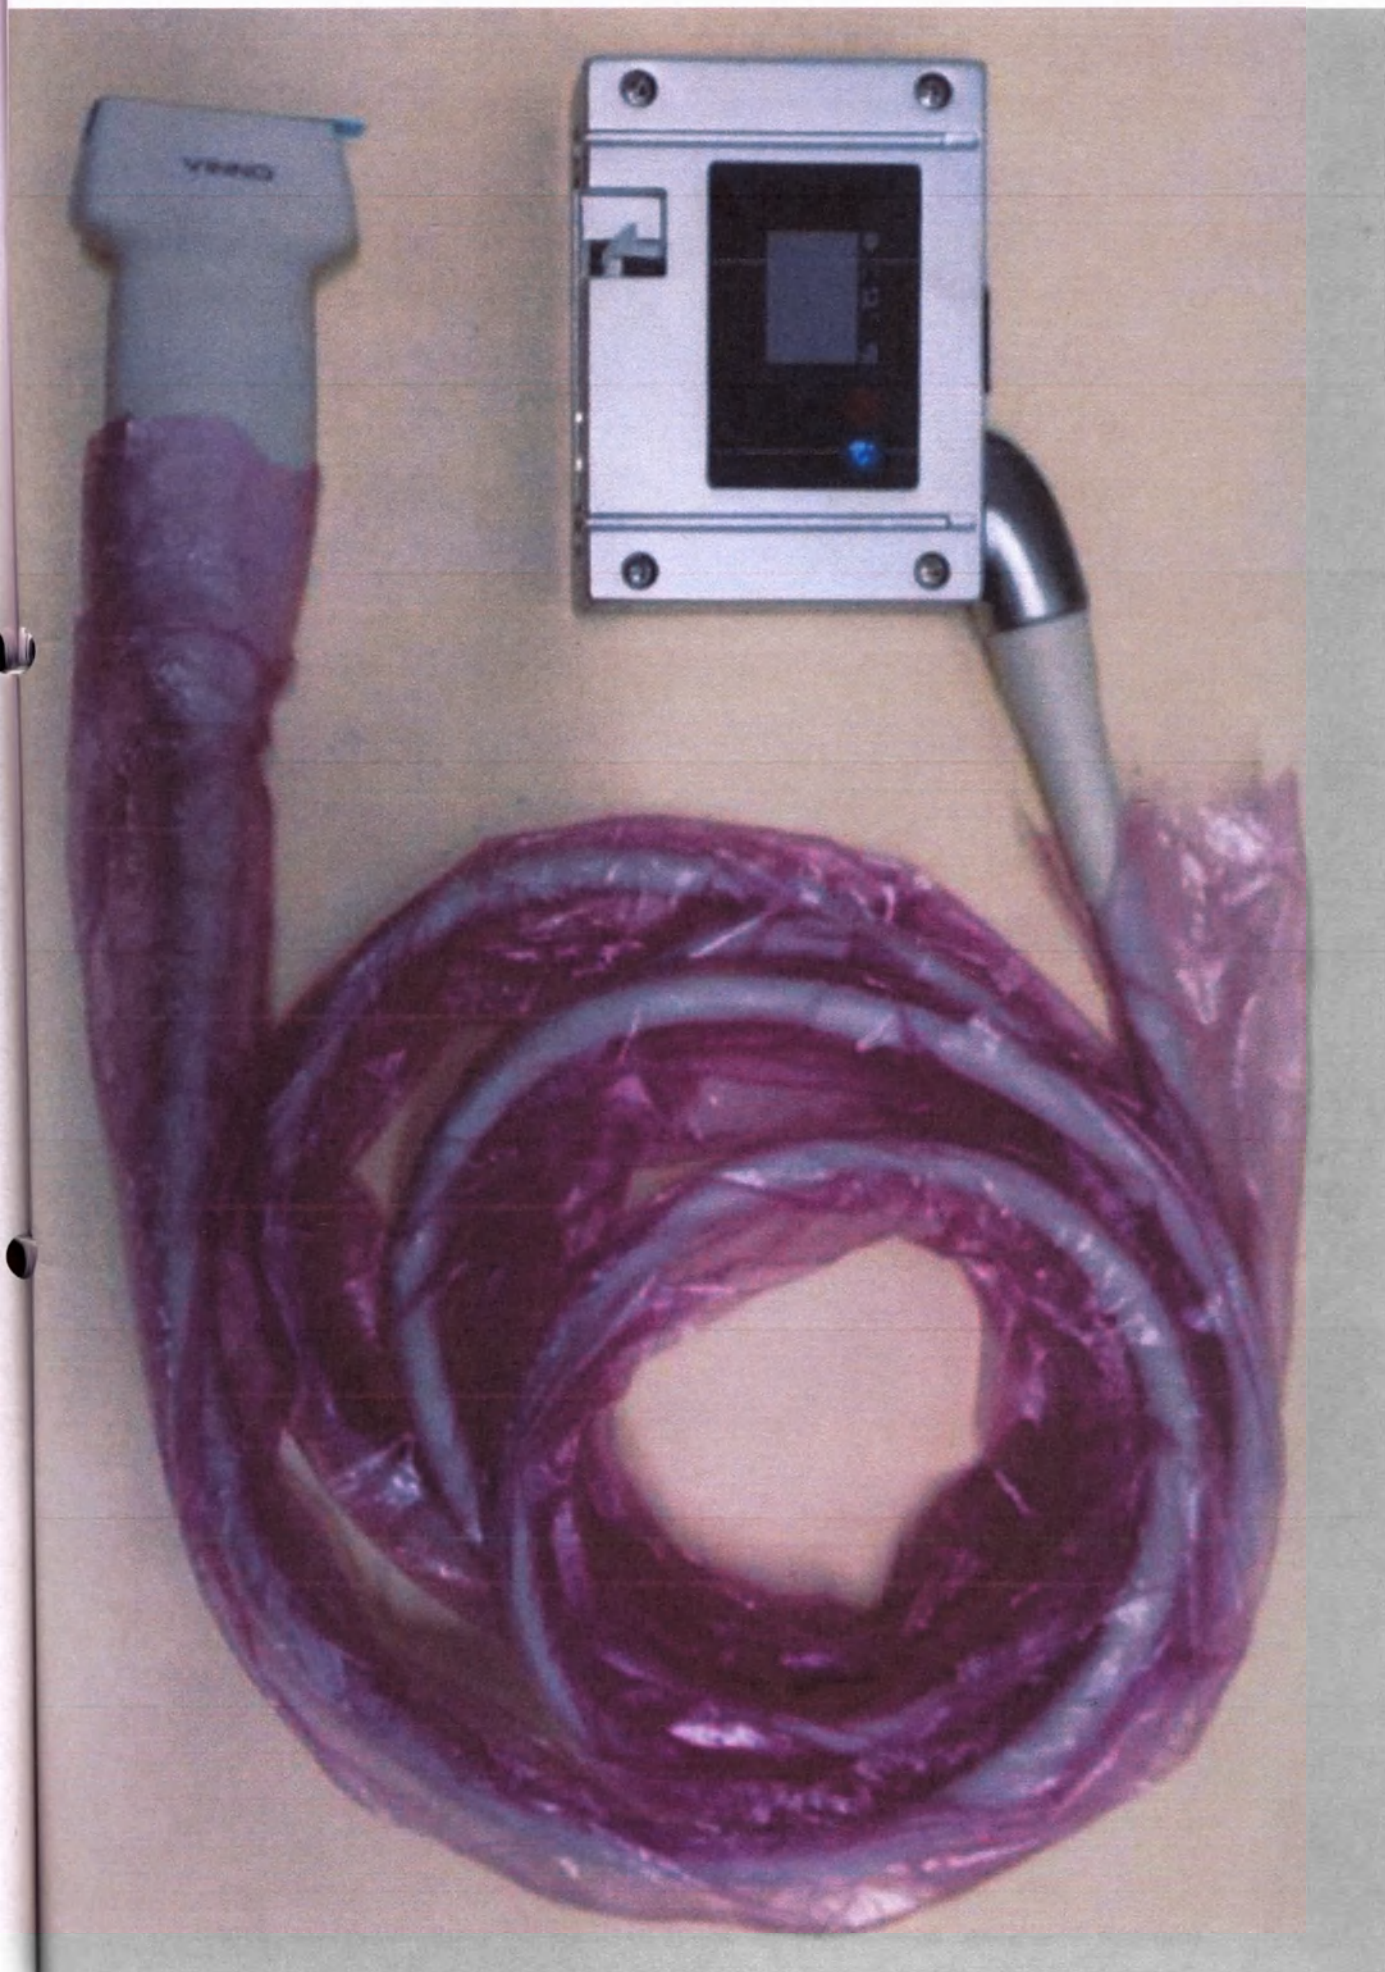


Рисунок 12 - Датчик УЗ X4-12L (в транспортировочной защитной пленке)

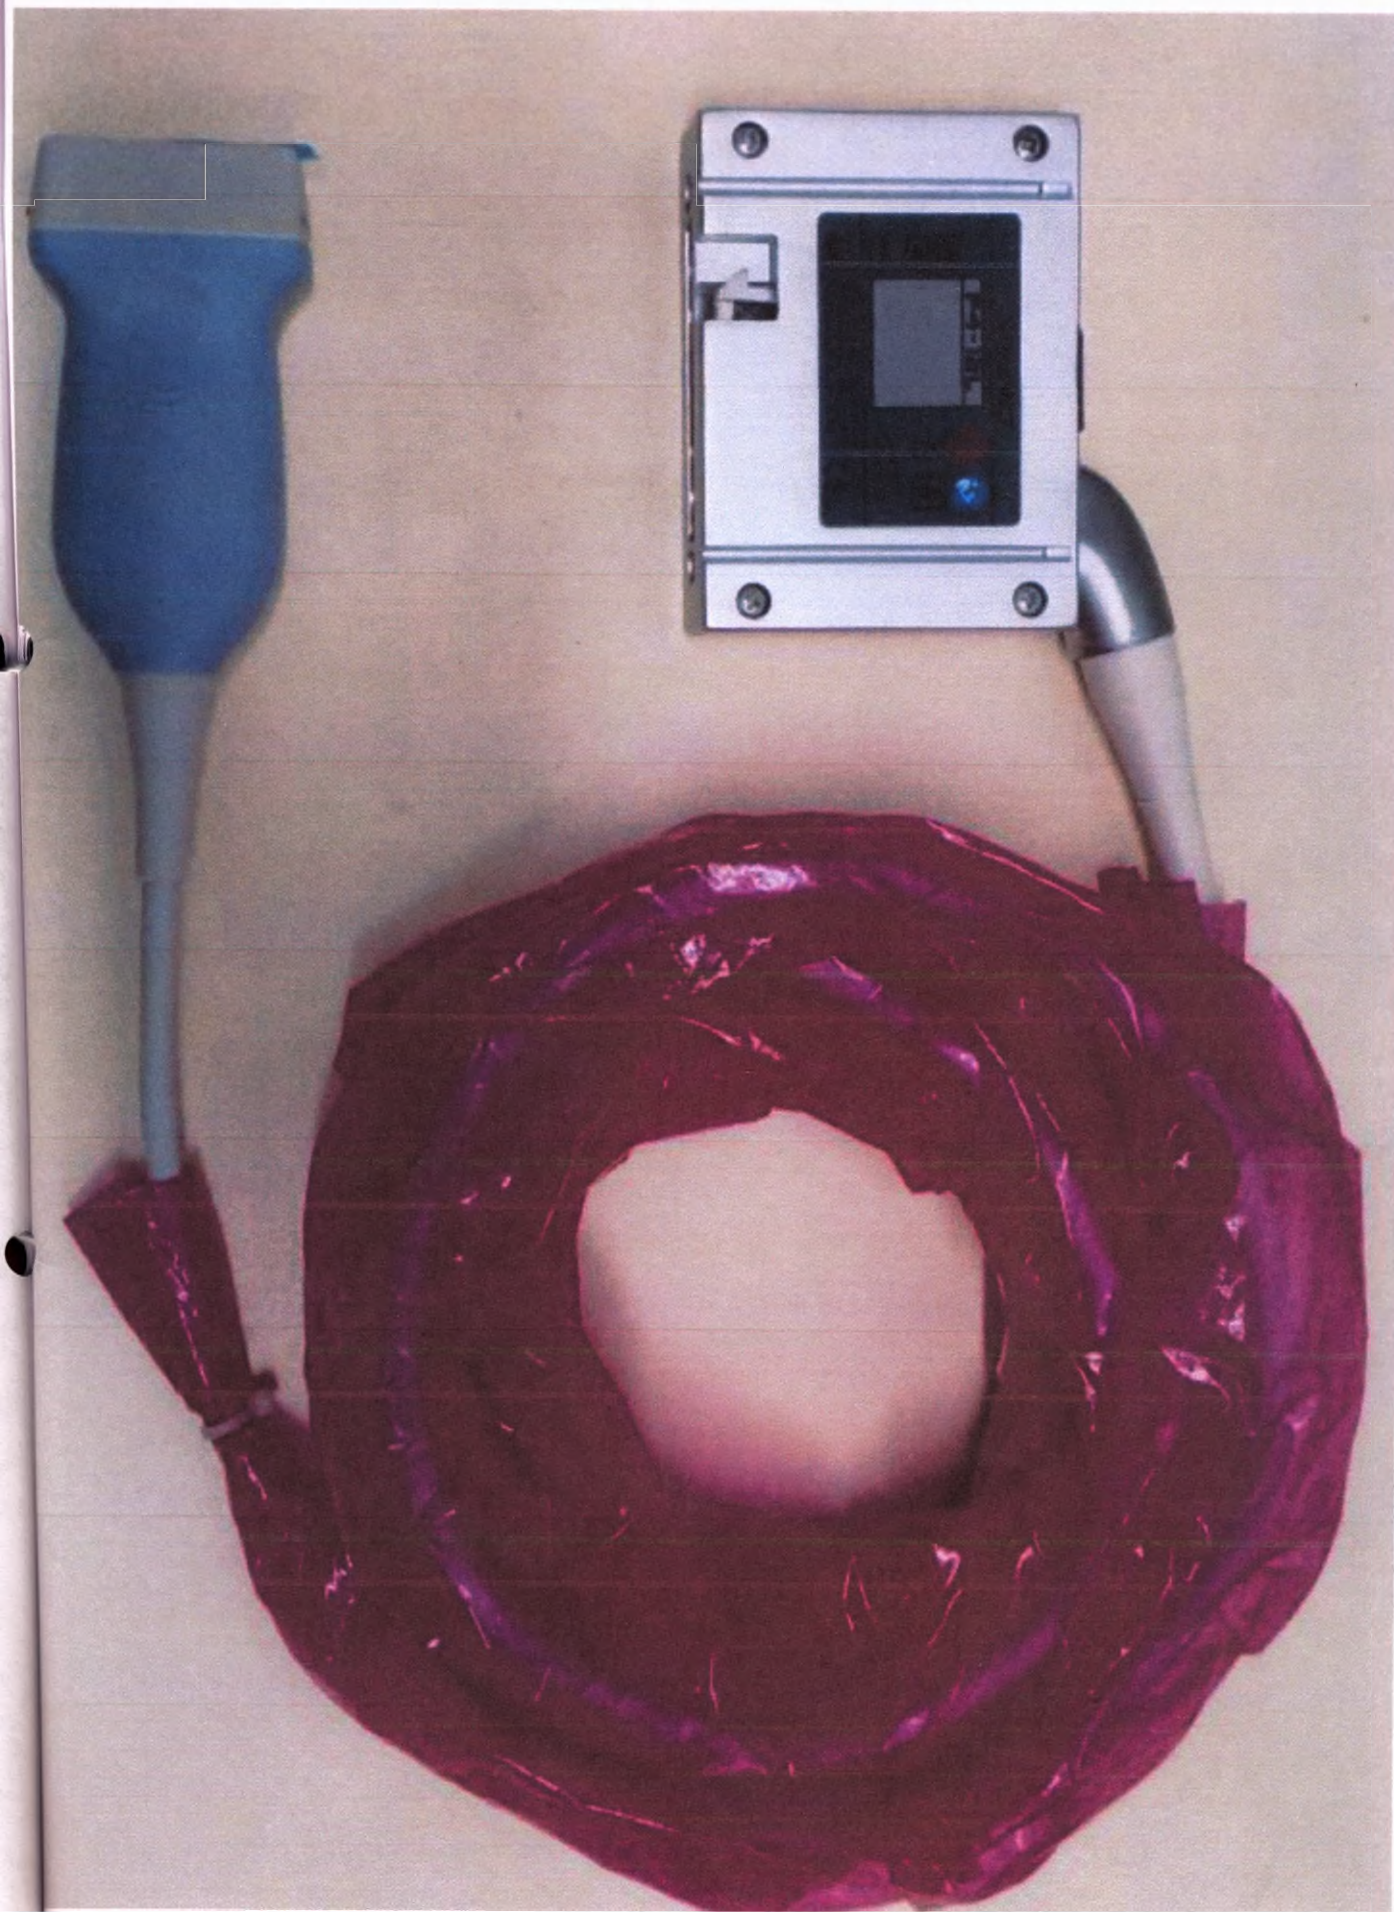


Рисунок 13 - Датчик УЗ F4-12L (в транспортировочной защитной пленке)



Рисунок 14 - Датчик УЗ D3-6C (в транспортировочной защитной пленке)

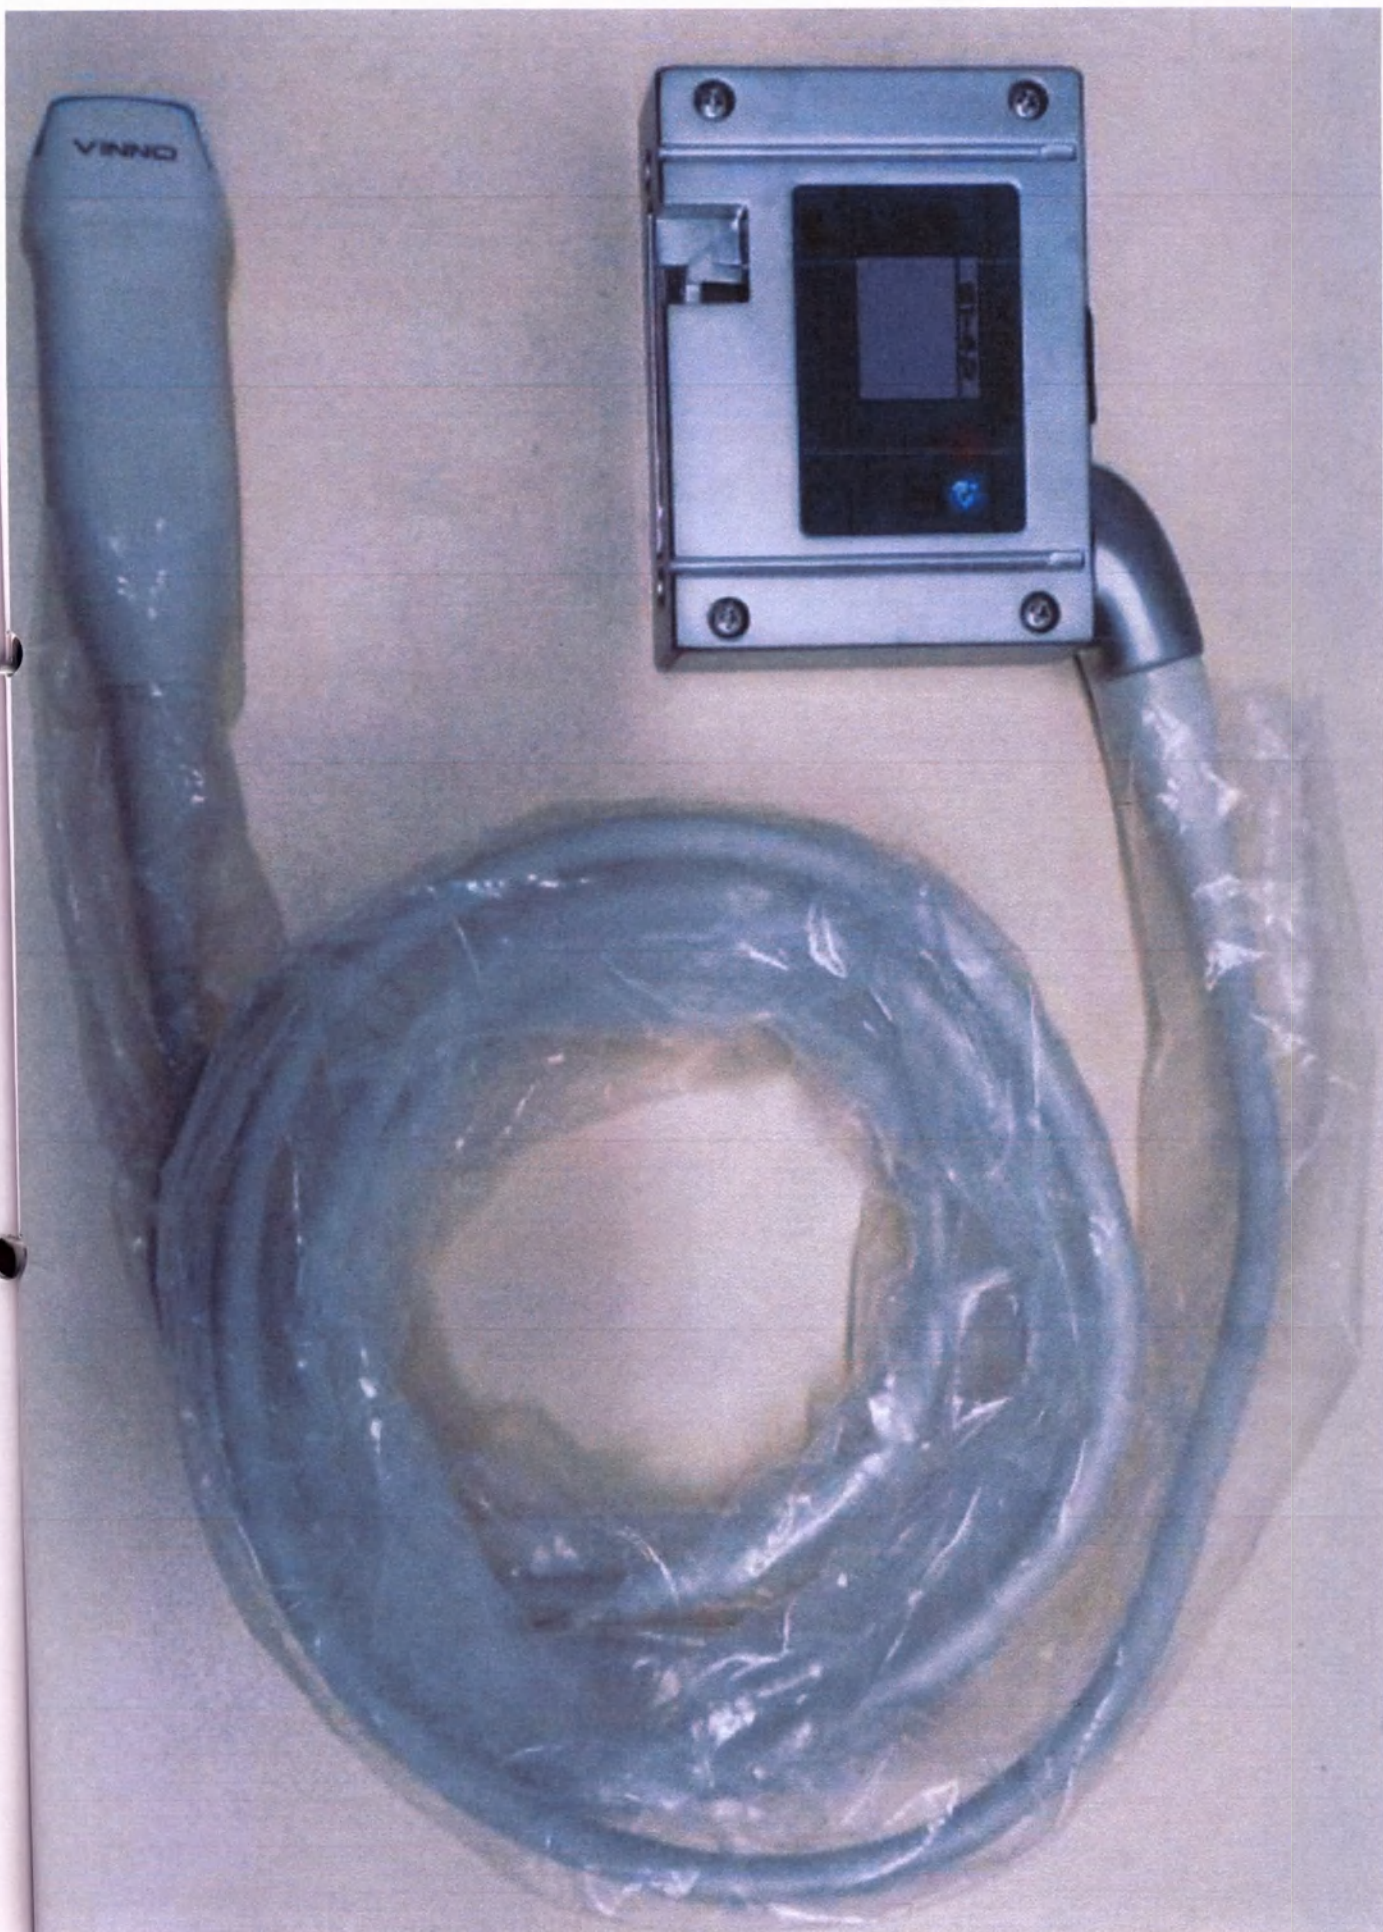


Рисунок 15 - Датчик УЗ G1-4P (в транспортировочной защитной пленке)

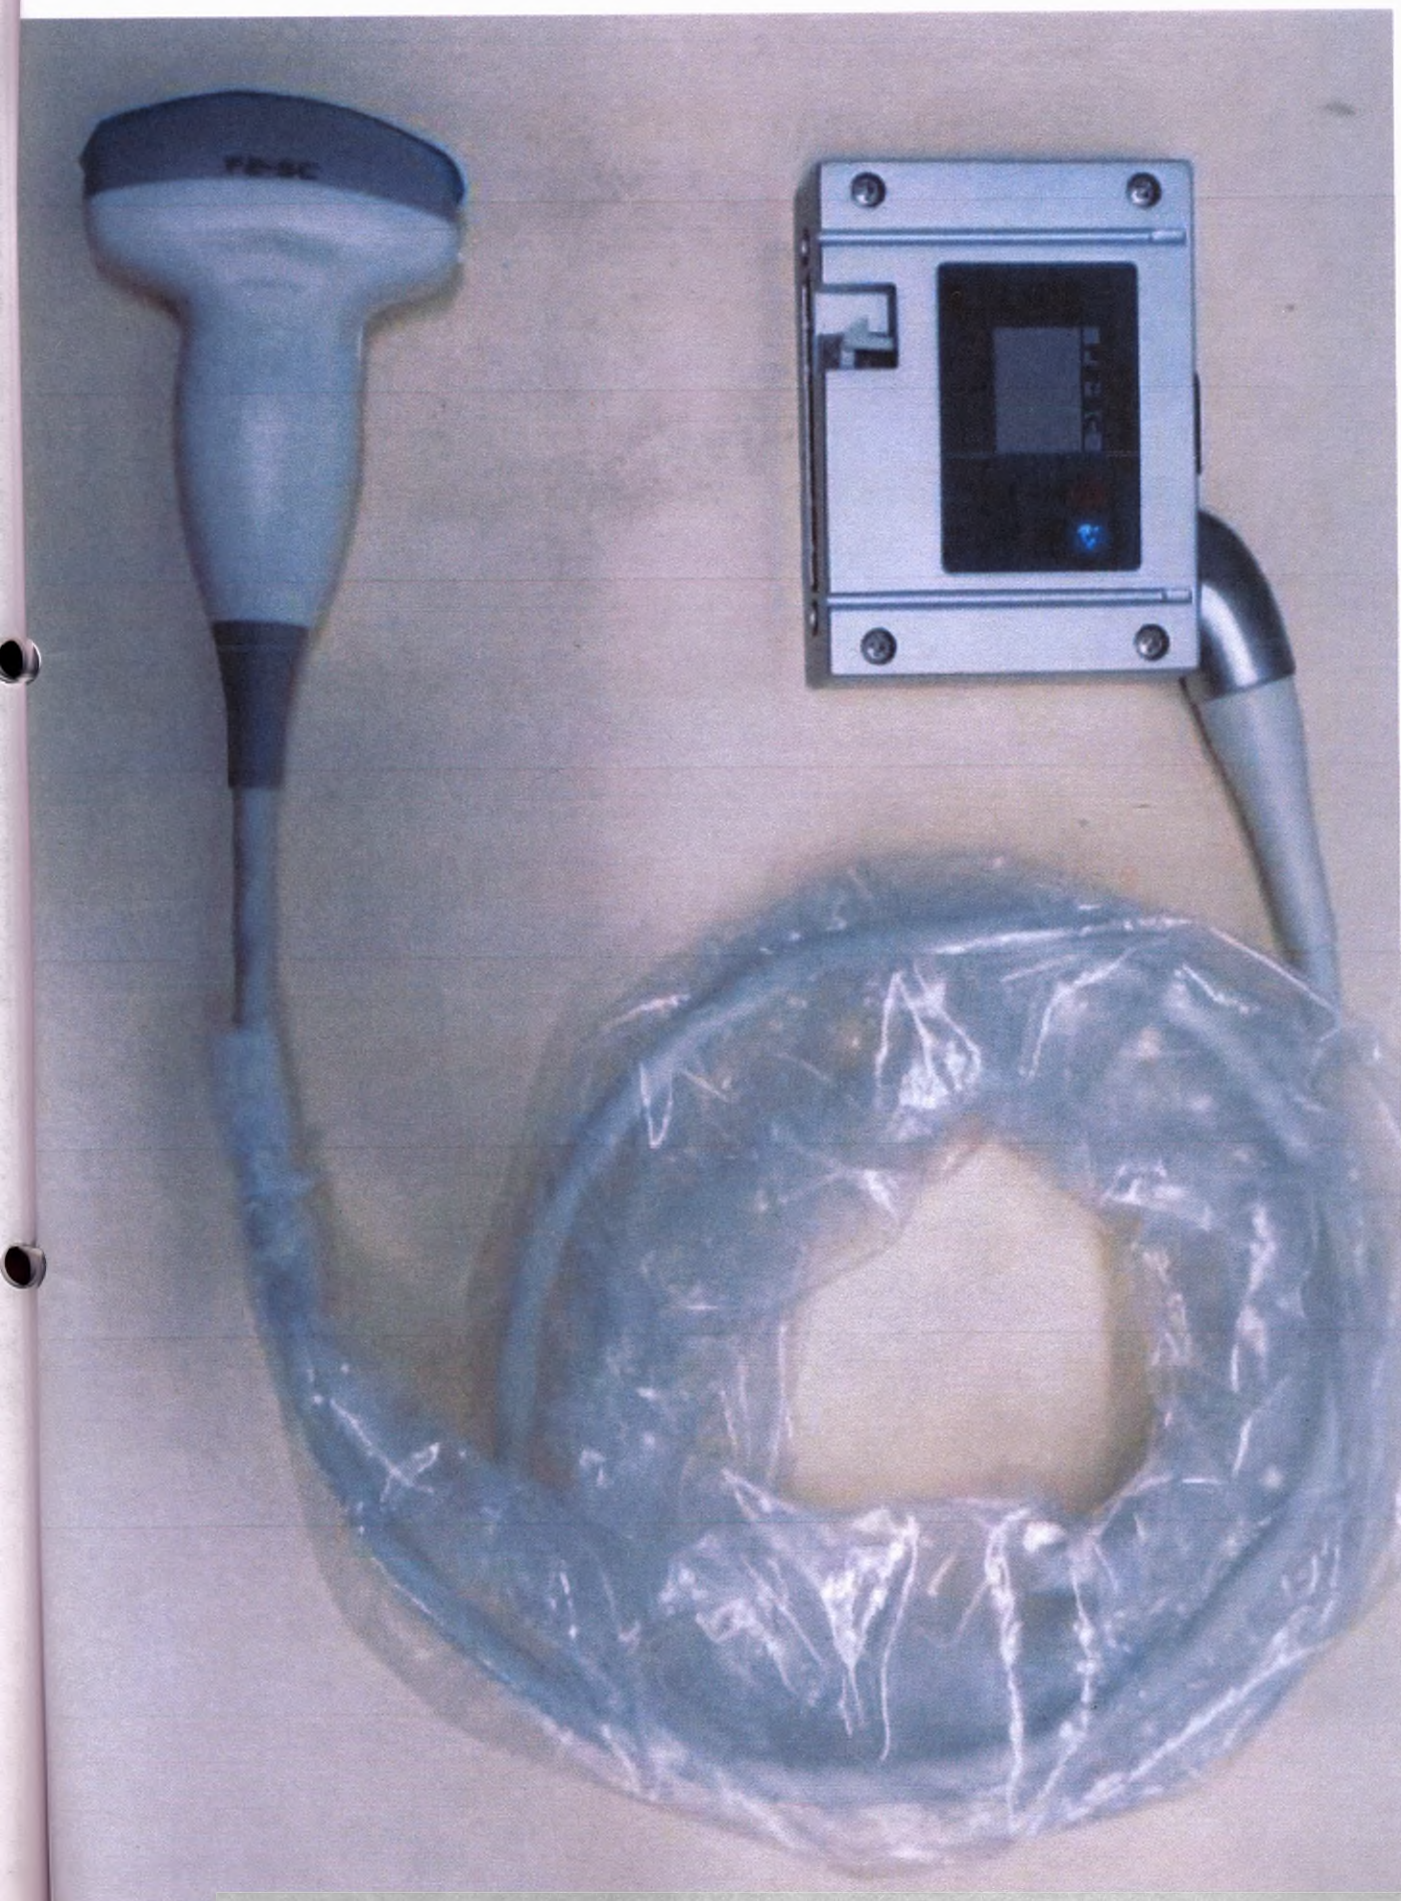


Рисунок 16 - Датчик УЗ F2-5C (в транспортировочной защитной пленке)



Рисунок 17 - Датчик УЗ G2-5C (в транспортировочной защитной пленке)

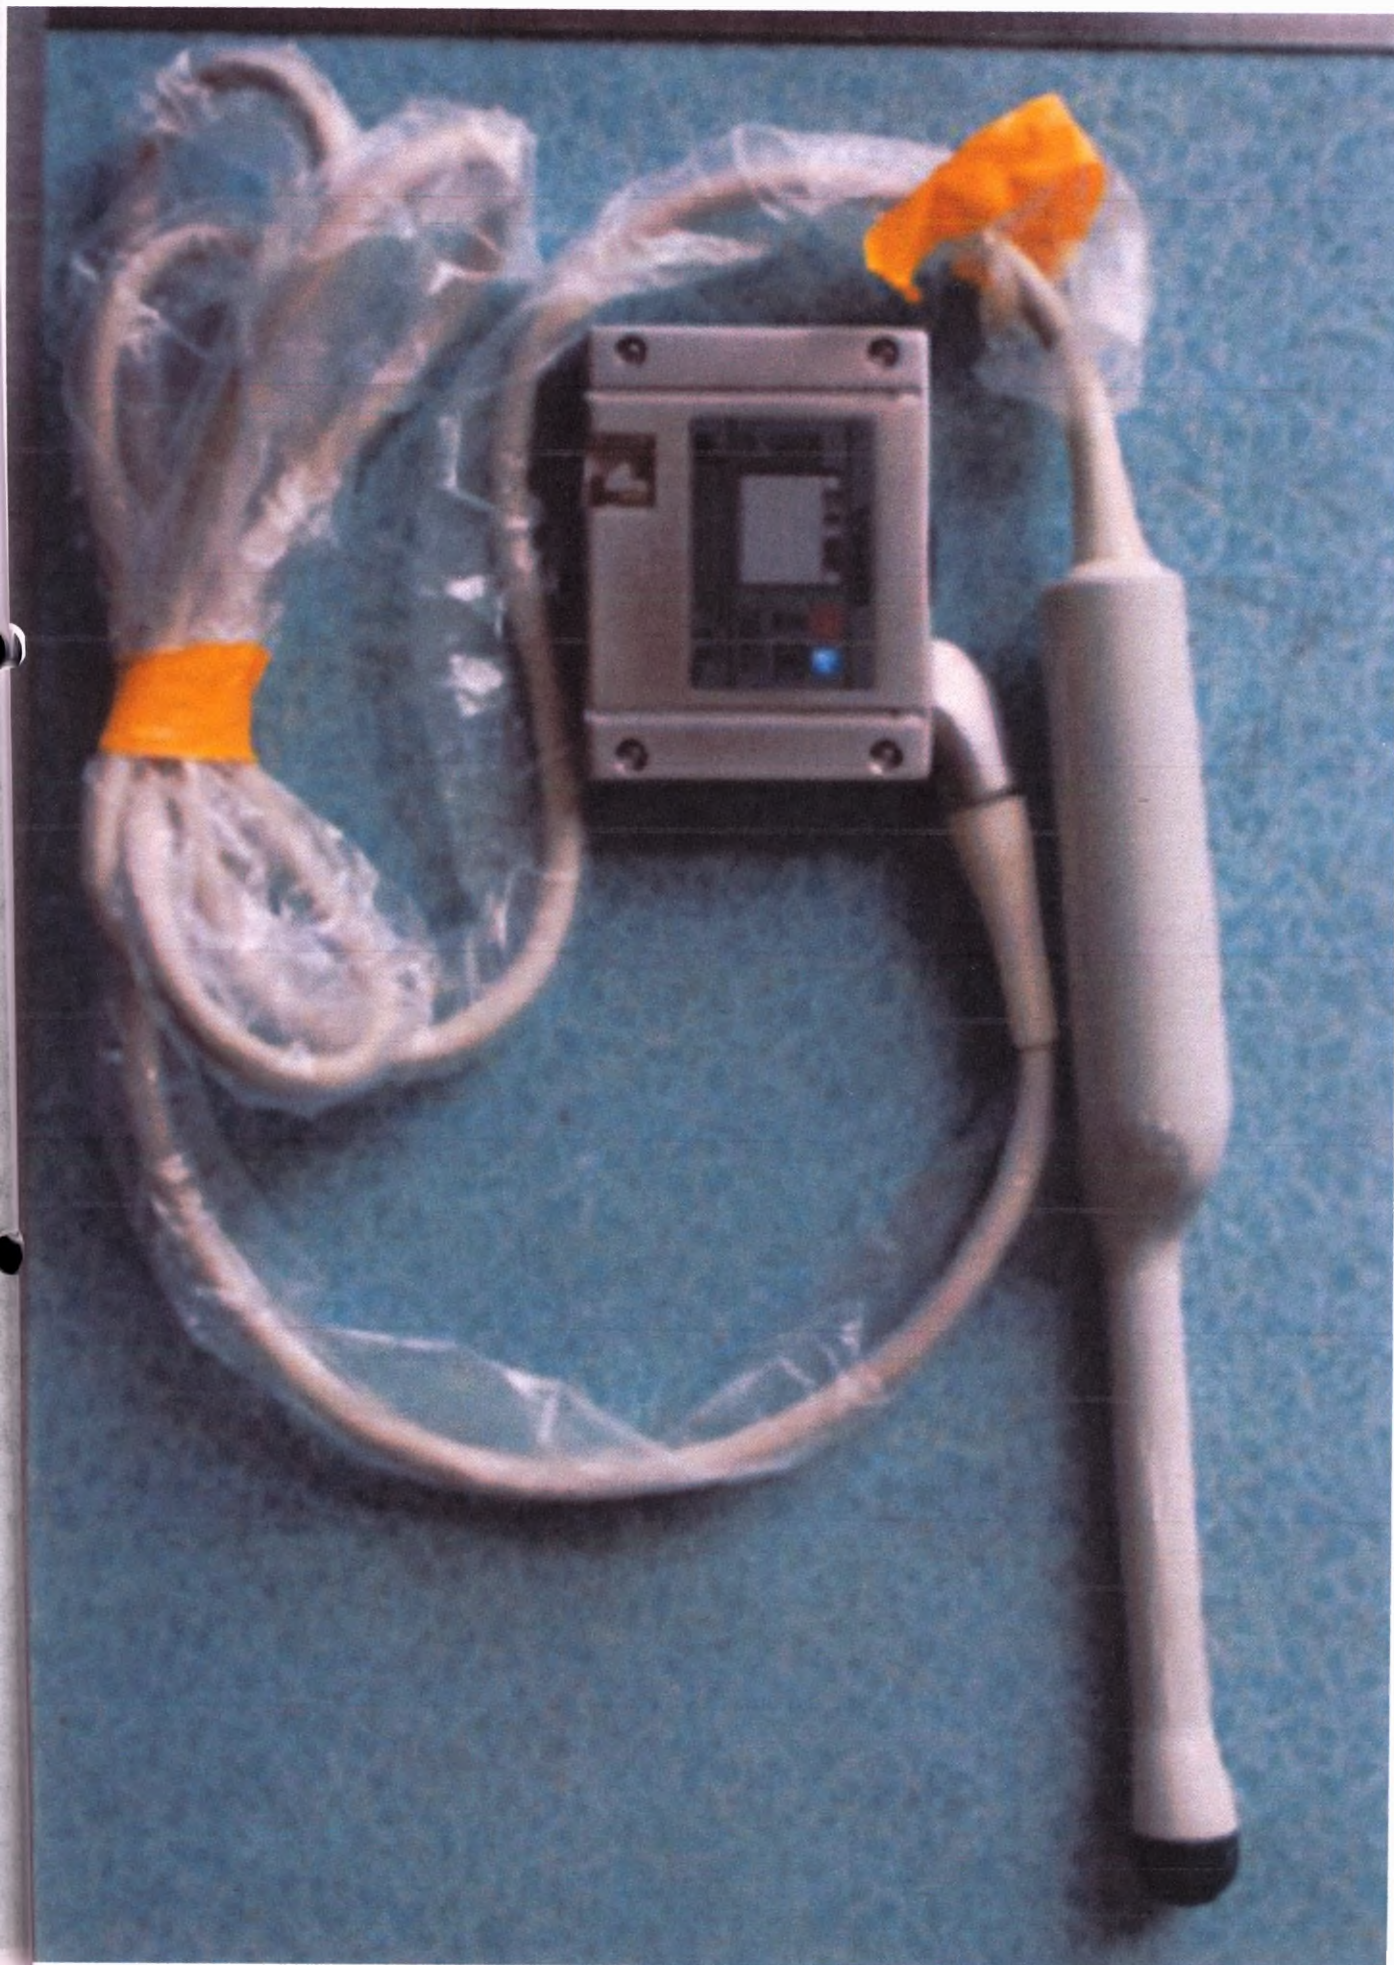


Рисунок 18 - Датчик УЗ D4-9Е (в транспортировочной защитной пленке)



Рисунок 19 - Датчик УЗ Х6-16L (в транспортировочной защитной пленке)



Рисунок 20 - Датчик УЗ U5-15LE (в транспортировочной защитной пленке)

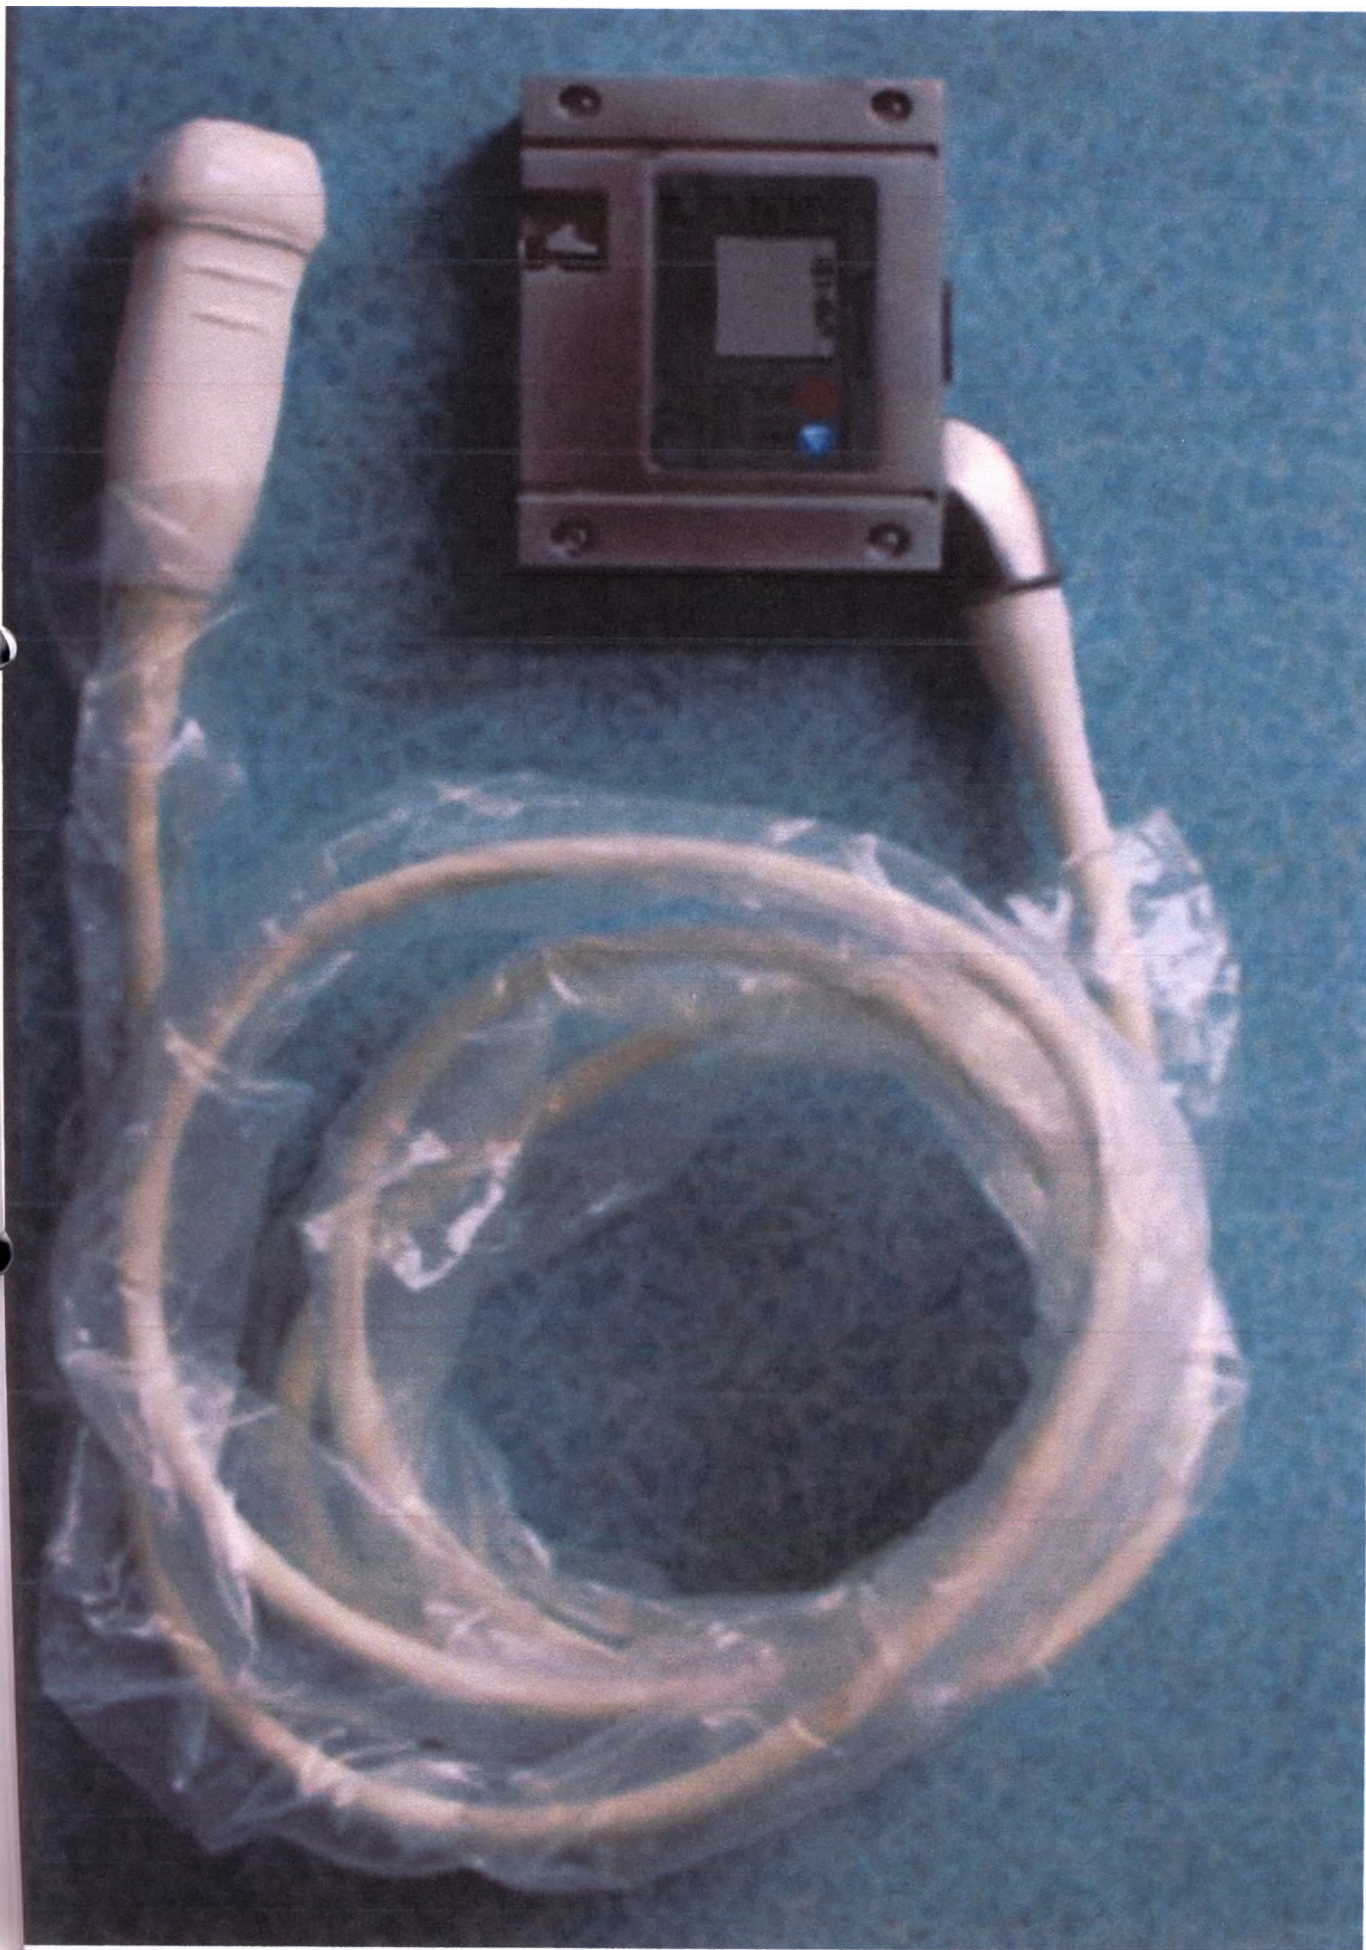


Рисунок 21 - Датчик УЗ S1-6P (в транспортировочной защитной пленке)



Рисунок 22 - S-video кабель



Рисунок 23 - DVI-D кабель



Рисунок 24 - Привод оптический, кабель привода оптического (поставляется соединенным с приводом оптическим)

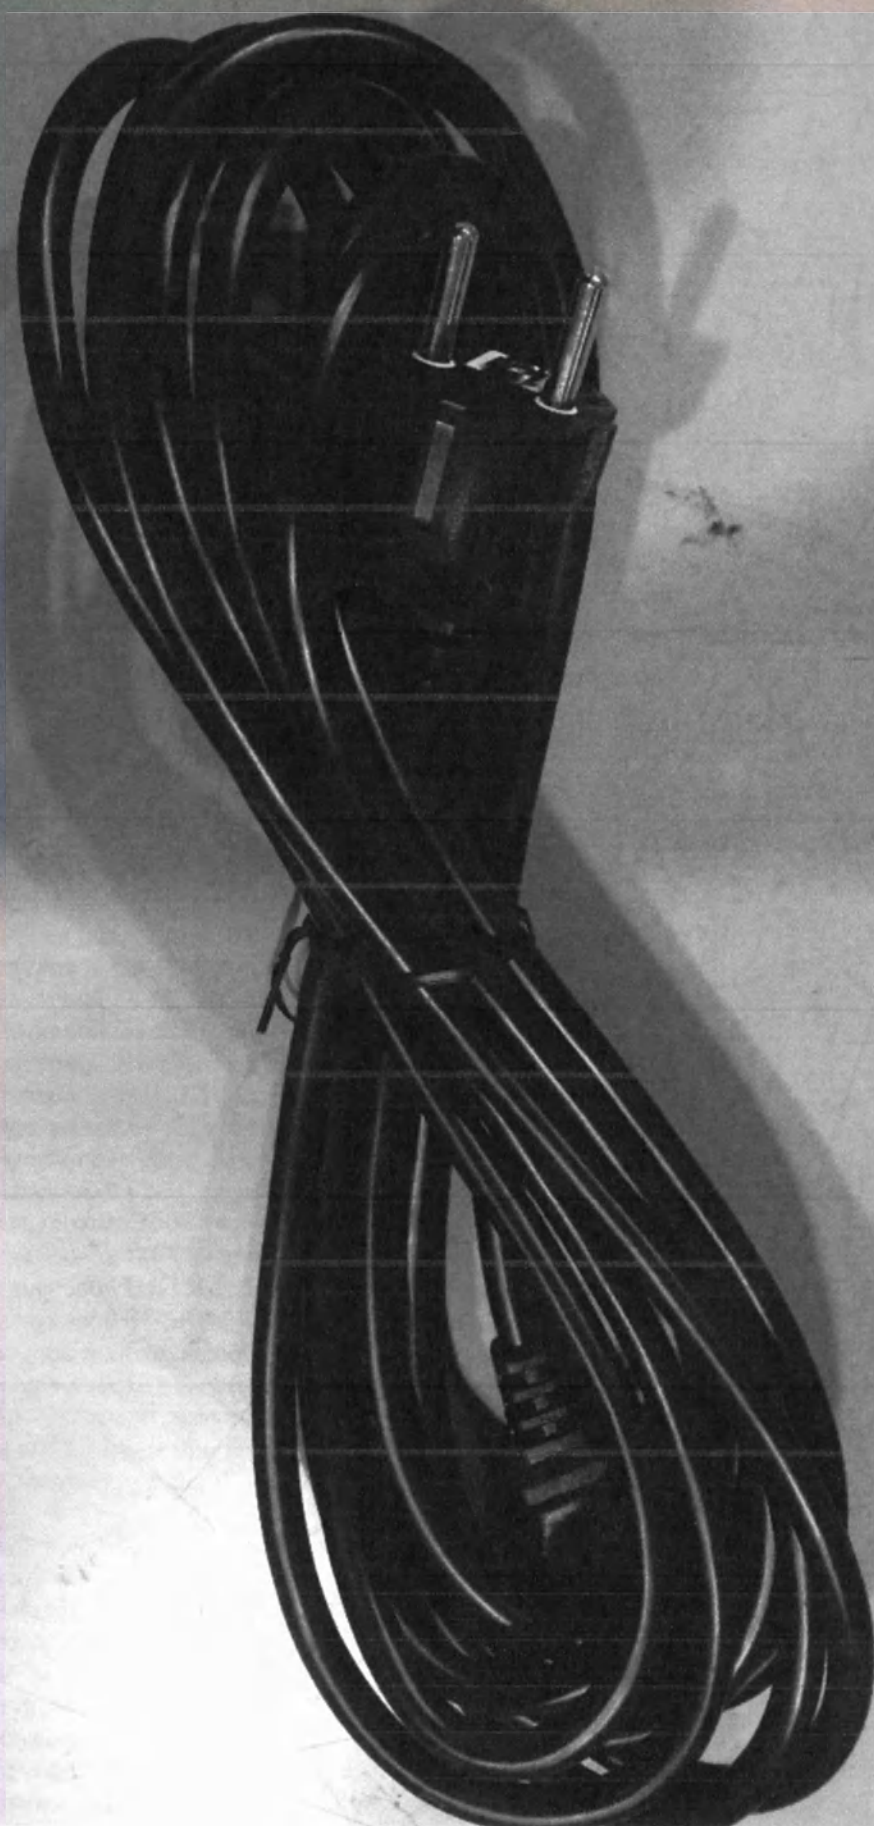


Рисунок 25 Кабель питания блока ультразвукового

ПРИЛОЖЕНИЕ

Аппарат ультразвуковой диагностический цифровой

В вариантах исполнения:

Аппарат ультразвуковой диагностический цифровой VINNO E20

- 1) Блок ультразвуковой VINNO E20 – 1 шт.;
- 2) Насадка биопсийная LPGF, REF 3100130 (при необходимости) – 1 шт.;
- 3) Насадка биопсийная LPEN (при необходимости) – 1 шт.;
- 4) Насадка биопсийная LPGF, REF 3100096 (при необходимости) – 1 шт.;
- 5) Датчик ультразвуковой G4-9E (при необходимости) – 1 шт.;
- 6) Датчик ультразвуковой F4-9E (при необходимости) – 1 шт.;
- 7) Датчик ультразвуковой G4-9M (при необходимости) – 1 шт.;
- 8) Датчик ультразвуковой X4-12L (при необходимости) – 1 шт.;
- 9) Датчик ультразвуковой F4-12L (при необходимости) – 1 шт.;
- 10) Датчик ультразвуковой D3-6C (при необходимости) – 1 шт.;
- 11) Датчик ультразвуковой G1-4P (при необходимости) – 1 шт.;
- 12) Датчик ультразвуковой F2-5C (при необходимости) – 1 шт.;
- 13) Датчик ультразвуковой G2-5C (при необходимости) – 1 шт.;
- 14) Датчик ультразвуковой D4-9E (при необходимости) – 1 шт.;
- 15) Датчик ультразвуковой X6-16L (при необходимости) – 1 шт.;
- 16) Датчик ультразвуковой U5-15LE (при необходимости) – 1 шт.;
- 17) Датчик ультразвуковой S1-6P (при необходимости) – 1 шт.;
- 18) S-Video кабель (при необходимости) – 1 шт.;
- 19) DVI-D кабель (при необходимости) – 1 шт.;
- 20) Кабель питания блока ультразвукового – 1 шт.;
- 21) Привод оптический (при необходимости) – 1 шт.;
- 22) Руководство по эксплуатации – 1 шт.;

Аппарат ультразвуковой диагностический цифровой VINNO E10

- 1) Блок ультразвуковой VINNO E10 – 1 шт.;
- 2) Насадка биопсийная LPGF, REF 3100130 (при необходимости) – 1 шт.;
- 3) Насадка биопсийная LPEN (при необходимости) – 1 шт.;
- 4) Насадка биопсийная LPGF, REF 3100096 (при необходимости) – 1 шт.;
- 5) Датчик ультразвуковой G4-9E (при необходимости) – 1 шт.;
- 6) Датчик ультразвуковой F4-9E (при необходимости) – 1 шт.;
- 7) Датчик ультразвуковой G4-9M (при необходимости) – 1 шт.;
- 8) Датчик ультразвуковой X4-12L (при необходимости) – 1 шт.;
- 9) Датчик ультразвуковой F4-12L (при необходимости) – 1 шт.;
- 10) Датчик ультразвуковой D3-6C (при необходимости) – 1 шт.;
- 11) Датчик ультразвуковой G1-4P (при необходимости) – 1 шт.;
- 12) Датчик ультразвуковой F2-5C (при необходимости) – 1 шт.;
- 13) Датчик ультразвуковой G2-5C (при необходимости) – 1 шт.;
- 14) Датчик ультразвуковой D4-9E (при необходимости) – 1 шт.;
- 15) Датчик ультразвуковой U5-15LE (при необходимости) – 1 шт.;
- 16) Датчик ультразвуковой S1-6P (при необходимости) – 1 шт.;
- 17) S-Video кабель (при необходимости) – 1 шт.;
- 18) DVI-D кабель (при необходимости) – 1 шт.;
- 19) Кабель питания блока ультразвукового – 1 шт.;
- 20) Привод оптический (при необходимости) – 1 шт.;
- 21) Руководство по эксплуатации – 1 шт.;

Аппарат ультразвуковой диагностический цифровой VINNO X3

- 1) Блок ультразвуковой VINNO X3 – 1 шт.;
- 2) Насадка биопсийная LPGF, REF 3100130 (при необходимости) – 1 шт.;
- 3) Насадка биопсийная LPEN (при необходимости) – 1 шт.;
- 4) Насадка биопсийная LPGF, REF 3100096 (при необходимости) – 1 шт.;
- 5) Датчик ультразвуковой G4-9E (при необходимости) – 1 шт.;
- 6) Датчик ультразвуковой F4-9E (при необходимости) – 1 шт.;
- 7) Датчик ультразвуковой G4-9M (при необходимости) – 1 шт.;
- 8) Датчик ультразвуковой X4-12L (при необходимости) – 1 шт.;
- 9) Датчик ультразвуковой F4-12L (при необходимости) – 1 шт.;
- 10) Датчик ультразвуковой D3-6C (при необходимости) – 1 шт.;

- 11) Датчик ультразвуковой G1-4P (при необходимости) – 1 шт.;
- 12) Датчик ультразвуковой F2-5C (при необходимости) – 1 шт.;
- 13) Датчик ультразвуковой G2-5C (при необходимости) – 1 шт.;
- 14) Датчик ультразвуковой D4-9E (при необходимости) – 1 шт.;
- 15) Датчик ультразвуковой X6-16L (при необходимости) – 1 шт.;
- 16) Датчик ультразвуковой U5-15LE (при необходимости) – 1 шт.;
- 17) Датчик ультразвуковой S1-6P (при необходимости) – 1 шт.;
- 18) S-Video кабель (при необходимости) – 1 шт.;
- 19) DVI-D кабель (при необходимости) – 1 шт.;
- 20) Кабель питания блока ультразвукового – 1 шт.;
- 21) Привод оптический (при необходимости) – 1 шт.;
- 22) Руководство по эксплуатации – 1 шт.;

Аппарат ультразвуковой диагностический цифровой VINNO X2

- 1) Блок ультразвуковой VINNO X2 – 1 шт.;
- 2) Насадка биопсийная LPGF, REF 3100130 (при необходимости) – 1 шт.;
- 3) Насадка биопсийная LPEN (при необходимости) – 1 шт.;
- 4) Насадка биопсийная LPGF, REF 3100096 (при необходимости) – 1 шт.;
- 5) Датчик ультразвуковой G4-9E (при необходимости) – 1 шт.;
- 6) Датчик ультразвуковой F4-9E (при необходимости) – 1 шт.;
- 7) Датчик ультразвуковой G4-9M (при необходимости) – 1 шт.;
- 8) Датчик ультразвуковой X4-12L (при необходимости) – 1 шт.;
- 9) Датчик ультразвуковой F4-12L (при необходимости) – 1 шт.;
- 10) Датчик ультразвуковой D3-6C (при необходимости) – 1 шт.;
- 11) Датчик ультразвуковой G1-4P (при необходимости) – 1 шт.;
- 12) Датчик ультразвуковой F2-5C (при необходимости) – 1 шт.;
- 13) Датчик ультразвуковой G2-5C (при необходимости) – 1 шт.;
- 14) Датчик ультразвуковой D4-9E (при необходимости) – 1 шт.;
- 15) Датчик ультразвуковой X6-16L (при необходимости) – 1 шт.;
- 16) Датчик ультразвуковой U5-15LE (при необходимости) – 1 шт.;
- 17) Датчик ультразвуковой S1-6P (при необходимости) – 1 шт.;
- 18) S-Video кабель (при необходимости) – 1 шт.;
- 19) DVI-D кабель (при необходимости) – 1 шт.;
- 20) Кабель питания блока ультразвукового – 1 шт.;
- 21) Привод оптический (при необходимости) – 1 шт.;
- 22) Руководство по эксплуатации – 1 шт.;

Аппарат ультразвуковой диагностический цифровой VINNO X1

- 1) Блок ультразвуковой VINNO X1 – 1 шт.;
- 2) Насадка биопсийная LPGF, REF 3100130 (при необходимости) – 1 шт.;
- 3) Насадка биопсийная LPEN (при необходимости) – 1 шт.;
- 4) Насадка биопсийная LPGF, REF 3100096 (при необходимости) – 1 шт.;
- 5) Датчик ультразвуковой G4-9E (при необходимости) – 1 шт.;
- 6) Датчик ультразвуковой F4-9E (при необходимости) – 1 шт.;
- 7) Датчик ультразвуковой G4-9M (при необходимости) – 1 шт.;
- 8) Датчик ультразвуковой F4-12L (при необходимости) – 1 шт.;
- 9) Датчик ультразвуковой D3-6C (при необходимости) – 1 шт.;
- 10) Датчик ультразвуковой G1-4P (при необходимости) – 1 шт.;
- 11) Датчик ультразвуковой F2-5C (при необходимости) – 1 шт.;
- 12) Датчик ультразвуковой G2-5C (при необходимости) – 1 шт.;
- 13) Датчик ультразвуковой D4-9E (при необходимости) – 1 шт.;
- 14) Датчик ультразвуковой U5-15LE (при необходимости) – 1 шт.;
- 15) Датчик ультразвуковой S1-6P (при необходимости) – 1 шт.;
- 16) S-Video кабель (при необходимости) – 1 шт.;
- 17) DVI-D кабель (при необходимости) – 1 шт.;
- 18) Кабель питания блока ультразвукового – 1 шт.;
- 19) Привод оптический (при необходимости) – 1 шт.;
- 20) Руководство по эксплуатации – 1 шт.;

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 27 листа (-ов)

Генеральный Директор Носова Т.А. / Носова Т.А.
М.П.

