



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

«Буферный раствор PAD для определения группы крови и резус фактора, в вариантах исполнения»

I. PAD Буфер, в составе:


1. PAD Буфер (5 флаконов x 50 мл).
2. Инструкция по применению – 1 шт.

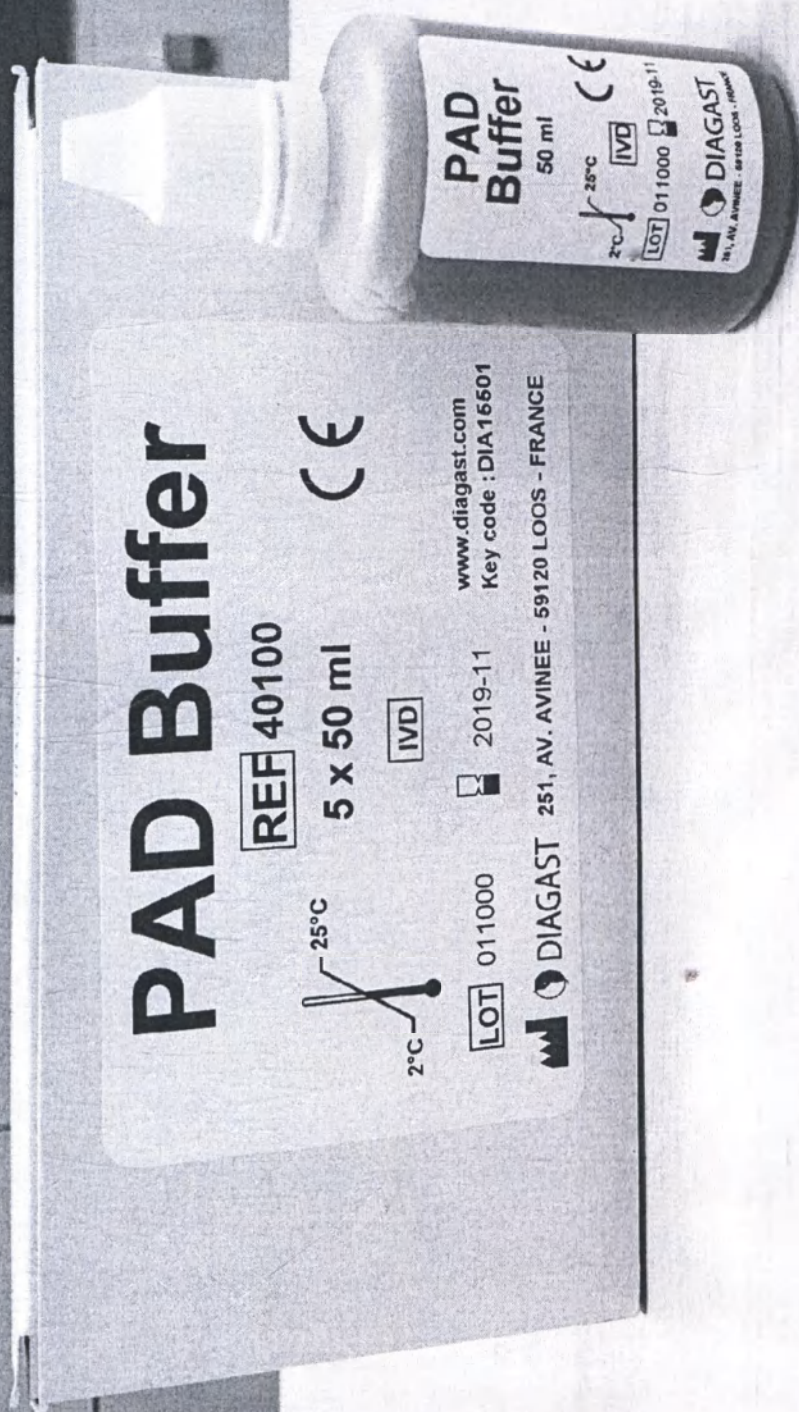


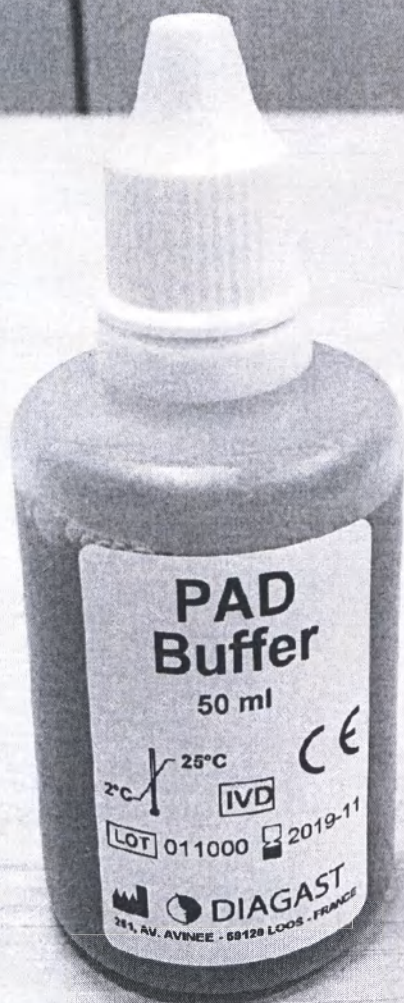


I. PAD Буфер 500, в составе:

1. PAD Буфер (1 флакон х 500 мл).
2. Инструкция по применению – 1 шт.

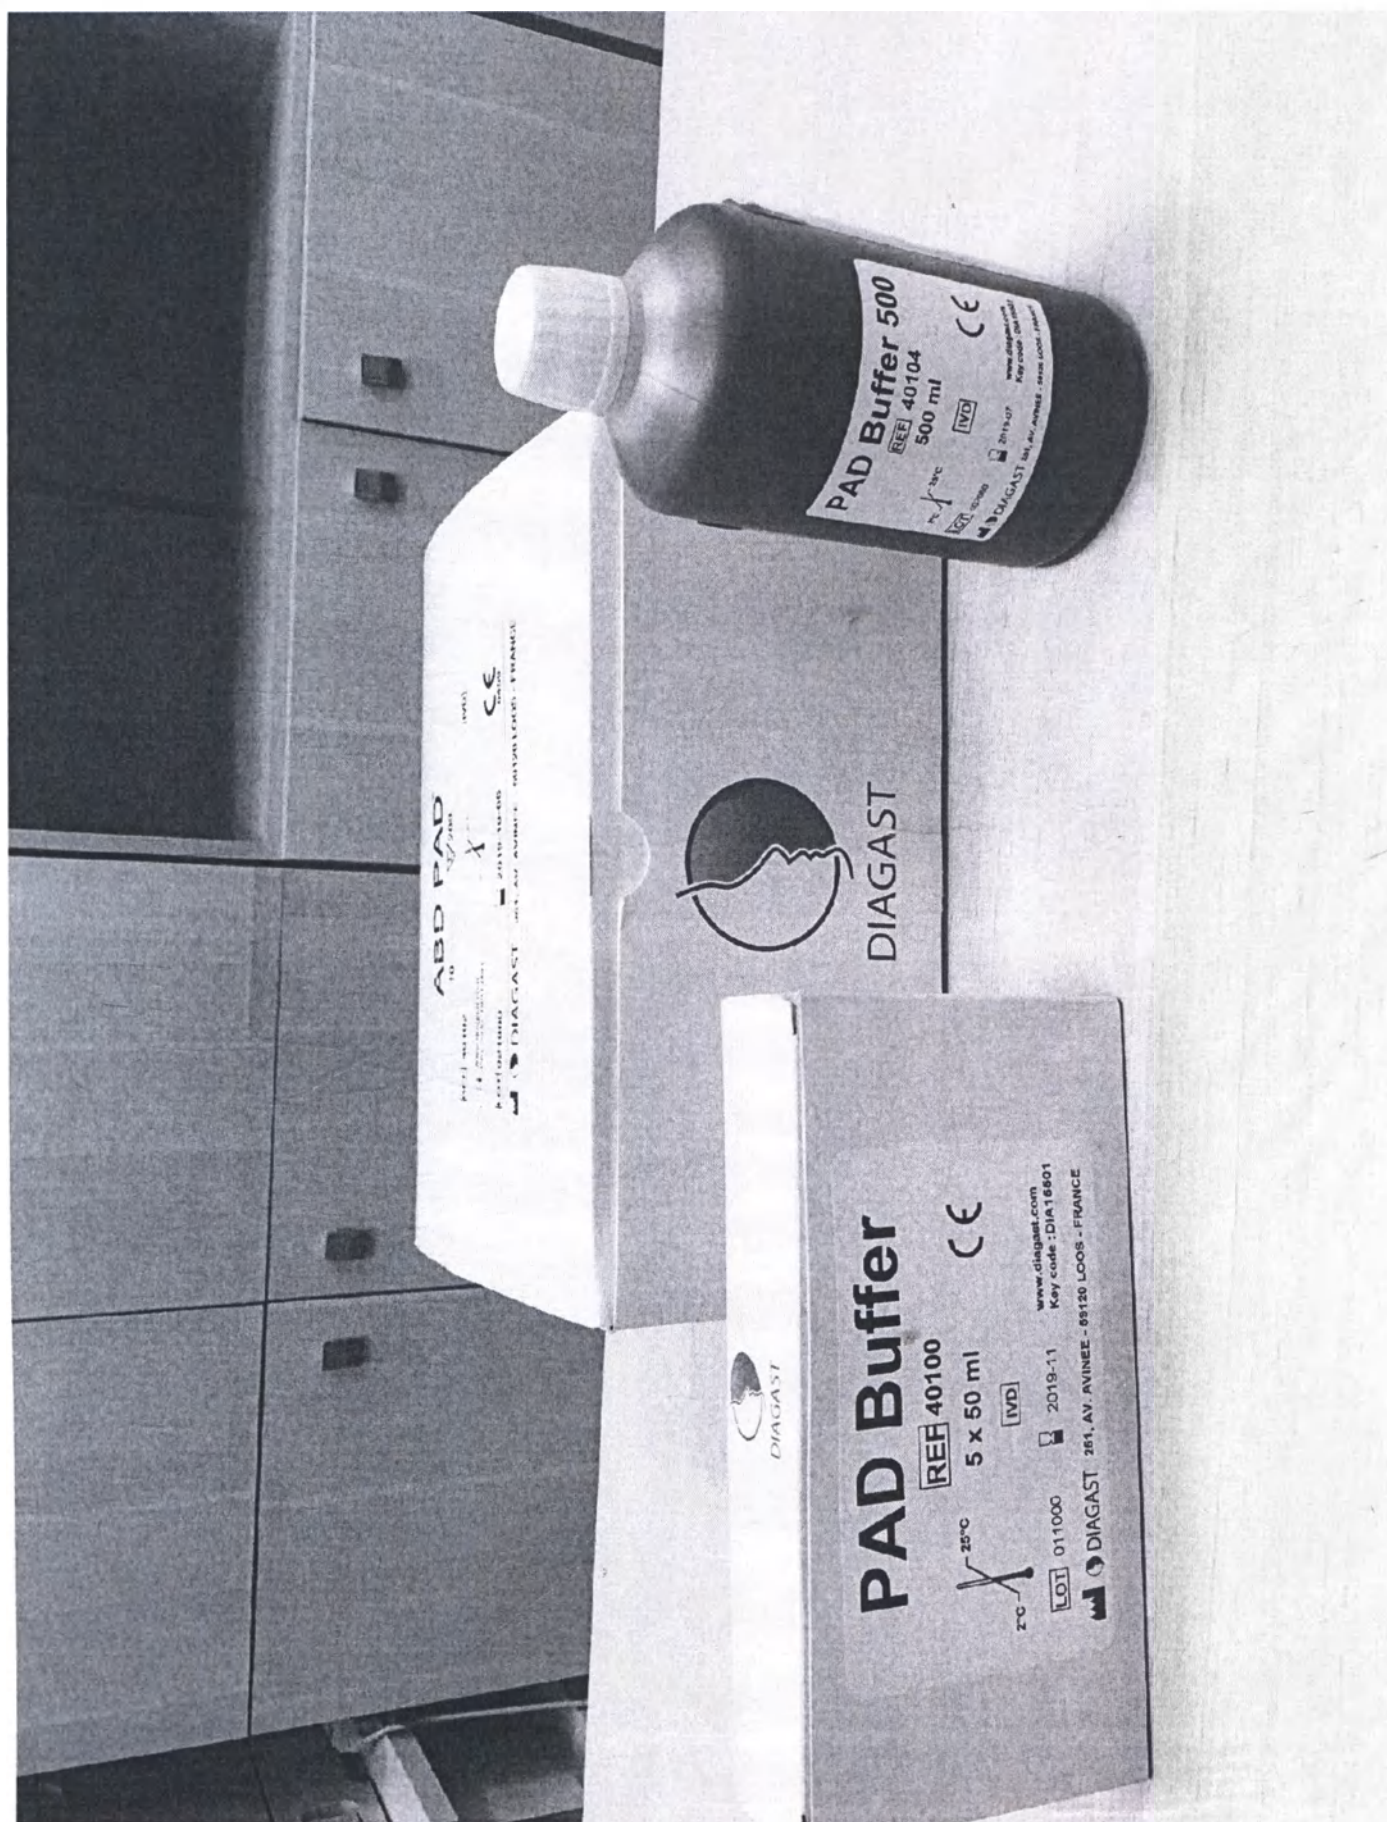

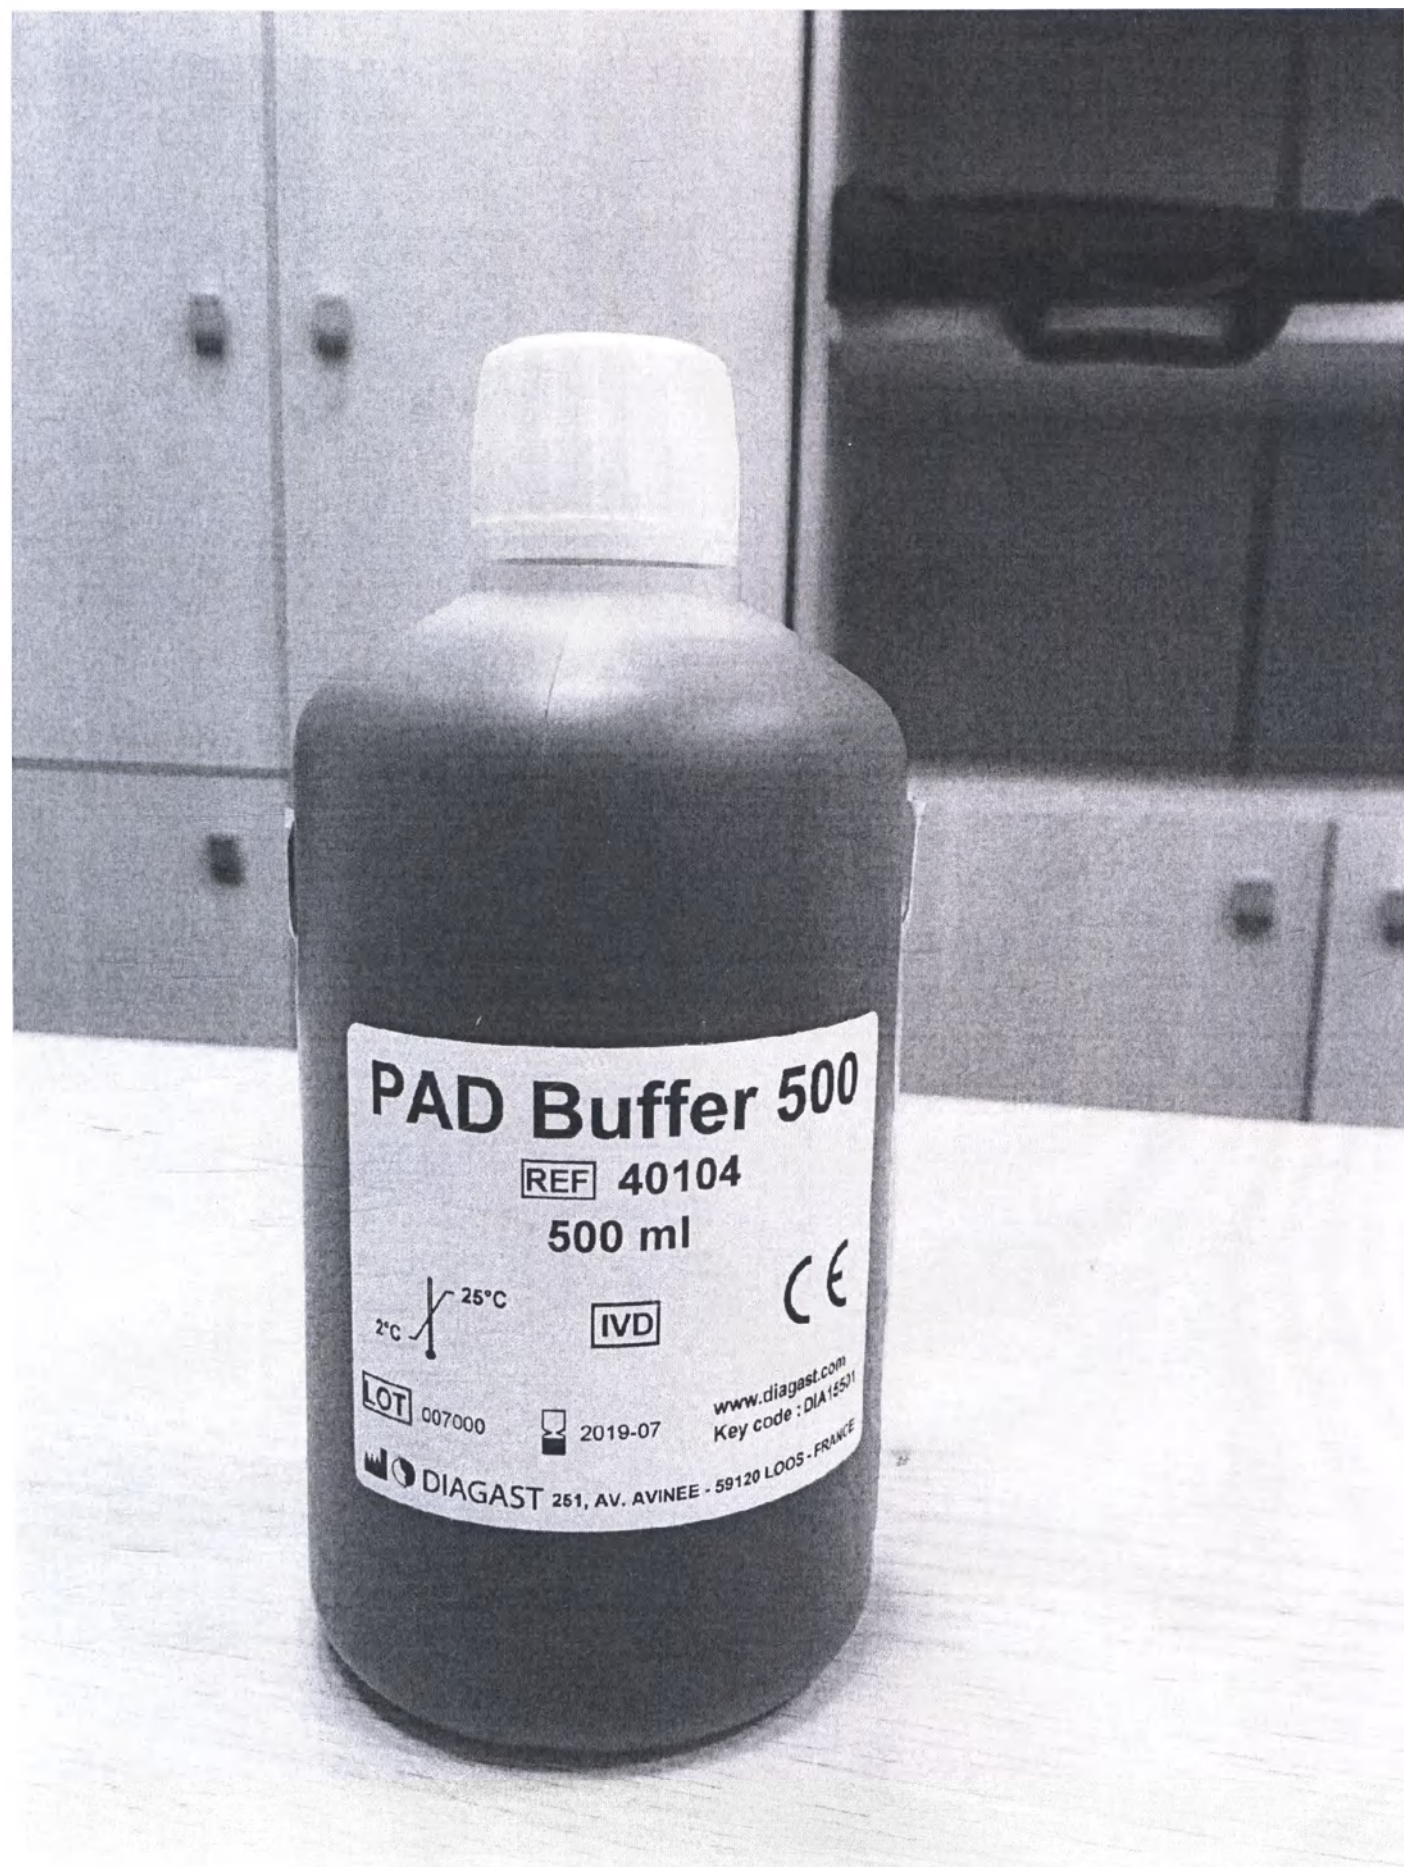

Буферный раствор PAD для определения группы крови и резус фактора



1. PAD Буфер (5 флаконов x 50 мл).
2. Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение _____

Утилизировать как потенциально опасные отходы (класса Б)



Произведено во Франции

DIAGAST S.A.S., FRANCE ДИАГАСТ С.А.С., Франция

Адрес производства: 251, avenue Eugène Avinée, Eurasanté Parc, 59120 LOOS, FRANCE

Уполномоченный представитель в РФ: ЗАО «НПО АСТА», адрес: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, 6 эт., оф. 1, тел. +7 495 781 04 08, факс +7 405 781 04 08 доб. 120, эл. почта: blood@asta.ru, сайт: www.asta.ru.

ЗАО НПО «АСТА»

Прошито и скреплено
печатью 6 (шест)

лист 06

Генеральный директор

В. Н. Спиридонов

