

Фотографии медицинского изделия:

Аппарат УЗИ Acclarix, модели: LX8, LX4, с принадлежностями

Производство: «Edan Instruments, Inc.» P.R.China / «Эдан Инструментс, Инк.» КНР,

#15 Jinhui Road, Jinsha Community, Kengzi Sub-District, Pingshan District, Shenzhen/ 15 Цзиньхуэй Роуд, Коммуна Цзиньша, уличный комитет Кэнцзы, округ Пиншань, г. Шэньчжэнь

Список фото:

Рисунок 1. Аппарат УЗИ Acclarix LX8 основной блок

Рисунок 1.1. Аппарат УЗИ Acclarix LX8 основной блок (вид справа)

Рисунок 1.2. Аппарат УЗИ Acclarix LX8 основной блок (вид сзади)

Рисунок 1.3. Аппарат УЗИ Acclarix LX8 основной блок (вид слева)

Рисунок 1.4. Аппарат УЗИ Acclarix LX8 основной блок (вид сверху)

Рисунок 1.5. Аппарат УЗИ Acclarix LX8 основной блок (панель управления)

Рисунок 1.6. Аппарат УЗИ Acclarix LX8 основной блок (гнезда датчиков)

Рисунок 1.7. Аппарат УЗИ Acclarix LX8 основной блок (маркировка)

Рисунок 1.8. Аппарат УЗИ Acclarix LX8 (порты ввода-вывода)

Рисунок 2. Монитор

Рисунок 3. Руководство пользователя

Рисунок 4. Шнур питания

Рисунок 5. Кабель эквипотенциального заземления

Рисунок 6. Датчик конвексный ультразвуковой C5-2D

Рисунок 7. Маркировка датчика

Рисунок 8. Датчик 3D4D объемный ультразвуковой C5-2MD

Рисунок 9. Датчик линейный ультразвуковой L12-5D

Рисунок 10. Датчик линейный ультразвуковой L17-7HD

Рисунок 11. Датчик линейный ультразвуковой L17-7SD

Рисунок 12. Датчик линейный ультразвуковой L10-4D

Рисунок 13. Датчик конвексный ультразвуковой C5-2XD

Рисунок 14. Датчик фазированный ультразвуковой P5-1D

Рисунок 15. Датчик микроконвексный ультразвуковой MC8-4D

Рисунок 16. Датчик внутриволосной ультразвуковой E8-4D

Рисунок 17. Насадка биопсийная для датчиков конвексных ультразвуковых C5-2XD, C5-2D, модель BGK-C5-2

Рисунок 18. Насадка биопсийная для датчиков линейных ультразвуковых L10-4D, модель BGK-L40UB

Рисунок 19. Насадка биопсийная для датчиков микро-конвексных ультразвуковых MC8-4D, модель BGK-R15UB

Рисунок 20. Насадка биопсийная для датчиков внутримолосных ультразвуковых E8-4D, модель BGK-CR10UA

Рисунок 21. Насадка биопсийная для датчиков фазированных ультразвуковых P5-1XD, модель BGK-P5-1X

Рисунок 22. Видеопринтер черно-белый (SONY UP-X898MD)

Рисунок 23. Бумага для черно-белого видеопринтера SONY & MITSUBISHI (SONY, UPP-110S, 110 мм × 20 м)

Рисунок 24. Бумага для черно-белого видеопринтера SONY & MITSUBISHI (SONY, UPP-110HG, 110 мм × 18 м)

Рисунок 25. Flash-диск

Рисунок 26. Педаль ножная

Рисунок 26.1. Педаль ножная (маркировка)

Рисунок 27. Педаль двойная ножная

Рисунок 27.1. Педаль двойная ножная (маркировка)

Рисунок 28. Транспортный короб

Рисунок 29. Маркировка транспортного короба

Рисунок 30. Маркировка транспортного короба



Рисунок 1.

Аппарат УЗИ Acclatrix, модели: LX8, LX4, с принадлежностями



Рисунок 1.1.



Рисунок 1.2.



Рисунок 1.3.

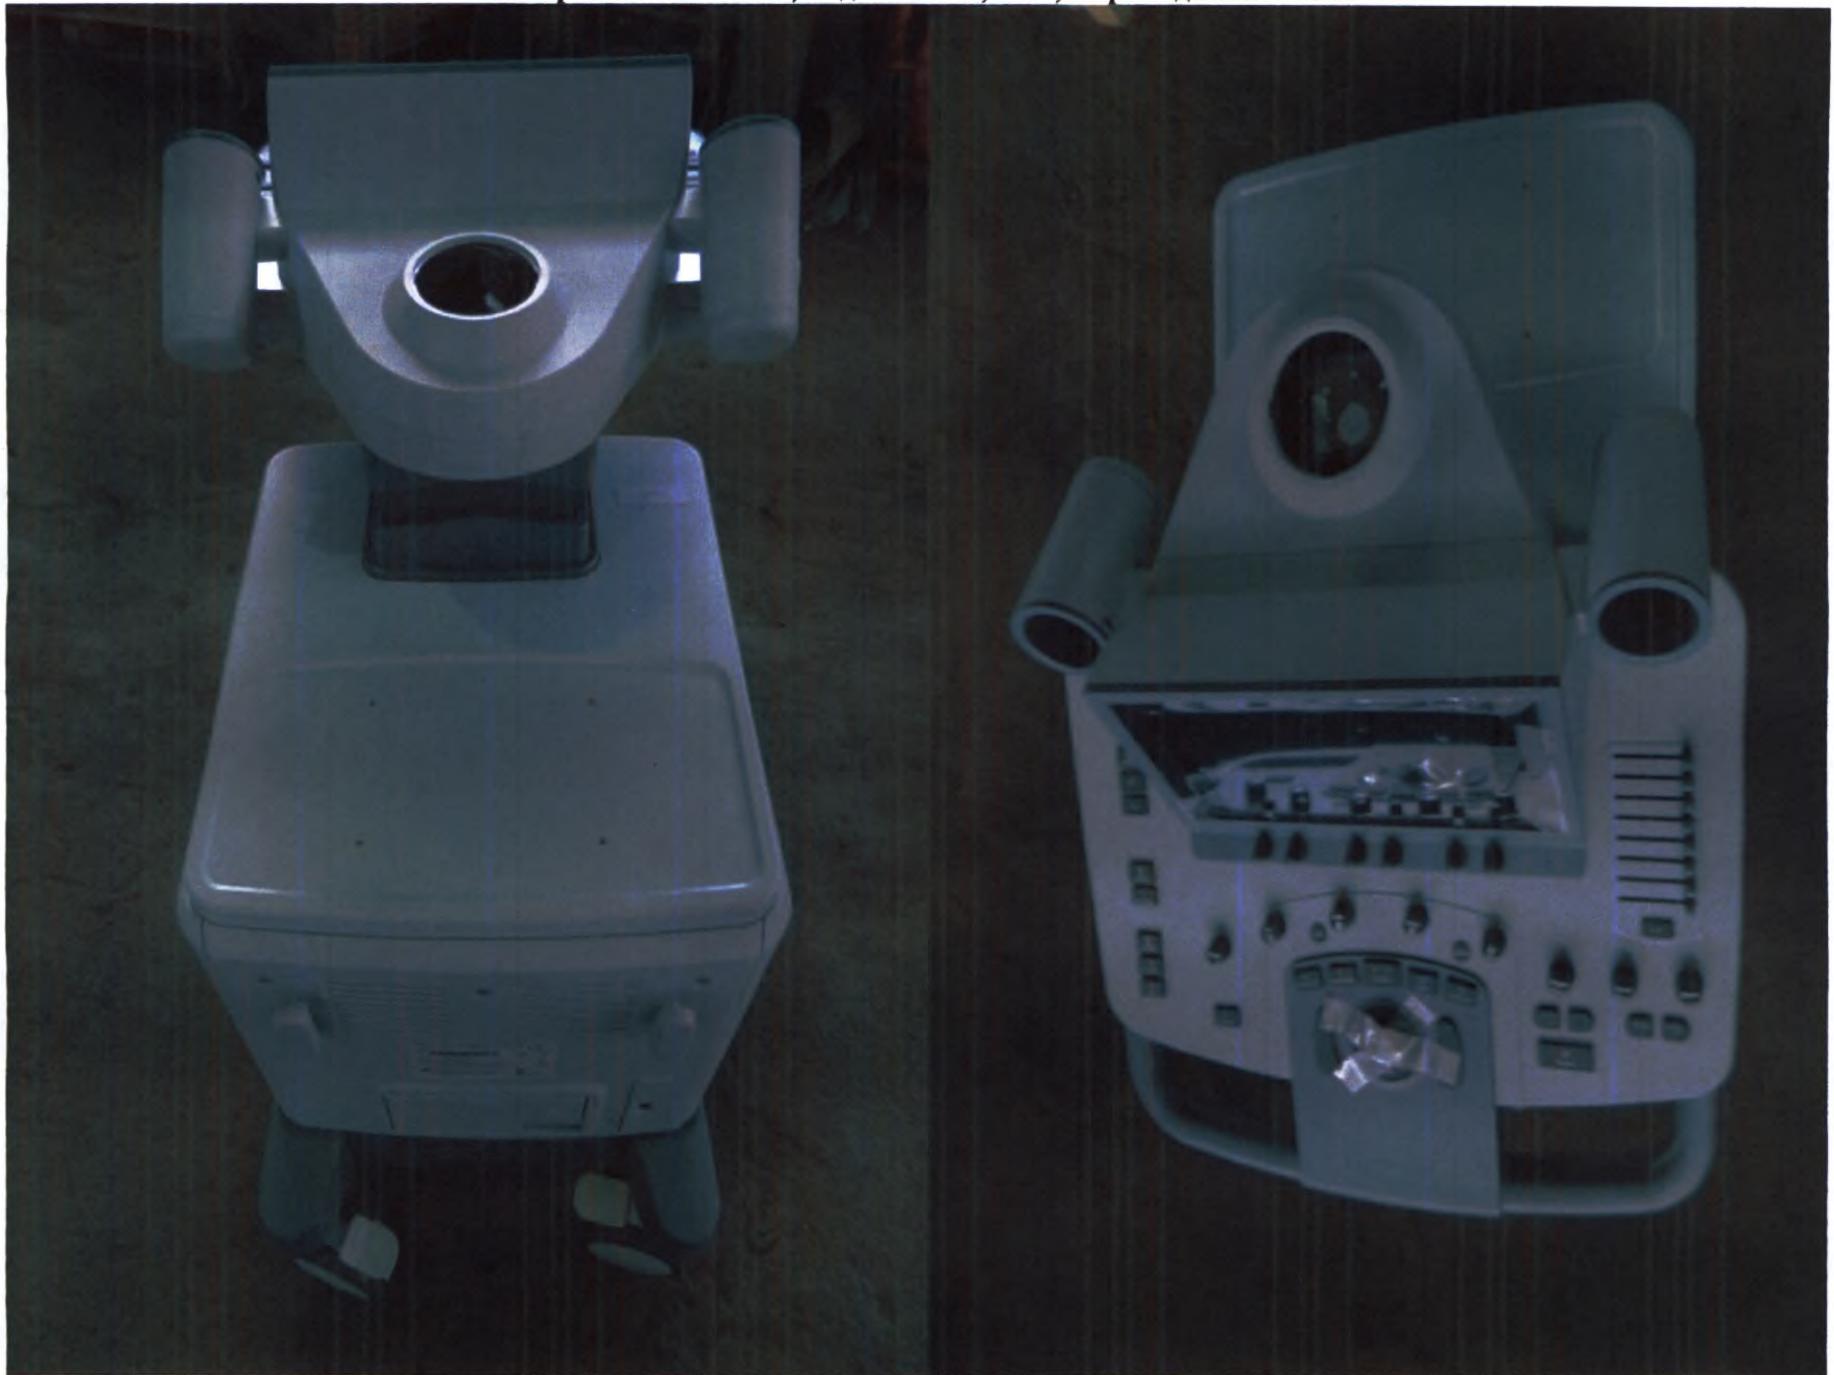


Рисунок 1.4.

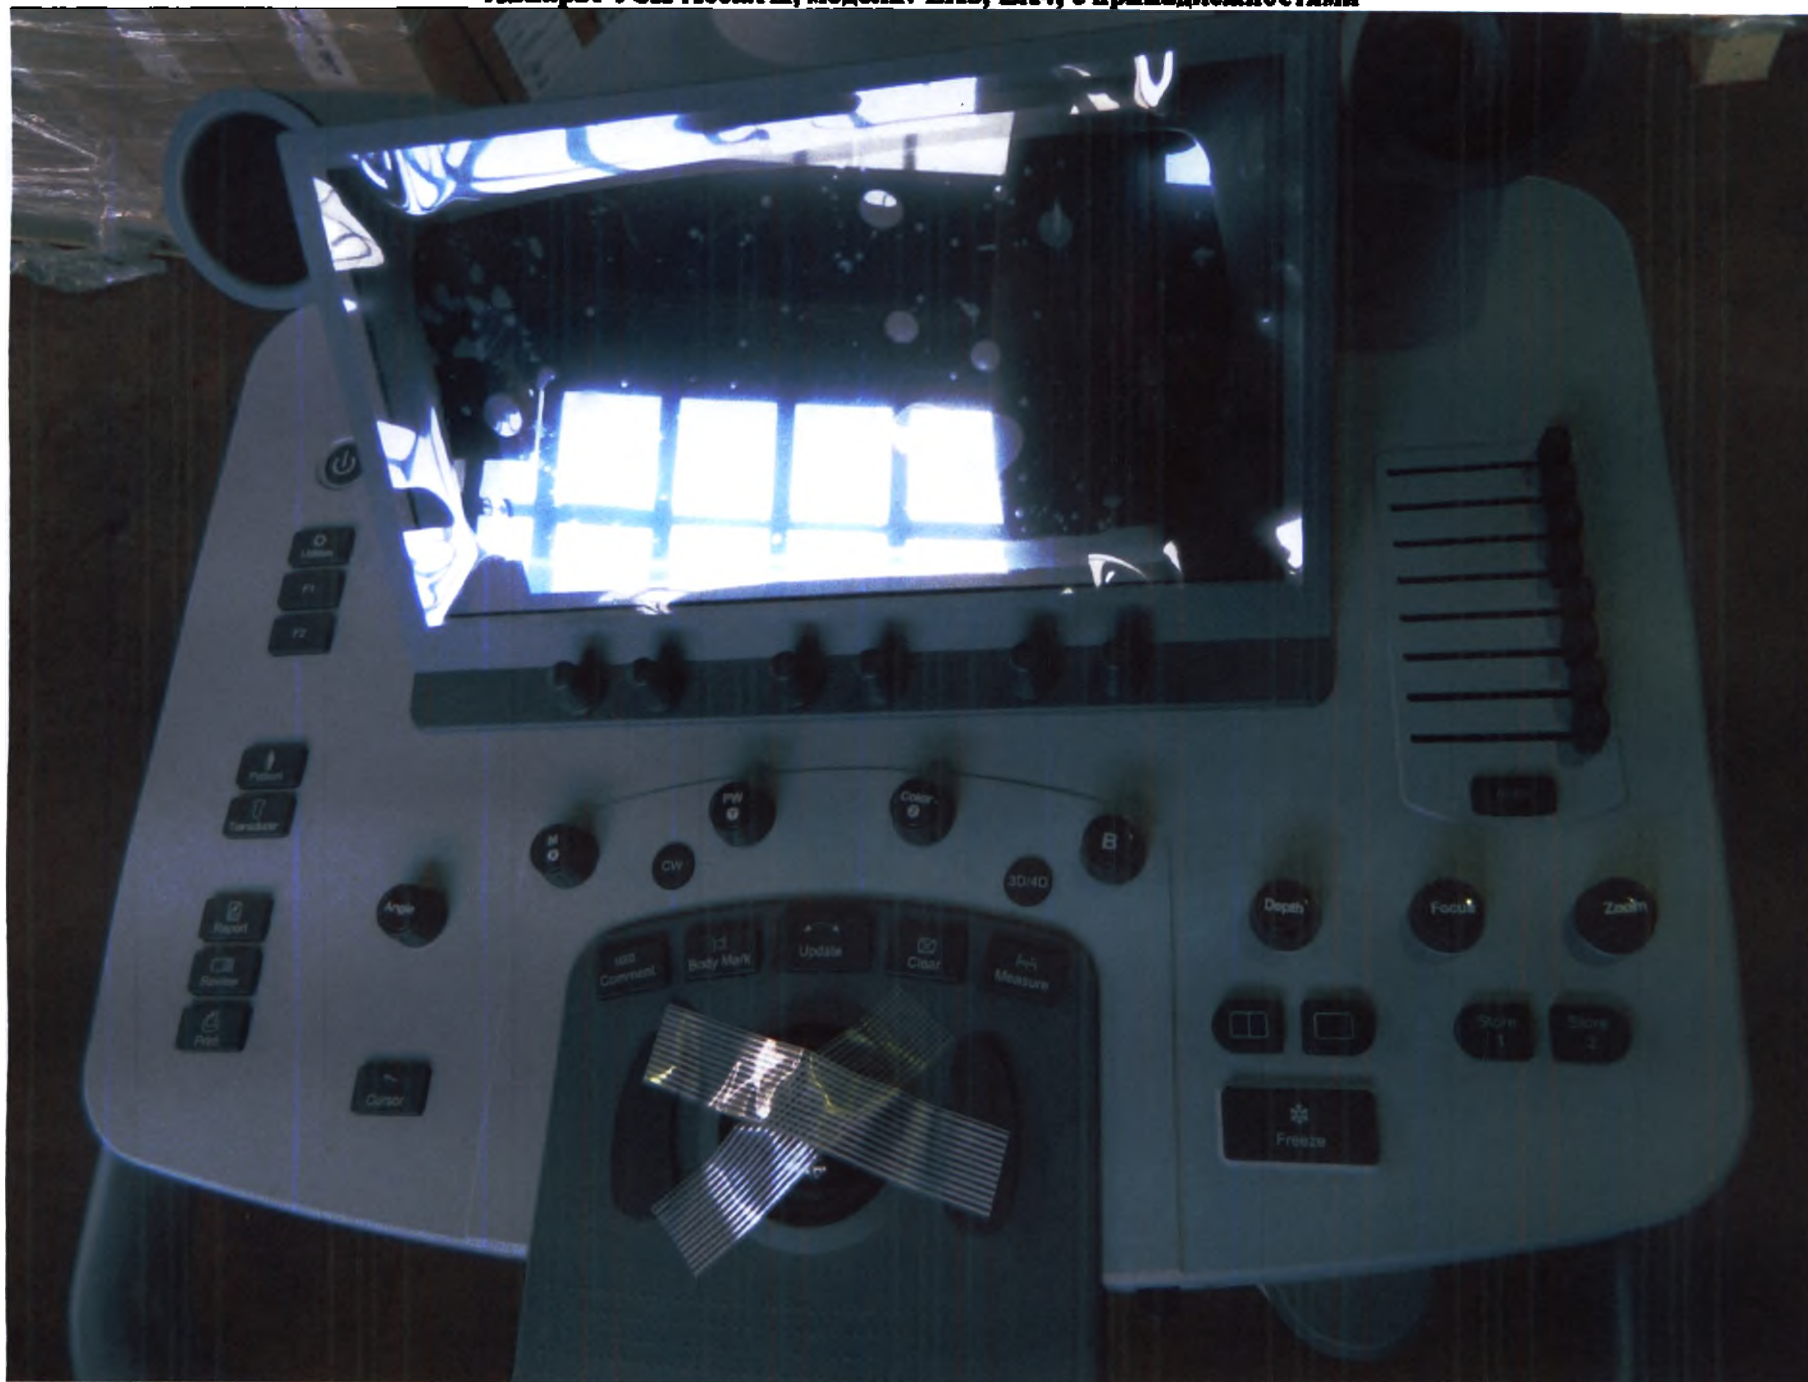


Рисунок 1.5.



Рисунок 1.6.

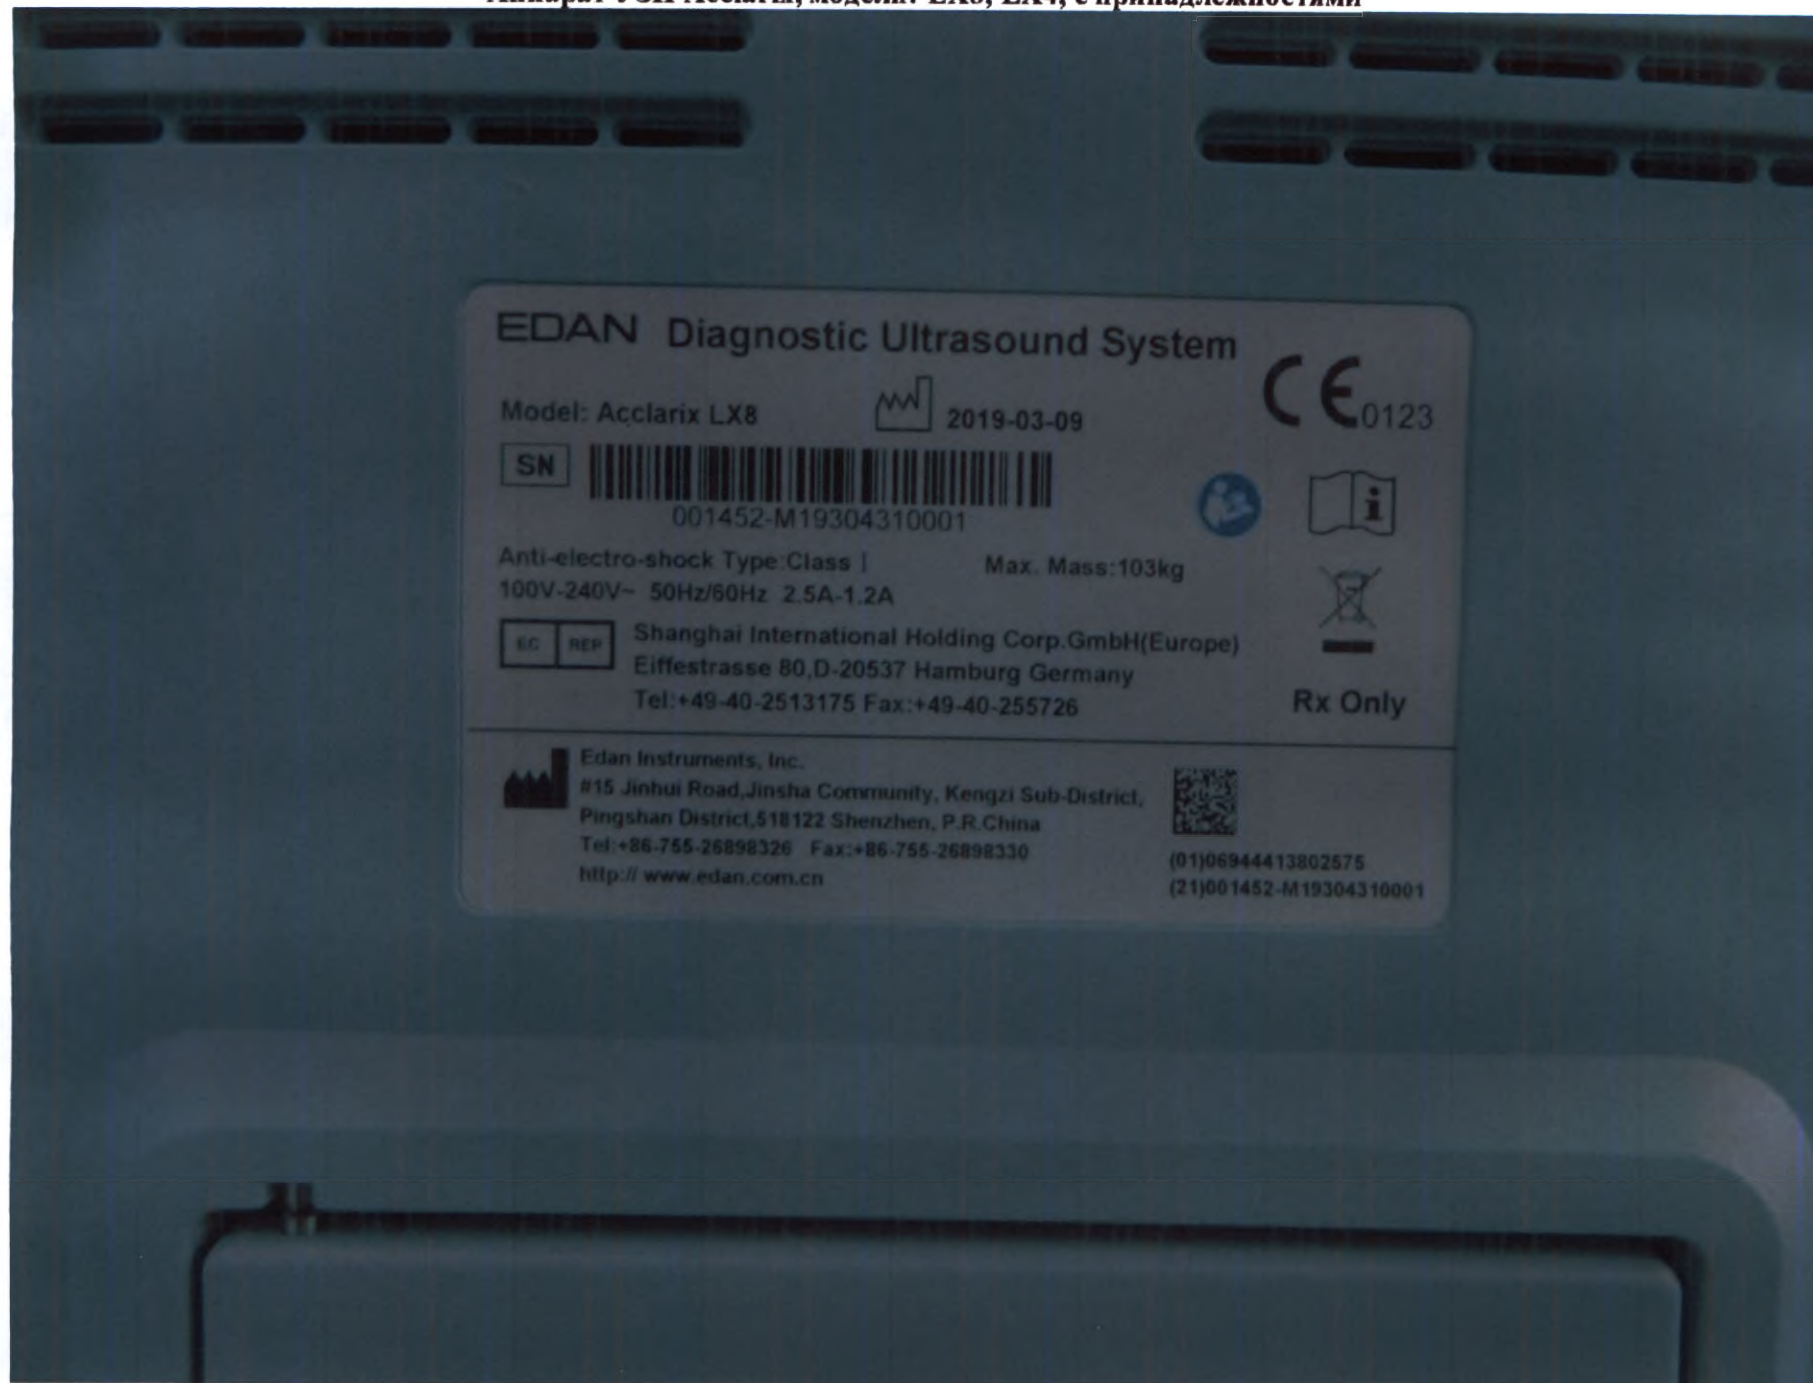


Рисунок 1.7.



Рисунок 1.8.

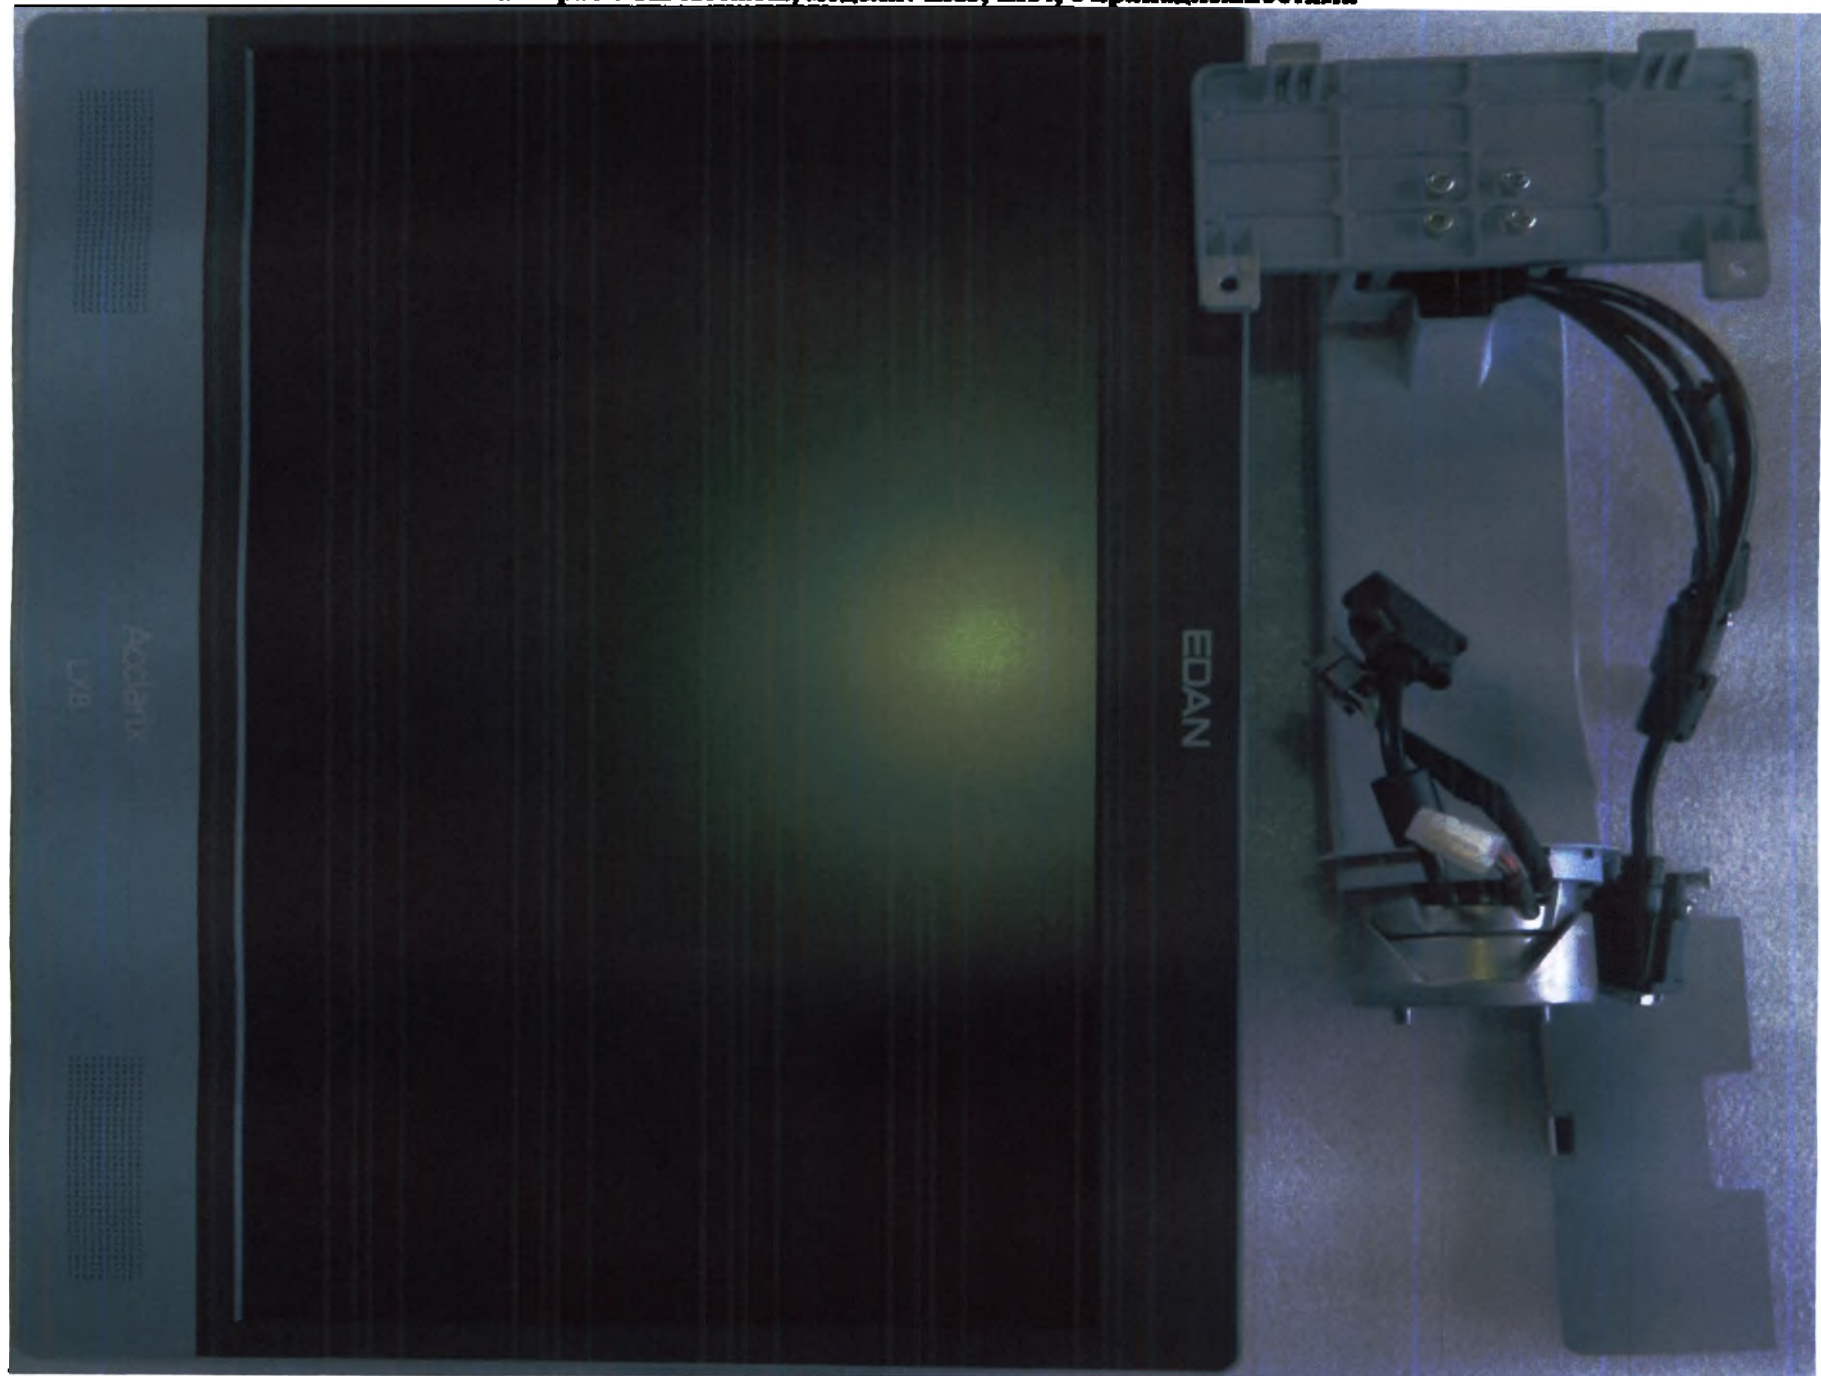


Рисунок 2.

Acclarix LX8,LX4

Диагностическая ультразвуковая система

Руководство по эксплуатации

Основные сведения

CE 0123


EDAN

Аппарат УЗИ Acclarix, модели: LX8, LX4, с принадлежностями

Рисунок 3.



Рисунок 4.

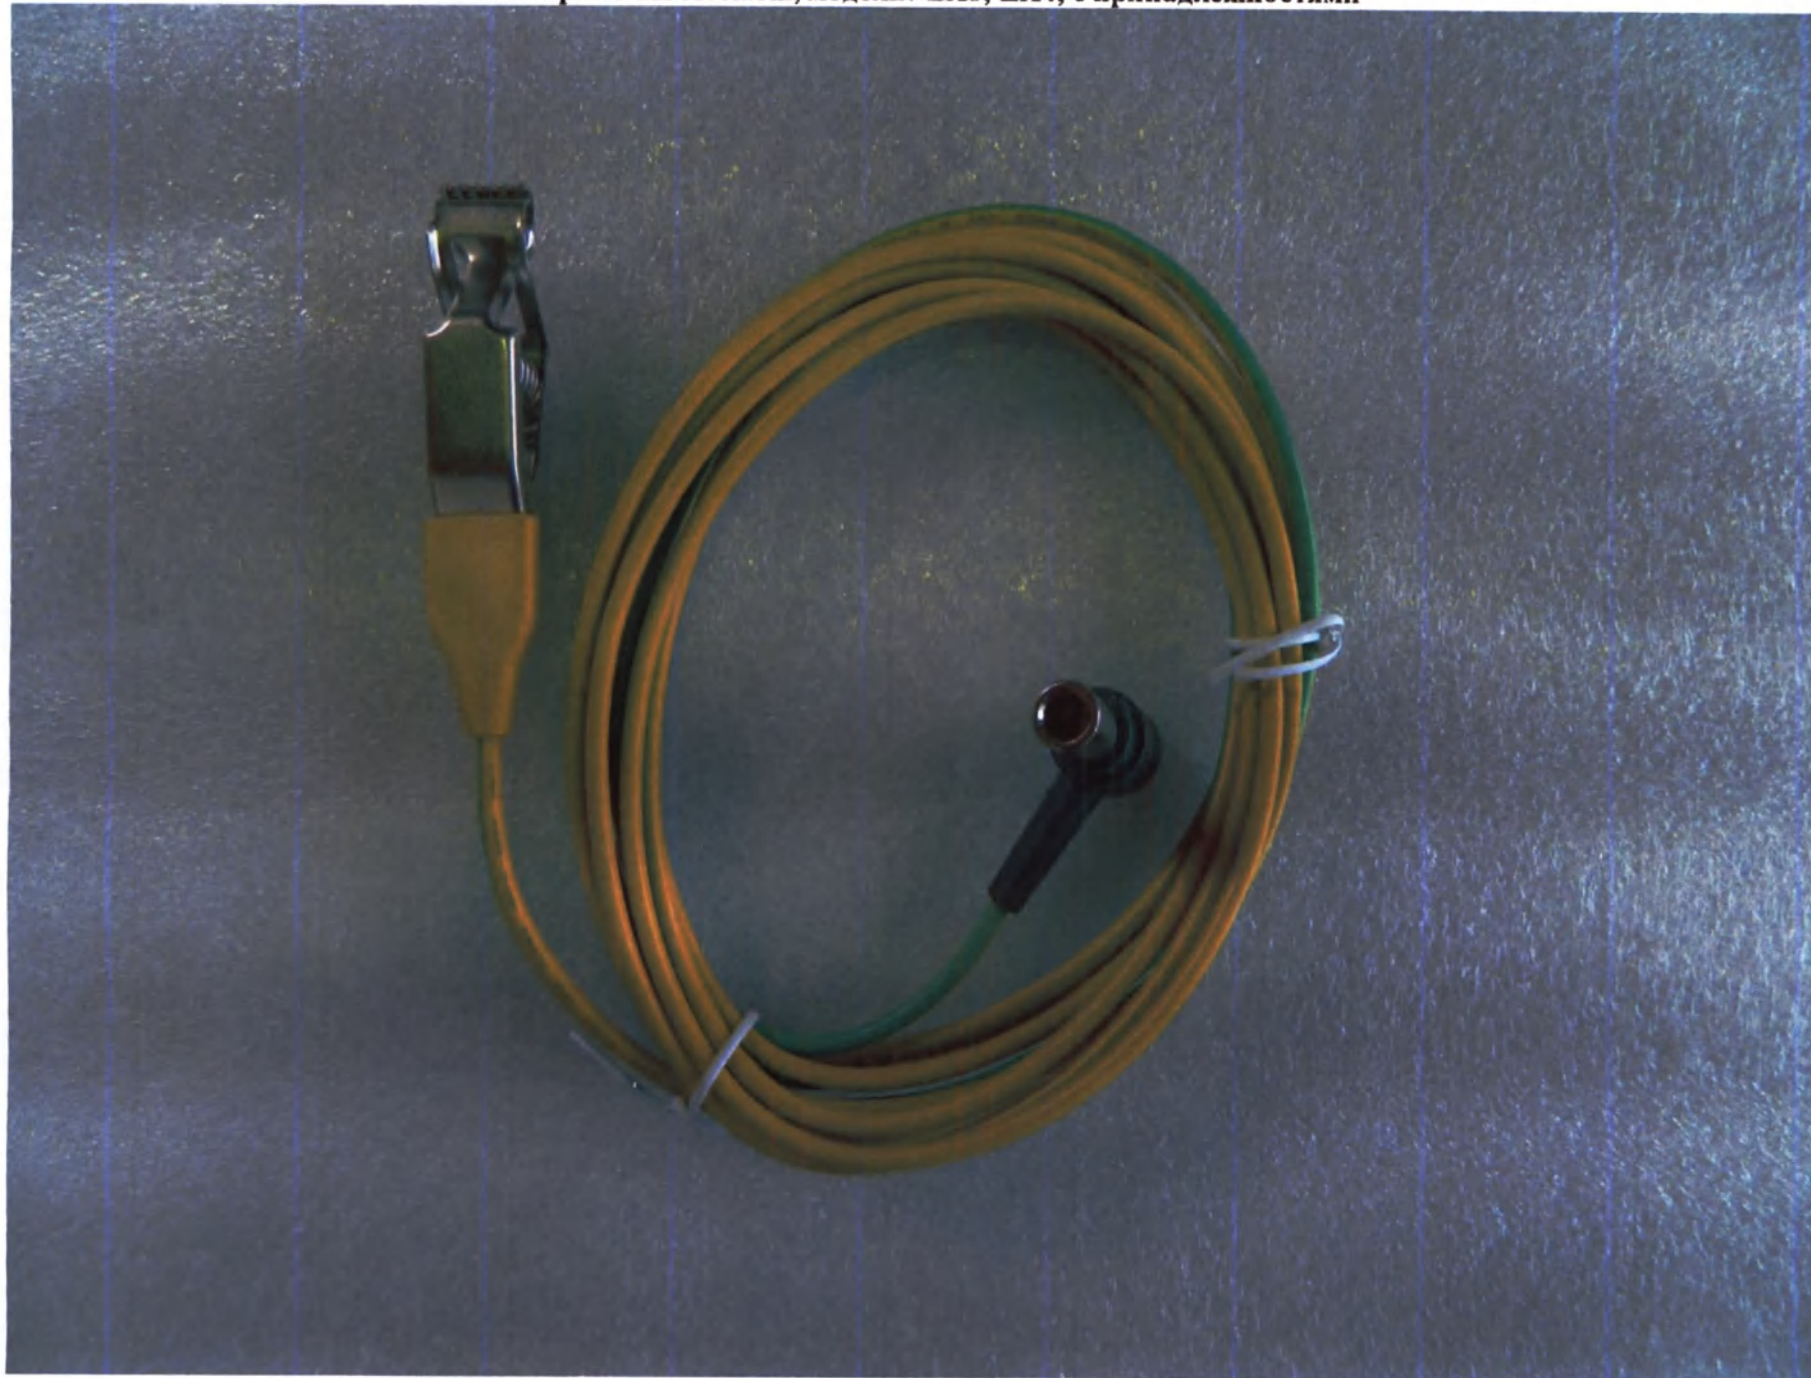


Рисунок 5.

Аппарат УЗИ Acclarix, модели: LX8, LX4, с принадлежностями



Рисунок 6.

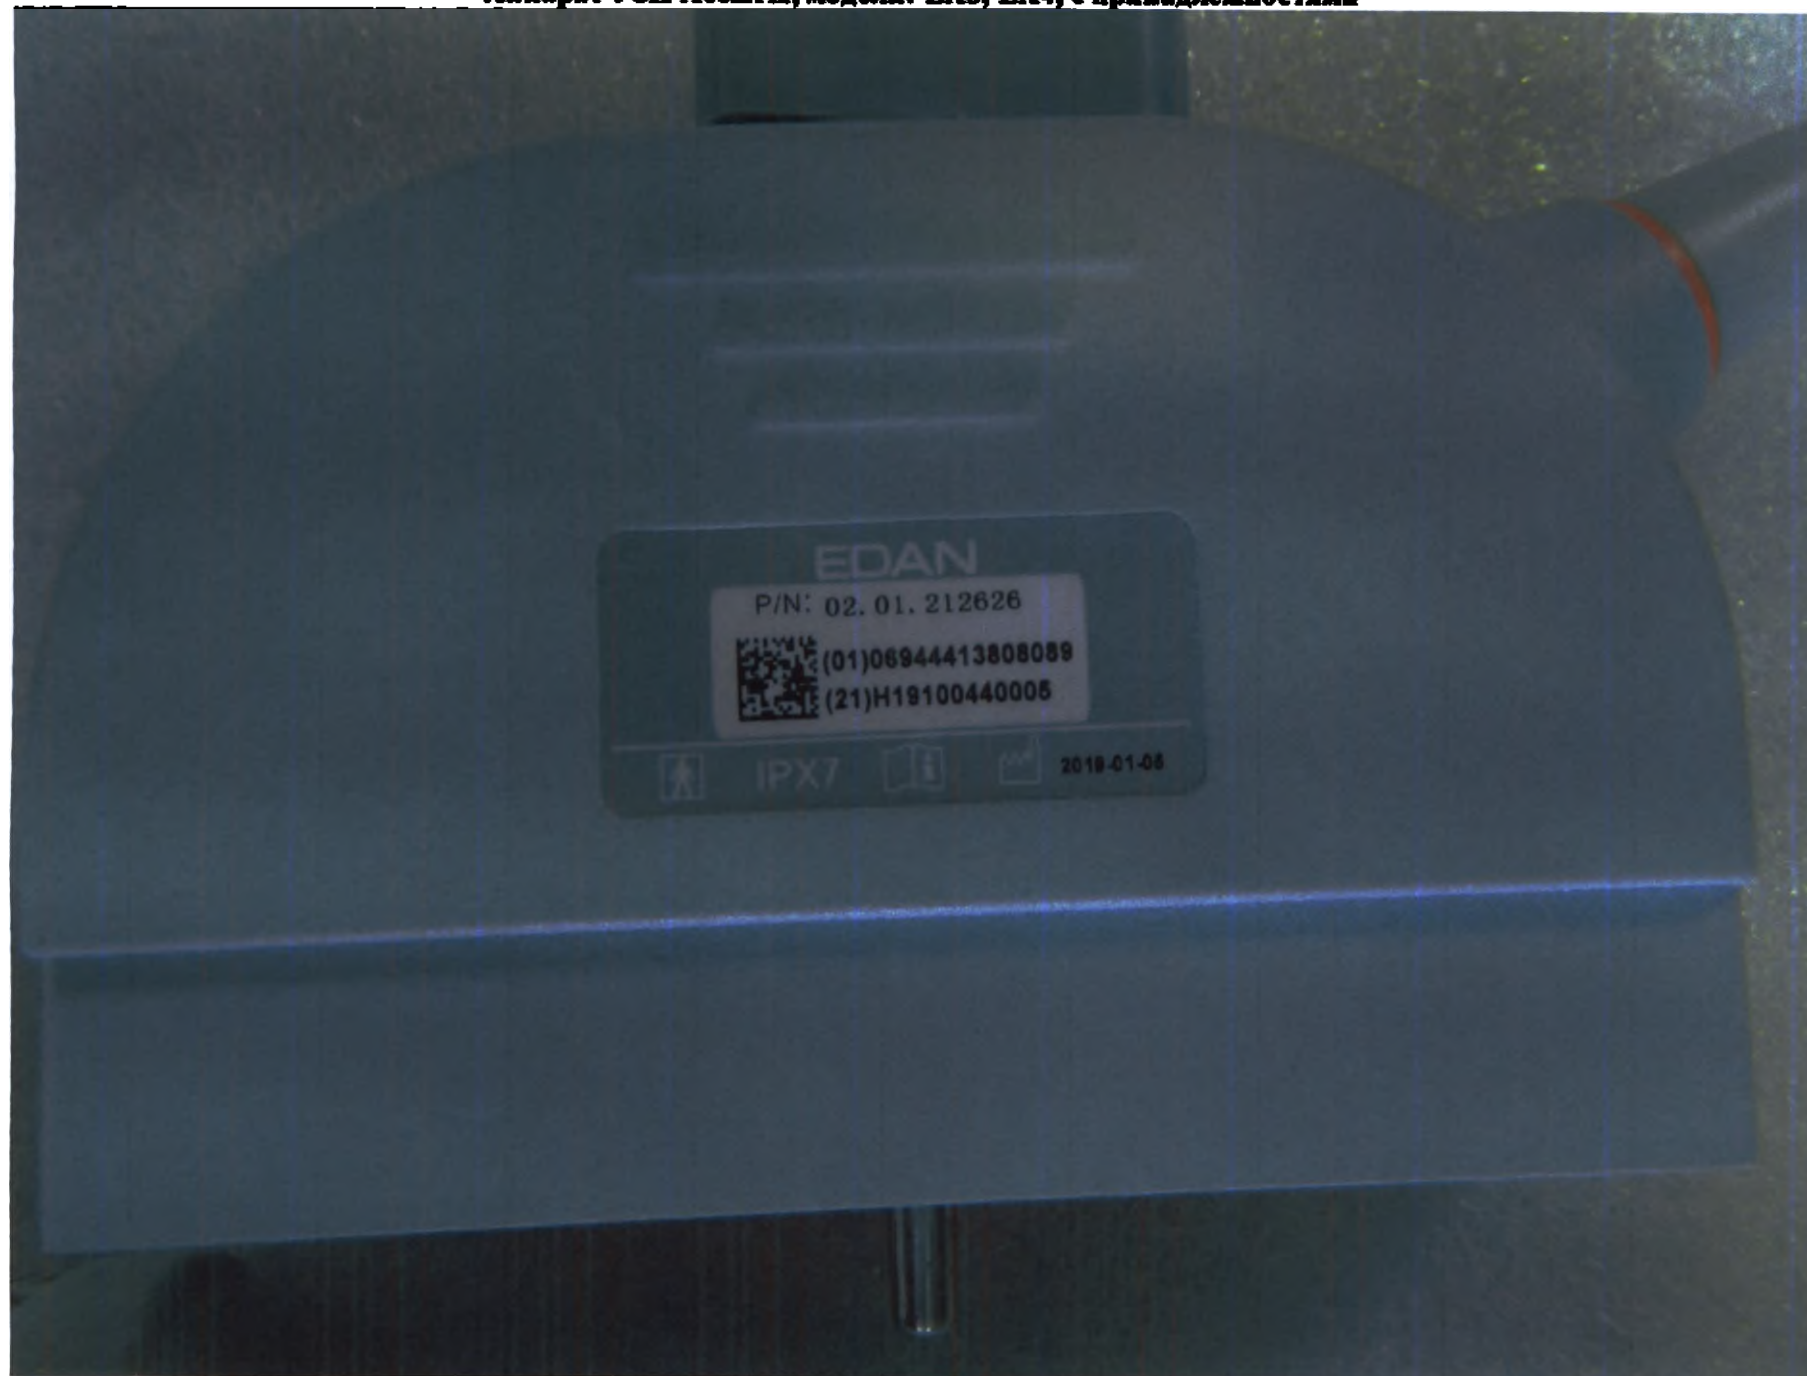


Рисунок 7.

Аппарат УЗИ Acclarix, модели: LX8, LX4, с принадлежностями



Рисунок 8.



Рисунок 9.



Рисунок 10.

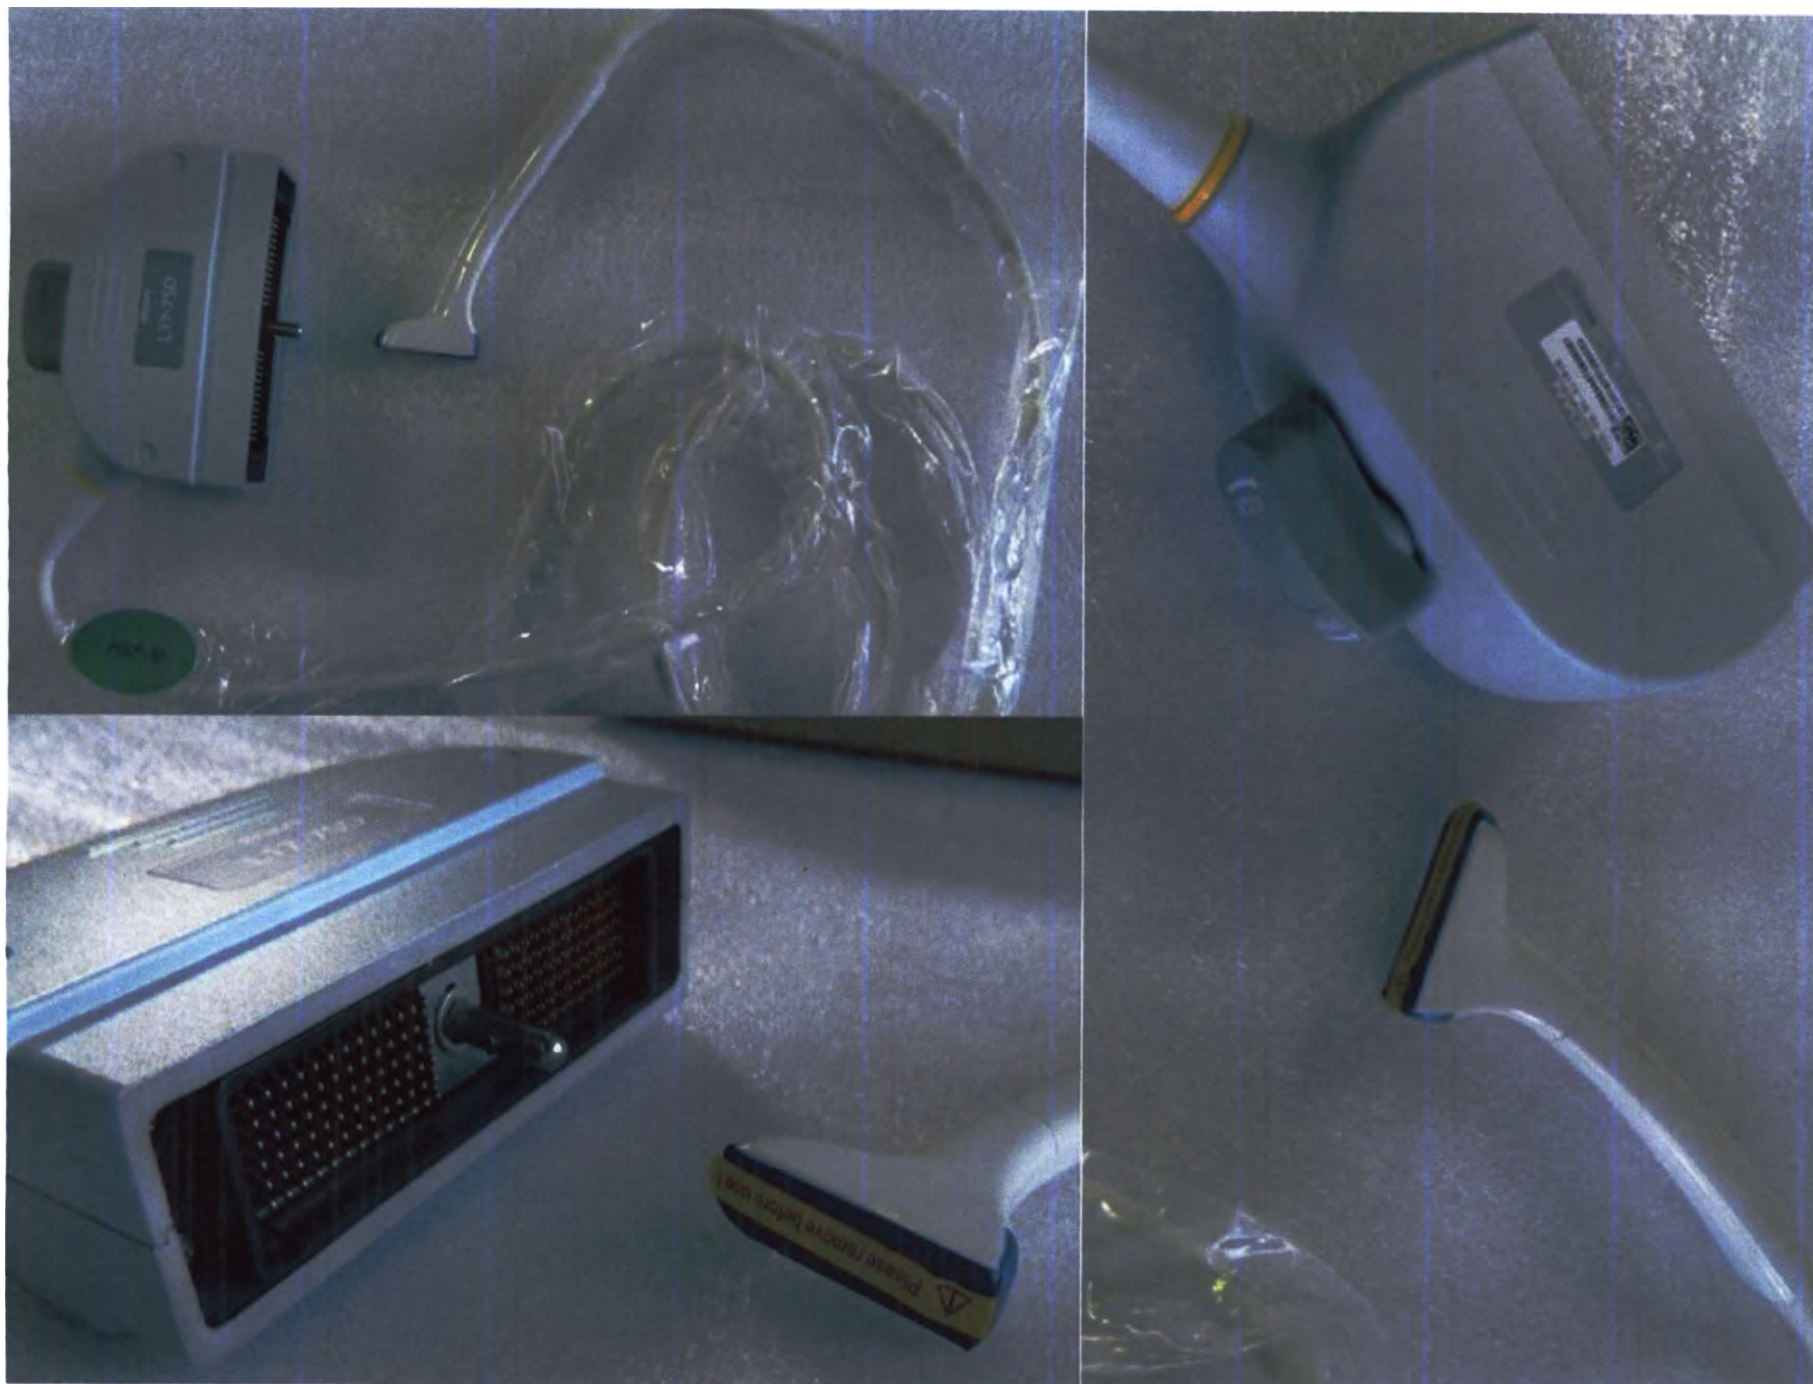


Рисунок 11.

Аппарат УЗИ Acclarix, модели: LX8, LX4, с принадлежностями



Рисунок 12.



Рисунок 13.



Рисунок 14.



Рисунок 15.

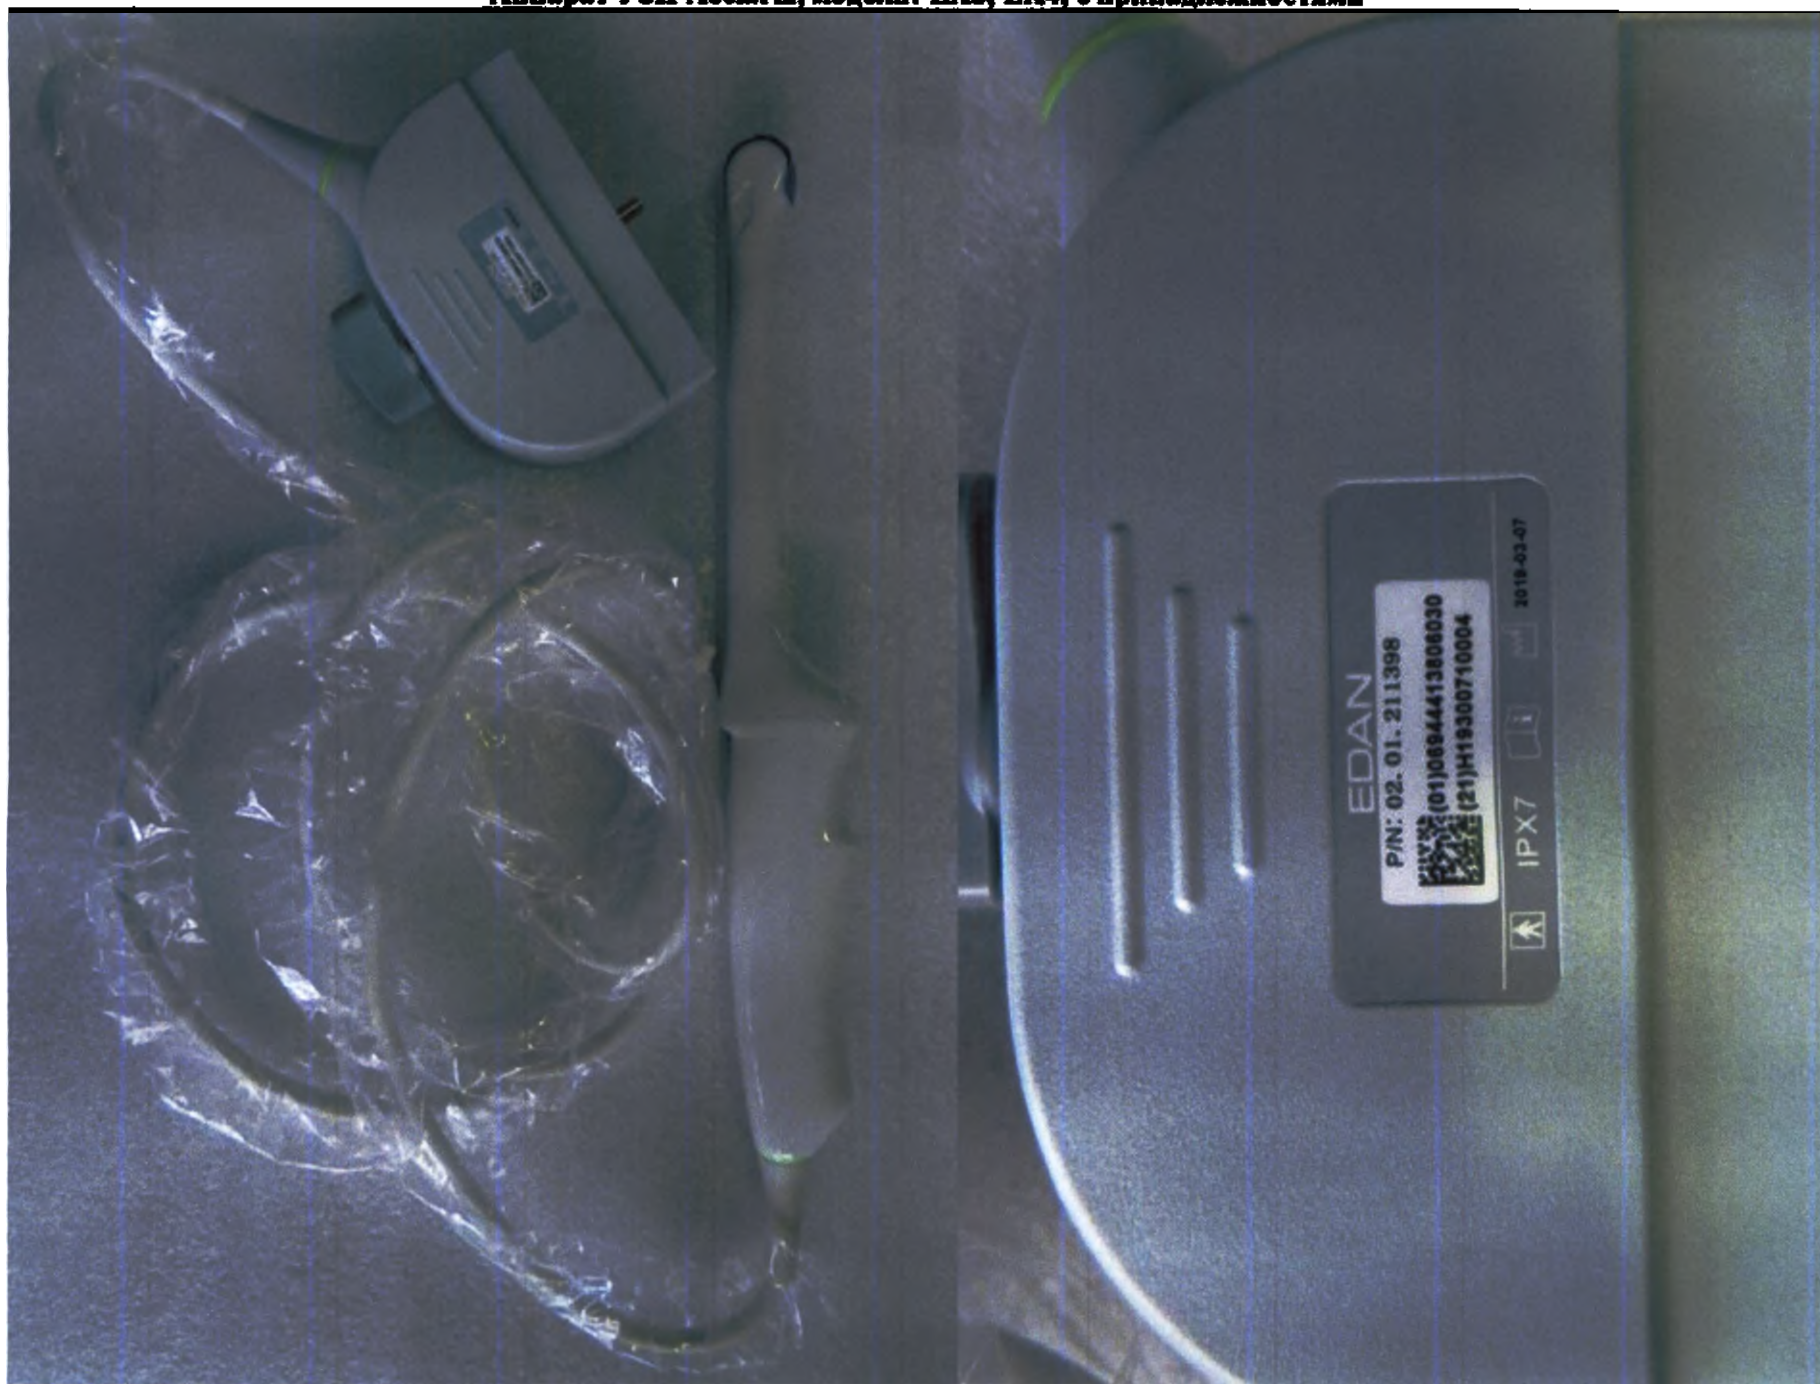


Рисунок 16.



Рисунок 17.



Рисунок 18.



Рисунок 19.

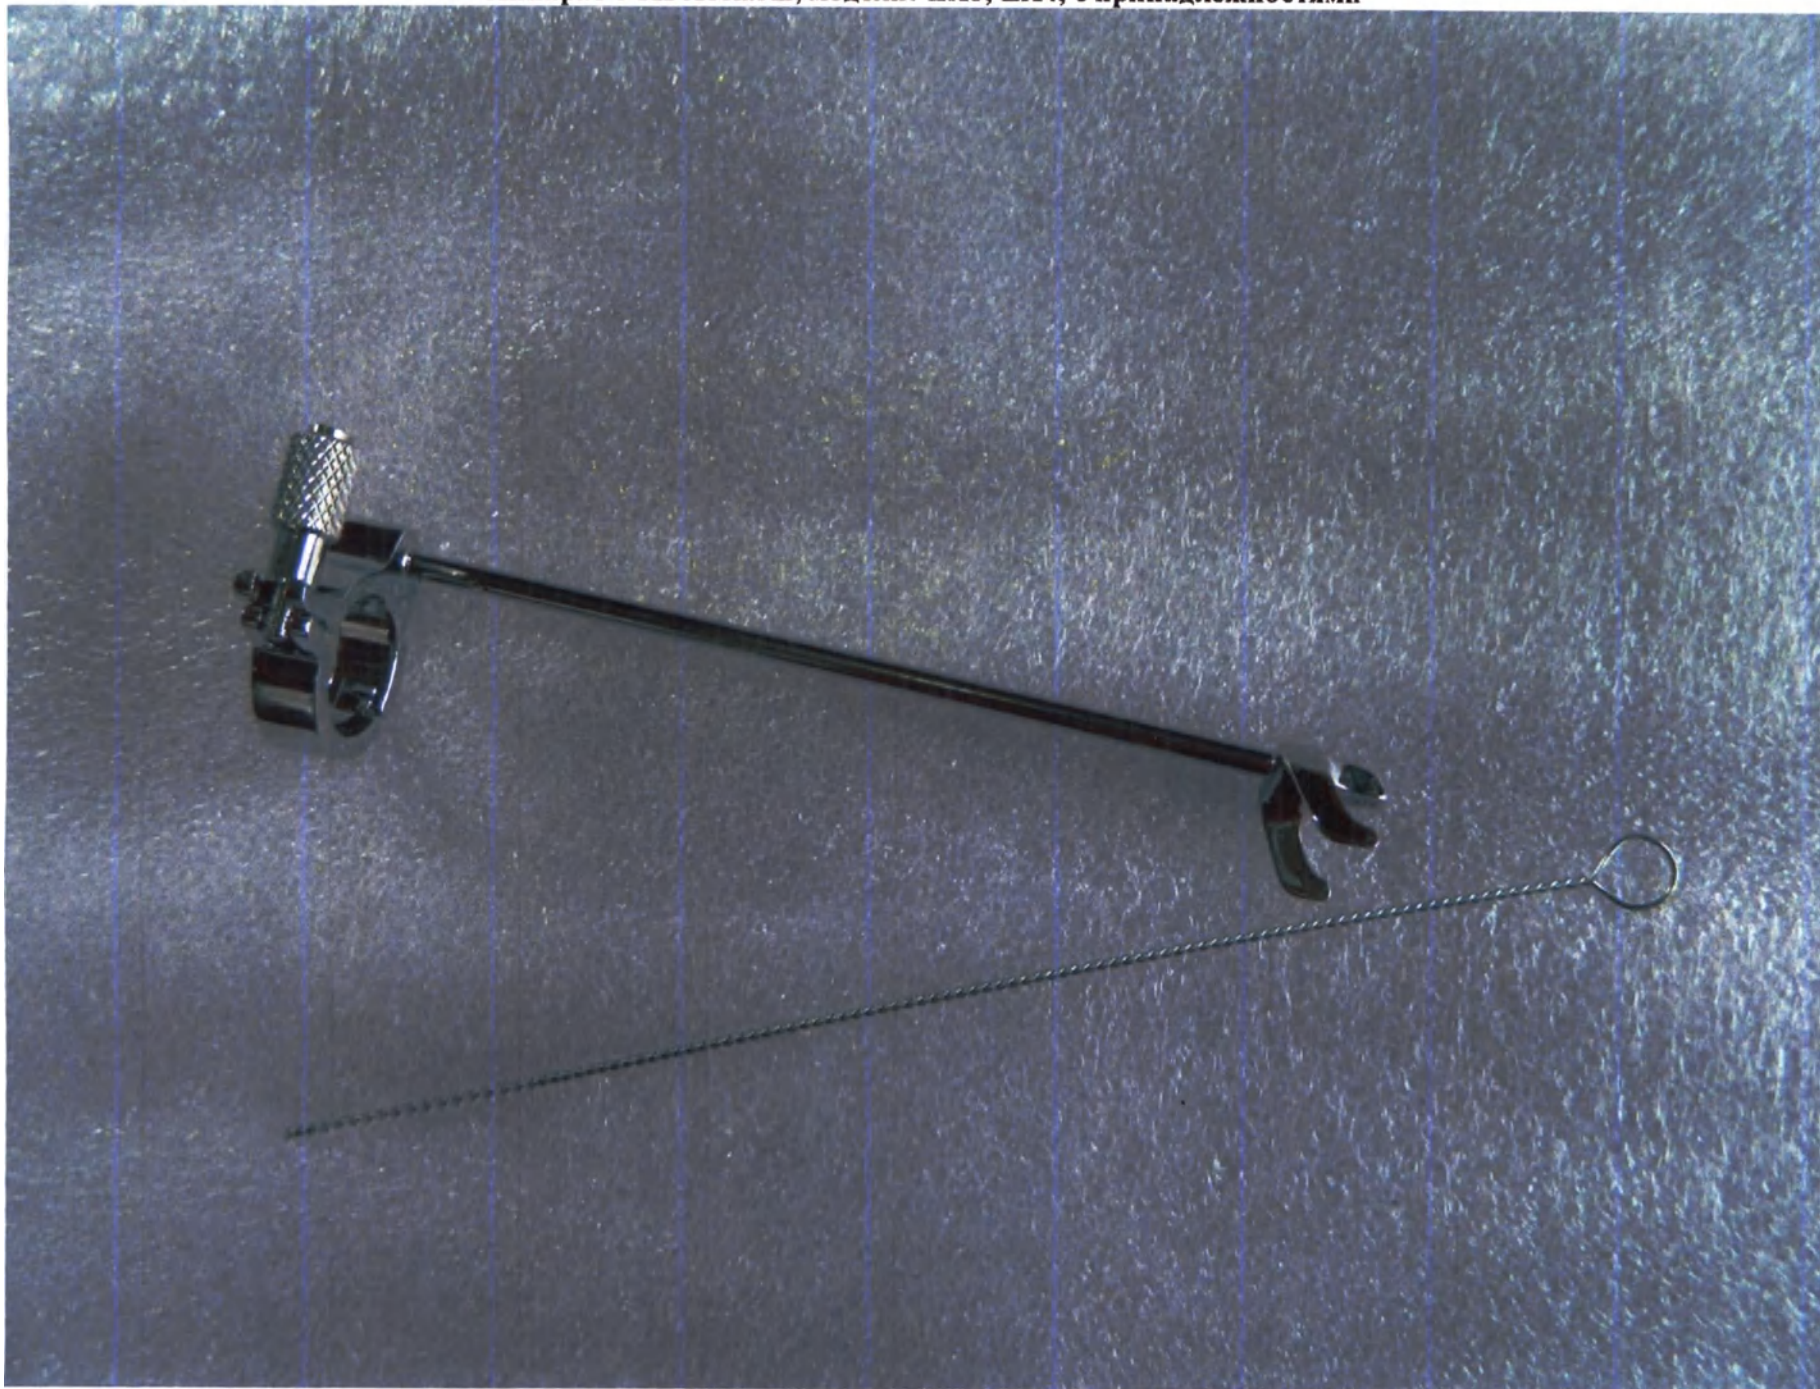


Рисунок 20.



Рисунок 21.

Аппарат УЗИ Acclarix, модели: LX8, LX4, с принадлежностями



Рисунок 22.



Рисунок 23.



Рисунок 24.



Рисунок 25.



Рисунок 26.



Рисунок 26.1.

Аппарат УЗИ Acclarix, модели: LX8, LX4, с принадлежностями



Рисунок 27.

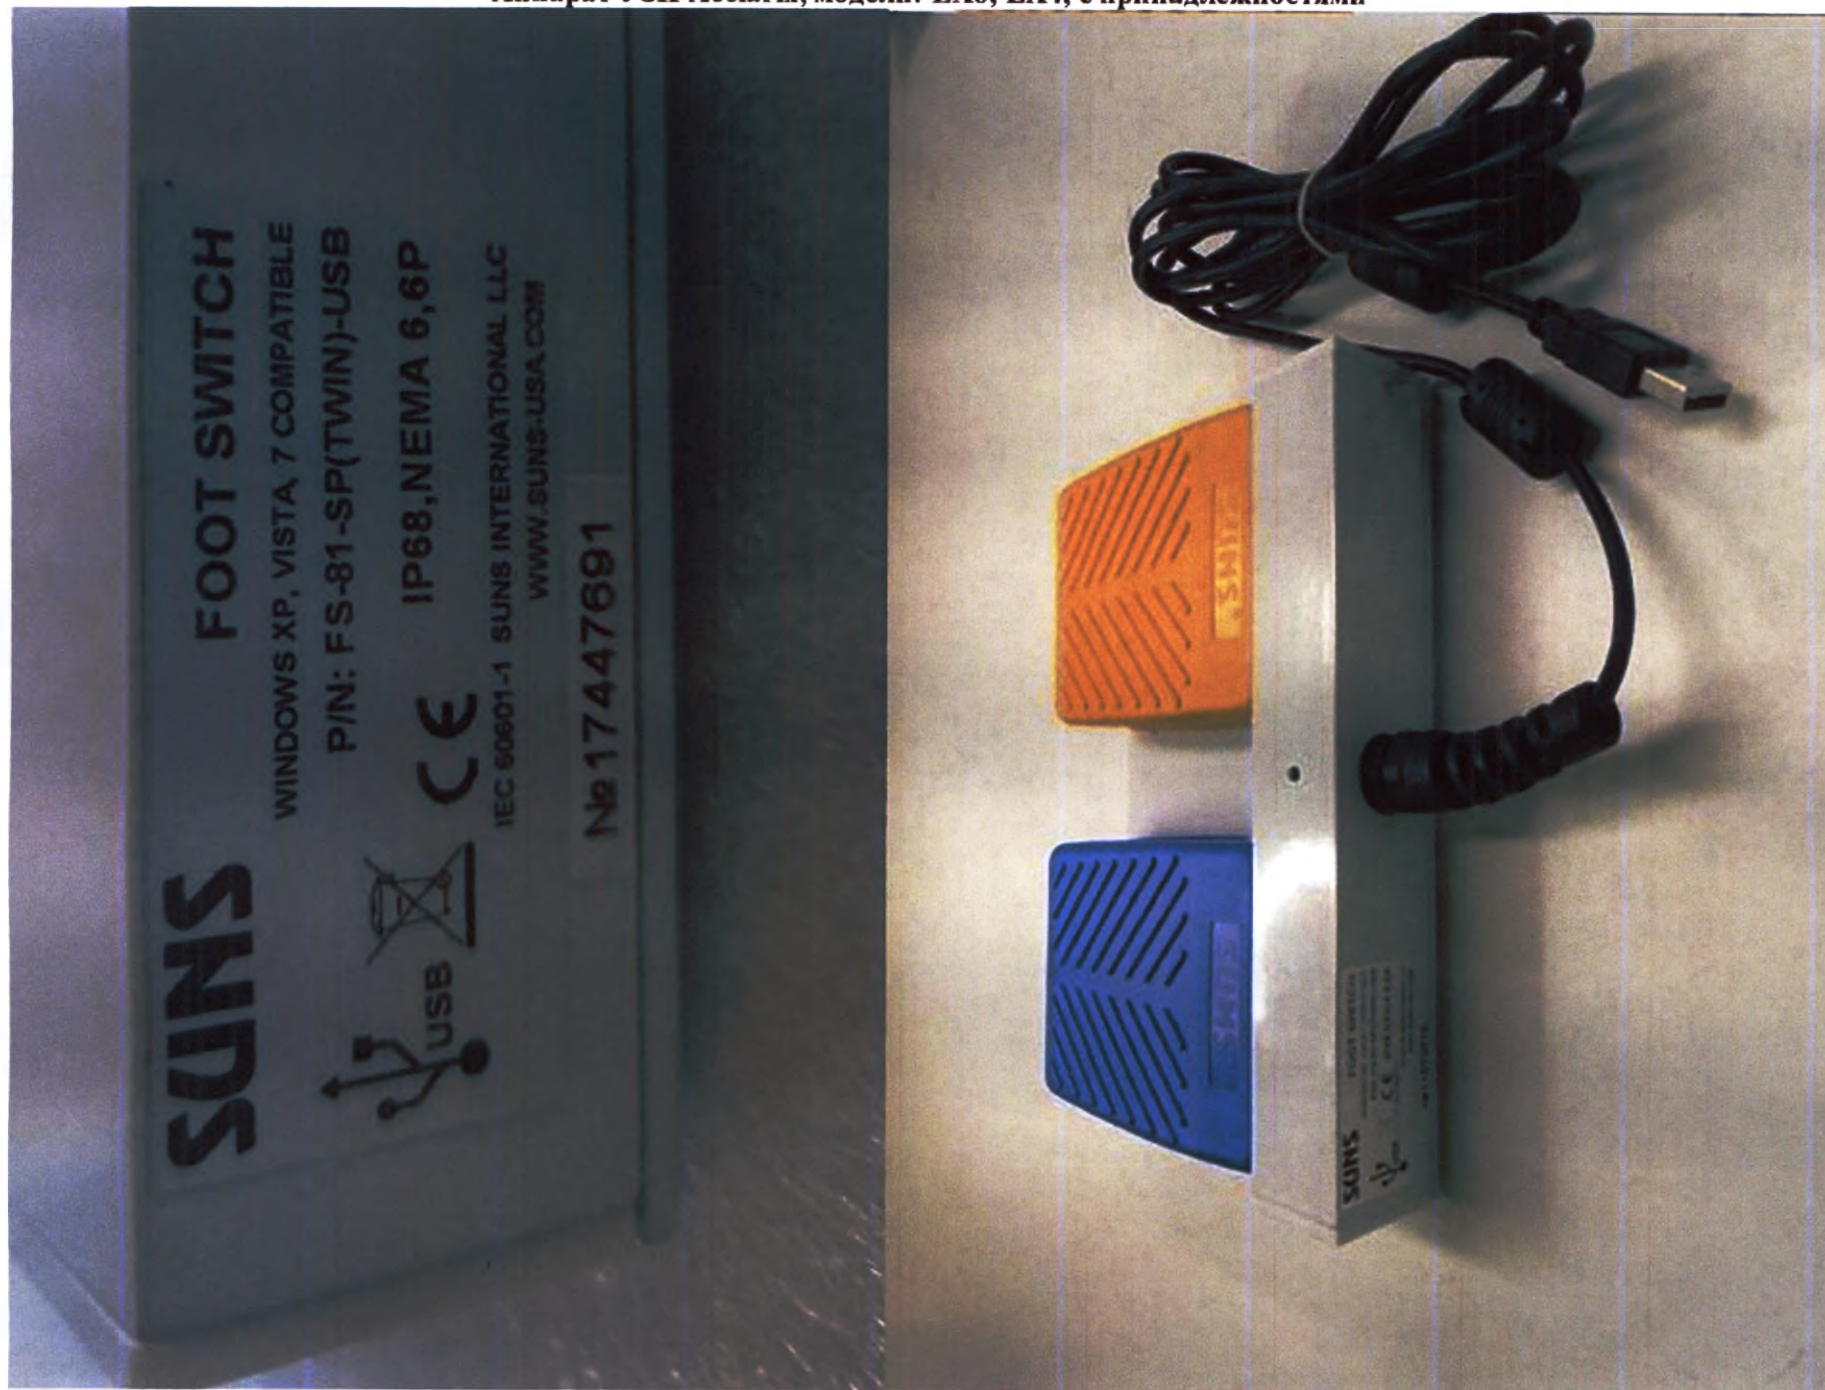


Рисунок 27.1.

Аппарат УЗИ Asclagix, модели: LX8, LX4, с принадлежностями



Рисунок 28.

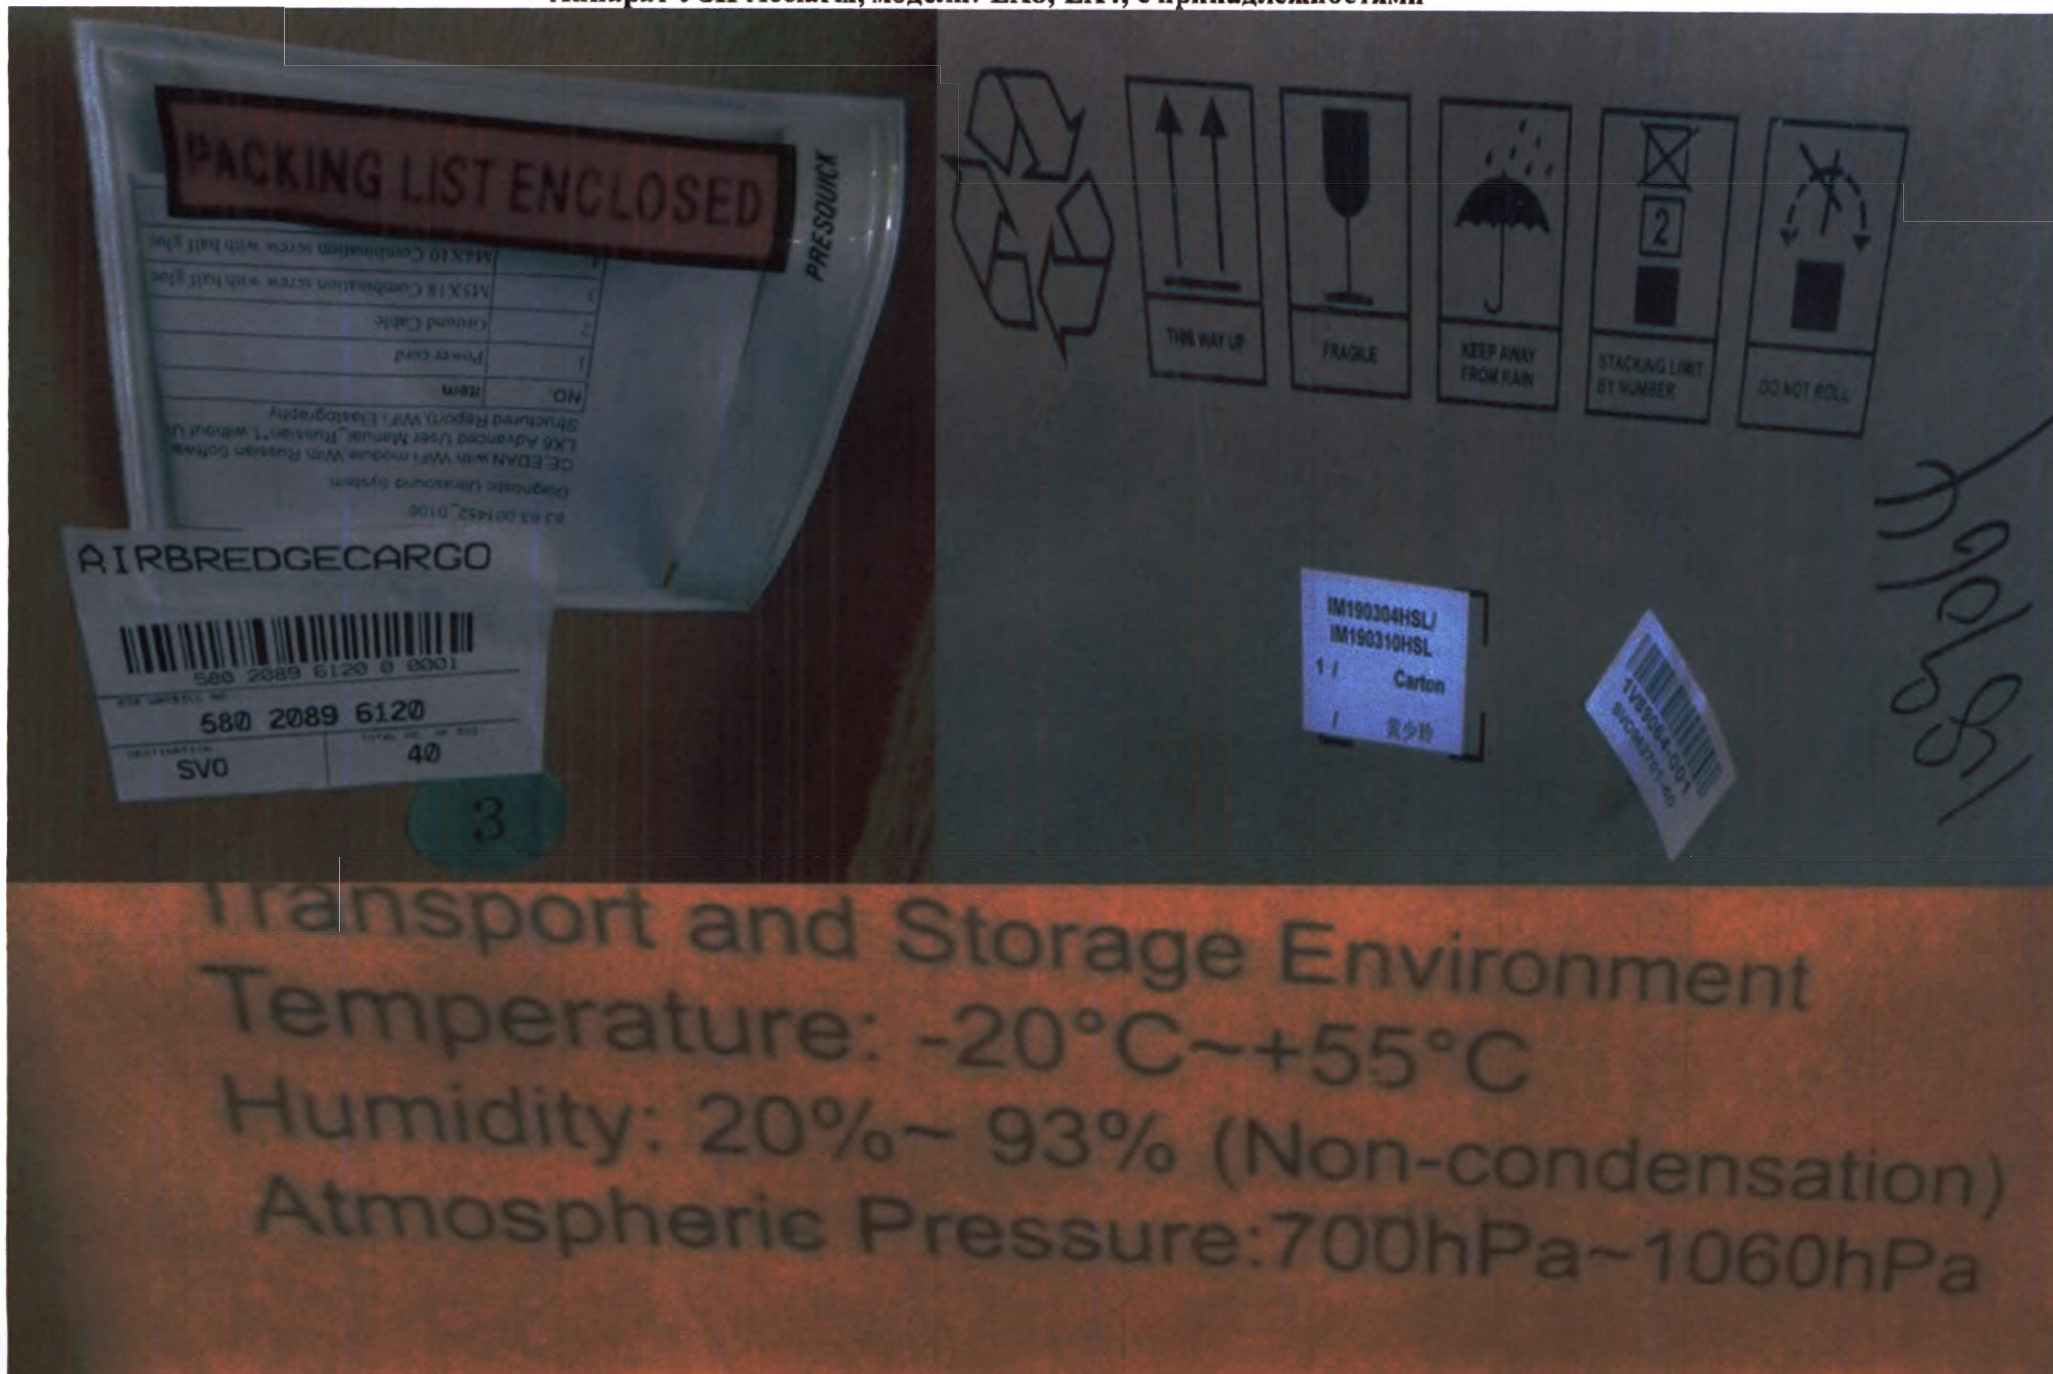


Рисунок 29.

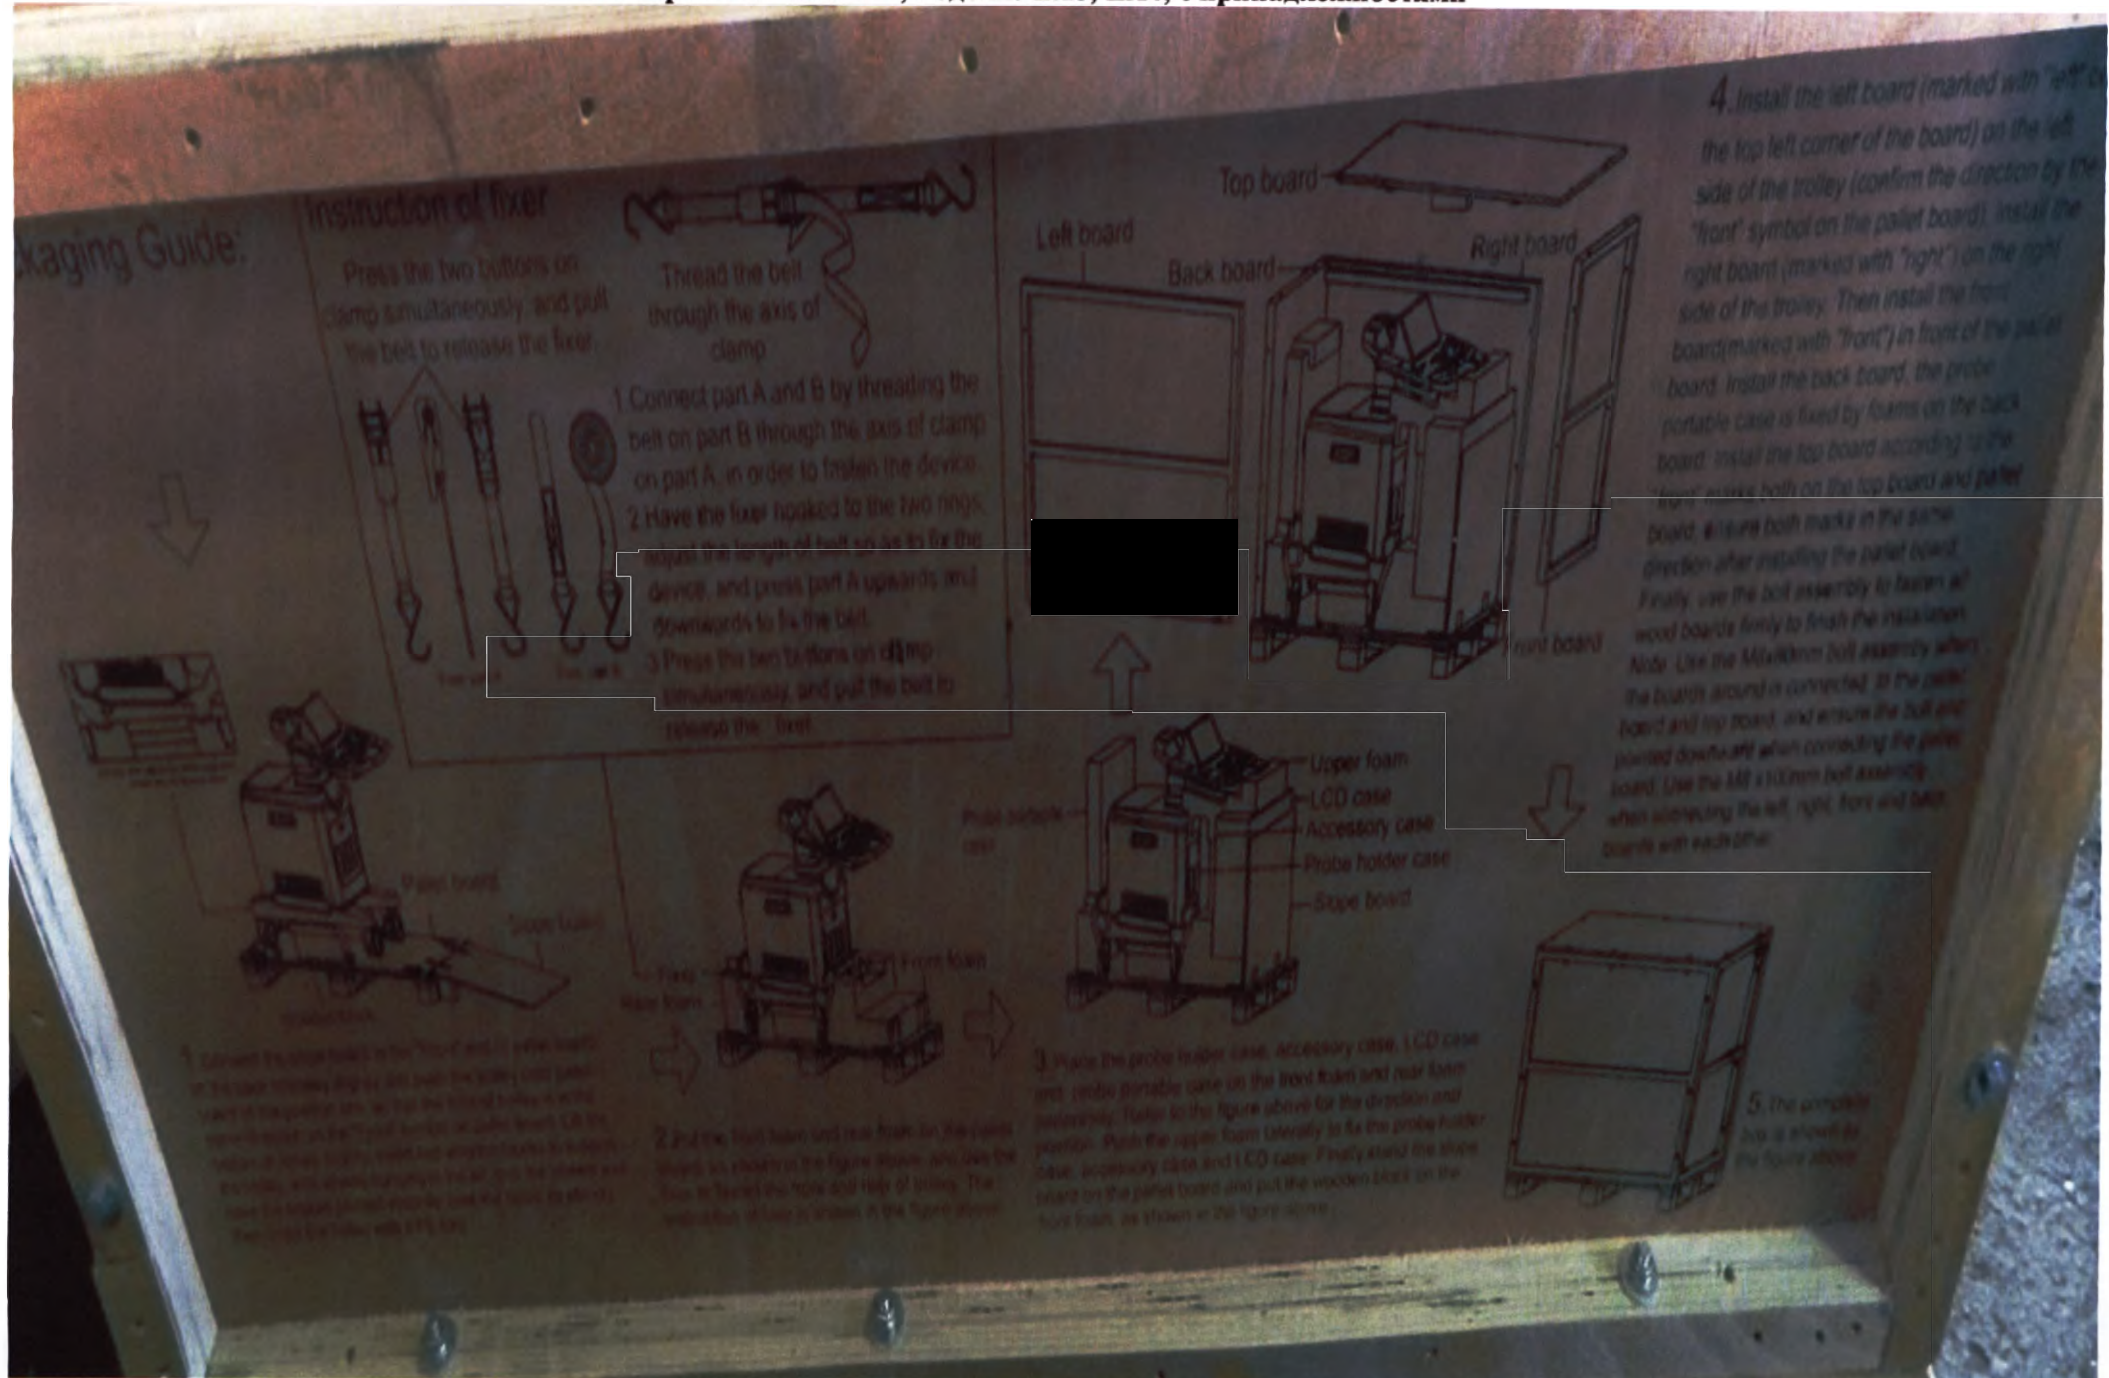


Рисунок 30.

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью на
42 листах

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
ЦЗЯНЬ ШУАИ

