


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»
Носова Т.А.

10.09.2019 г.




Фотографические изображения изделия:

Набор калибраторов для количественного определения тестостерона (Testosterone (TESTO CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd («Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд. »), Китай

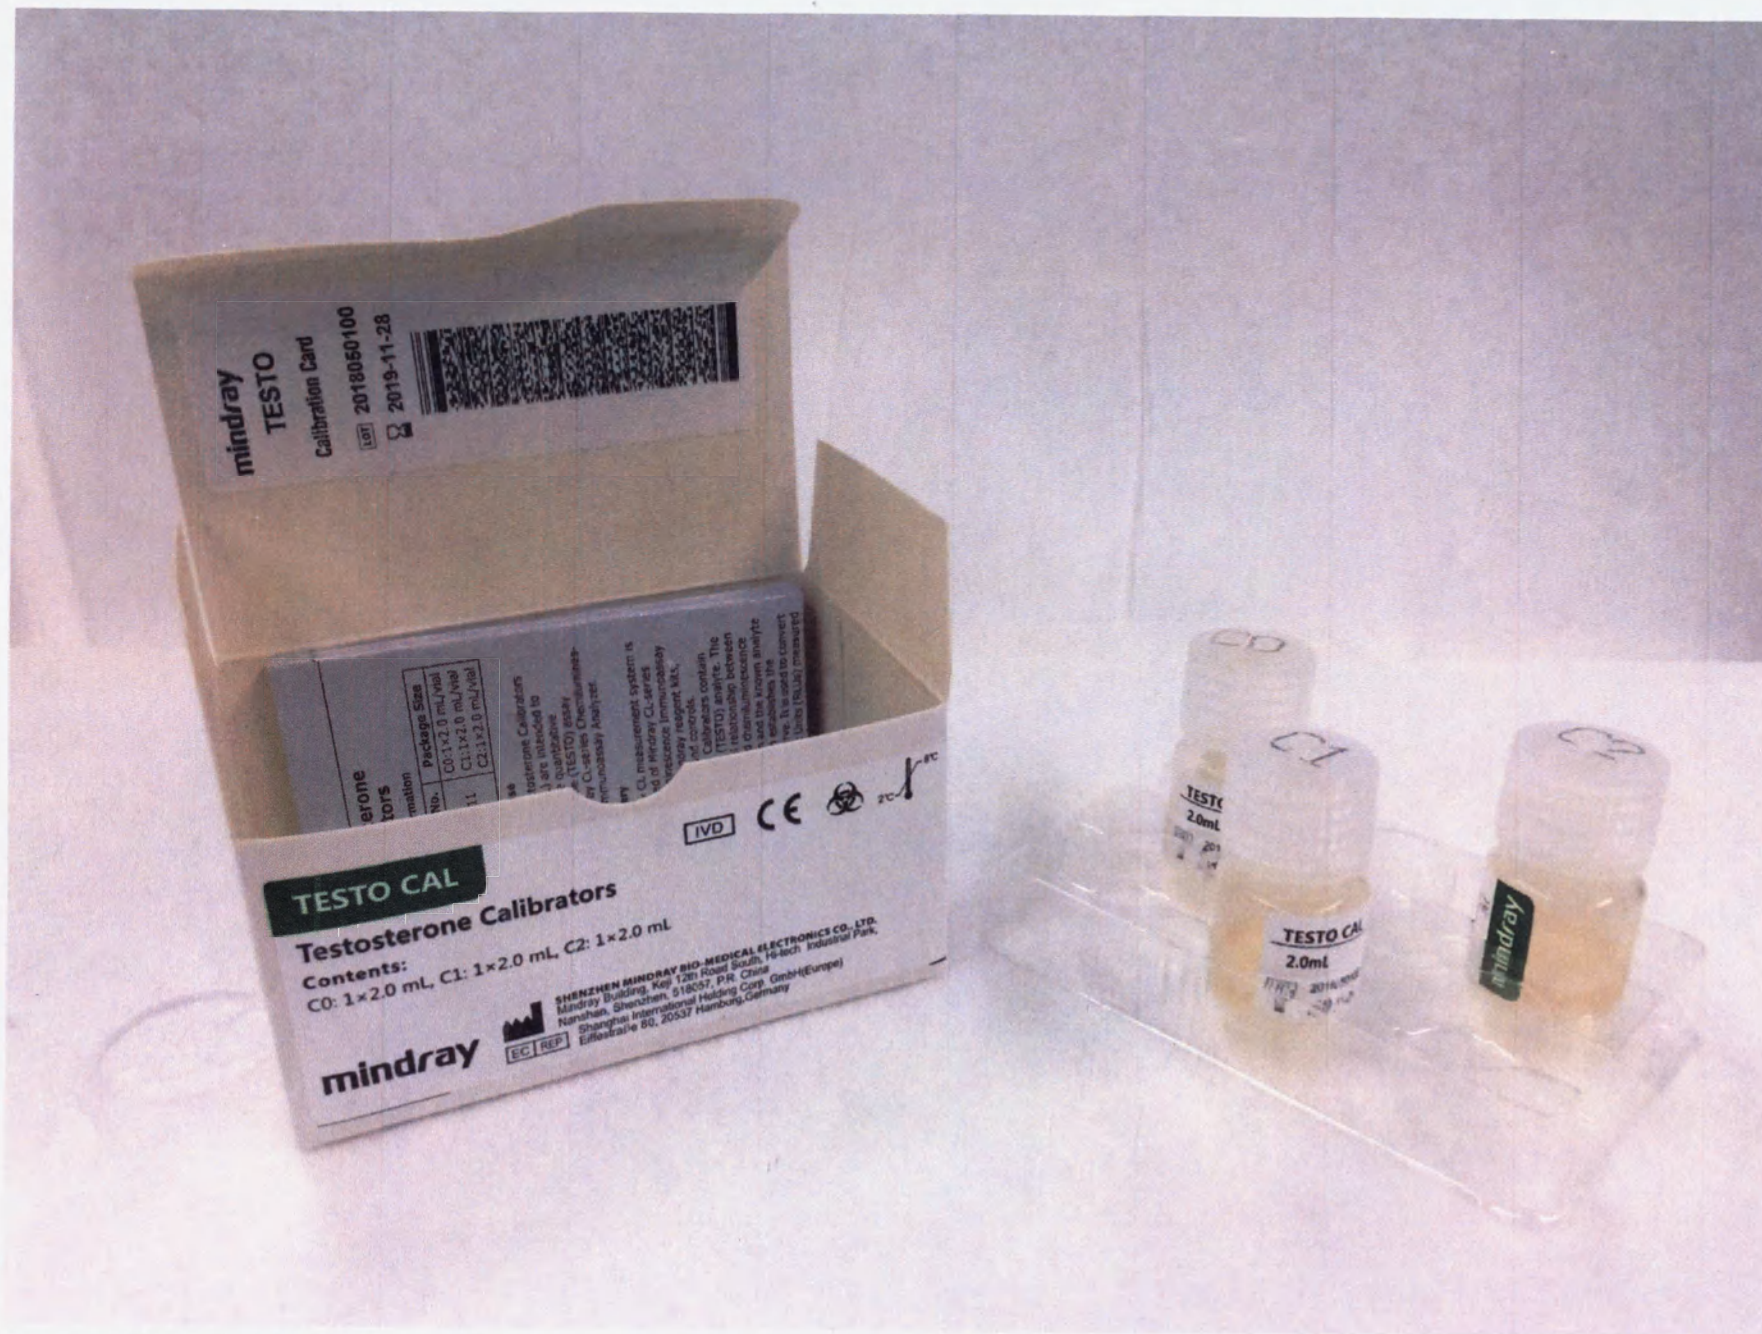

Общий вид медицинского изделия (Набор калибраторов для количественного определения тестостерона (Testosterone (TESTO CAL)) иммунохемилуминесцентным методом в стандартном образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro)), в варианте исполнения TESTO211

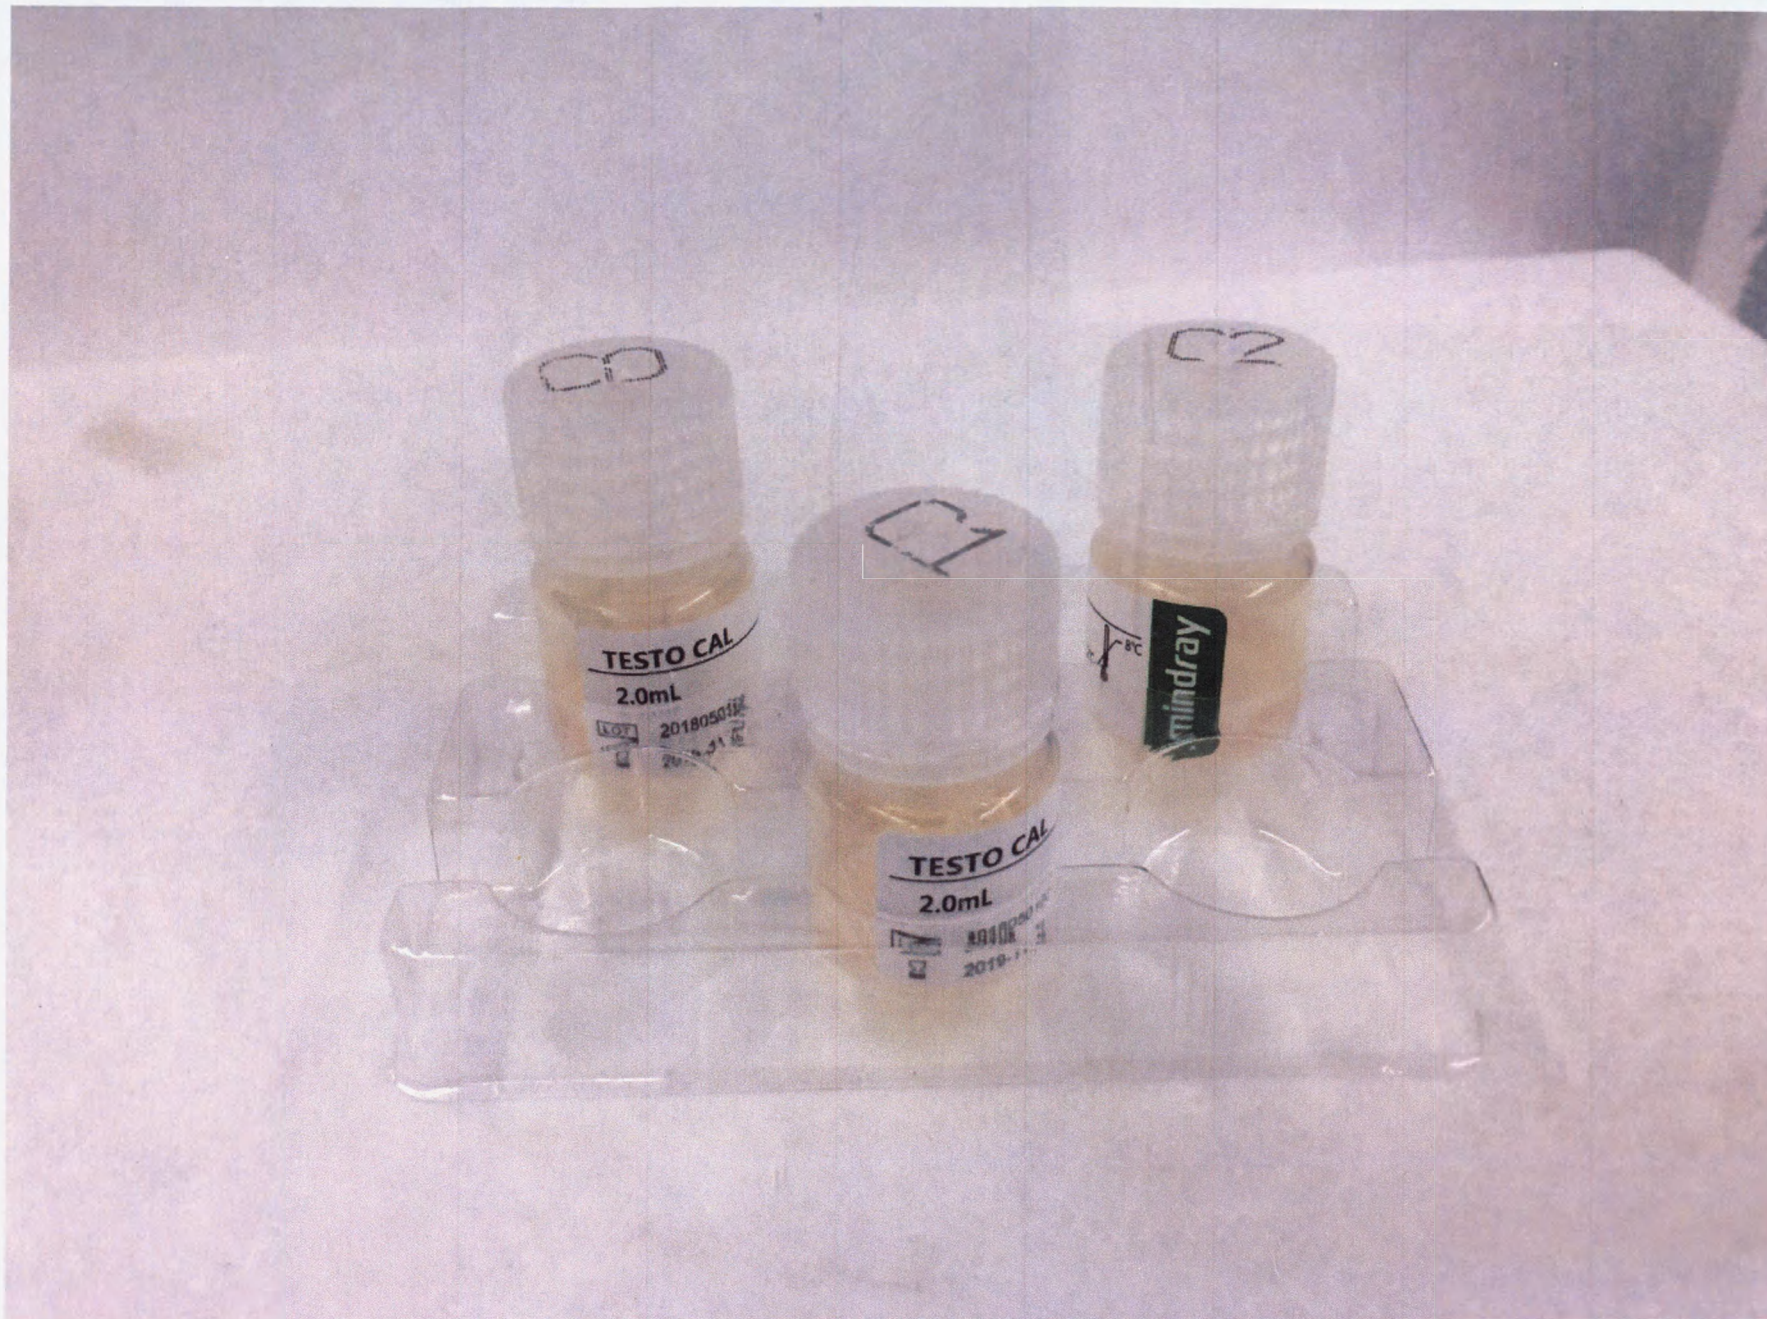

Фотографическое изображение флаконов

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 3 листа (-ов)

Генеральный Директор Носова / Носова Т.А.
М.П.

