

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Регистратор цифровой для холтеровского мони-
торинга CardioMet с принадлежностями***

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента регистрации и серти-
фикации Россия и СНГ

ООО «ДжиИ Хэлскеа»




С.Б. Парахина

1. Регистратор в сборе.



Пример маркировки

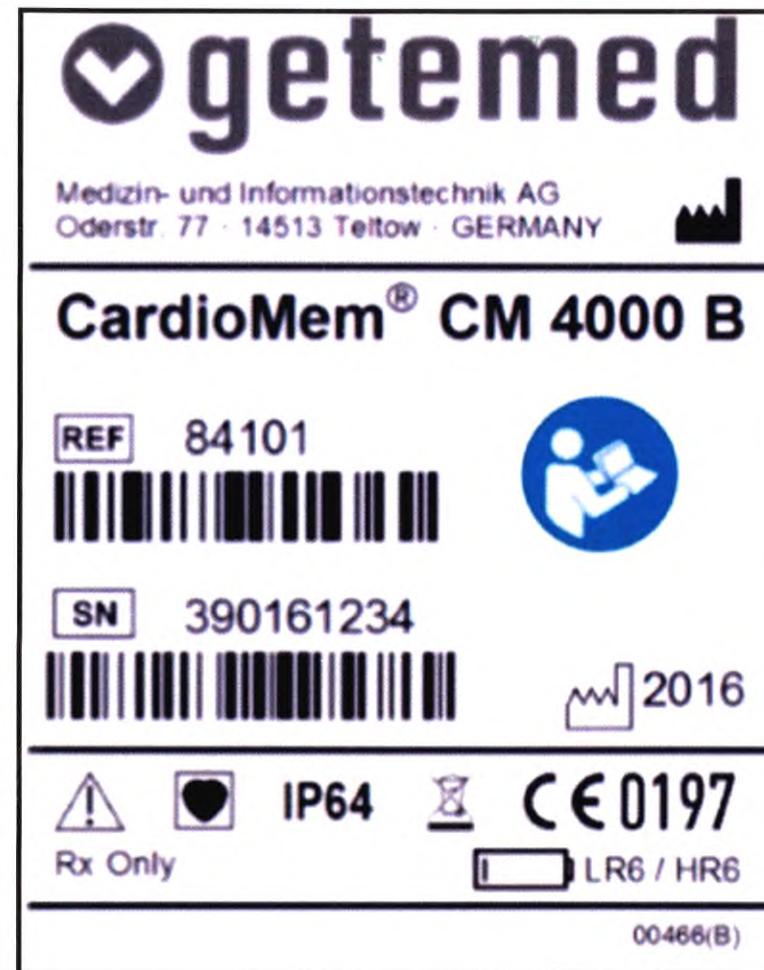

Текст на английском	Перевод
GERMANY	Германия
Rev	Версия



Руководство пользователя

 CardioMem® CM 4000 / CM 4000 B 

ЭКГ-регистратор

Редакция D

© 2010 getemed
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 10
тел. (495) 740-00-00

1. Аккумуляторы AA (не более 12 шт.).



2. Аккумуляторы AAA (не более 12 шт.).



3. Батарей AA (не более 20 шт.).




4. Батарей AAA (не более 20 шт.).




5. Устройство зарядное.



6. Кабели отведений (не более 50 шт.).

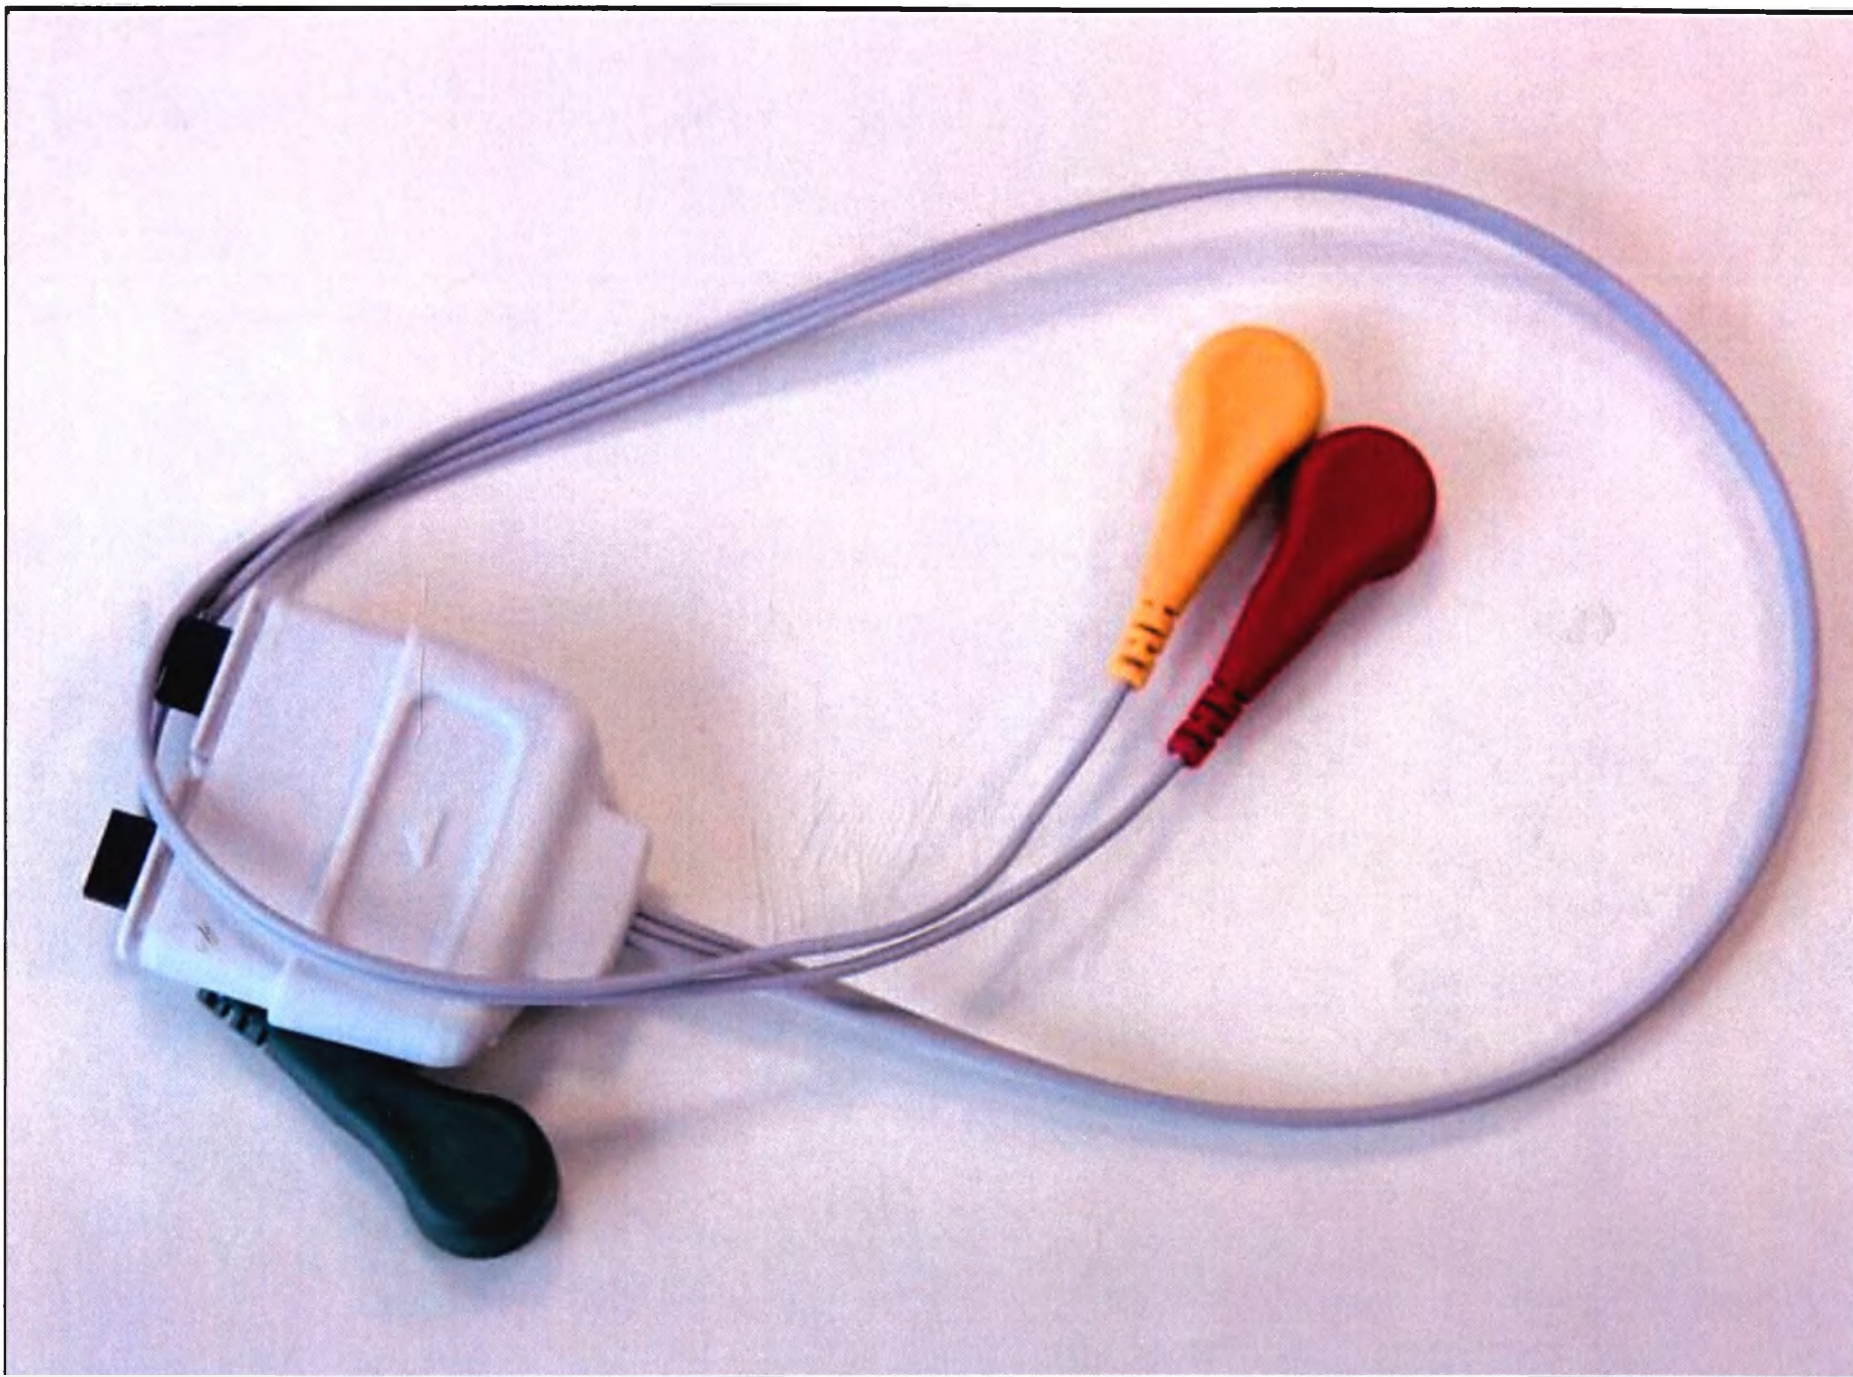


7. Кабели пациента (не более 50 шт.).

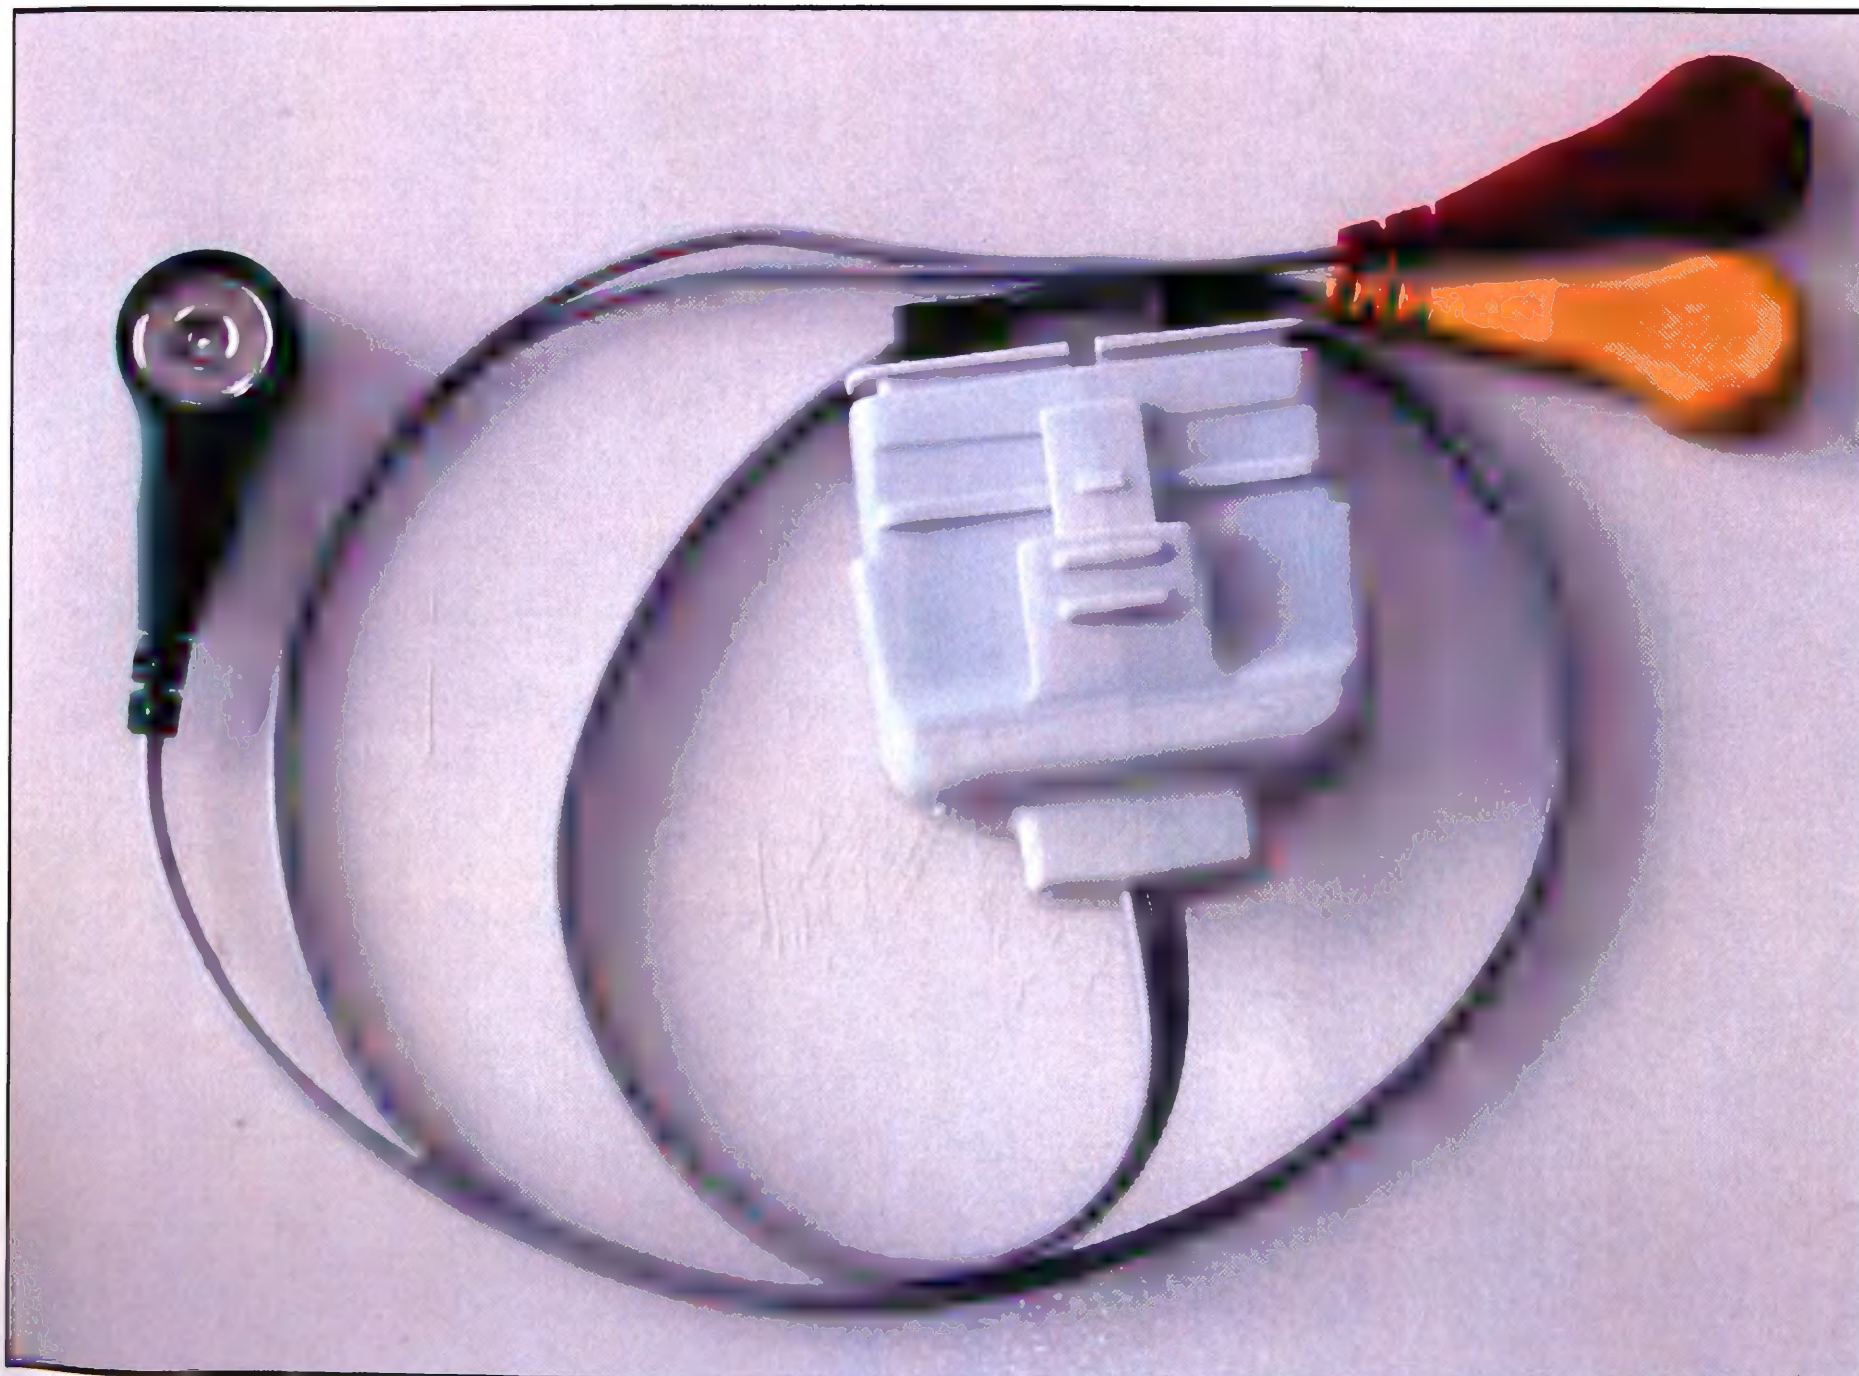


8. Кабель для последовательного порта.




9. Кабель соединительный USB (не более 5 шт).

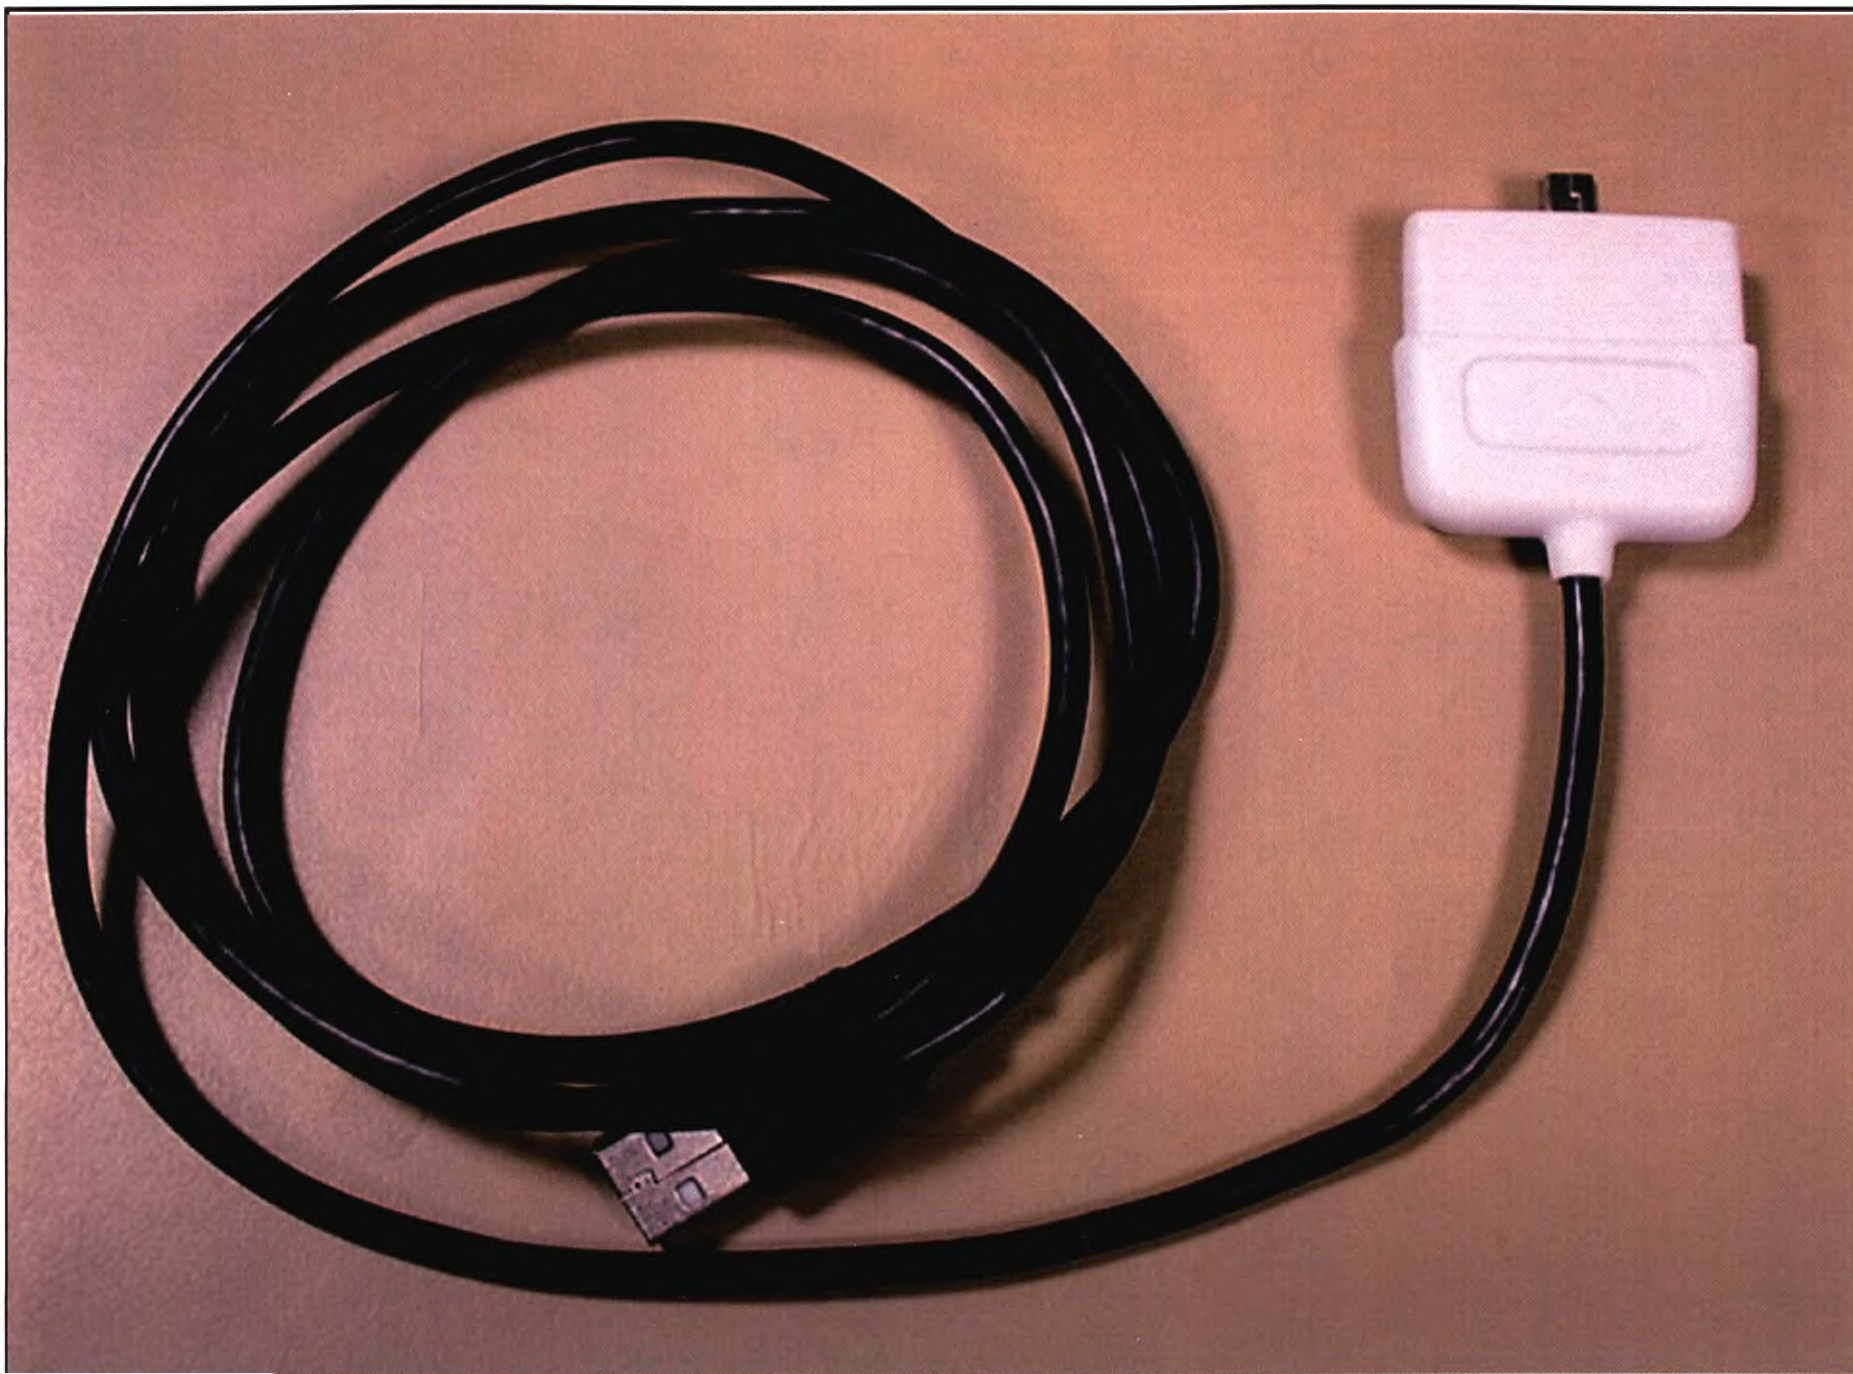


10. Кабели ЭКГ на 12 каналов (10 отведений) (не более 30 шт.).

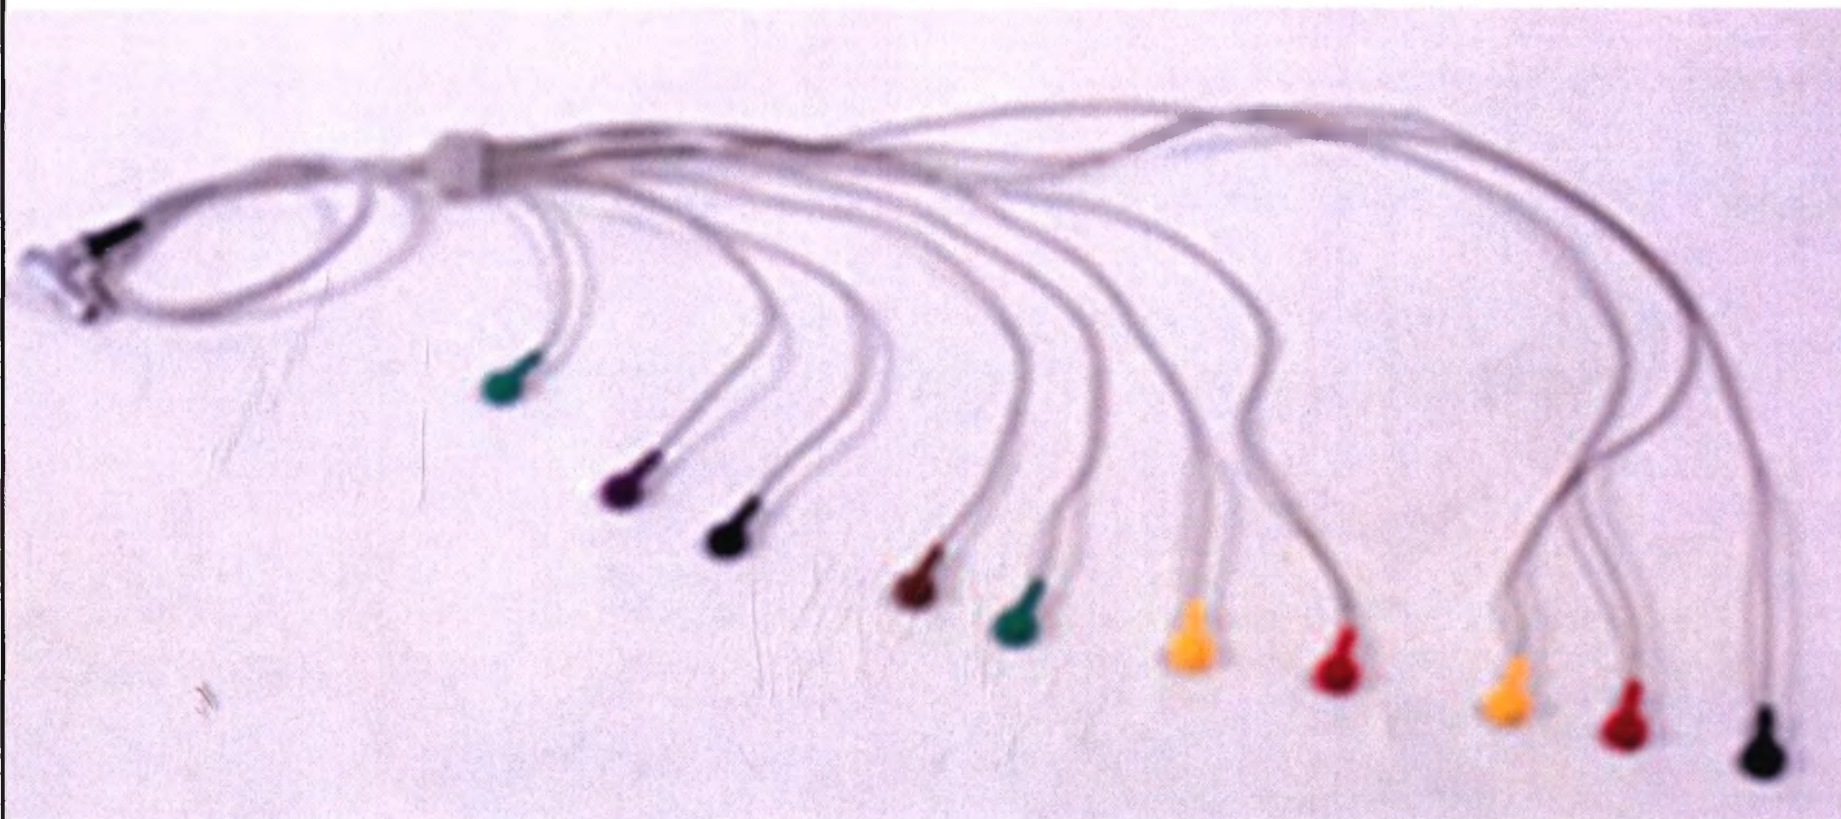


11. Кабели ЭКГ на 2 канала (5 отведений) без защиты от разряда дефибриллятора 50 см (не более 30 шт.).

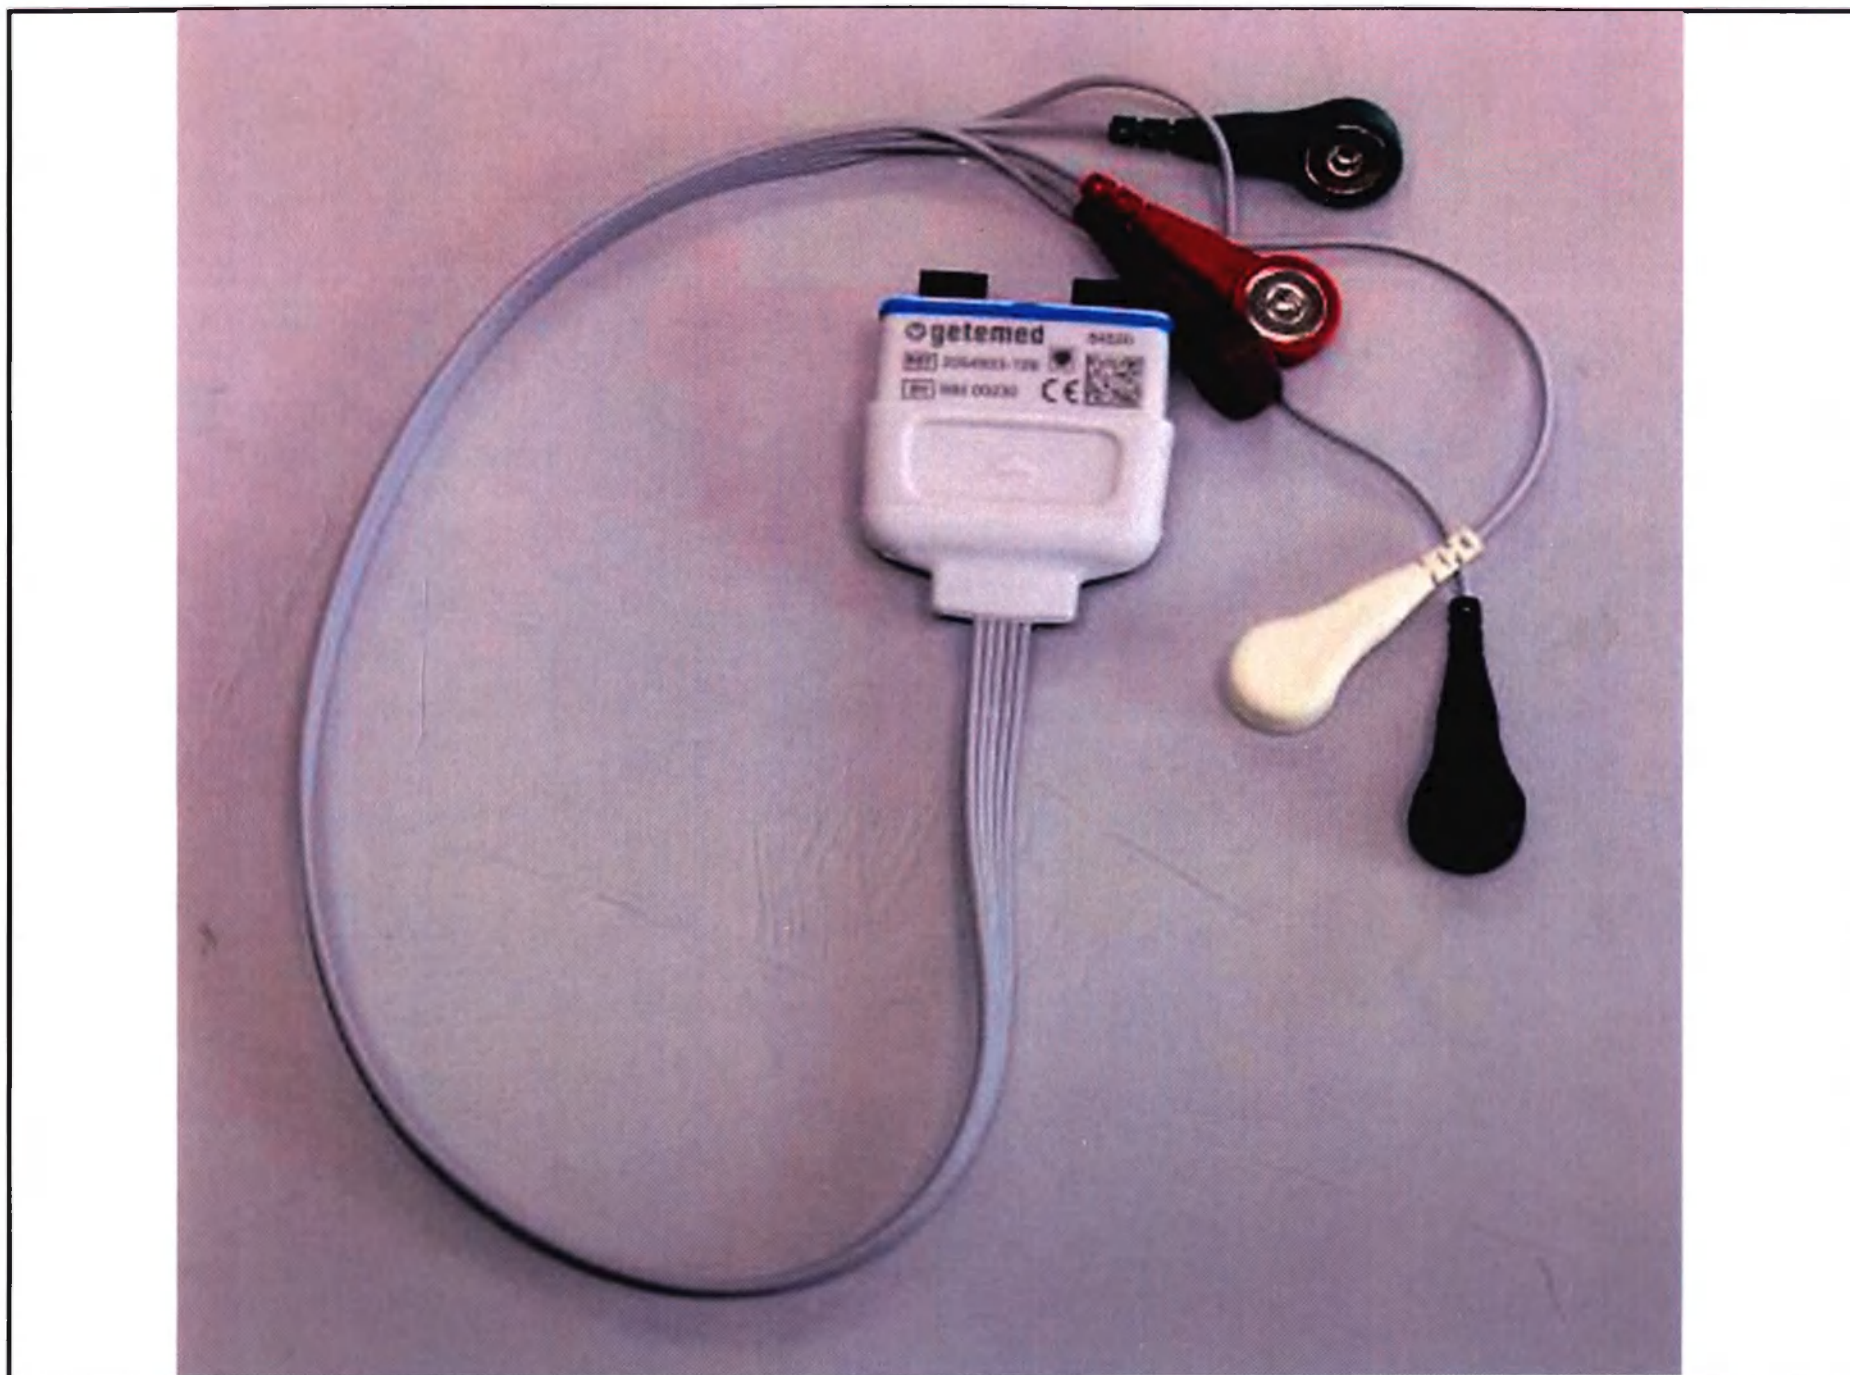


12. Кабели ЭКГ на 2 канала (5 отведений) без защиты от разряда дефибриллятора 80 см (не более 30 шт.).

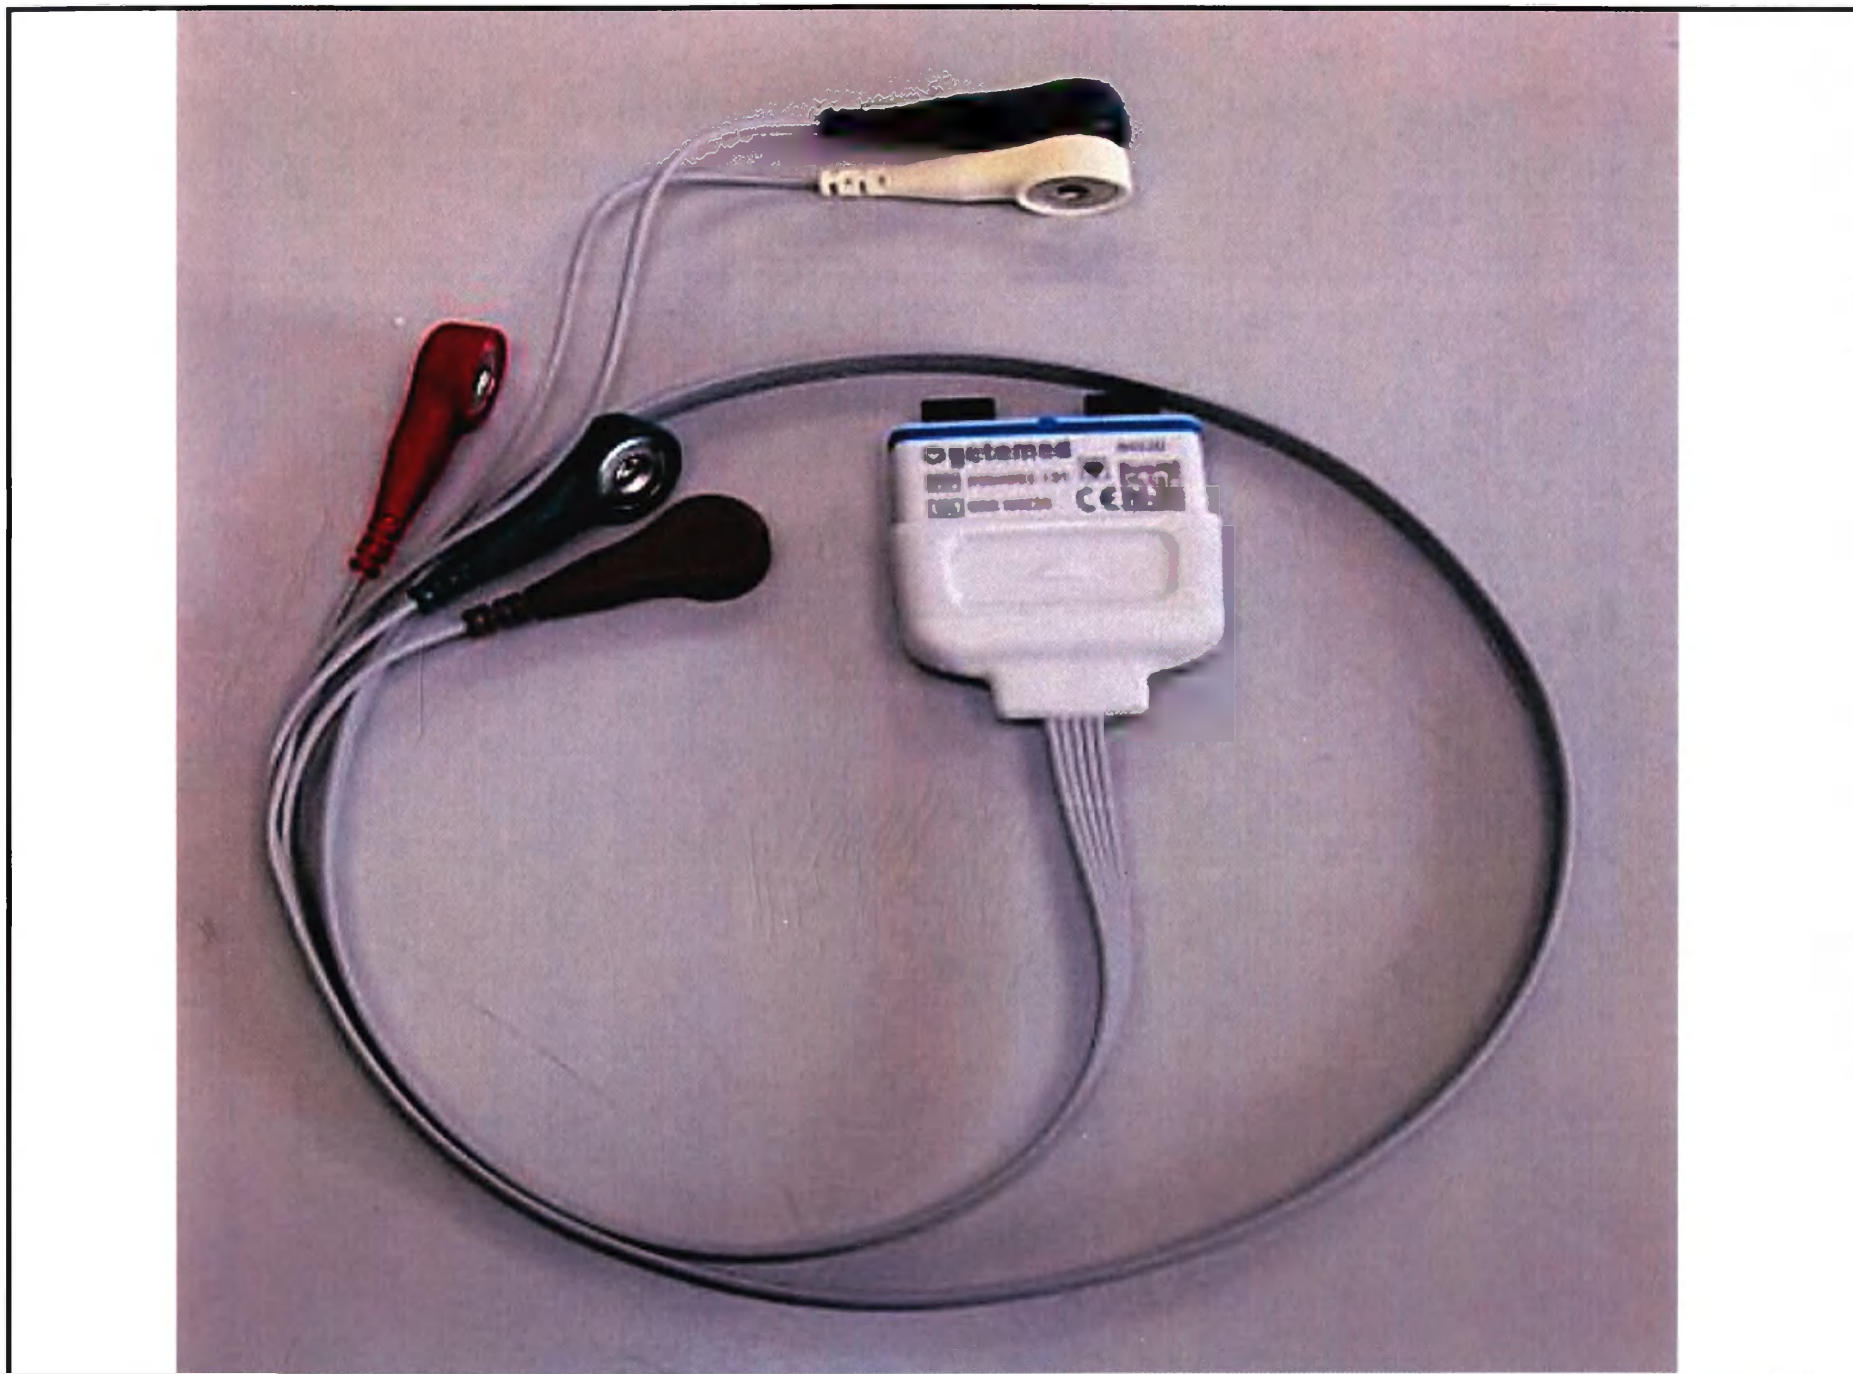

13. Кабели ЭКГ на 2 канала (5 отведений) (не более 30 шт.).

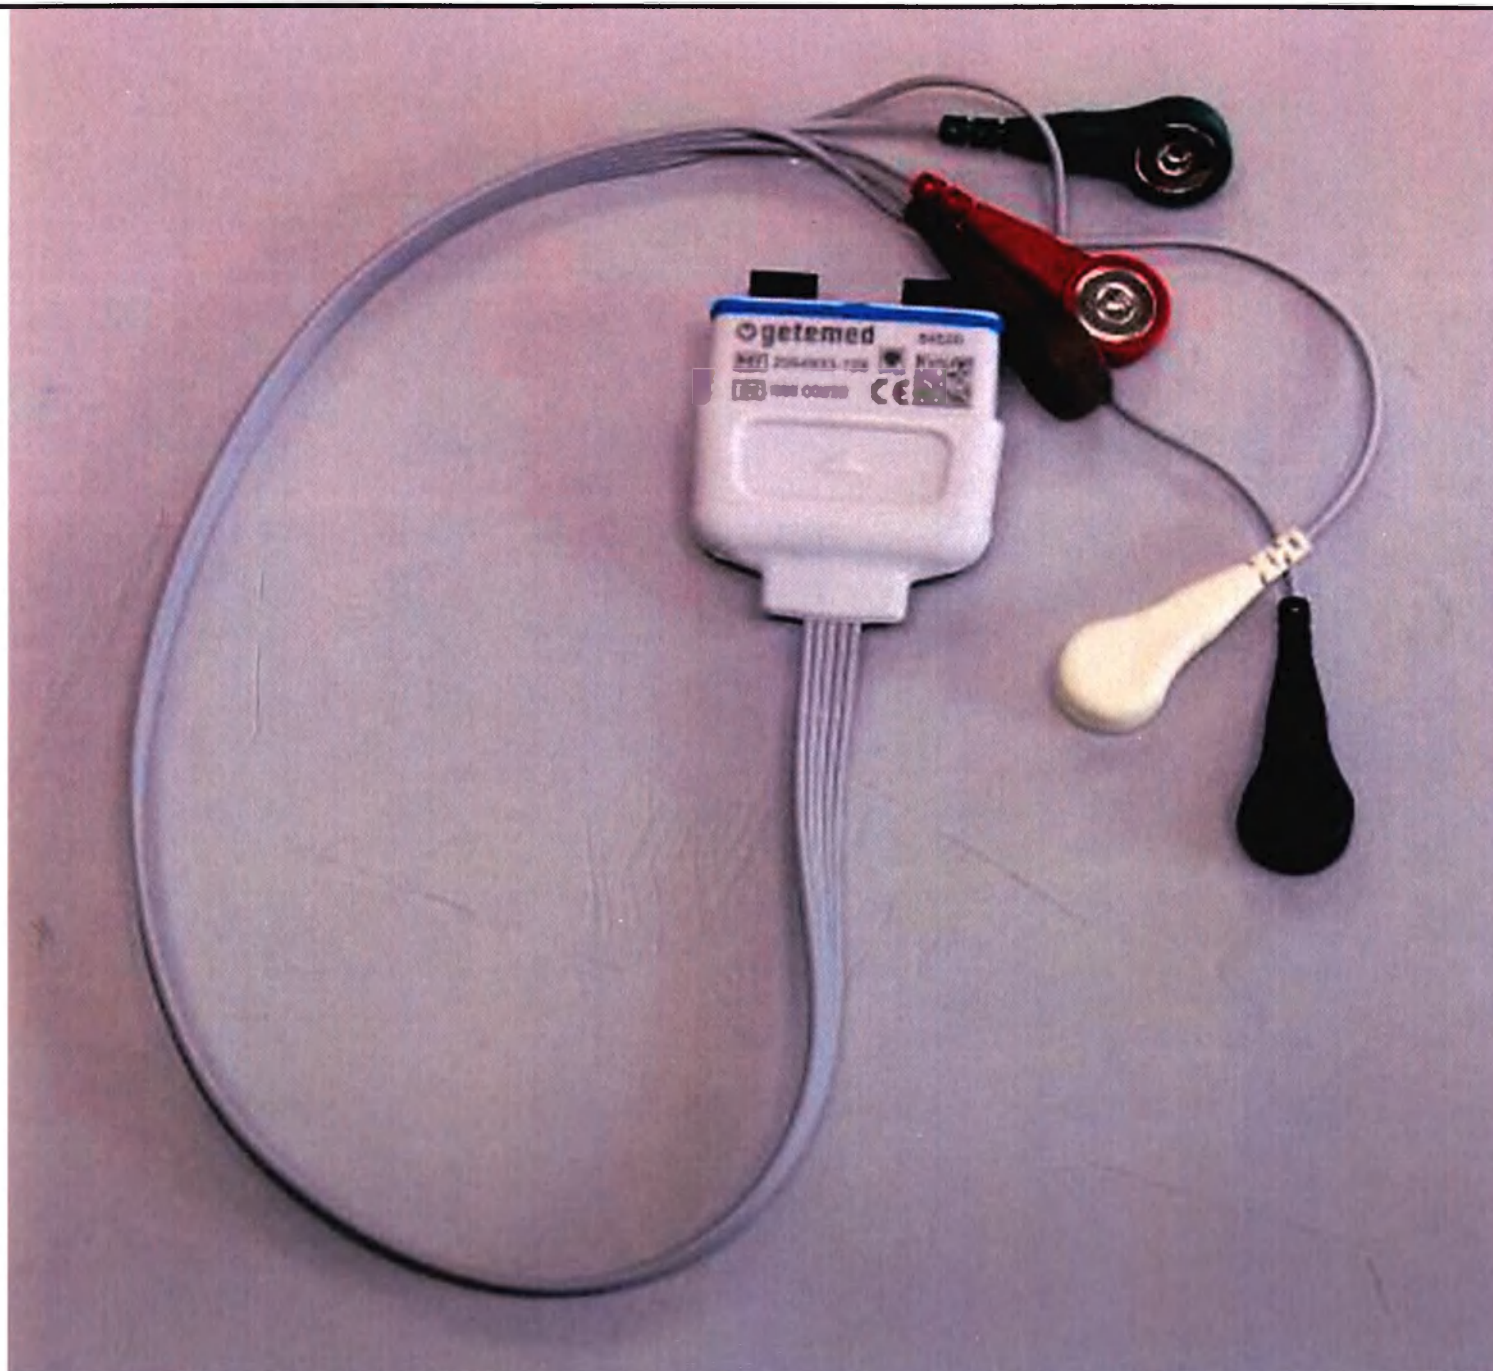


14. Кабели ЭКГ на 3 канала (7 отведений) без защиты от разряда дефибриллятора 50 см (не более 30 шт.).

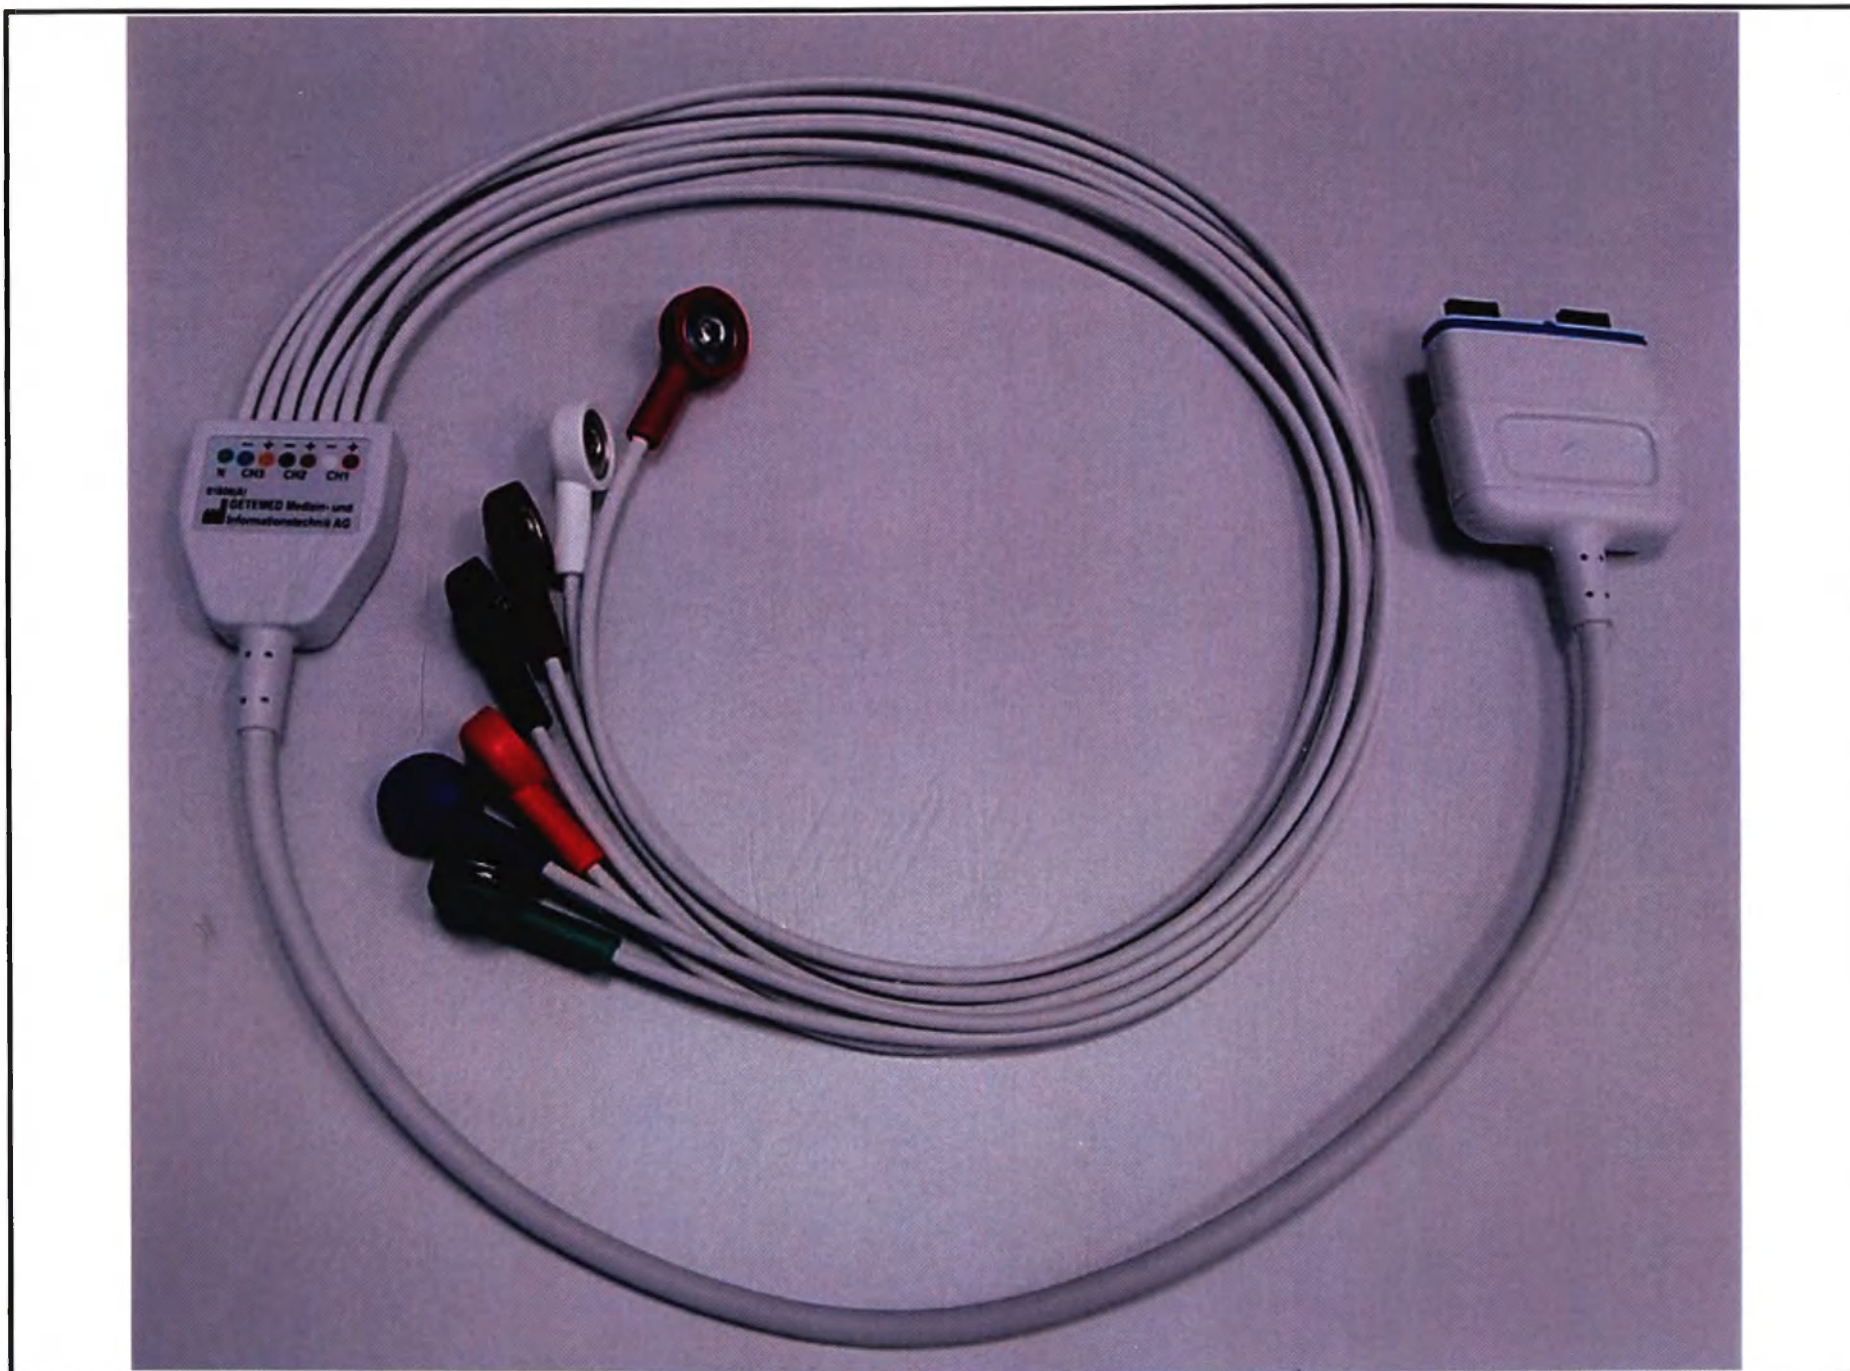


15. Кабели ЭКГ на 3 канала (7 отведений) без защиты от разряда дефибриллятора 80 см (не более 30 шт.).




16. Кабели ЭКГ на 3 канала (7 отведений) (не более 30 шт.).

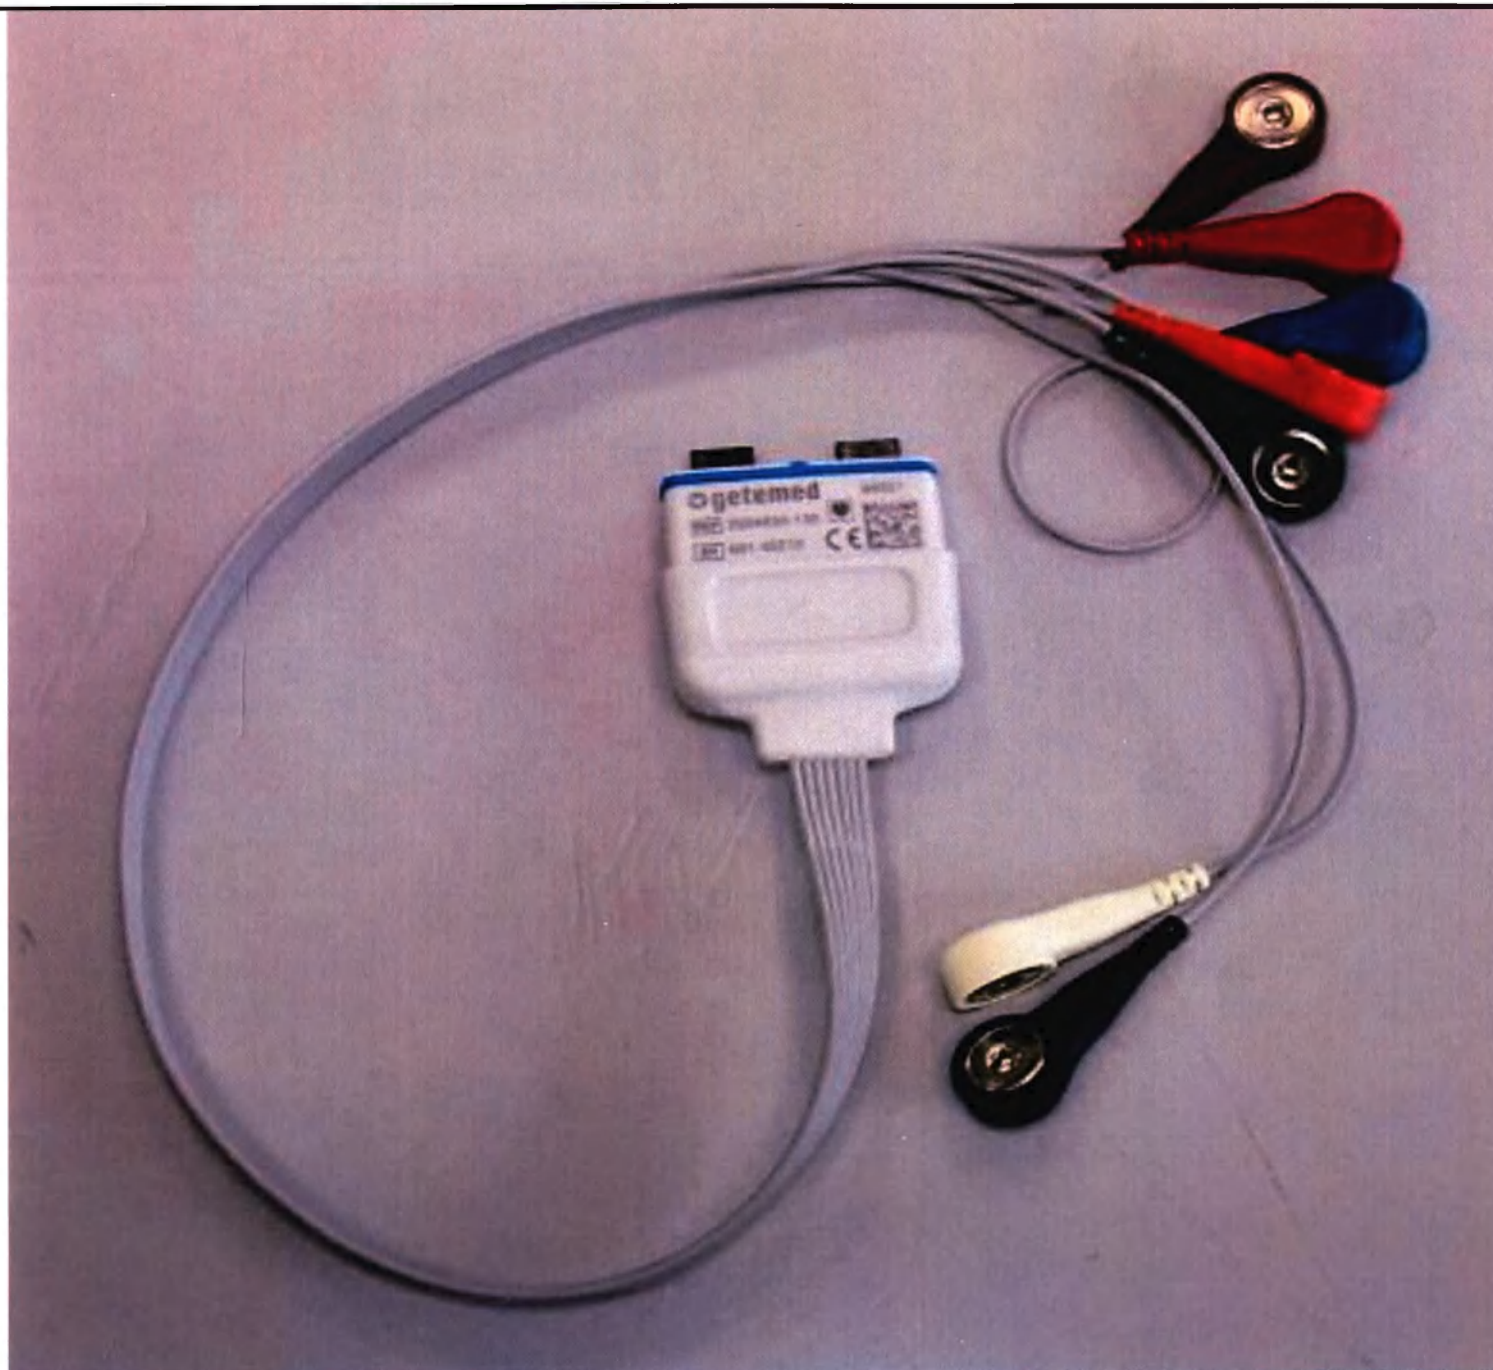

17. Карты памяти (не более 10 шт.).

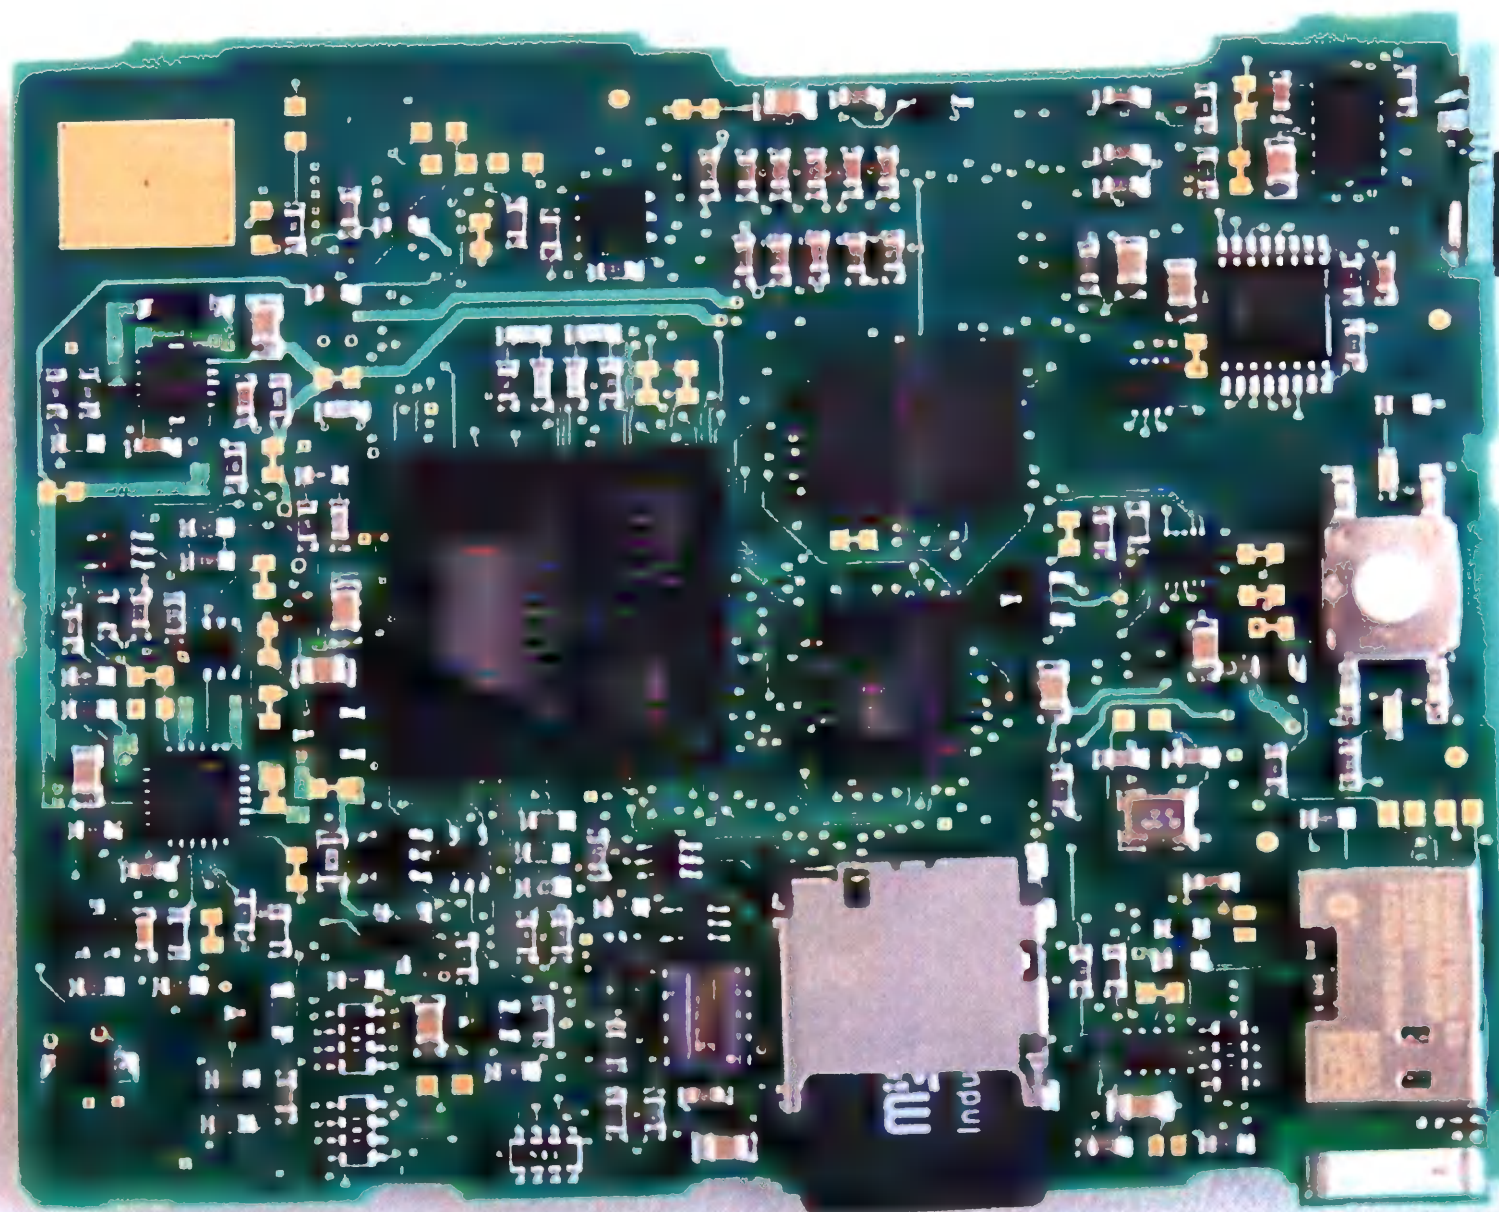


18. Кнопка включения/выключения.

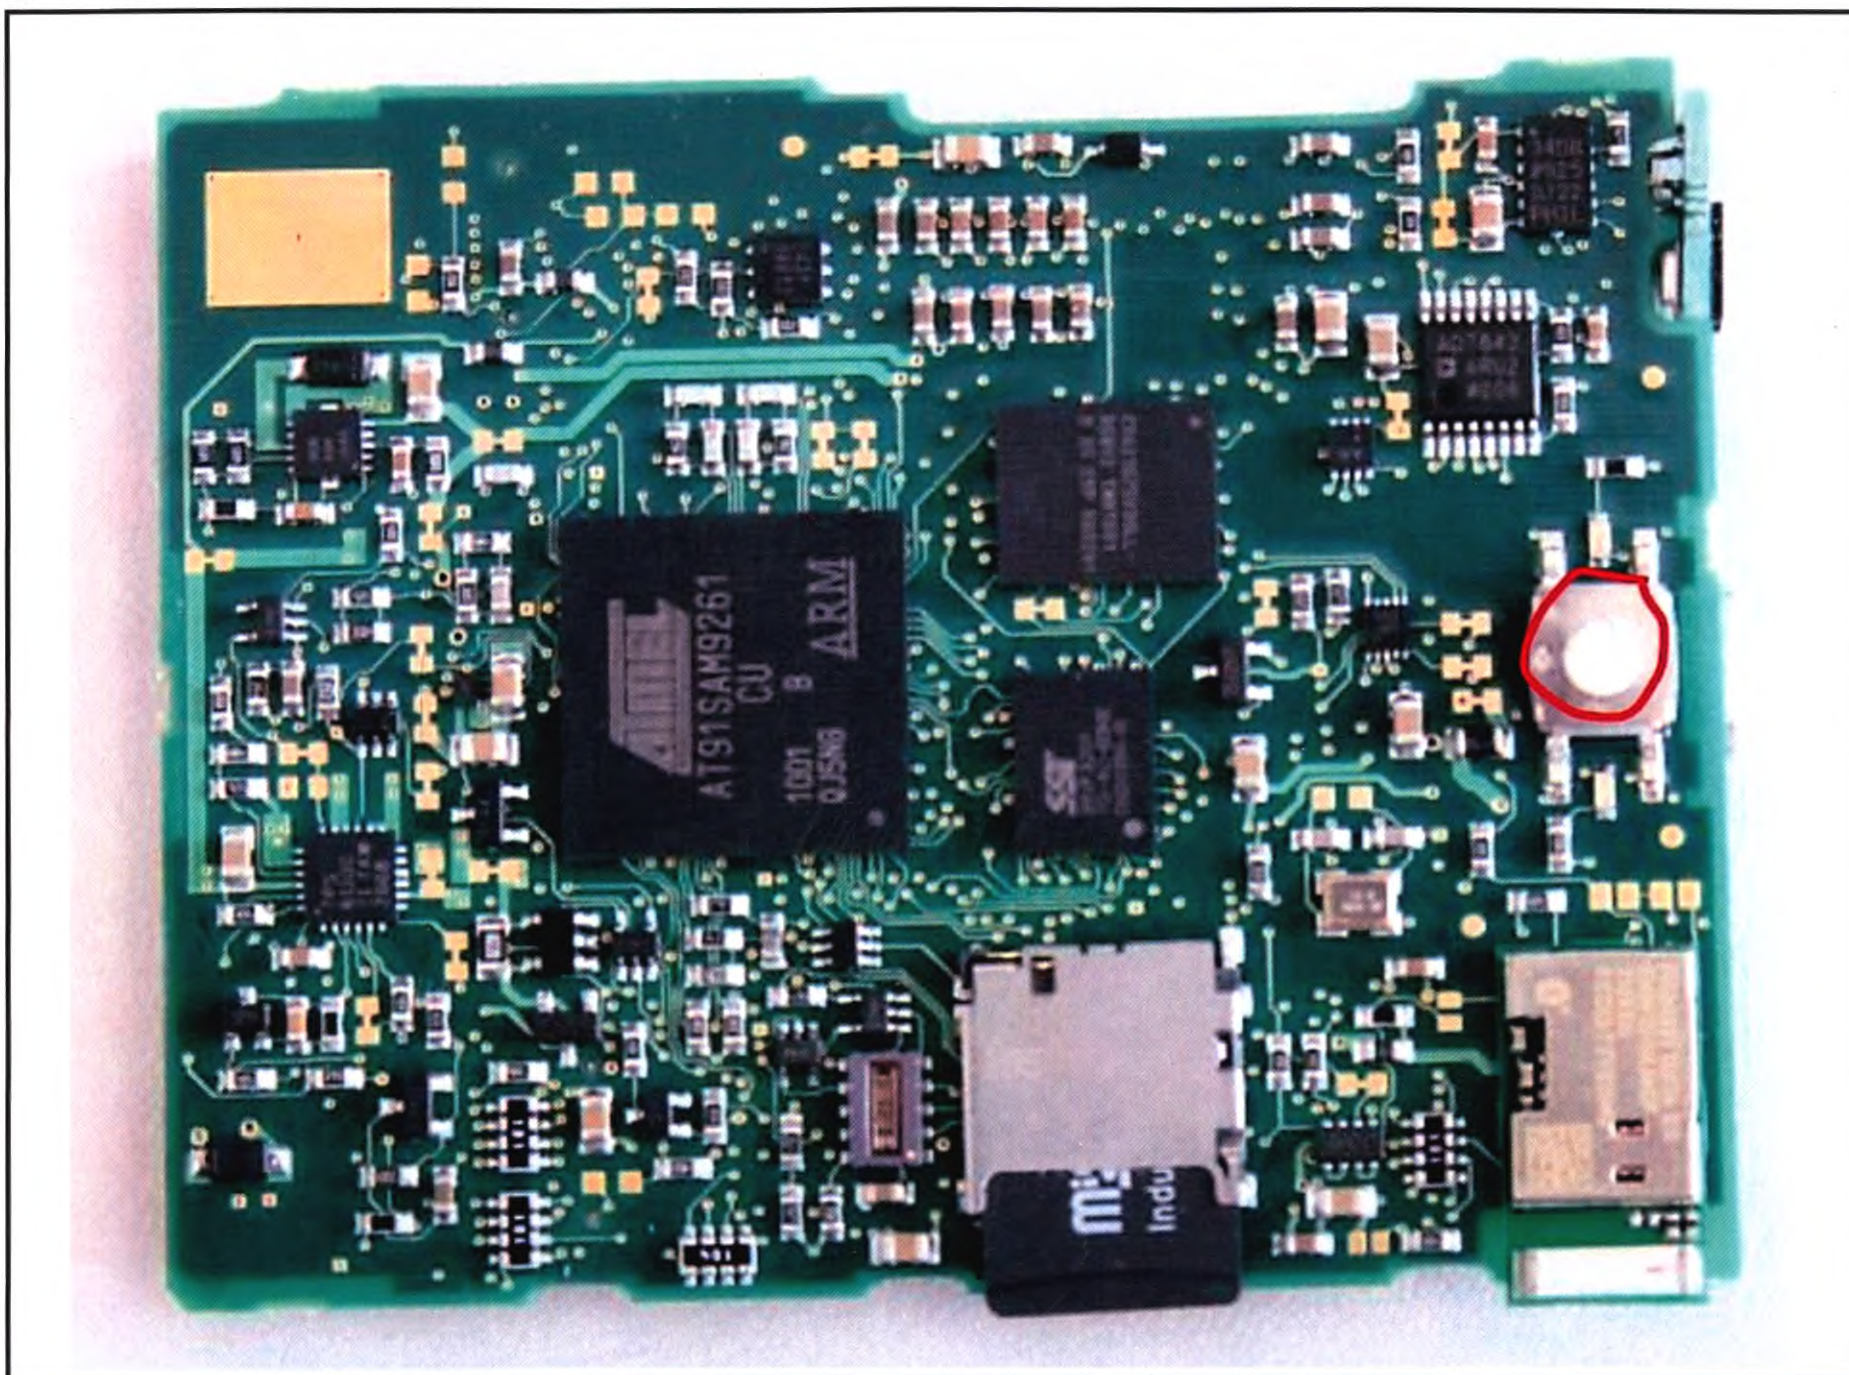

19. Компакт-диск с документацией (не более 5 шт)



20. Корпус регистратора.

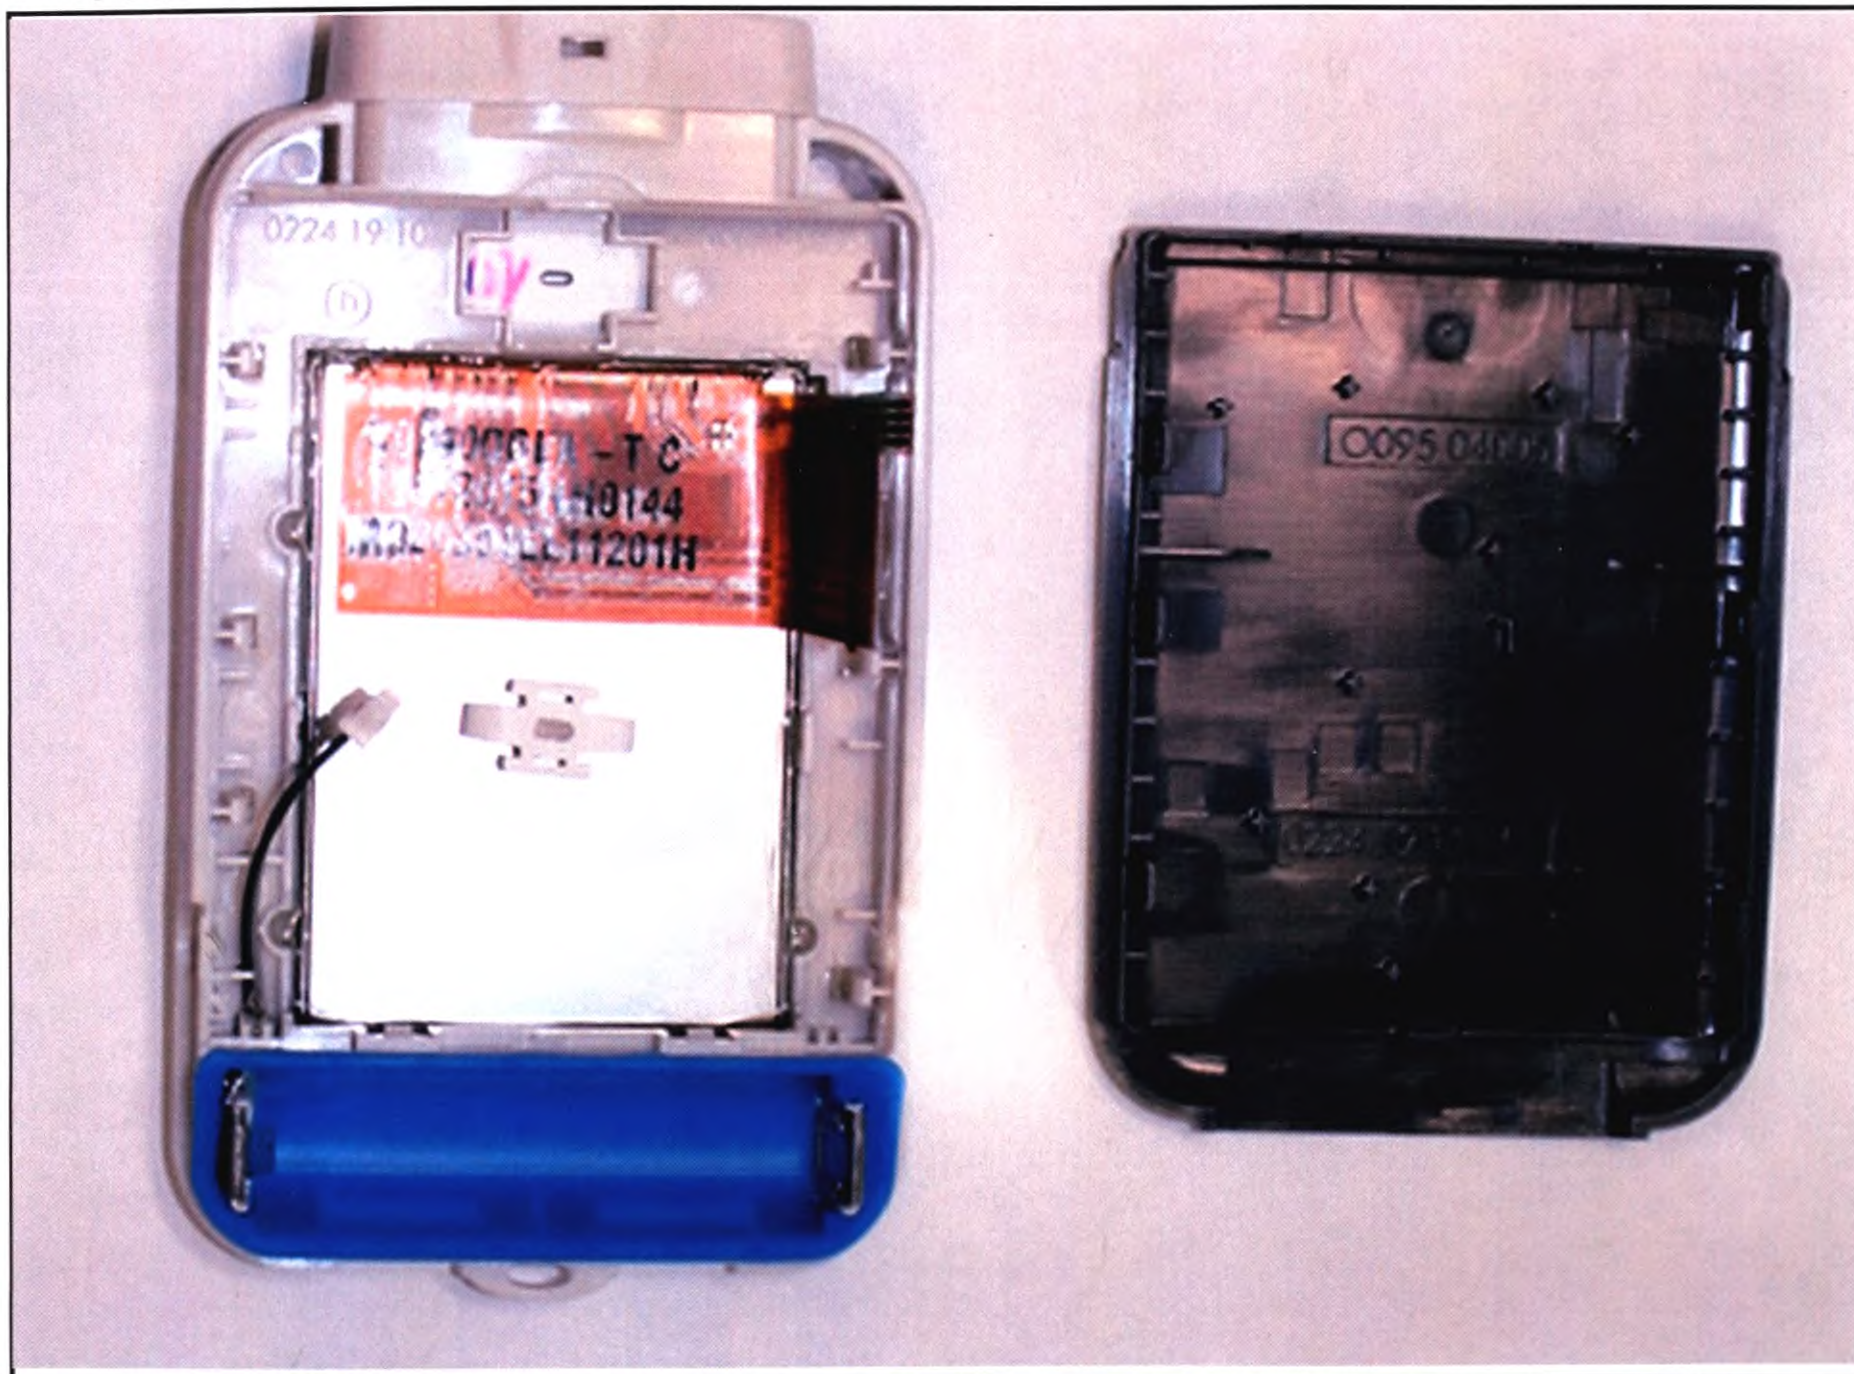




CardioMem® CM 4000 – Краткое руководство пользователя

Если кабель пациента подсоединен, регистратор автоматически показывает рекомендуемое расположение электродов.

- Экран справа от экрана «Электроды»: Проверка качества сигнала и начало записи
- Экран справа от экрана «Электроды»: Проверка установок, выключение регистратора

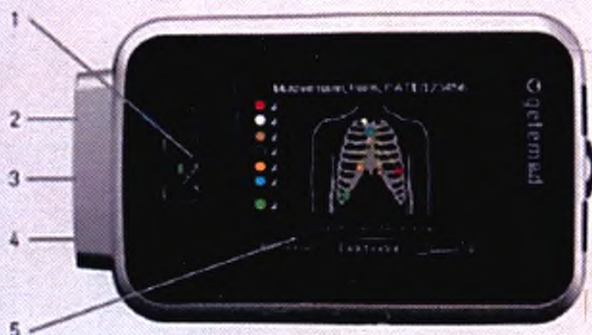


- 1 Кнопка включения/выключения и маркировки событий пациента
- 2 Подсоединение кабеля пациента
- 3 USB порт
- 4 Микрофон для речевой записи
- 5 Сенсорный экран

- Стрелки на сенсорном экране служат для переключения экранов и выбора типа установок
- Выбор установок производится нажатием на сенсорный экран
- Нажатие на ОК подтверждает выбор
- Нажатие на символ приводит к выходу из меню без сохранения изменений



Наложение электродов, проверка качества сигнала, начало записи

- Включить регистратор
- Подсоединить кабель пациента к регистратору
- Наложить электроды на пациента
- Соединить электроды с кабелем пациента
- Ввести или проверить данные пациента
- Проверить расположение электродов и качество сигнала
- Начать запись

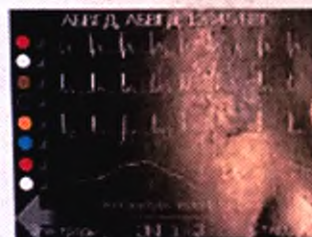

Закончить и считать запись

- Чтобы закончить запись нужно держать кнопку включения нажатой некоторое время
- Для считывания записи нужно подключить регистратор к ПК используя USB кабель



0816H1-LAB-0001-Rev A-CM-4000-KSA-RU.doc


22. Крышка для батарейного отсека АА.




23. Крышка для батарейного отсека AAA.



24. Материнская плата.

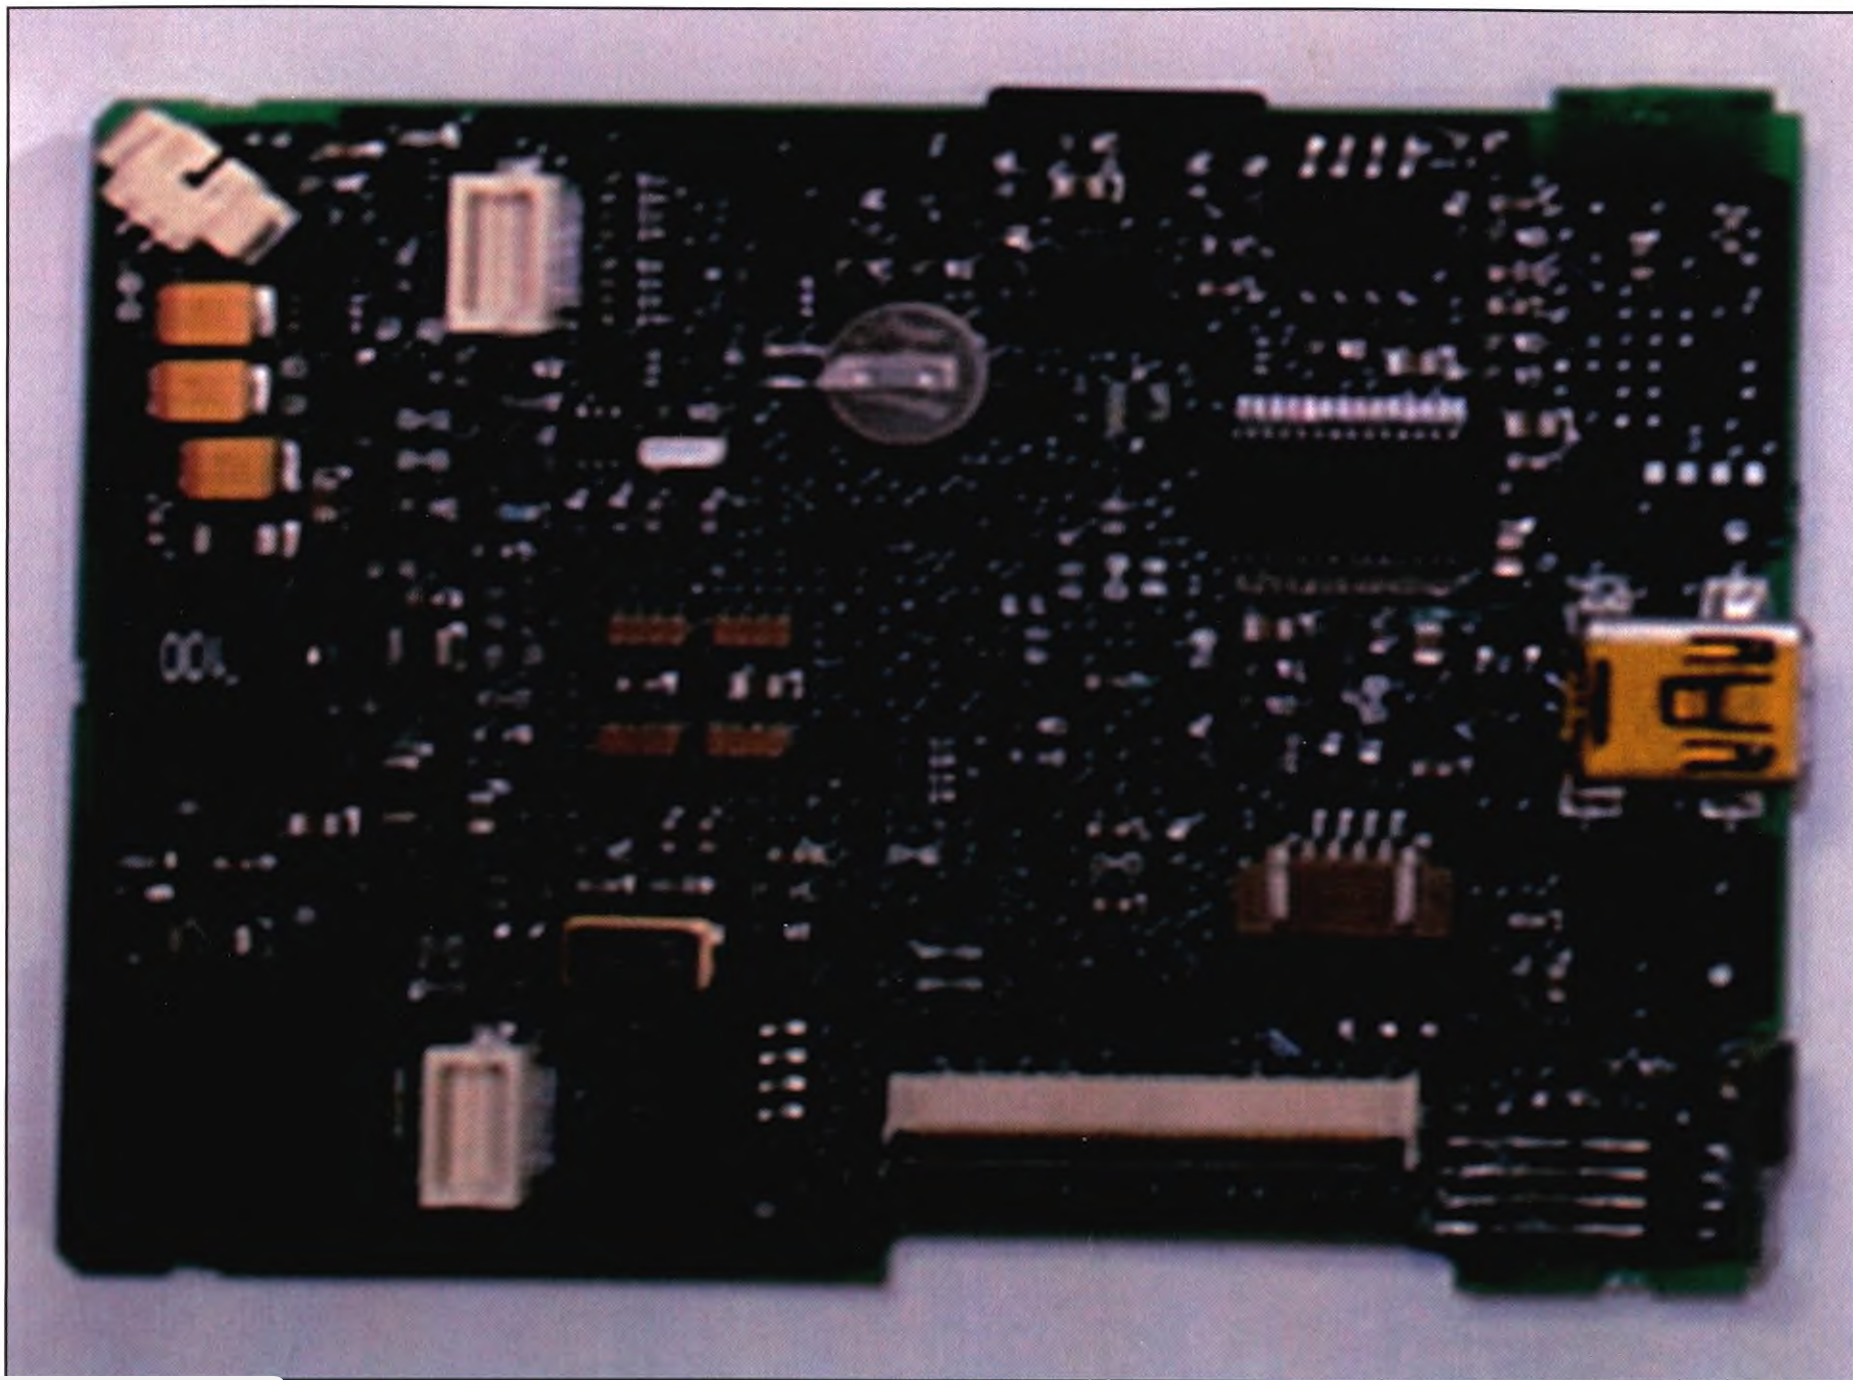


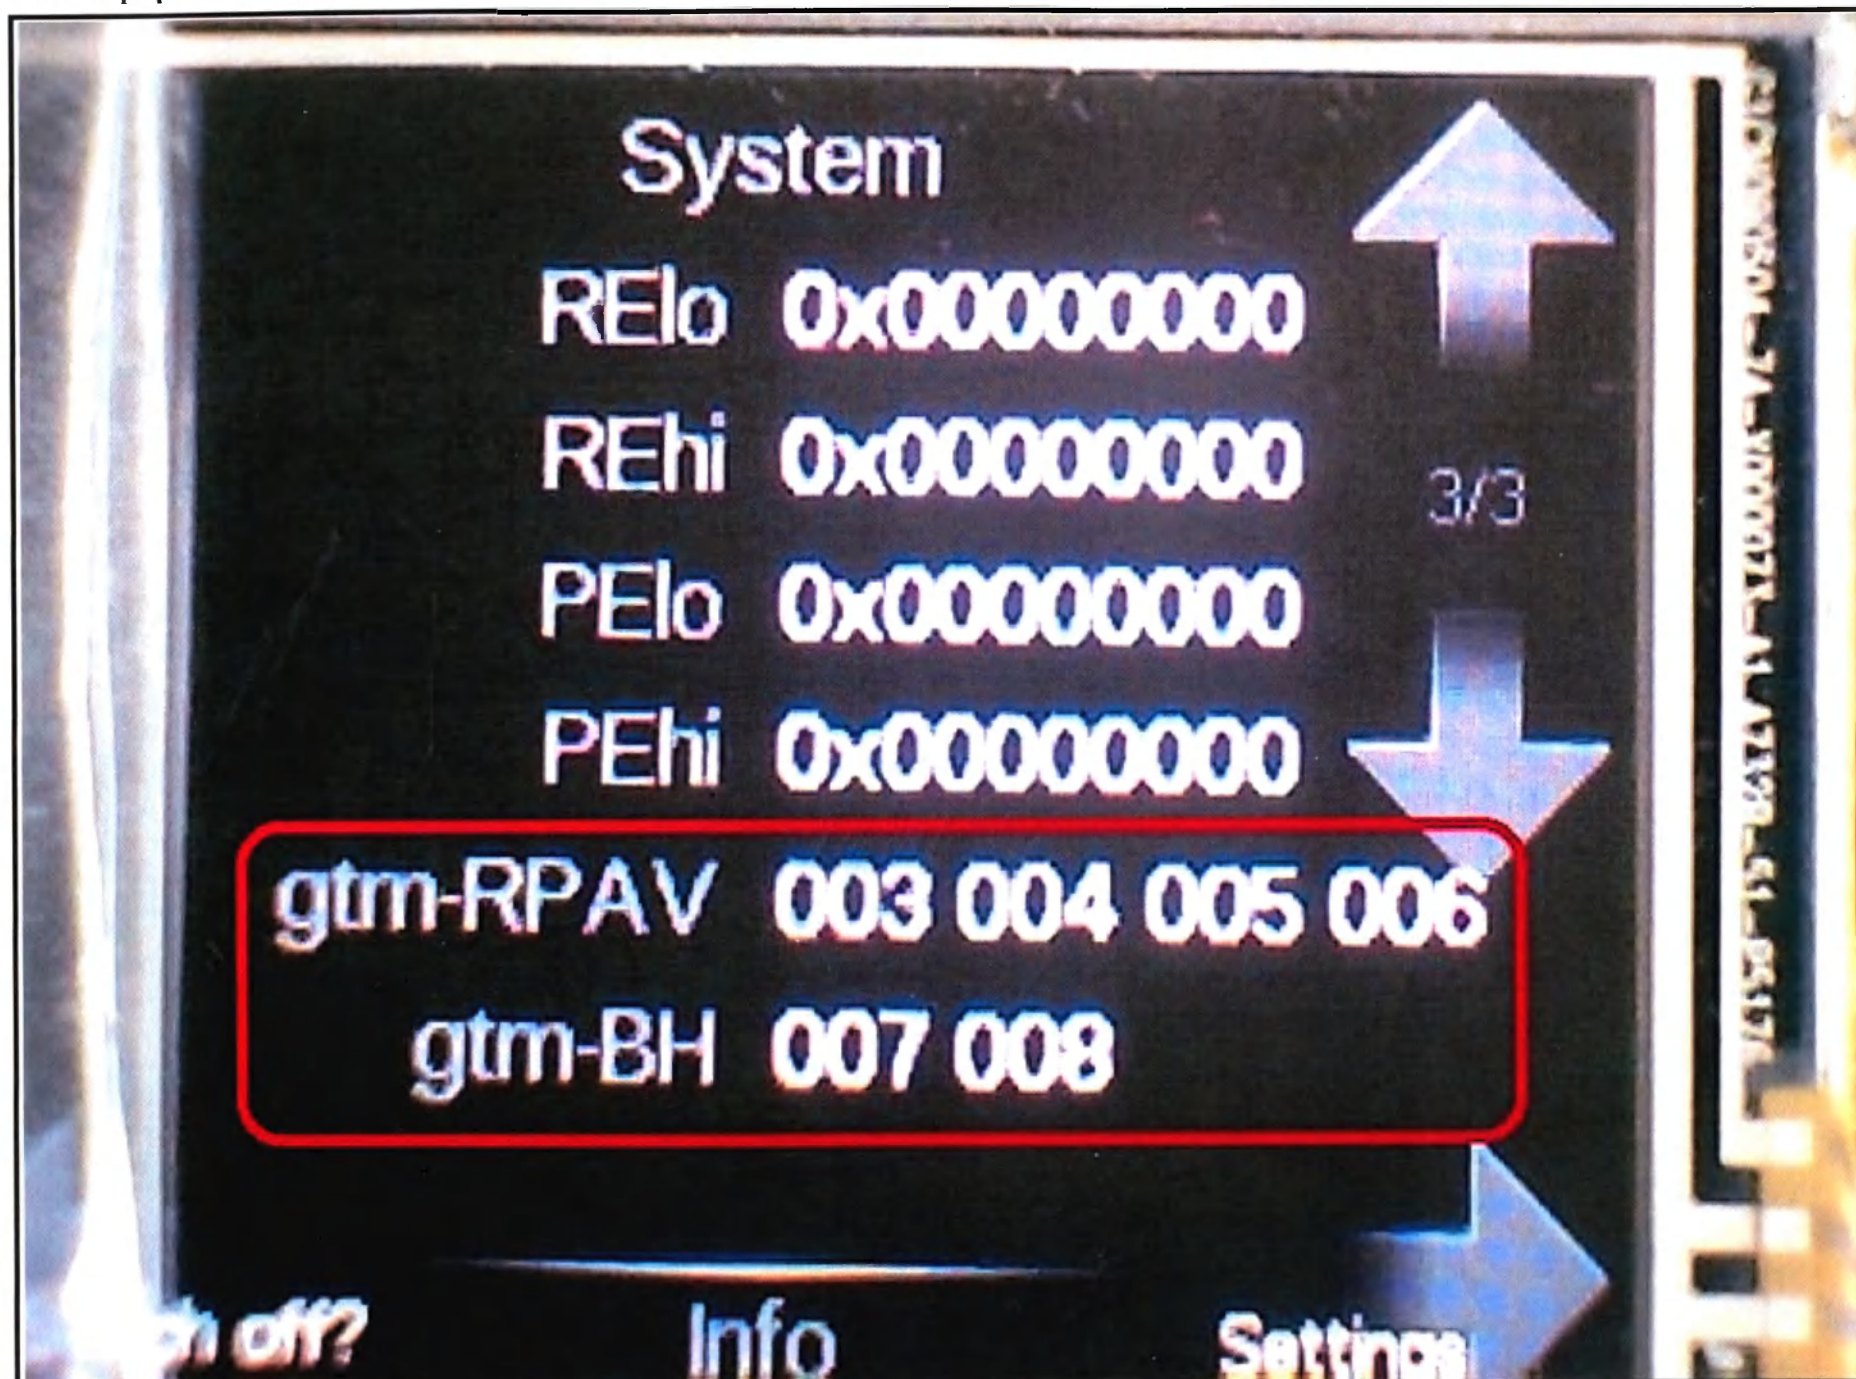


26. Модуль ЖК дисплея.




27. Модуль памяти.

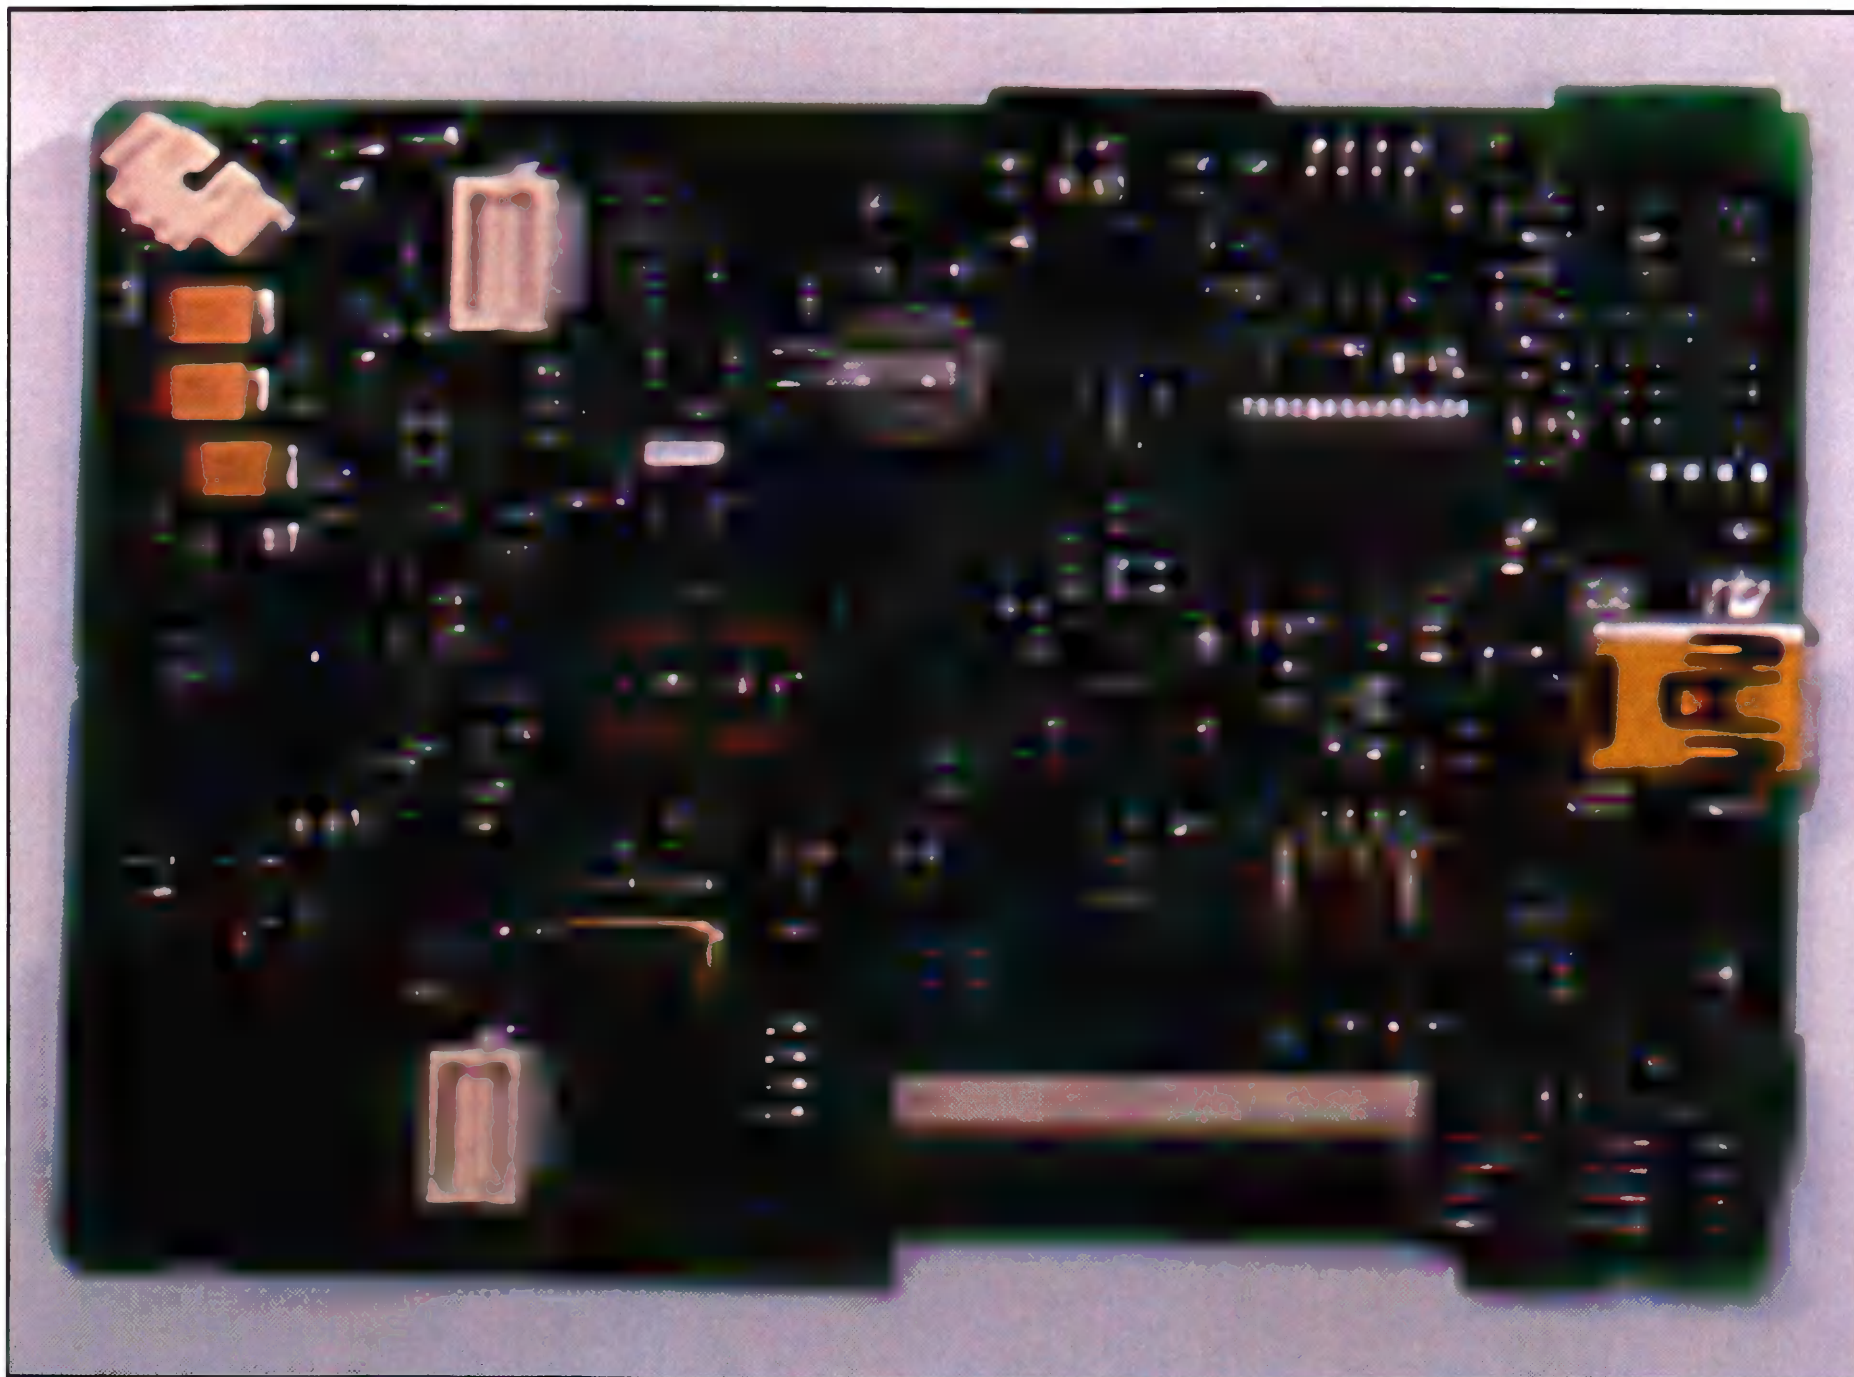


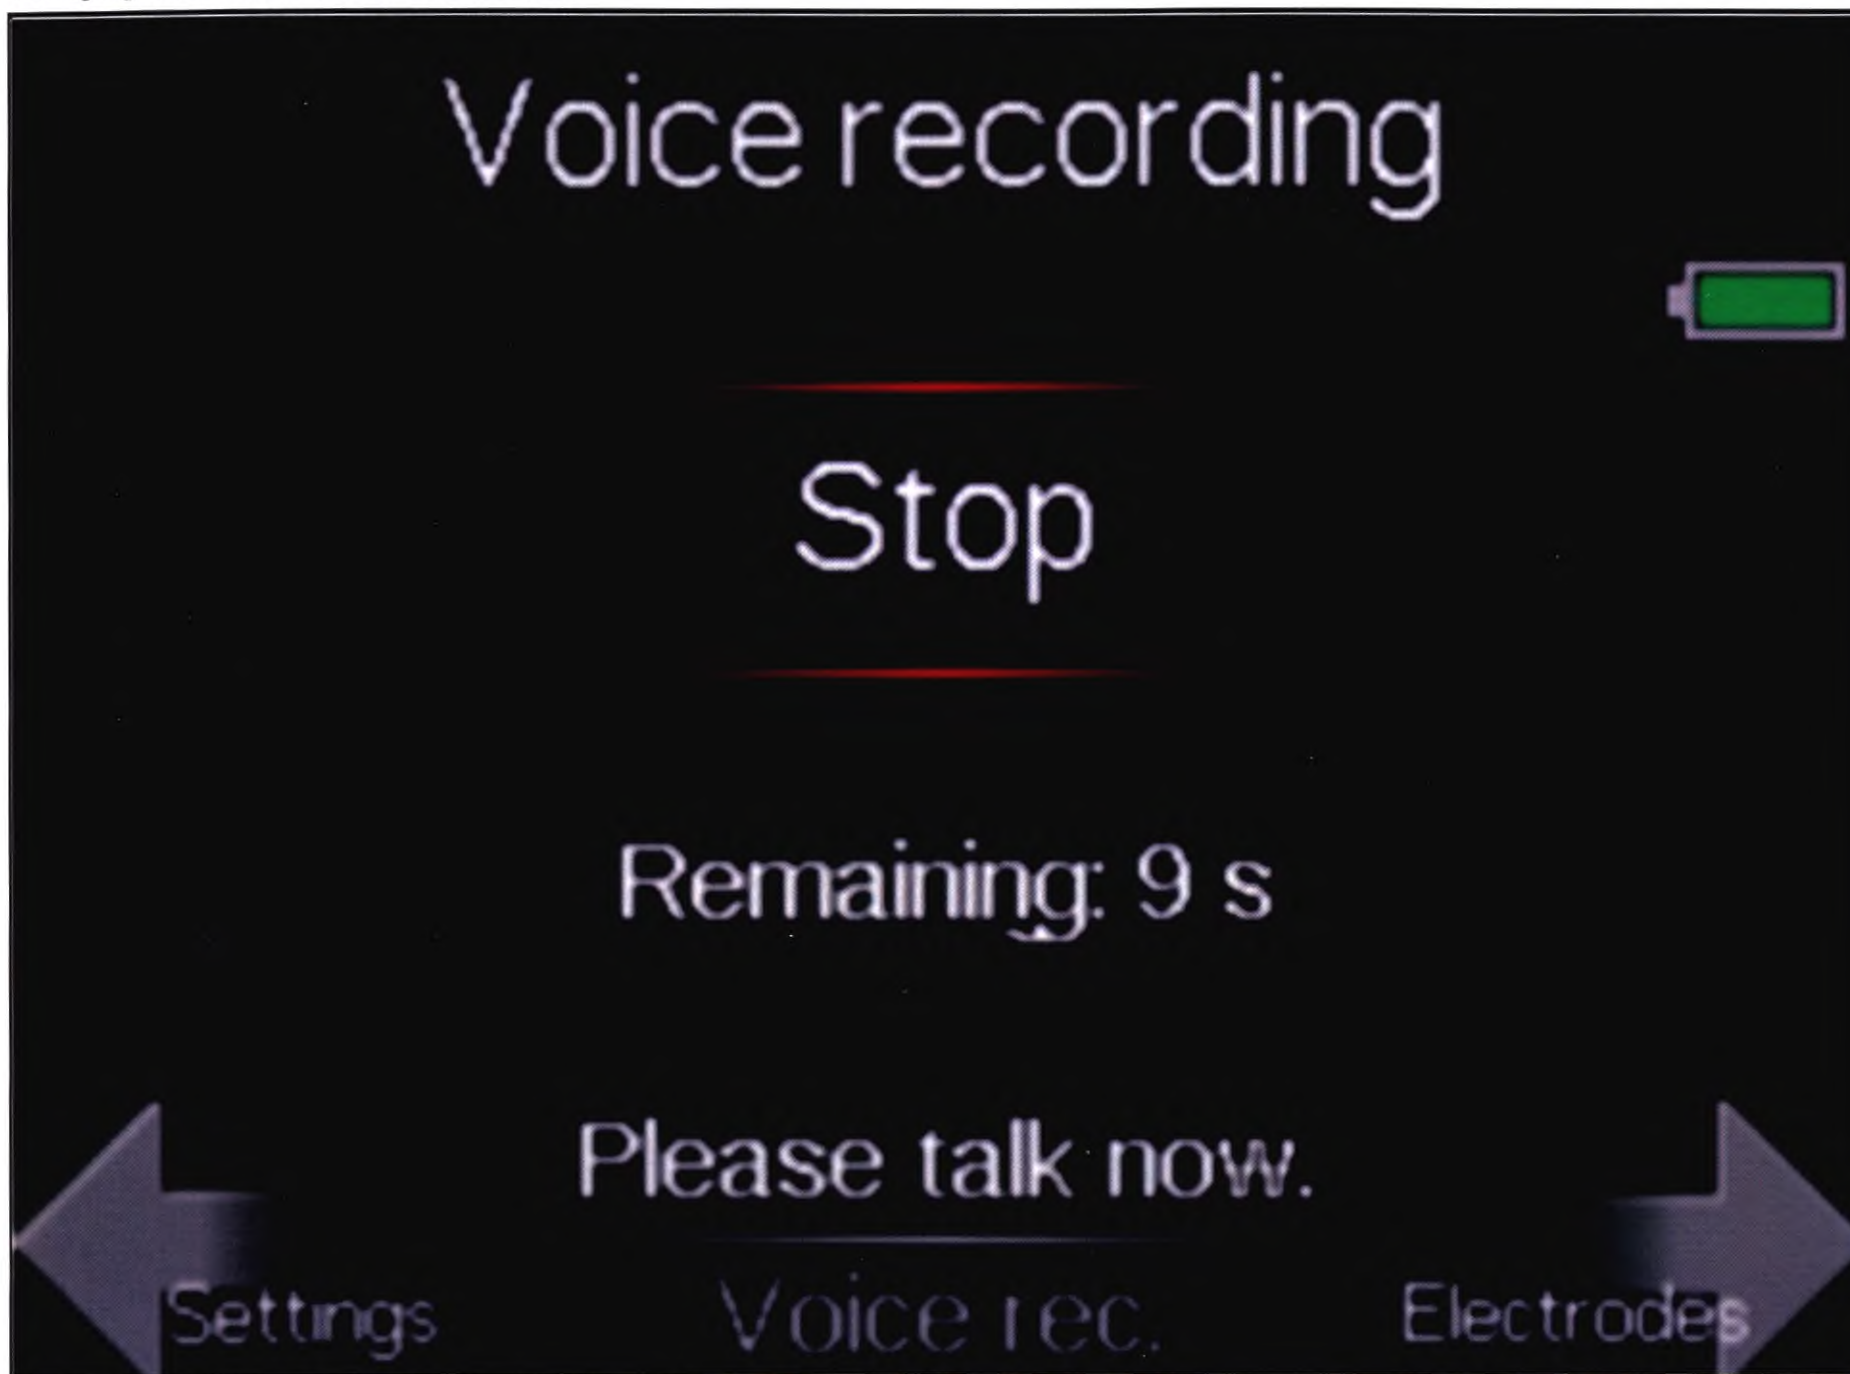

29. Программное обеспечение записи ЭКГ высокого разрешения.

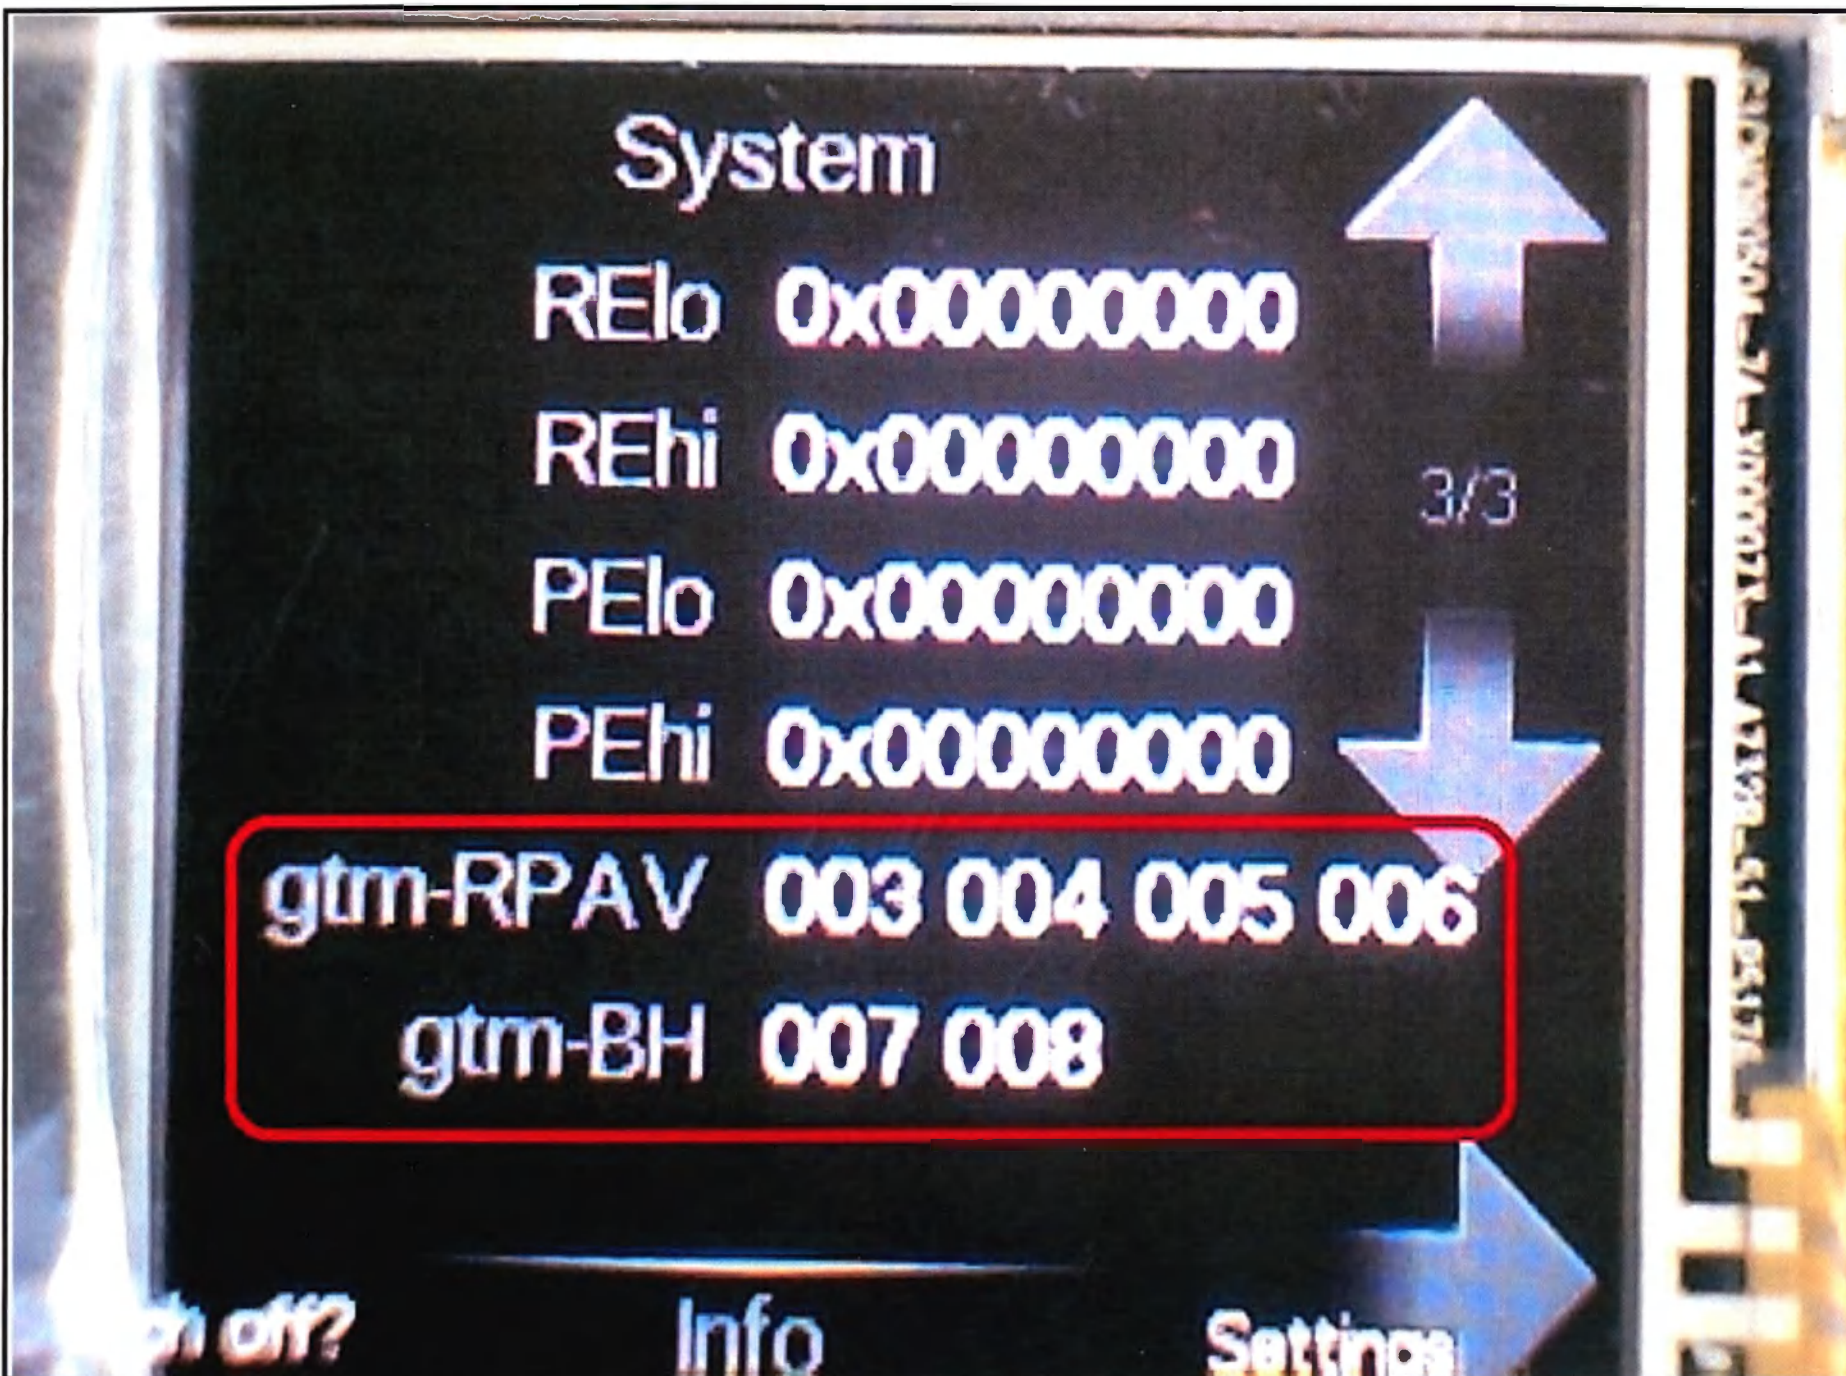

30. Программное обеспечение определения активности пациента.

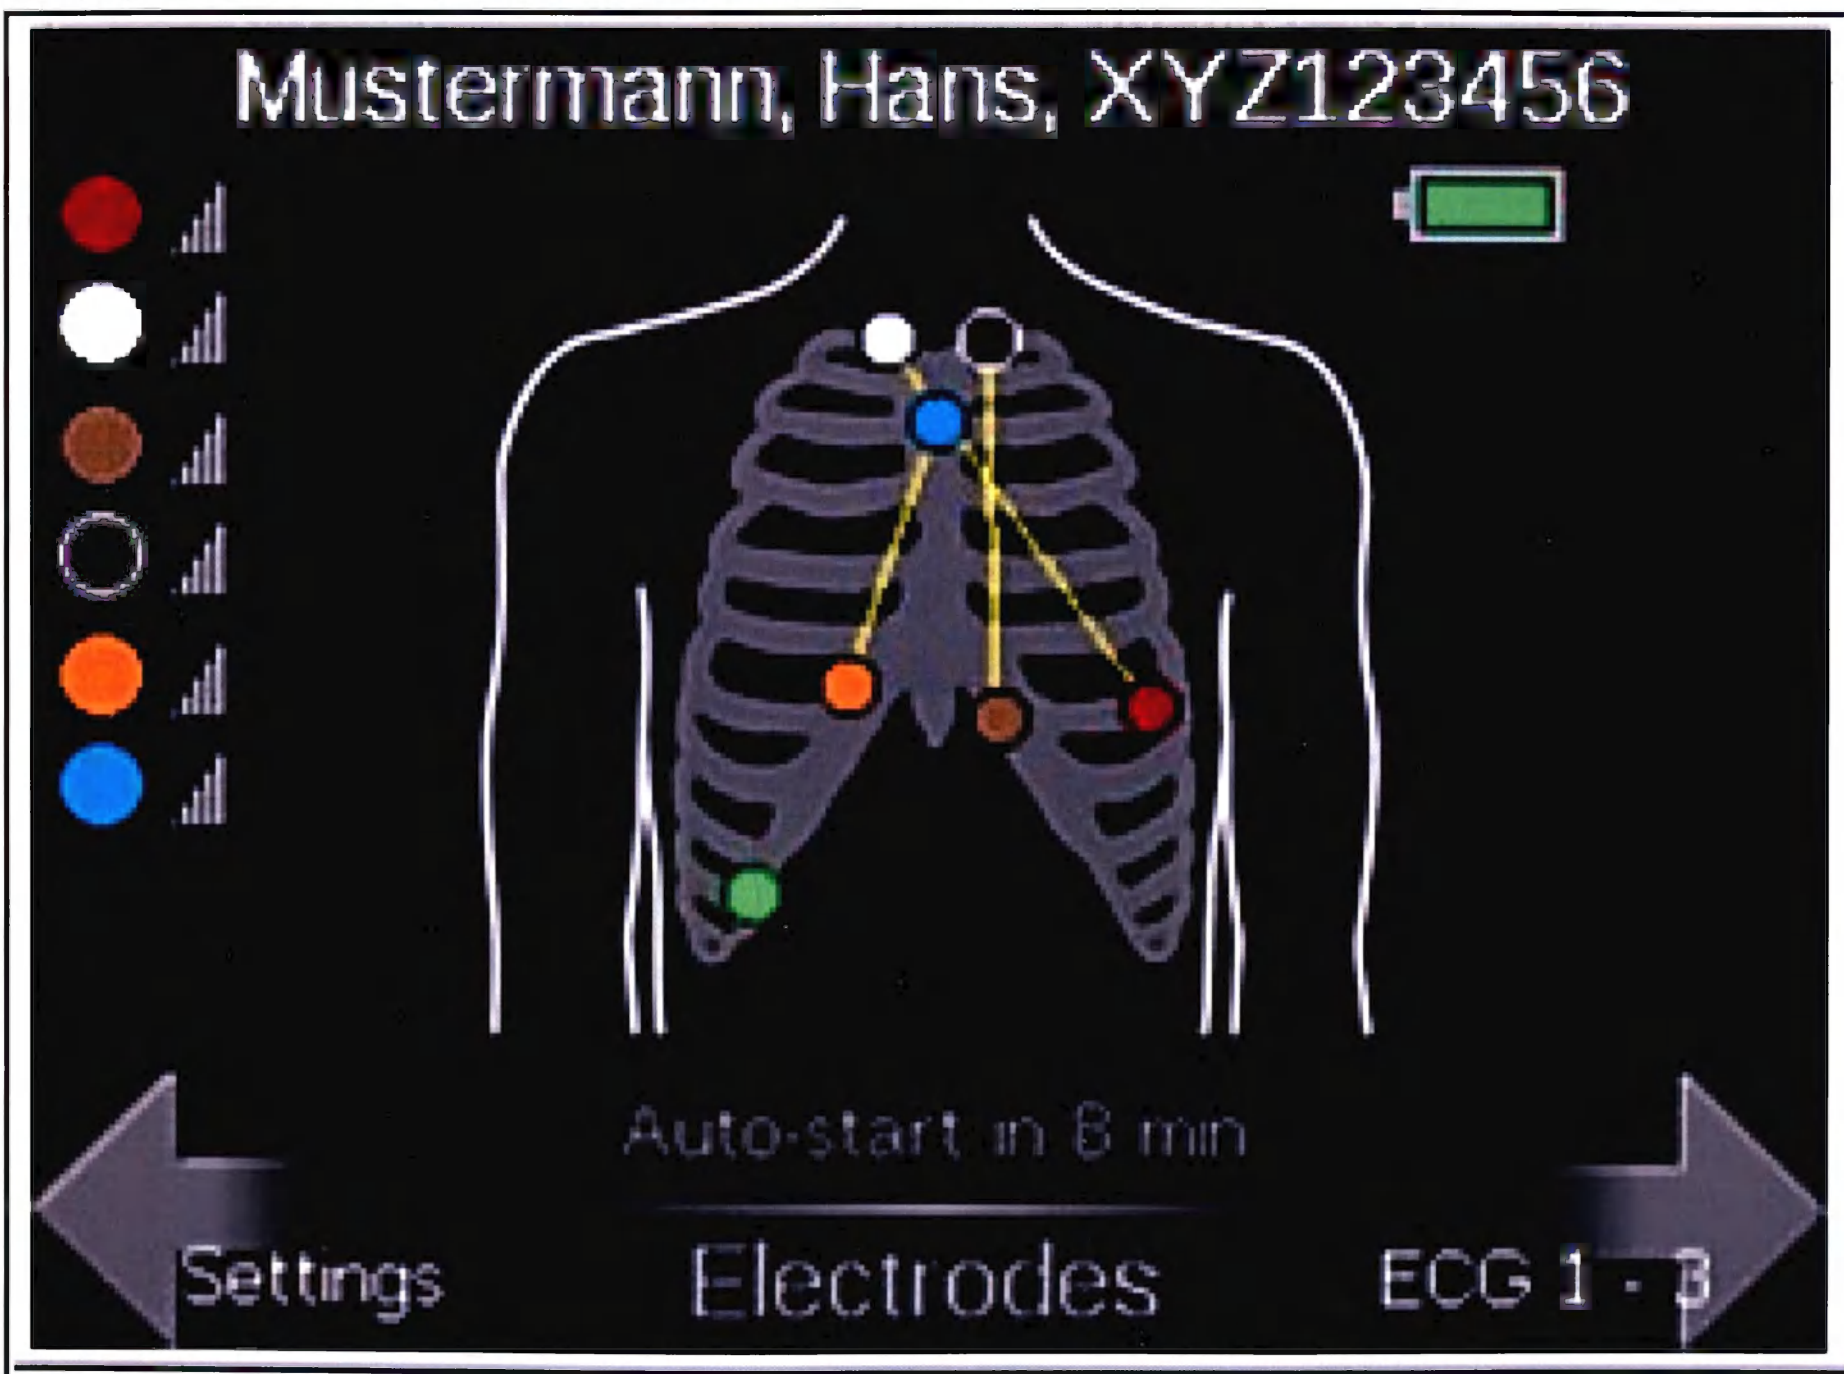

30. Программное обеспечение определения активности пациента.




30. Программное обеспечение определения активности пациента.



30. Программное обеспечение определения активности пациента.



30. Программное обеспечение определения активности пациента.

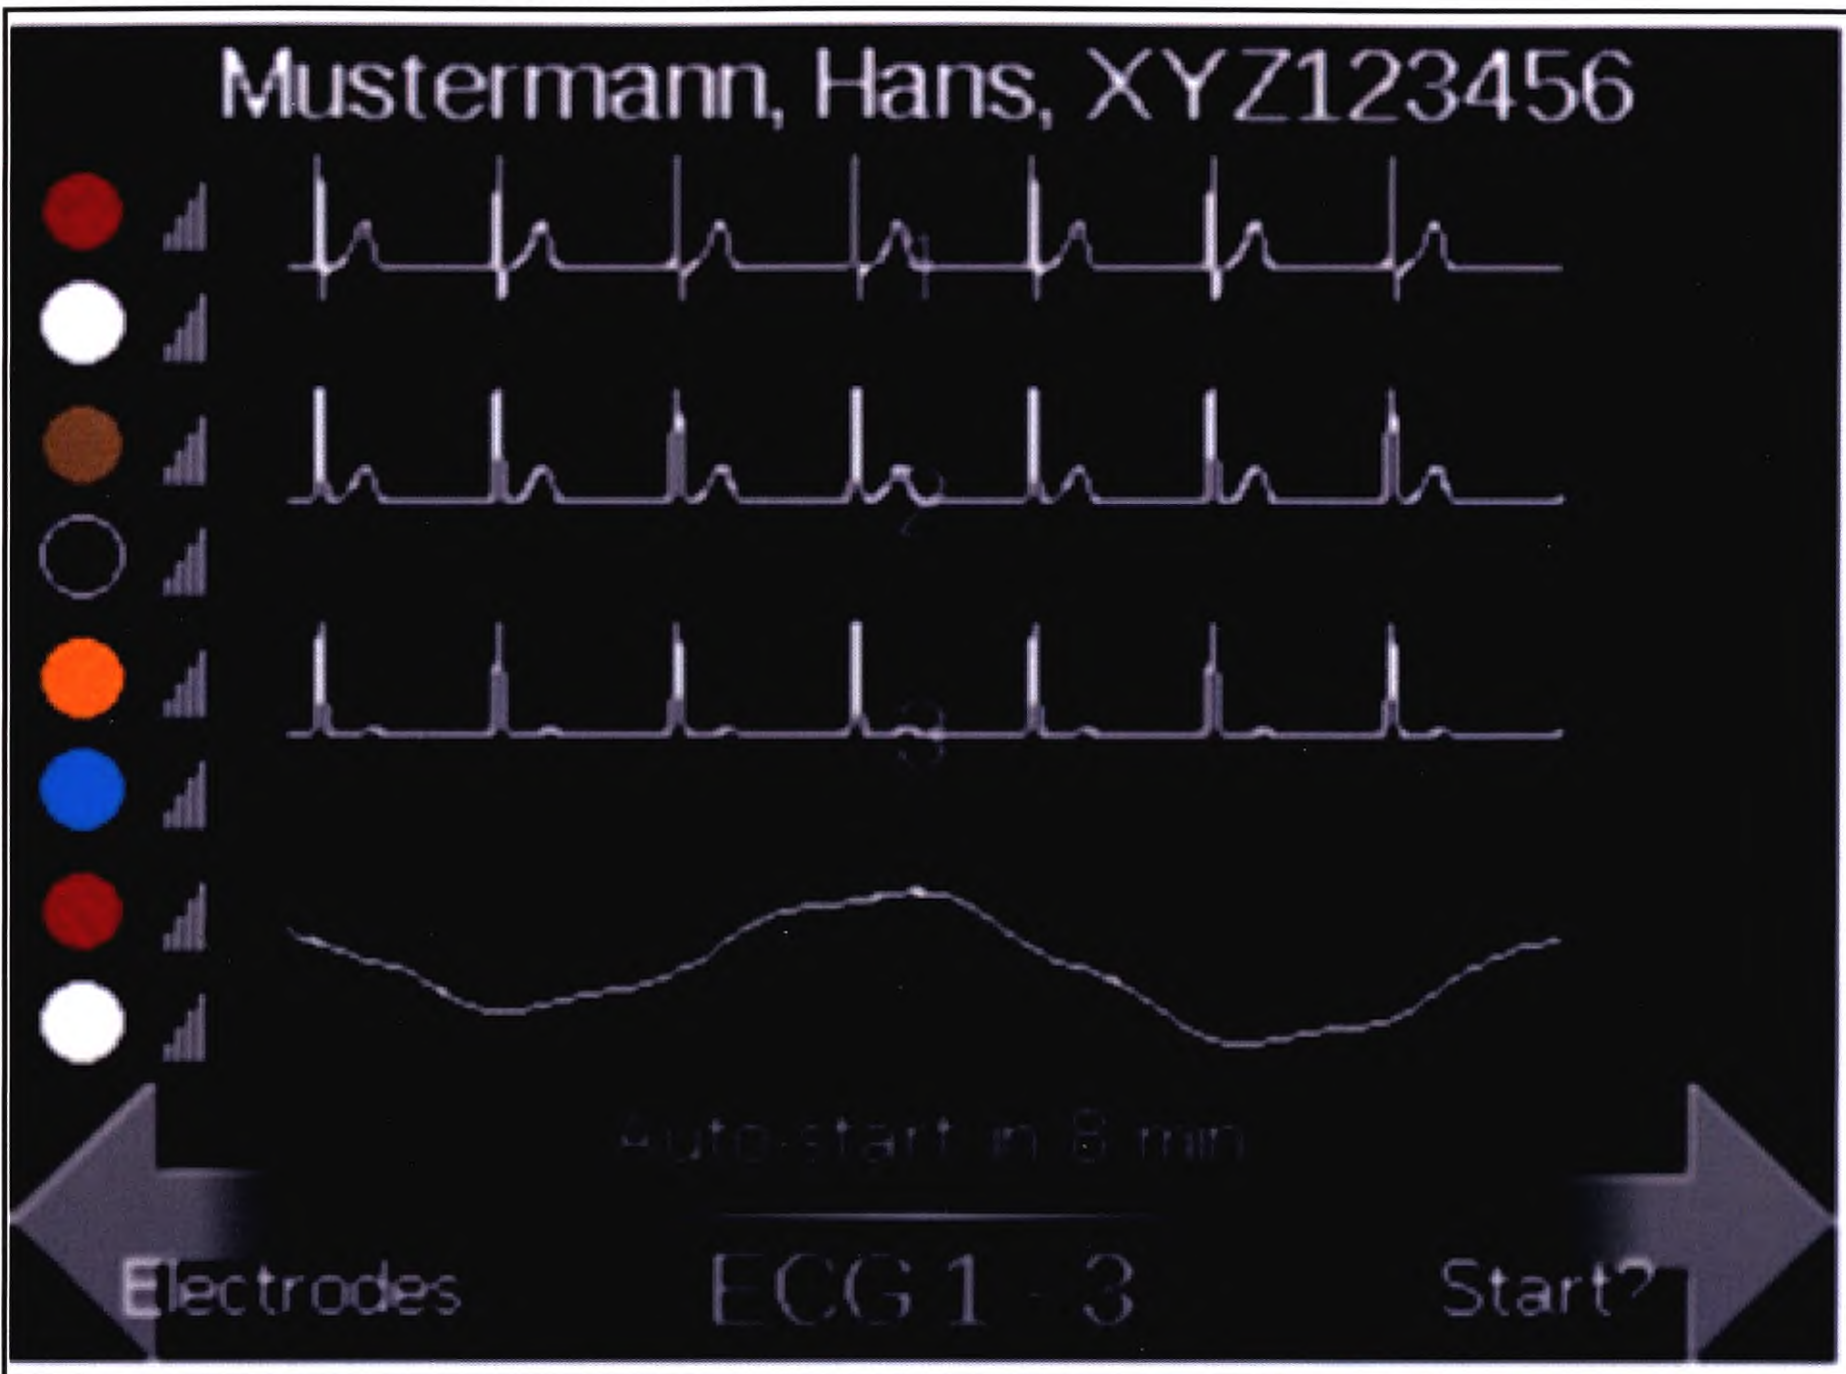

30. Программное обеспечение определения активности пациента.


Remaining
23h: 59min

30. Программное обеспечение определения активности пациента.


Remaining
23h: 59min

Marker
12:02


31. Программное обеспечение определения импульсов кардиостимулятора.

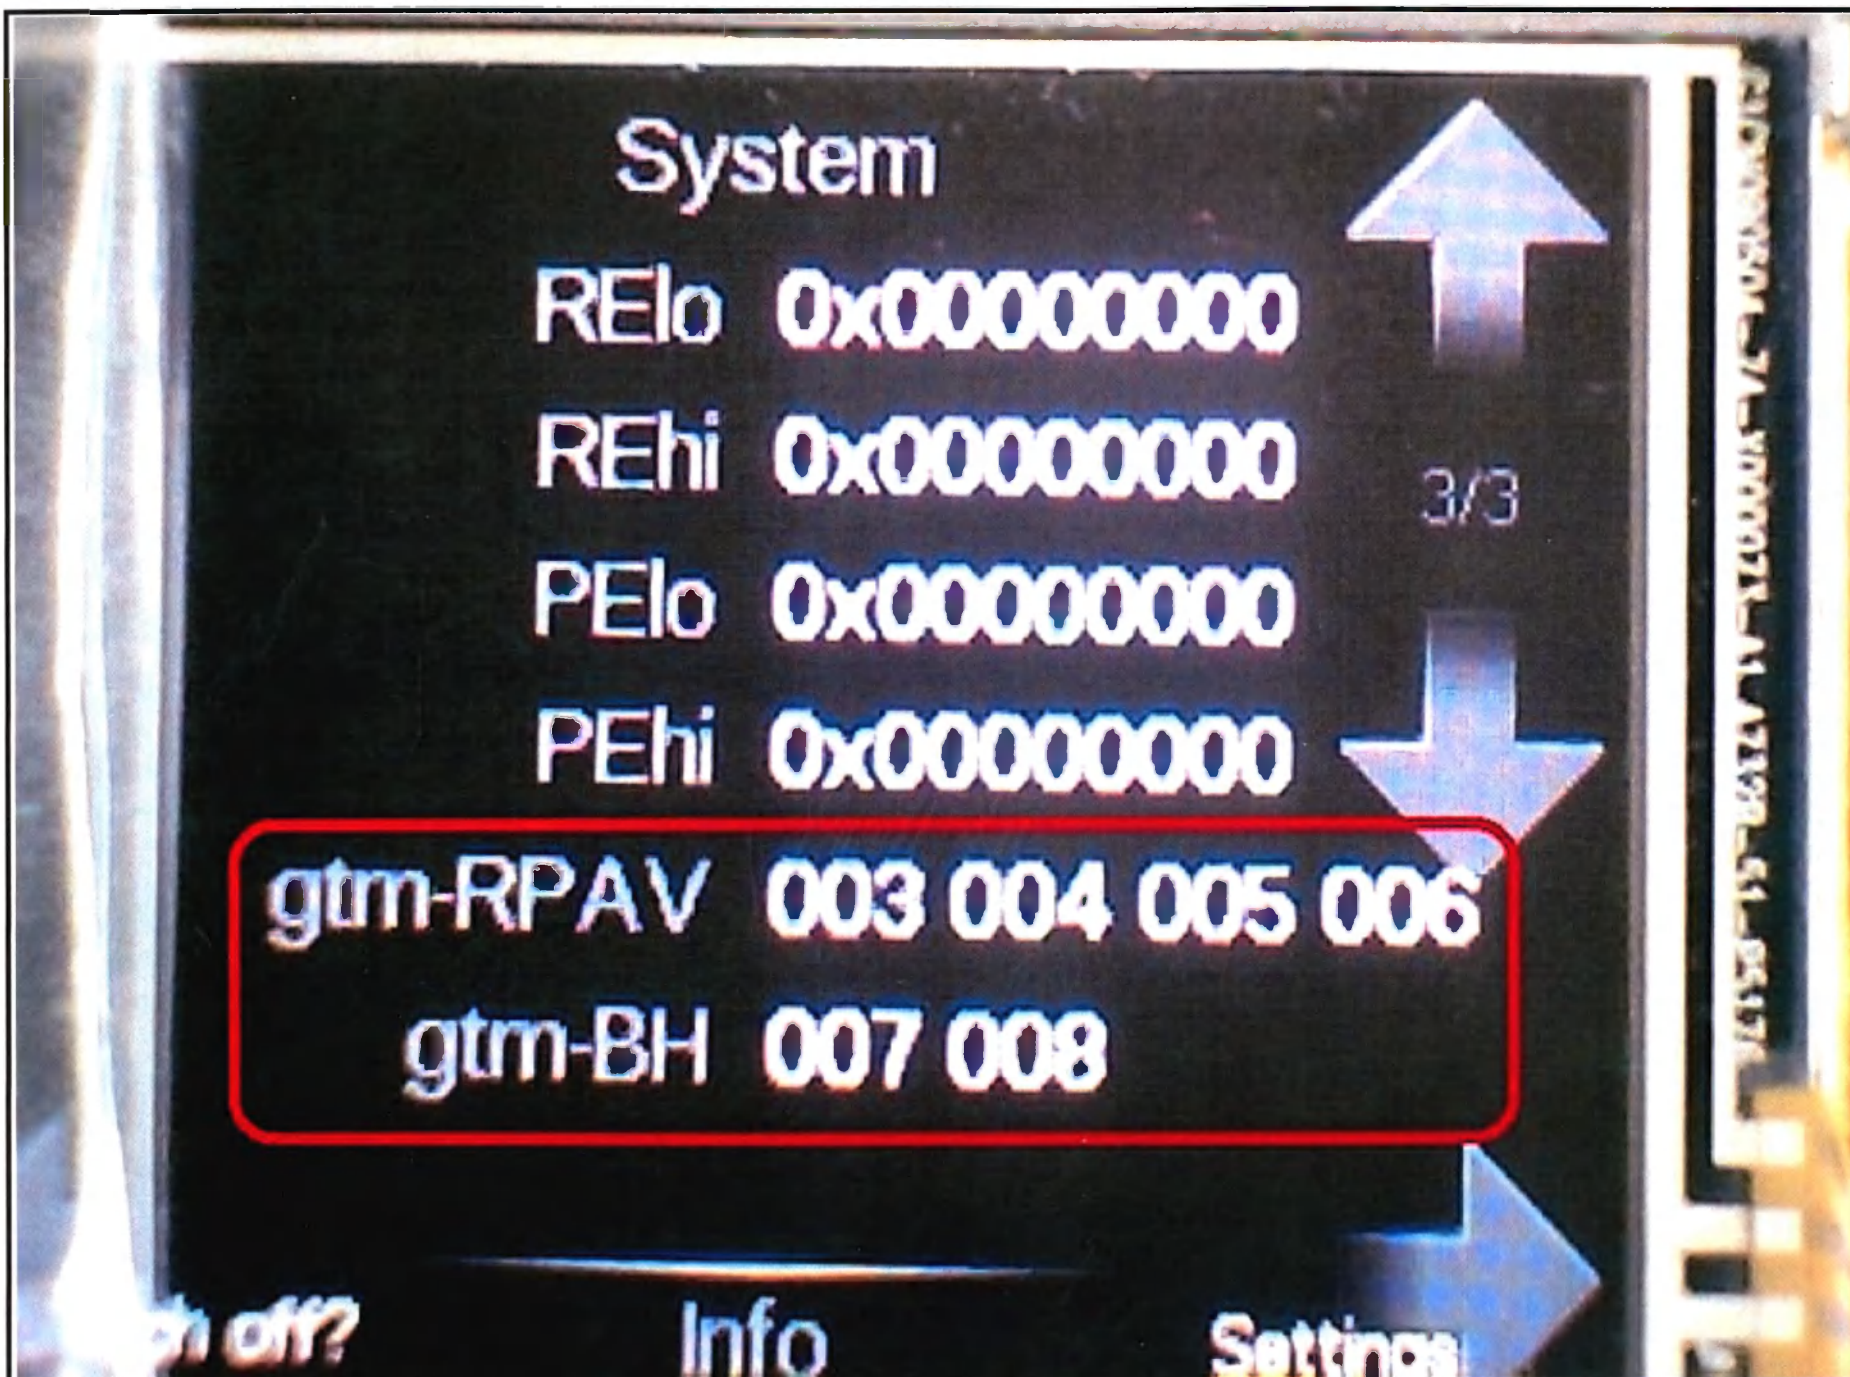

32. Программное обеспечение определения торакального импеданса.

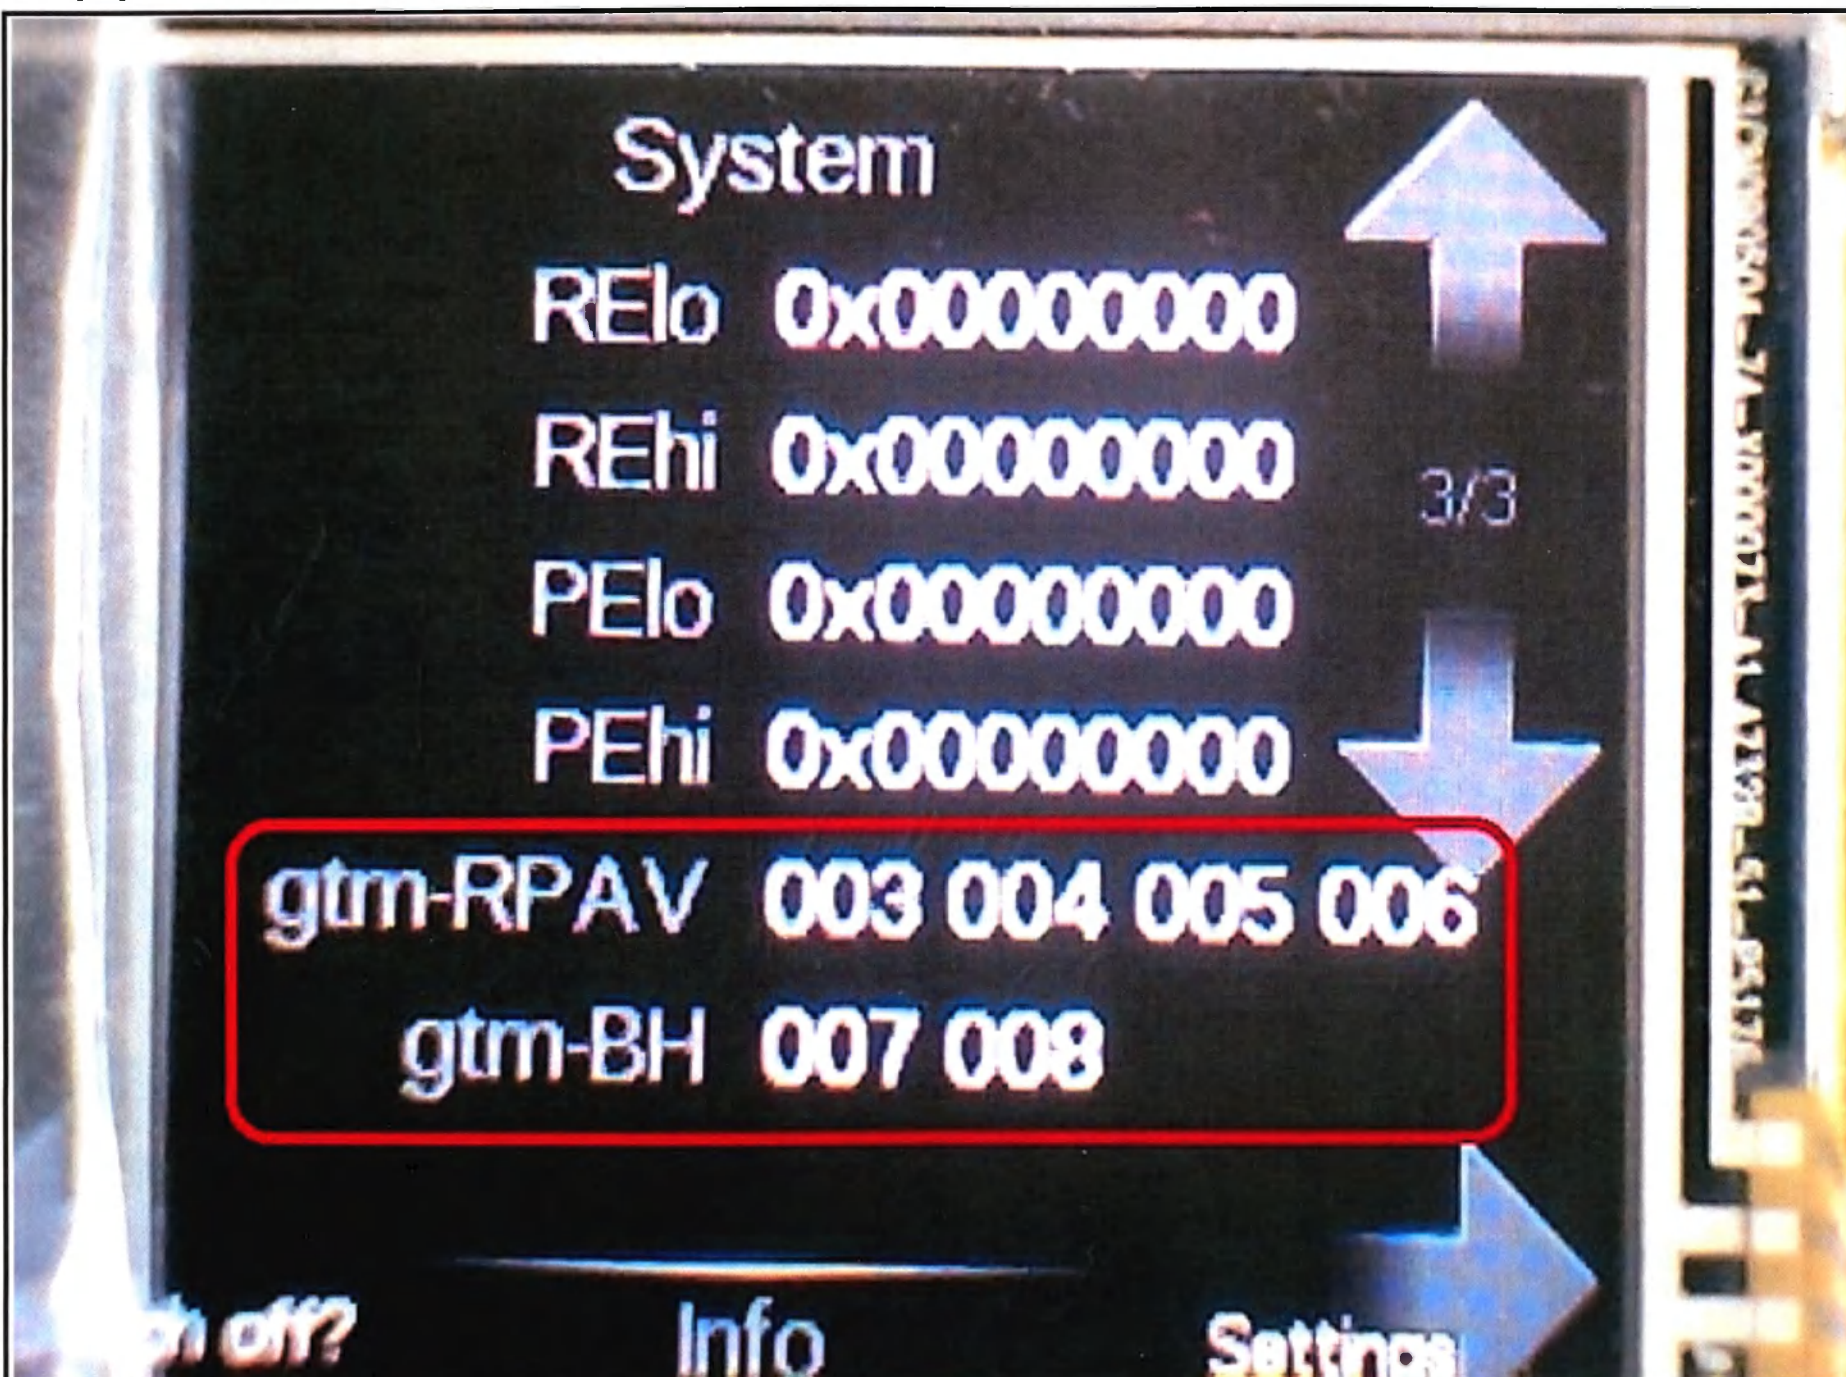

33. Программное обеспечение связи по Bluetooth.

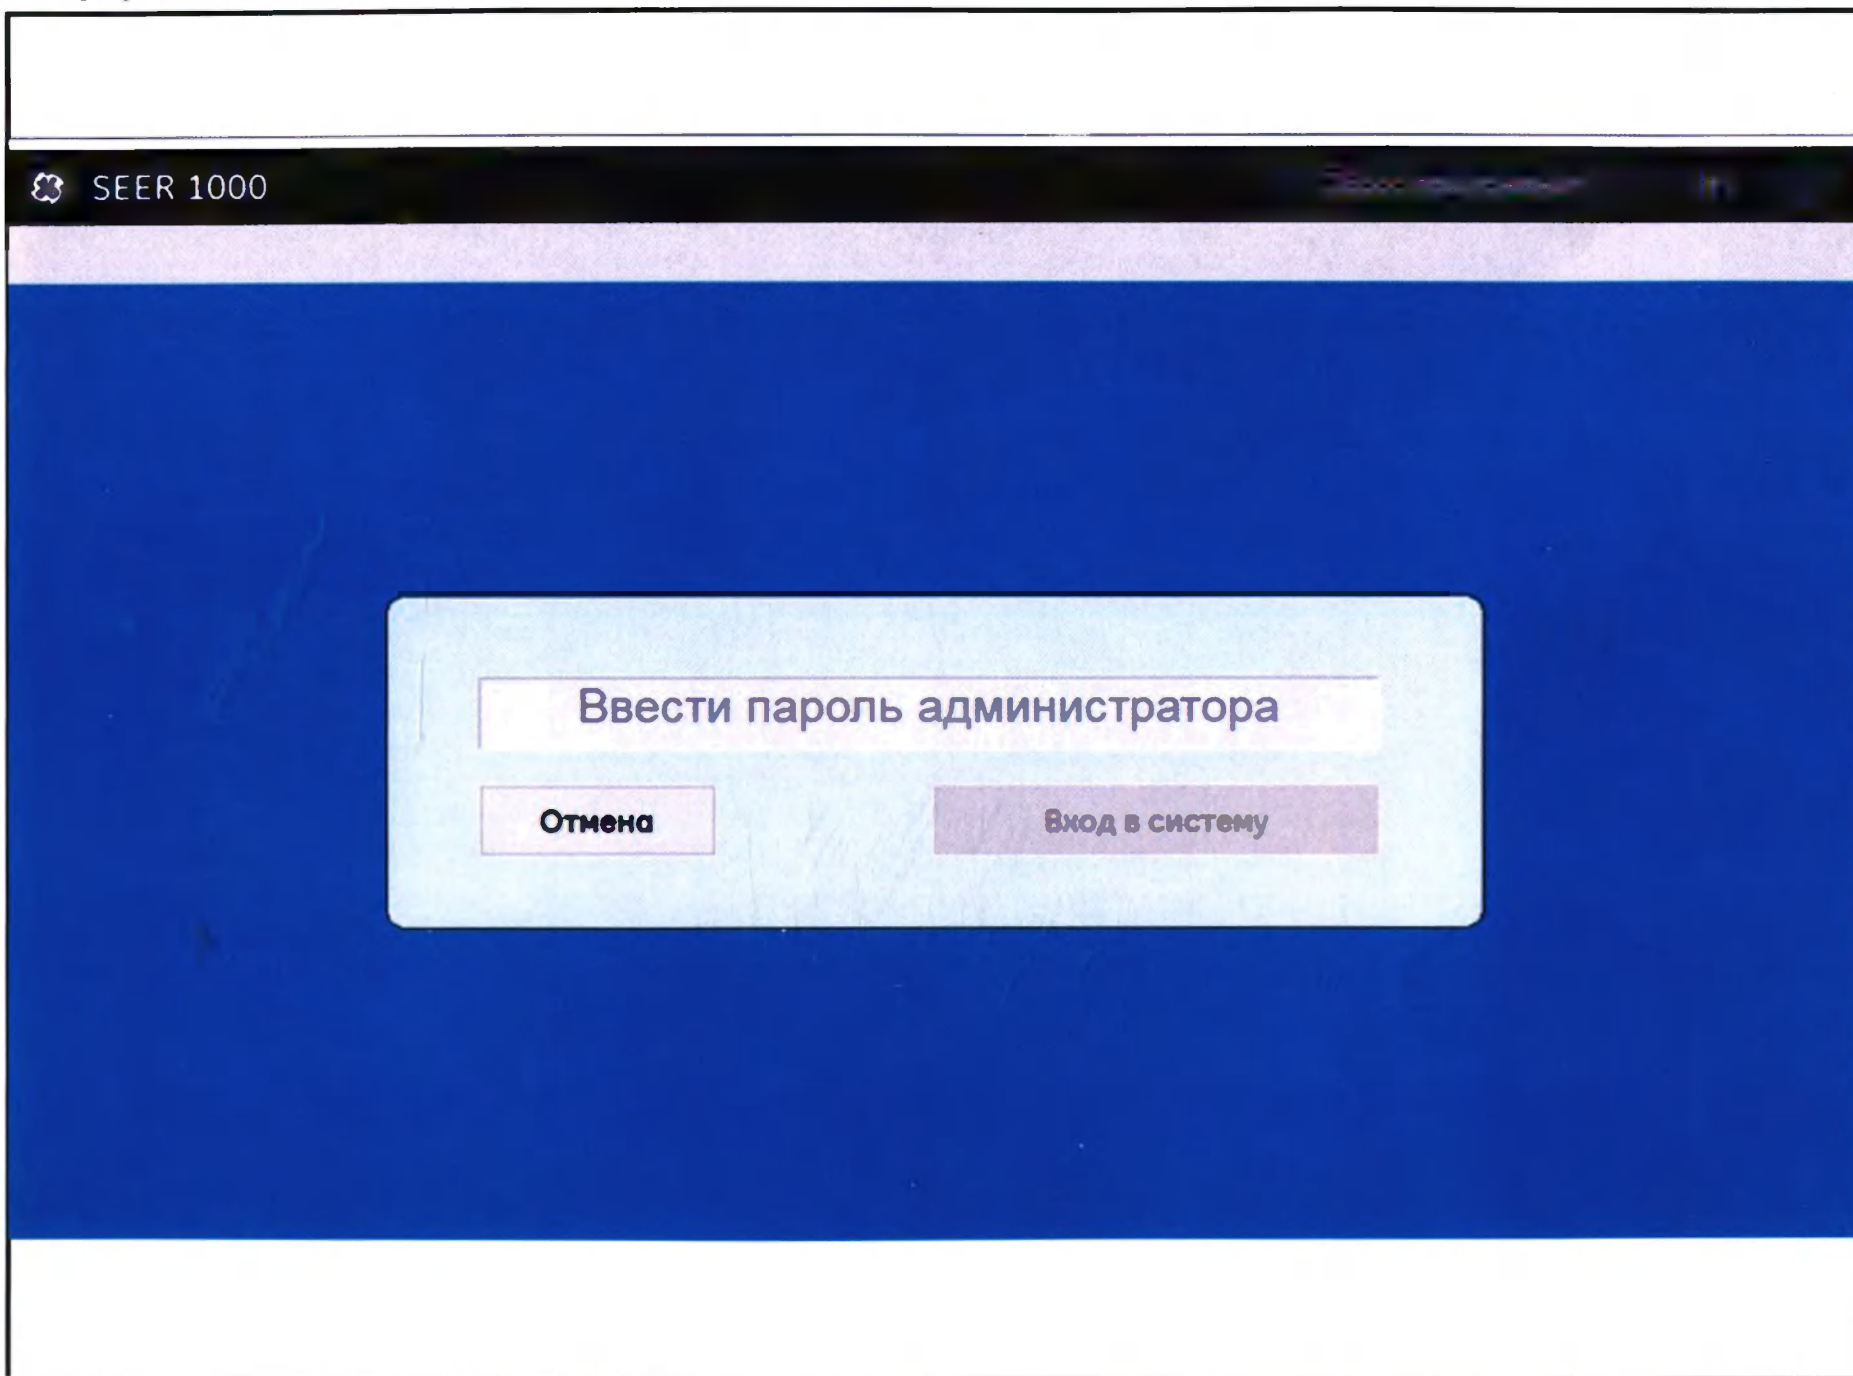


34. Отсек для батарей типа АА.




35. Отсек для батарей типа AAA.



36. Разъем для кабеля USB.

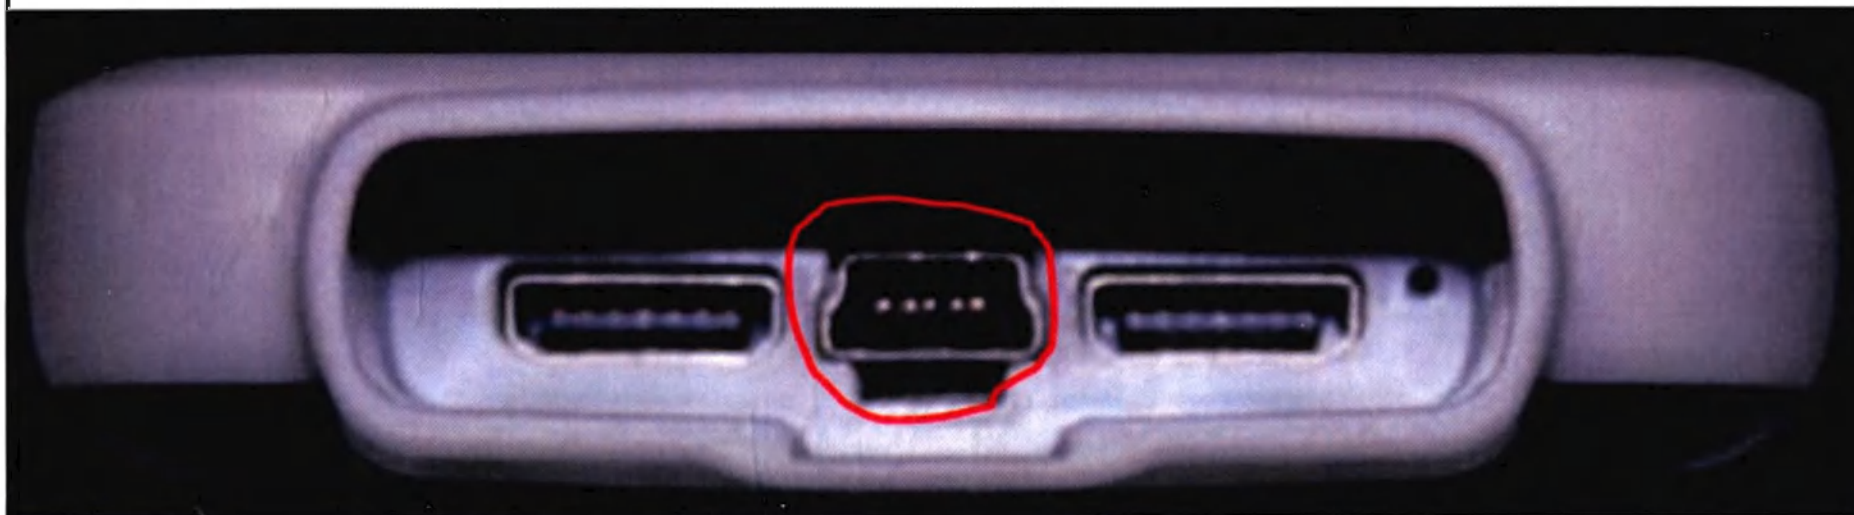

37. Разъем для кабеля пациента.

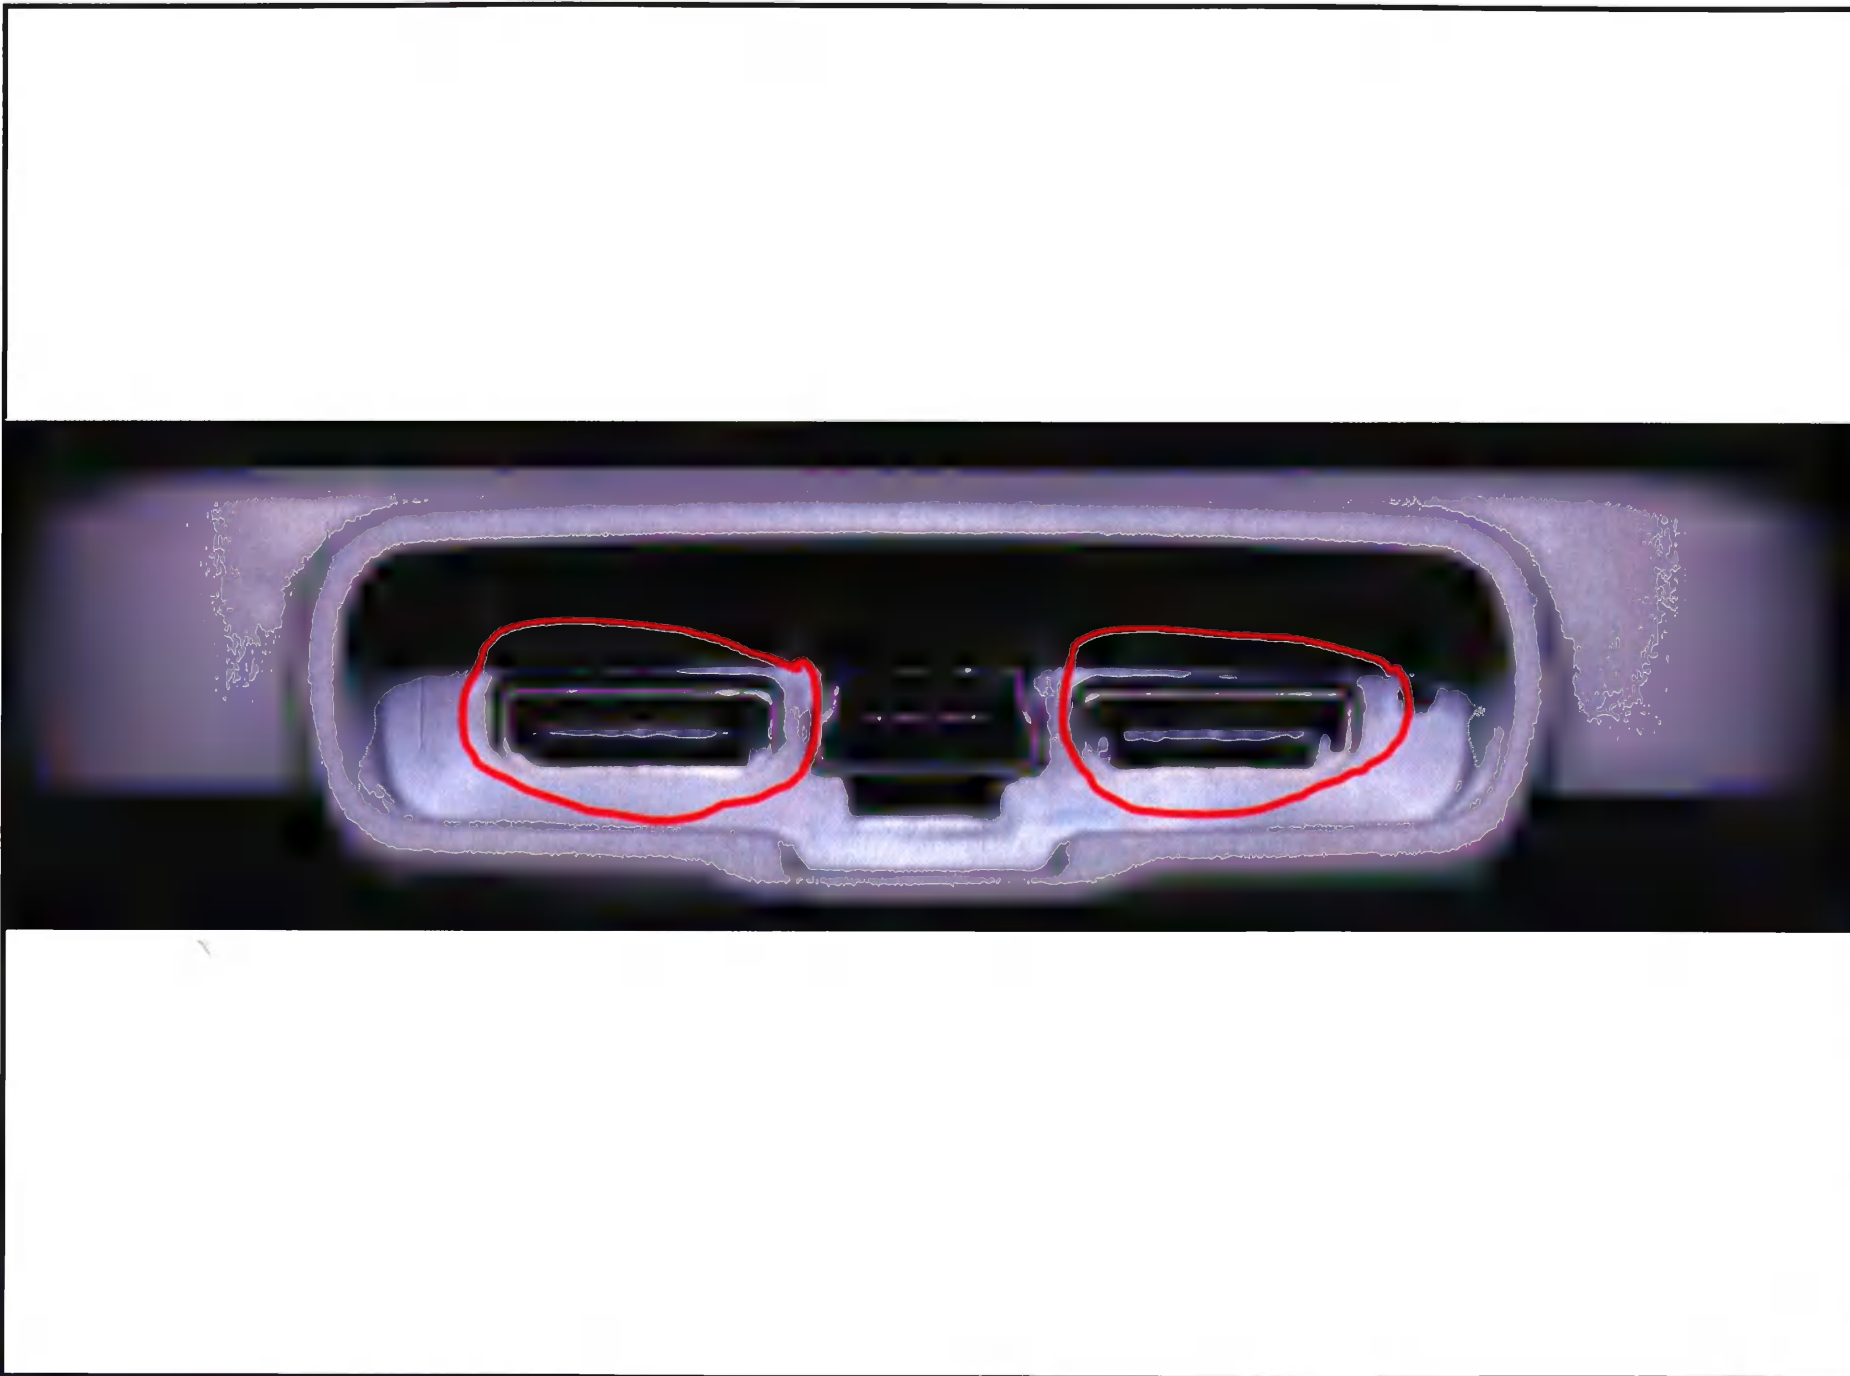

38. Ремни для сумки регистратора плечевые (не более 10 шт.).



39. Ремни для сумки регистратора поясные (не более 10 шт.).



40. Сумки для регистратора одноразовые (не более 500 штук).



41. Коробка транспортная для регистратора.




42. Устройство чтения карт памяти.




43. Чехлы для регистратора (не более 10 штук).




44. Электроды клейкие для взрослых для снятия ЭКГ (не более 5 000 шт.).

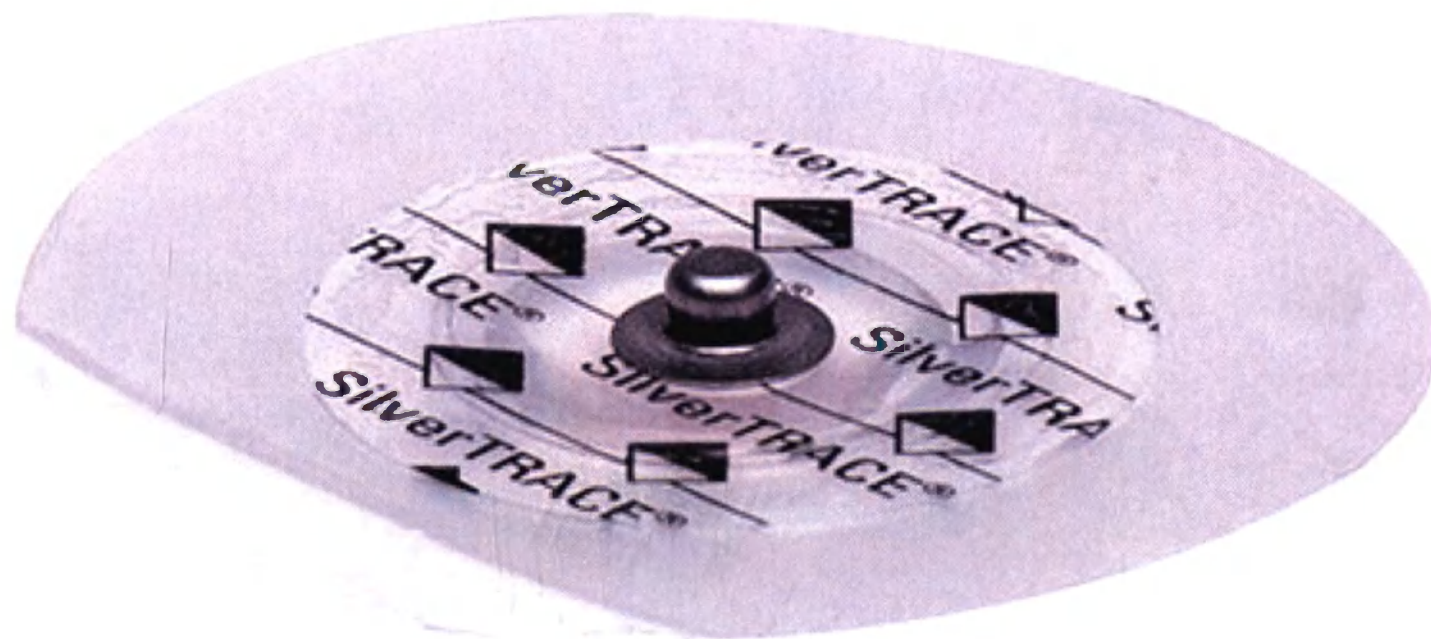


45. Электроды клейкие для детей для снятия ЭКГ (не более 5 000 шт.).

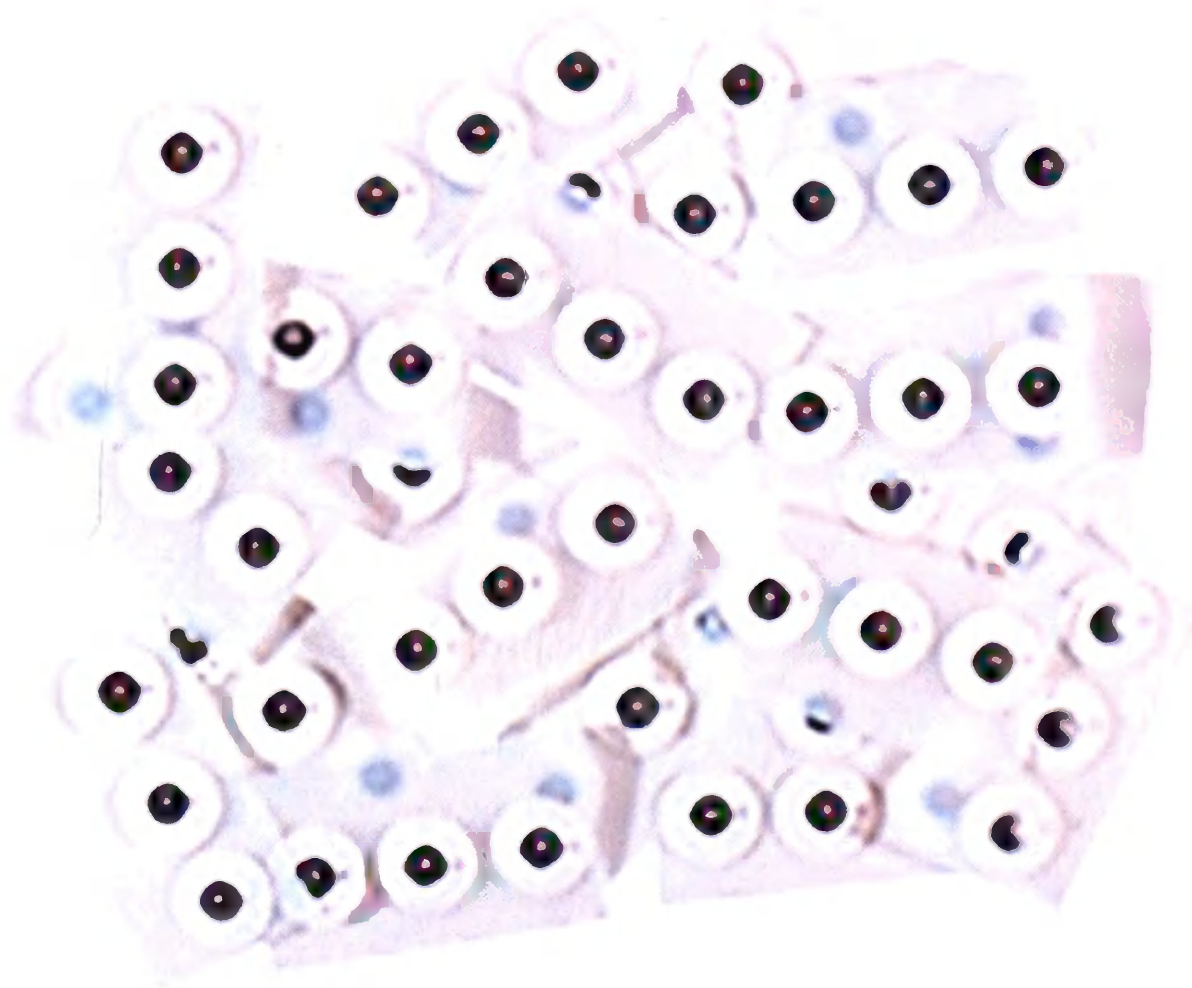

46. Электроды клейкие для младенцев для снятия ЭКГ (не более 5 000 шт.).

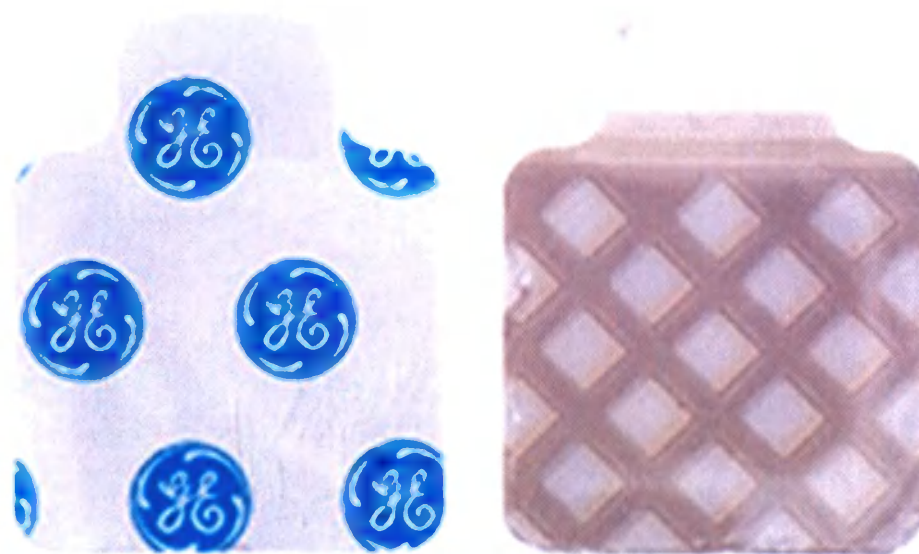

47. Программное обеспечение для обмена данными на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе (не более 5 шт).

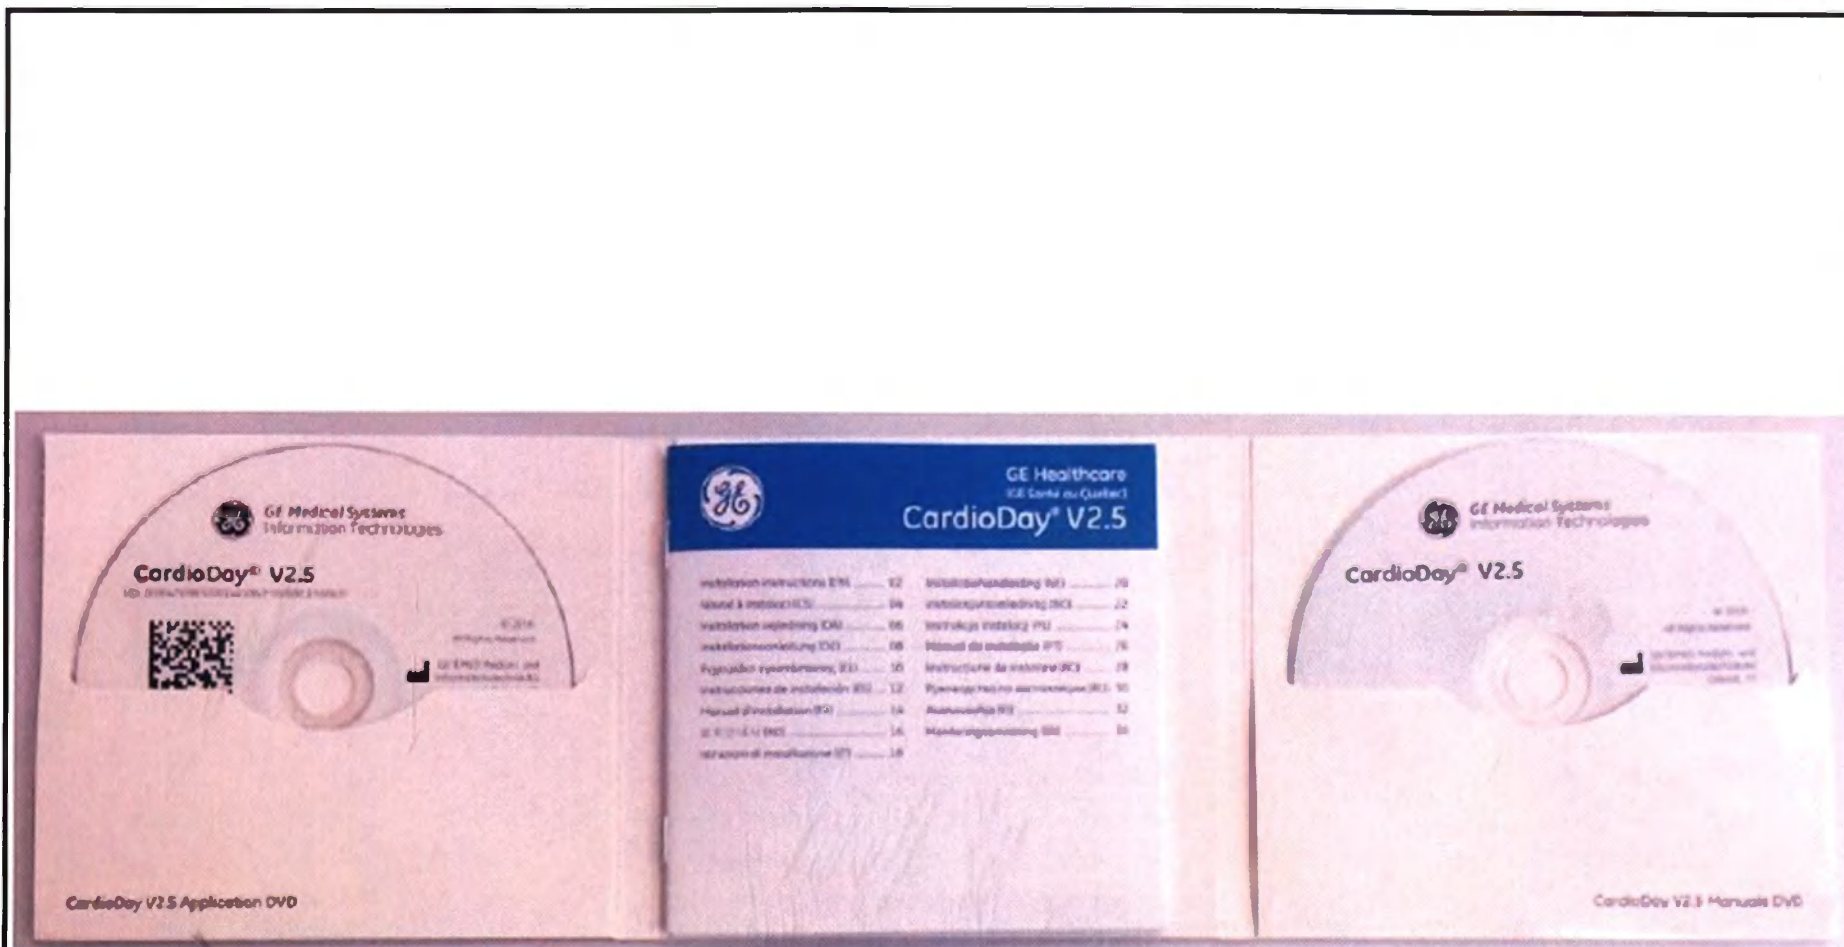

48. Опция программного обеспечения на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе для установки обновлений (не более 5 шт).

Параметры

СН: ()

Макс. кол-во пользователей: 1

Параметры: 32768

ИН хоста: HzyXNo3JoyMF1D2i

Easy [X]

ЭКС распознавание []

ЭКС анализ []

RR стандартный []

RR расширенный []

PR анализ []

QT стандартный []

QT расширенный []

PDF Экспорт []

Соединение с MUSE []

Экспорт (MIT, XML, CSV) []

Архив []

12 каналов []

Дыхание []

Импорт расширенный []

ФП стандартная []

ФП расширенная []

НRT []

АС/DC []

ТWA []

Регистратор событий []

Импорт данных мониторинга []


Веб-выгрузка []

Длинные записи []

Обслуживание []

OK

49. Ключ электронный к USB порту компьютера (не более 5 шт).

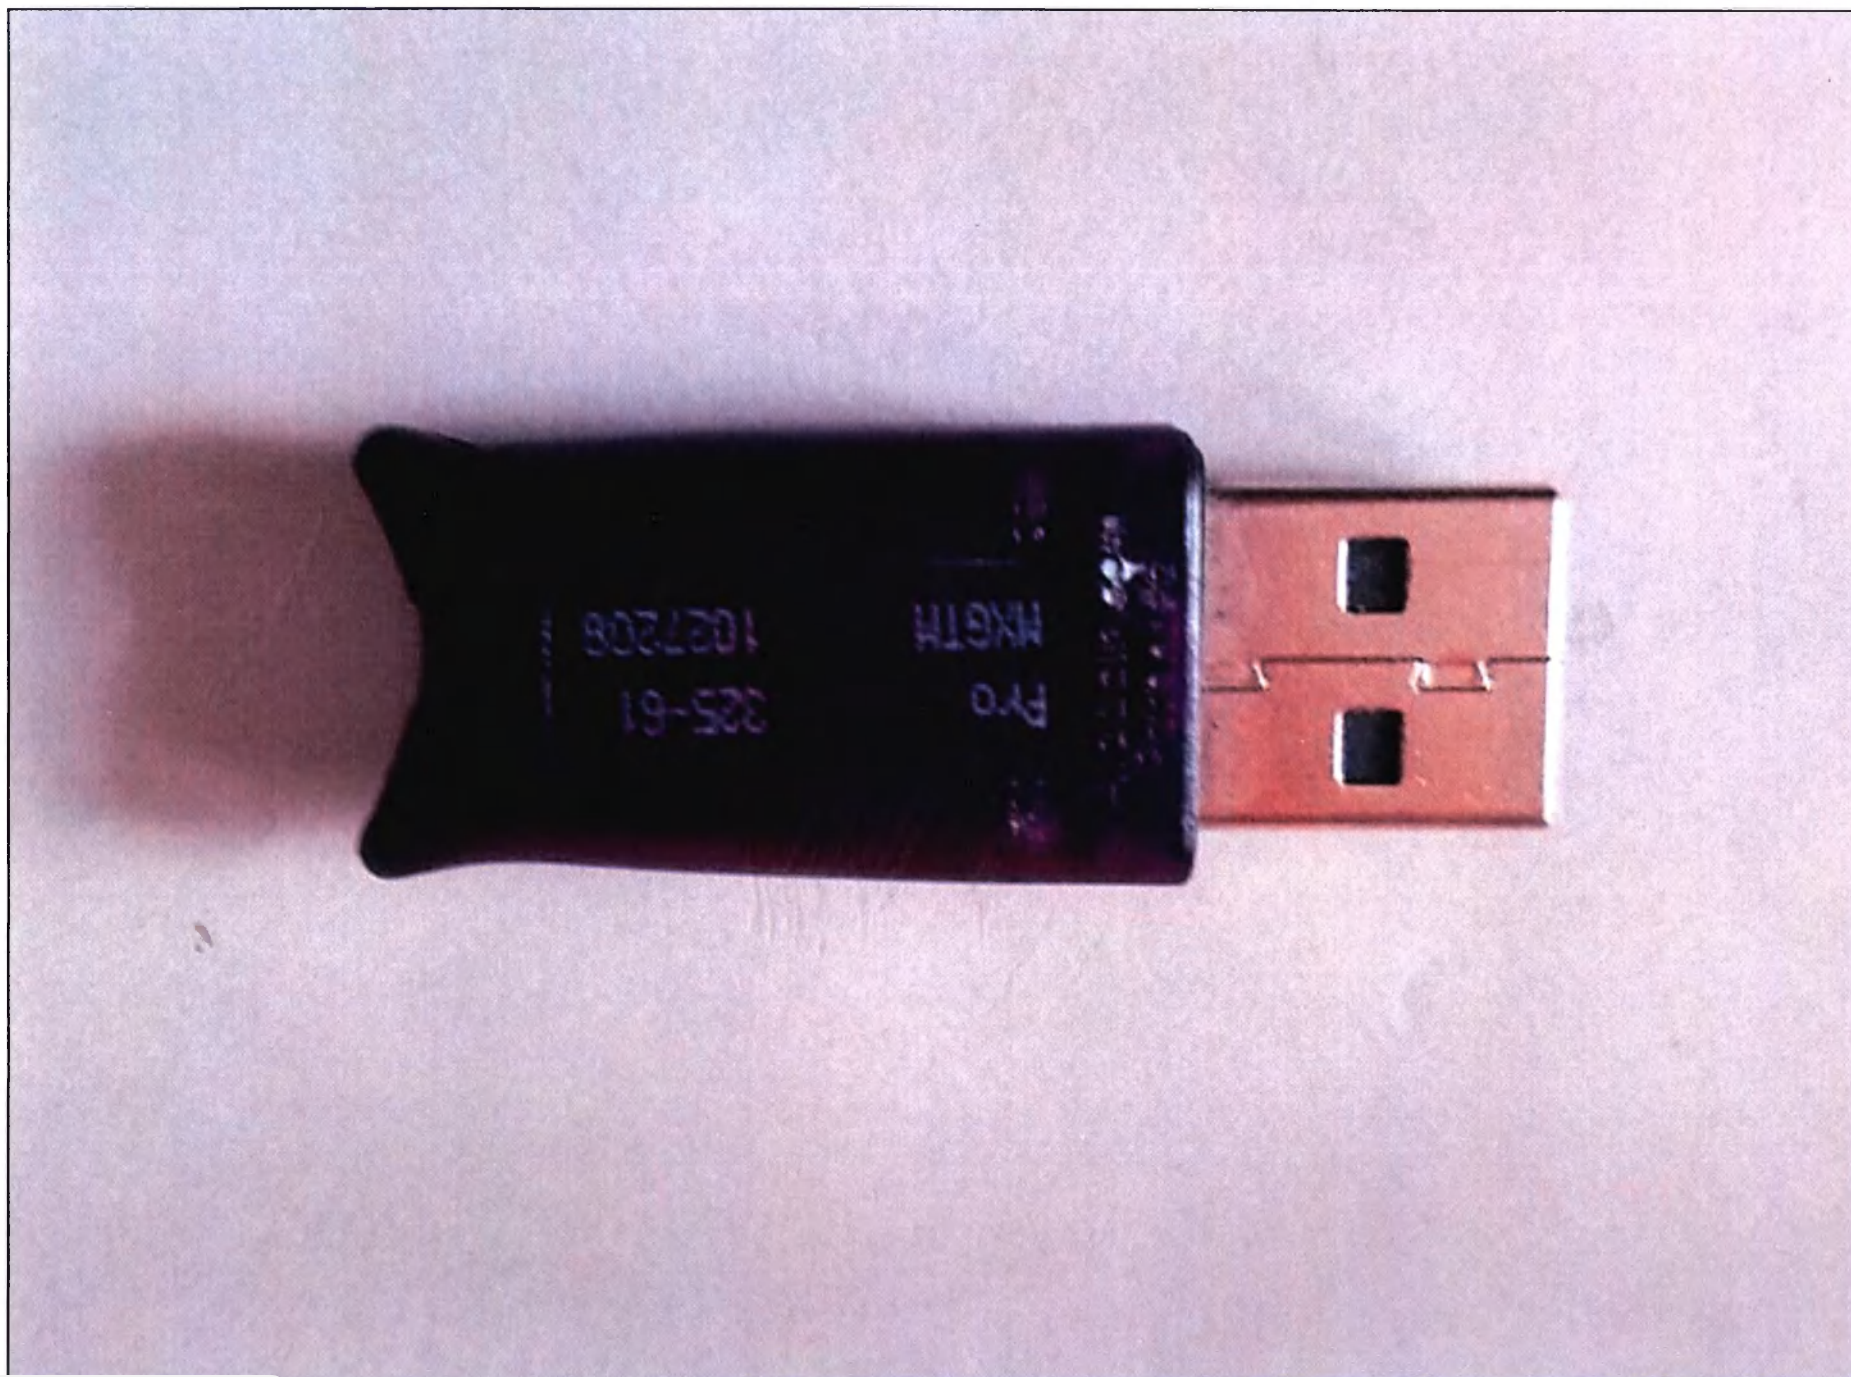

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 59
(пятьдесят девять) листов
Руководитель отдела регистрации и
сертификации России и СНГ ООО
«ДжиИ Хэлскеа» Парахина С.Б.

Подпись _____

