


Проводники эндоскопические с принадлежностями

Варианты исполнения: DWG-25-260-S; DWG-25-260-A-S; DWG-35-260-S; DWG-35-260-A-S

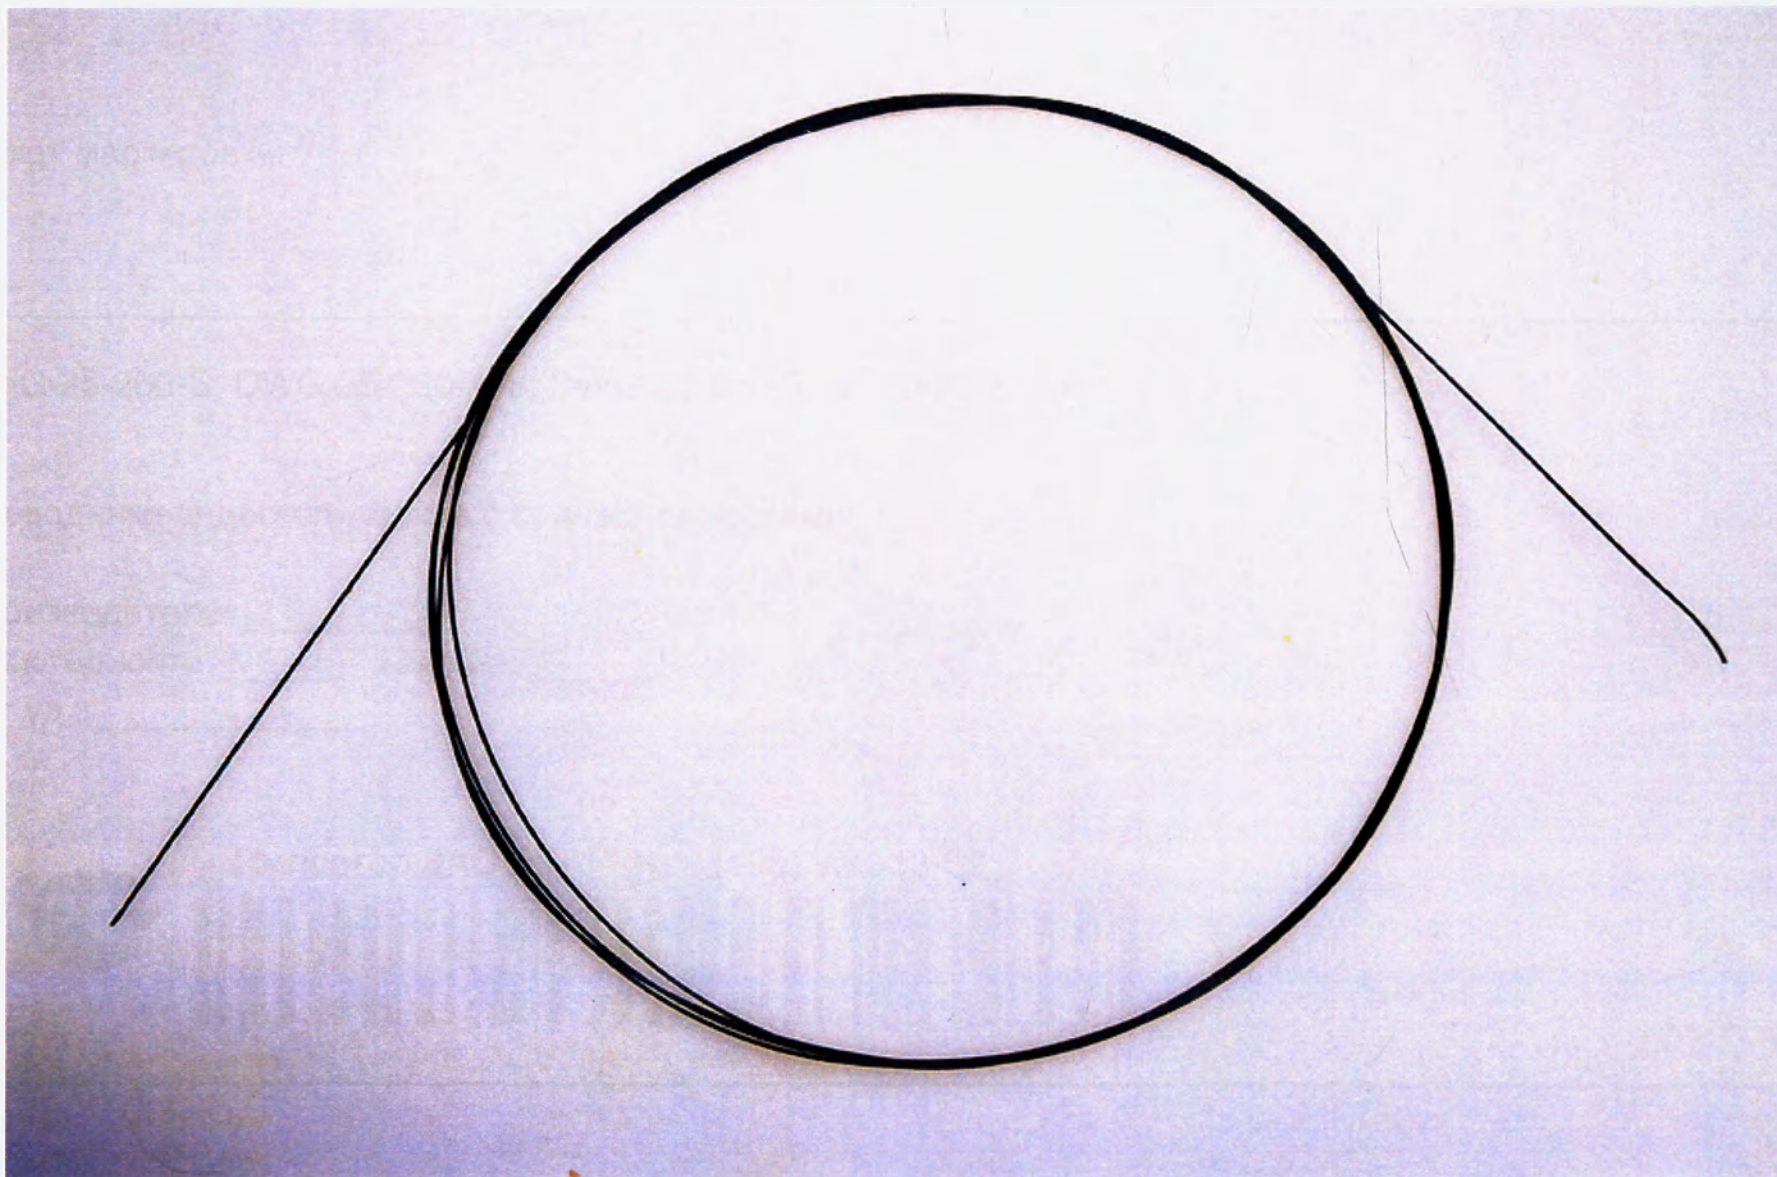

Макет маркировки:

DWG-25-260-S; DWG-25-260-A-S; DWG-35-260-S; DWG-35-260-A-S

Проводники эндоскопические с принадлежностями:

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



DWG-25-260-S
DELTA WIRE GUIDE

G31595

.025 in

260 cm

DISPOSABLE - SINGLE USE ONLY

LOT	W4158581	EXP	2021-08-28	REF	2018-08-28
STERILE	NO		RxOnly		

COOK DWG-25-260-S G31595
W4158581
LOT 0082700251585817315858173158581

COOK DWG-25-260-S G31595
W4158581
LOT 0082700251585817315858173158581

COOK DWG-25-260-S G31595
W4158581
LOT 0082700251585817315858173158581

COOK
MEDICAL

Wilson-Cook Medical Inc.
4400 Behrns Street Road
Morton Grove, IL 60053
COOK Medical
Chandler Road, Future Technology Park
Limerick, Ireland
www.cookmedical.com


CE 0088
MADE IN USA
190210906

DWG-25-260-S
Гибкий проводник

Производитель: Wilson Cook Medical Inc. Соединительные шпатели
Срок годности: 28.08.21 Партия: W4158581
Пер. уа: РЗН 2015/2946 от 11.08.2015 г.
Муницип. ЗАО "ИЛ" Тен. (485) 936-13-09

PG
A035

тики эндоскопические с принадлежностями
анты исполнения: ACRO-25-260; ACRO-25-450; ACRO-35-205; ACRO-35-260; ACRO-35-450

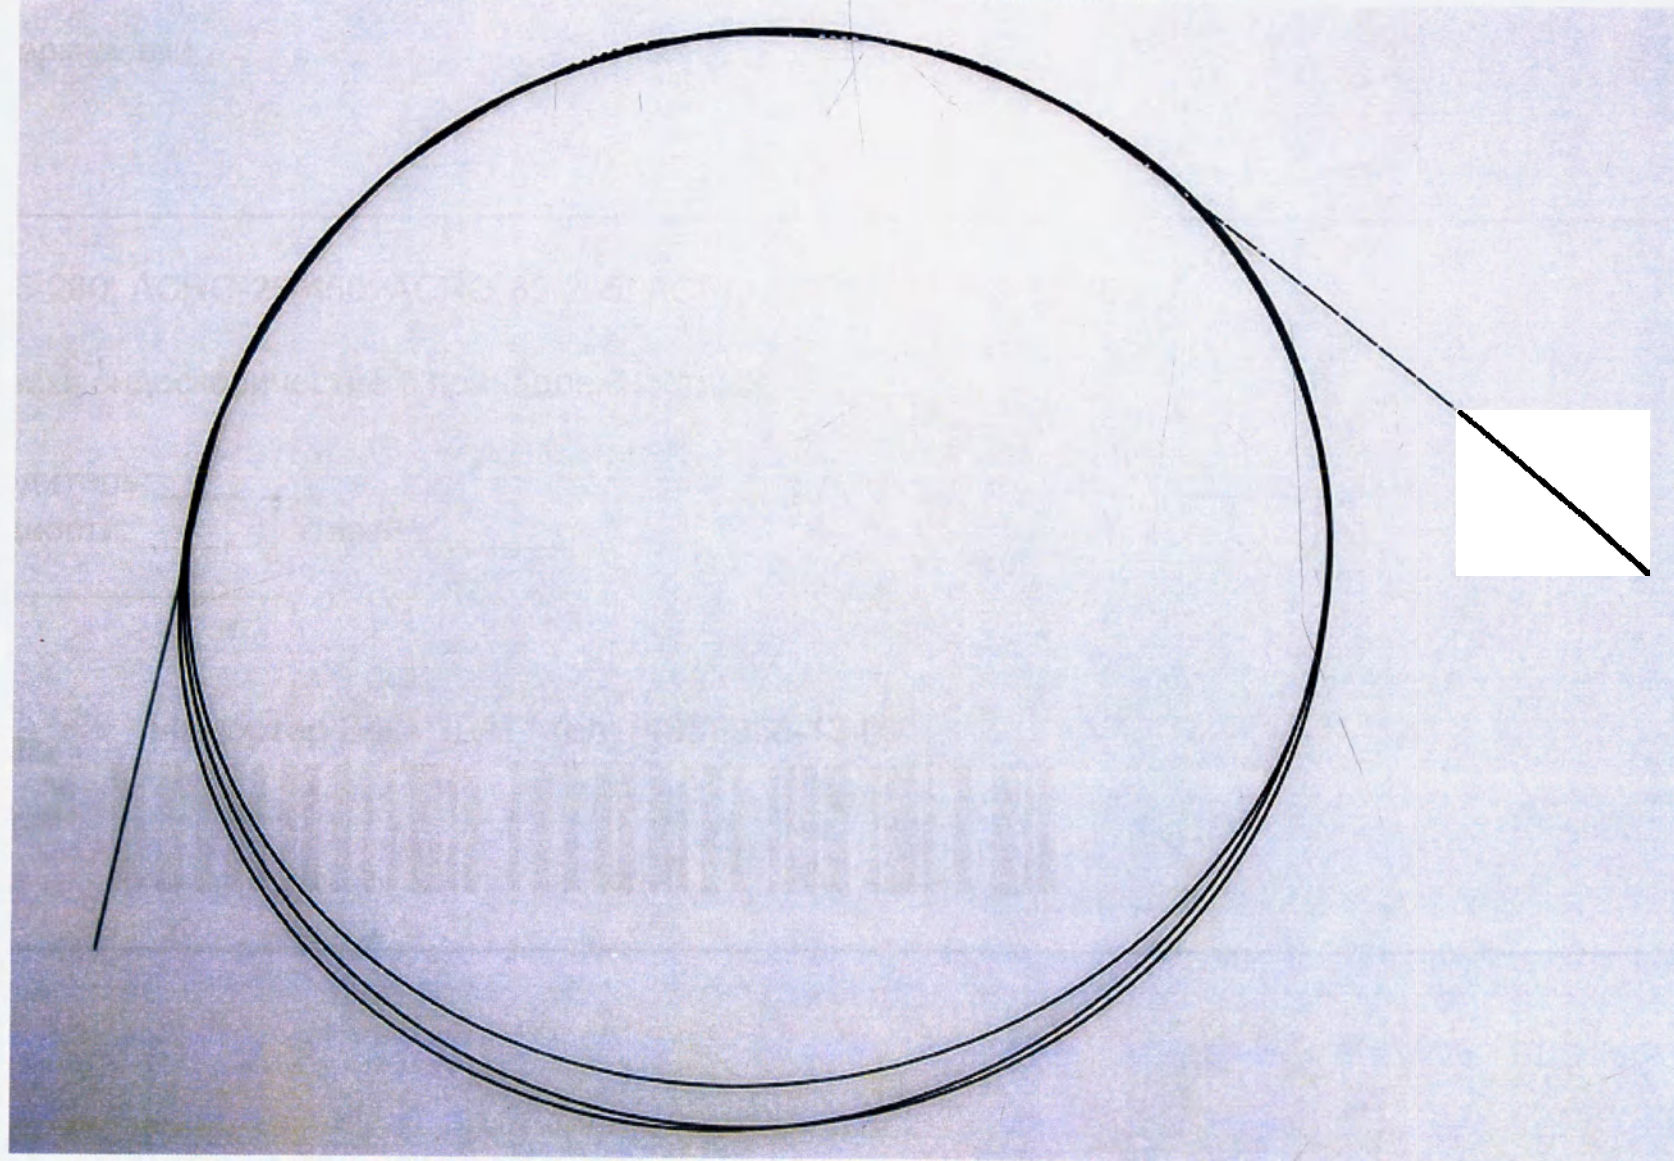

Макет маркировки:

ACRO-25-260; ACRO-25-450; ACRO-35-205; ACRO-35-260; ACRO-35-450

Проводники эндоскопические с принадлежностями:

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



COOK MEDICAL

Acrobat™

CALIBRATED TIP WIRE GUIDE

ACRO-35-260
G34265

DISPOSABLE - SINGLE USE ONLY

.035 in
260 cm

5 cm

RxOnly

STERILE

LOT: W4028988

EXP: 2021-02-05

MADE: 2018-02-05

COOK MEDICAL

Wilson Cook Medical, Inc.
1902 Ballantyne Station Road
Charlotte, NC 28216
MADE IN USA

COOK Medical
Charlotte, NC
National Technology Park
Lynchburg, VA

CE

ACRO-35-260 G34265 W4028988

ACRO-35-260 G34265 W4028988

ACRO-35-260 G34265 W4028988

160370113

ACRO-35-260

Проводник эндоскопический


Производитель: Wilson Cook Medical Inc. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
Срок годности: 05.02.21 Партия: W4028988
Рег. уд. РЗН 2015/2946 от 11.09.2015 г.
Импортер ЗАО "ШАГ" тел. (495) 956-13-09




W422



проводники эндоскопические с принадлежностями
варианты исполнения: AWG2-25-260-A; AWG2-25-450-A; AWG2-35-205-A; AWG2-35-260-A; AWG2-35-450-A
Изображение проводника эндоскопического (в держателе для проводника) форма наконечника - изогнутая

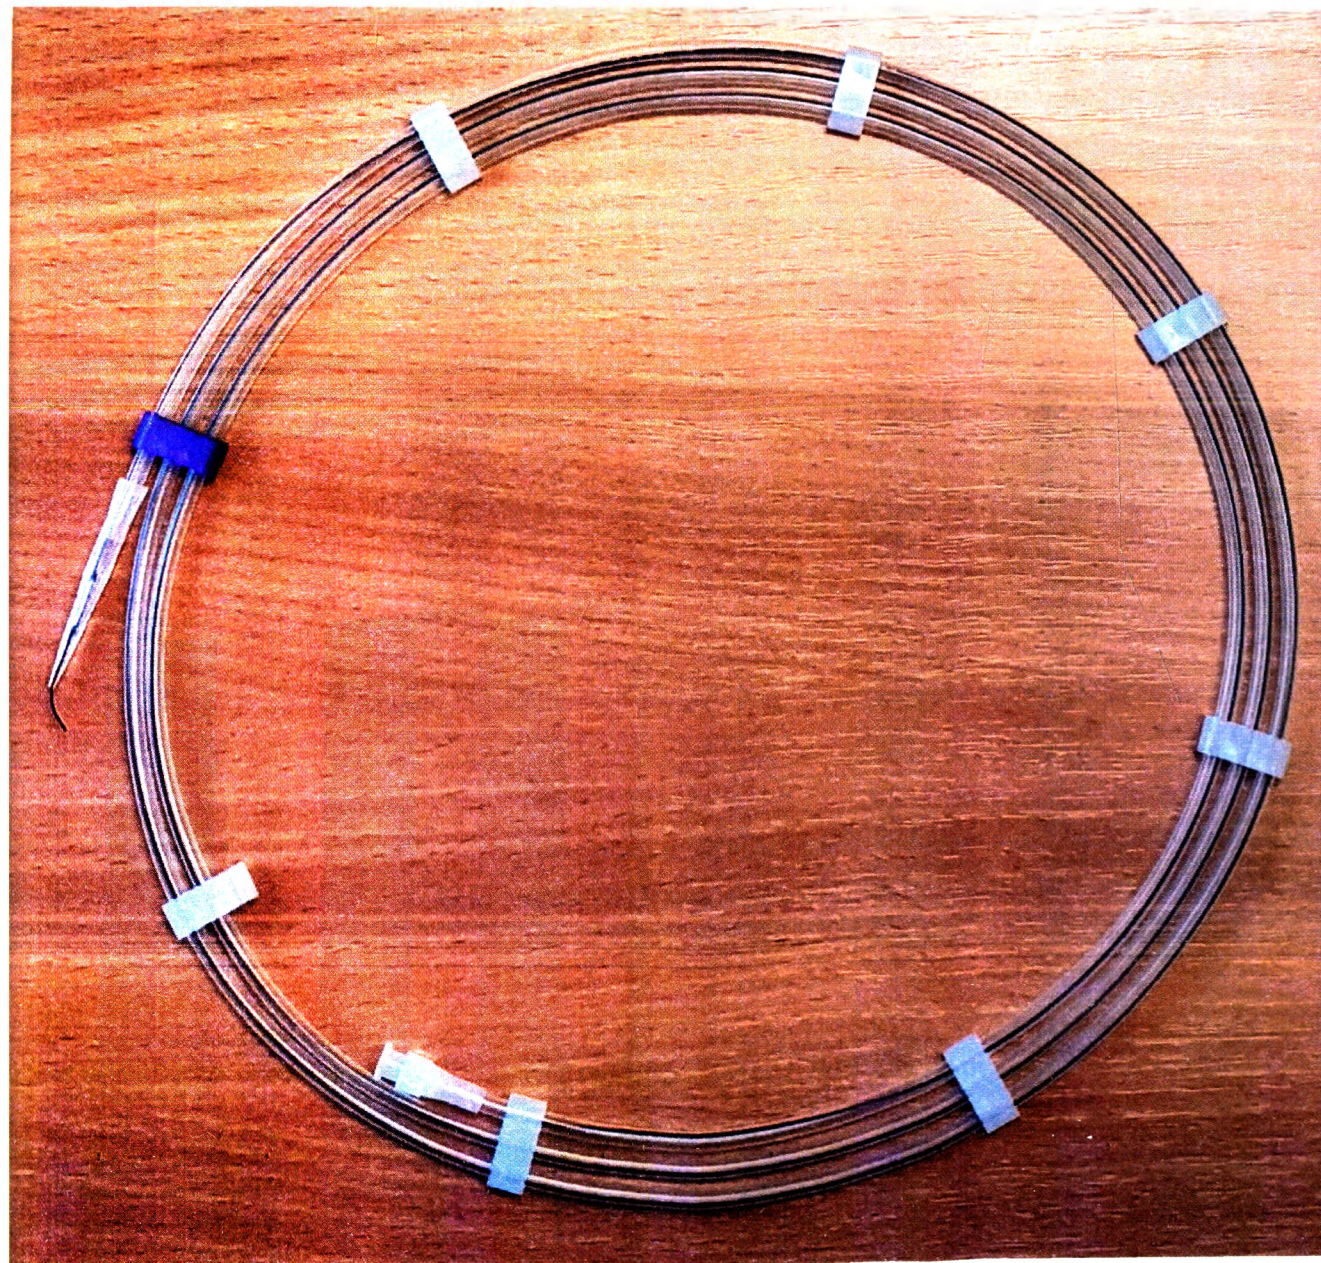

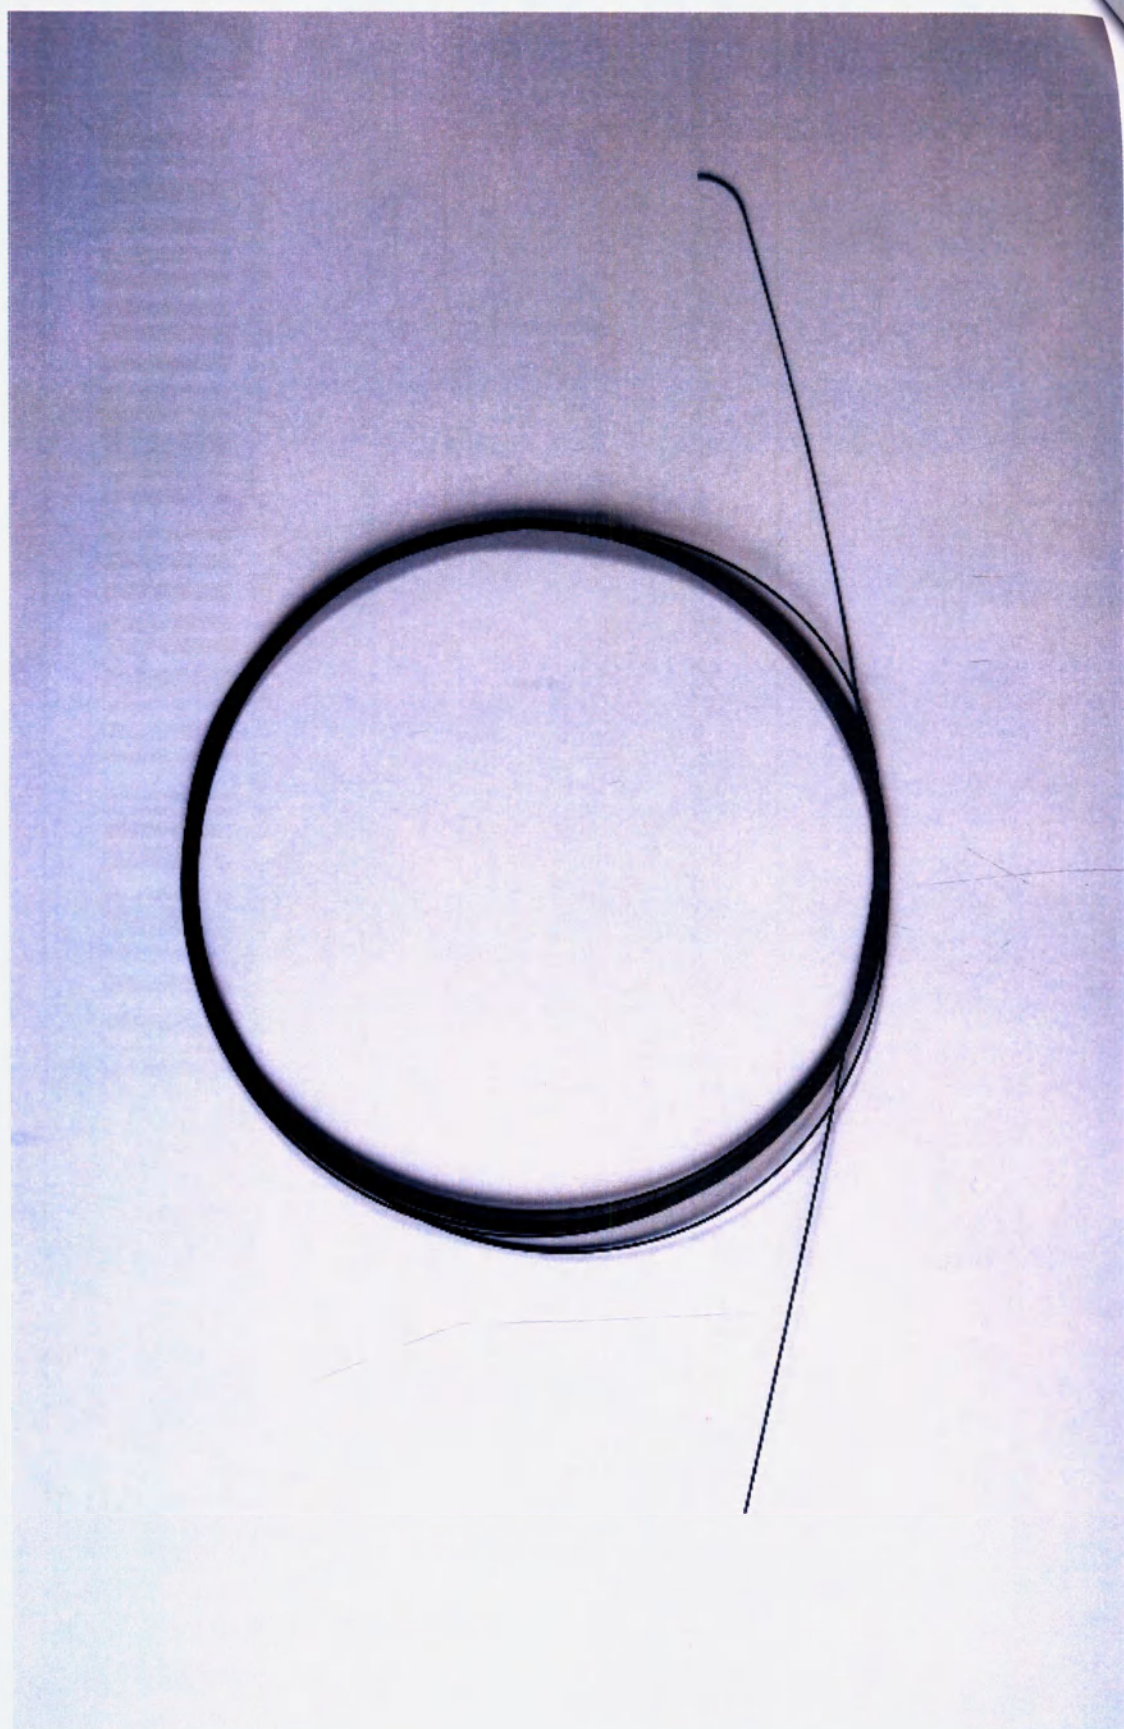

Макет маркировки:

AWG2-25-260-A; AWG2-25-450-A; AWG2-35-205-A; AWG2-35-260-A; AWG2-35-450-A

Проводники эндоскопические с принадлежностями:

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег. уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09




...тики эндоскопические с принадлежностями

...рианты исполнения: AWG2-25-260; AWG2-25-450; AWG2-35-205; AWG2-35-260; AWG2-35-450.

Изображение проводника эндоскопического (в держателе для проводника), форма наконечника - прямая

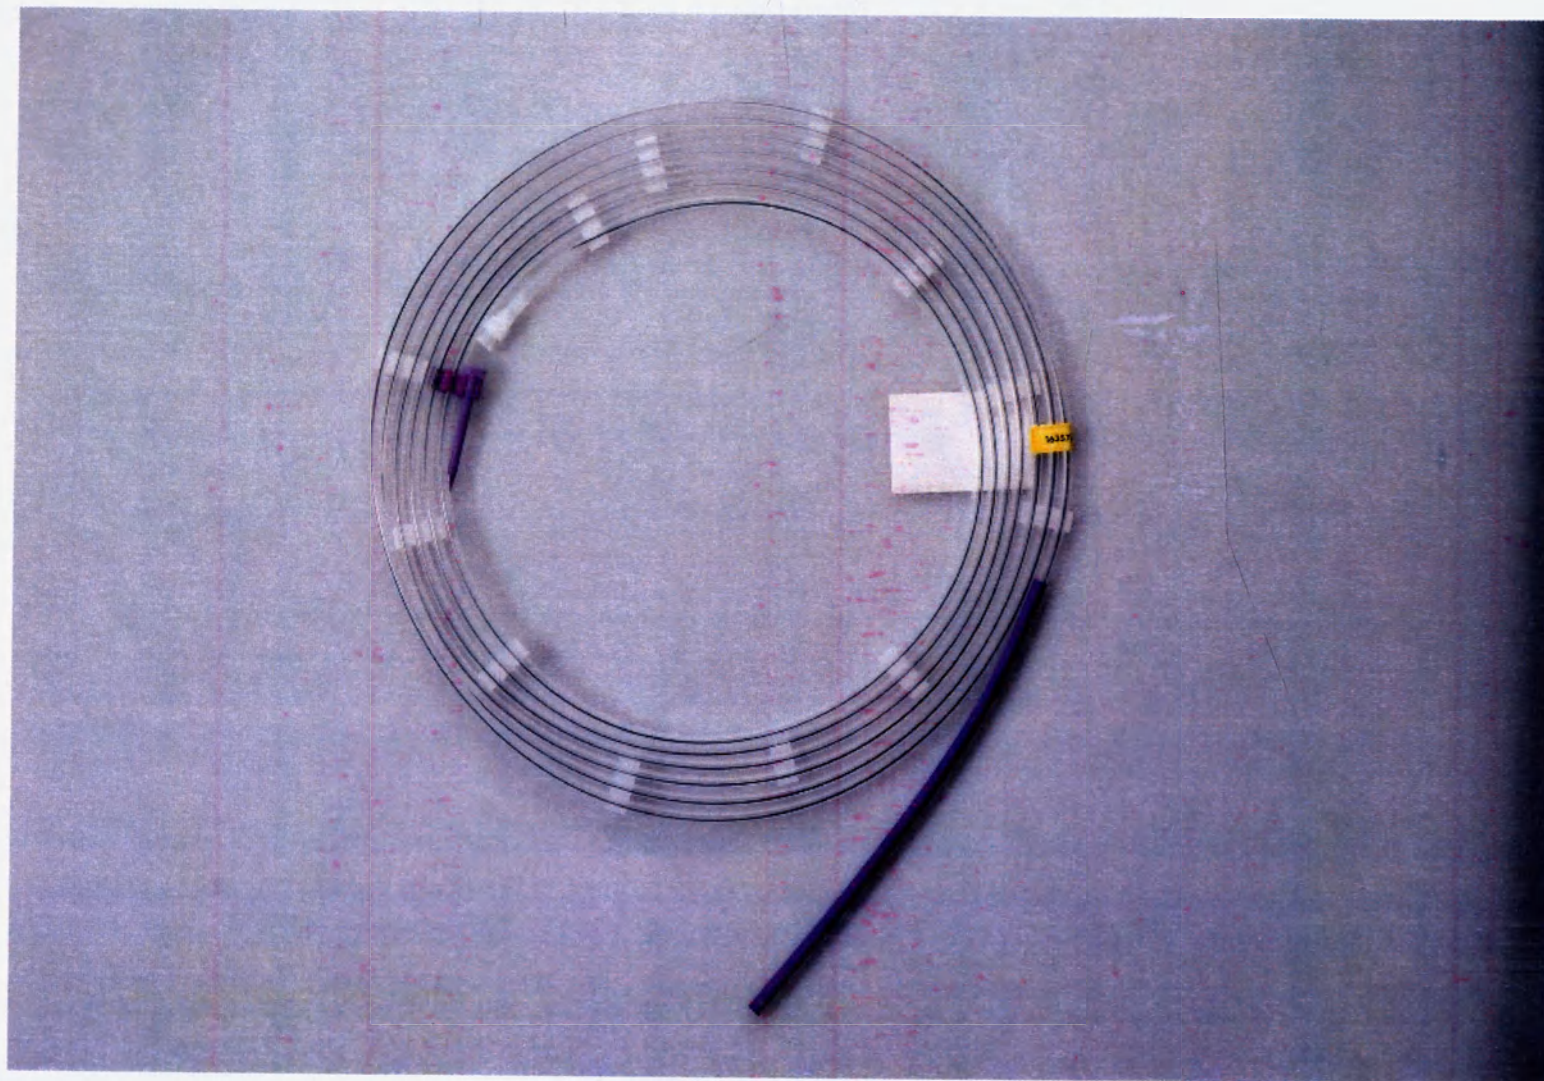

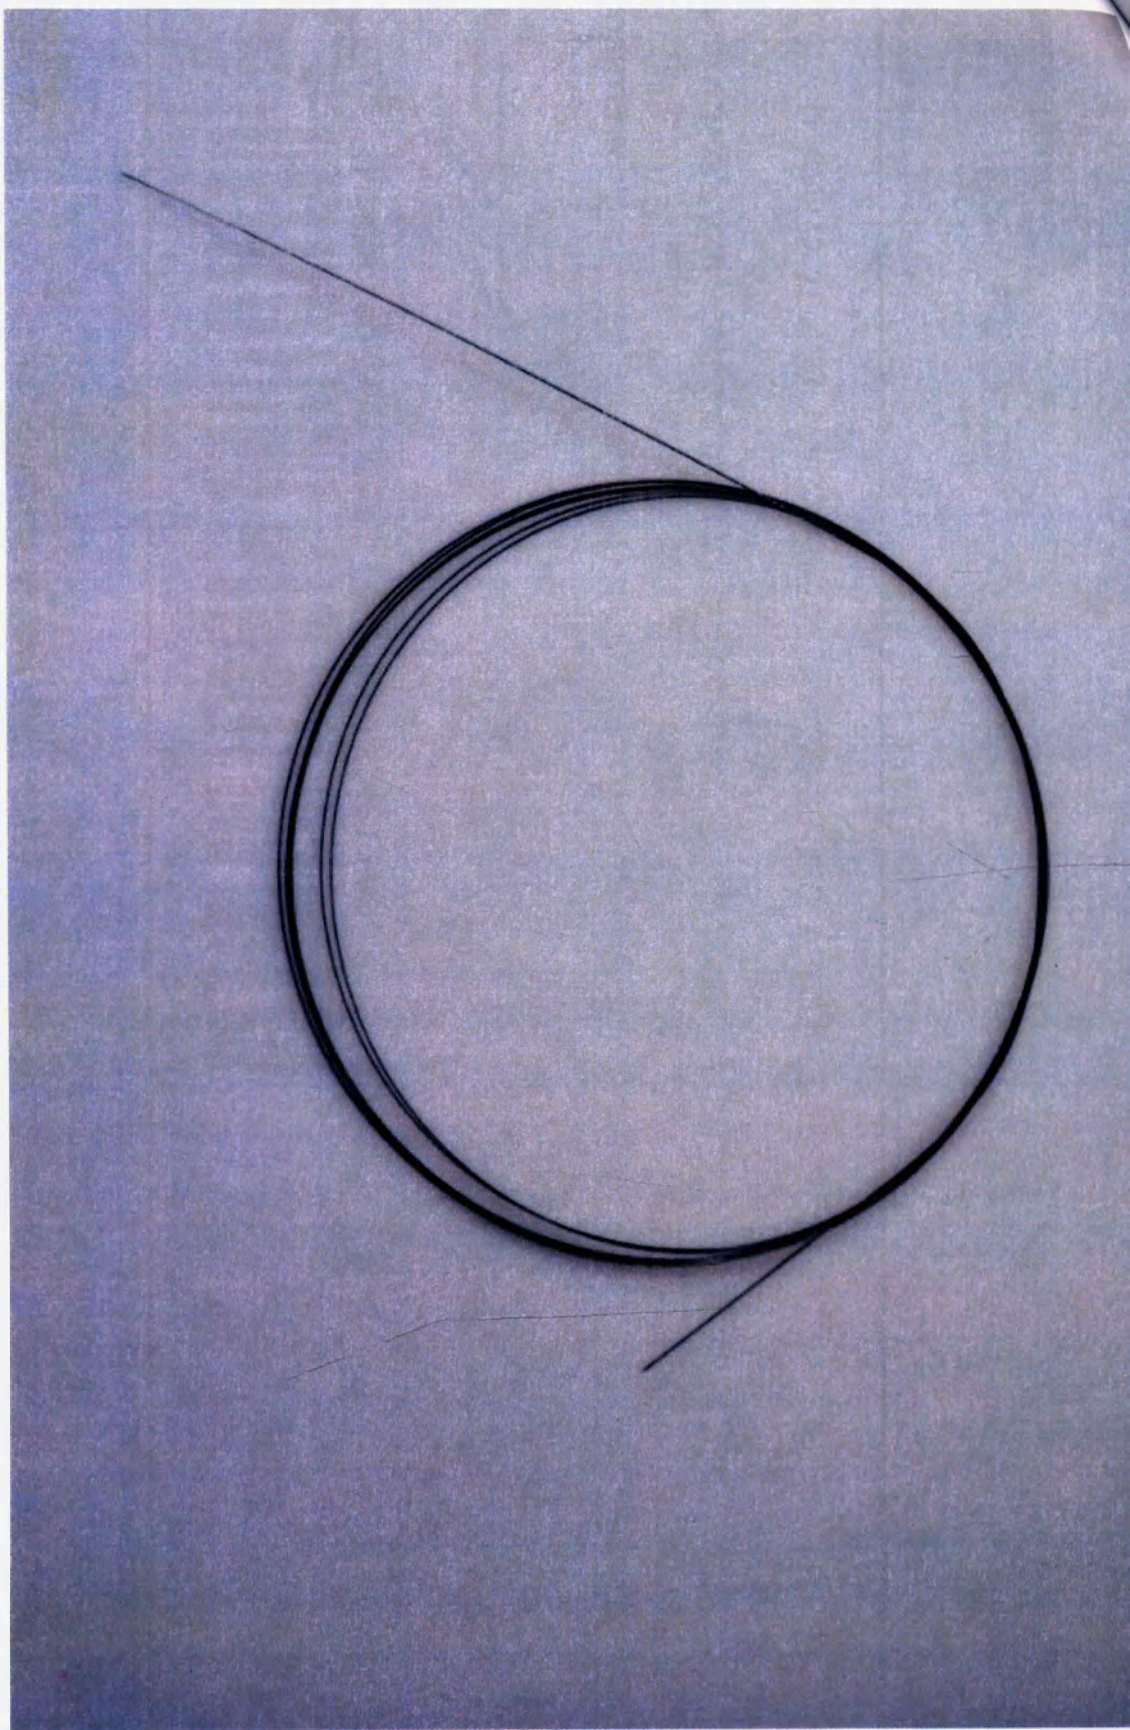

макет маркировки:

AWG2-25-260; AWC2-25-450; AWC2-35-205; AWC2-35-260; AWC2-35-450;

Проводники эндоскопические с принадлежностями:

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег. уд.: _____



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Acrobat 2

CALIBRATED TIP WIRE GUIDE

AWG2-35-260

G47614

COOK MEDICAL

.035 in
x 260 cm

DISPOSABLE - SINGLE USE ONLY



Rx Only



Wilson Cook Medical, Inc.
1000 Trafalgar Square, Suite 200
Bloomington, IL 61710-1000
USA
COOK MEDICAL
Catheter Technology Park
Lombard, Illinois

www.cookmedical.com

AWG2-35-260

Проводник радиочастотный

Производитель: Wilson Cook Medical Inc., СООБДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

Дата выпуска: 28.08.21 Партия: W4101332

Рег. №: -

Импортер ЗАО "ЦИМ" тел.: (495) 956-13-49



W4101332

W4101332

W4101332

W4101332

W4101332

W4101332

W4101332

W4101332

W4101332

W4101332

W4101332

W4101332

W4101332

W4101332

W4101332

W4101332

W4101332

W4101332

W4101332

W4101332

W4101332

W4101332

W4101332

W4101332


W4101332

W4101332

W4101332

W4101332

...ники эндоскопические с принадлежностями
...рианты исполнения: FS-LT-35-205; FS-LT-35-260; FS-LT-35-480

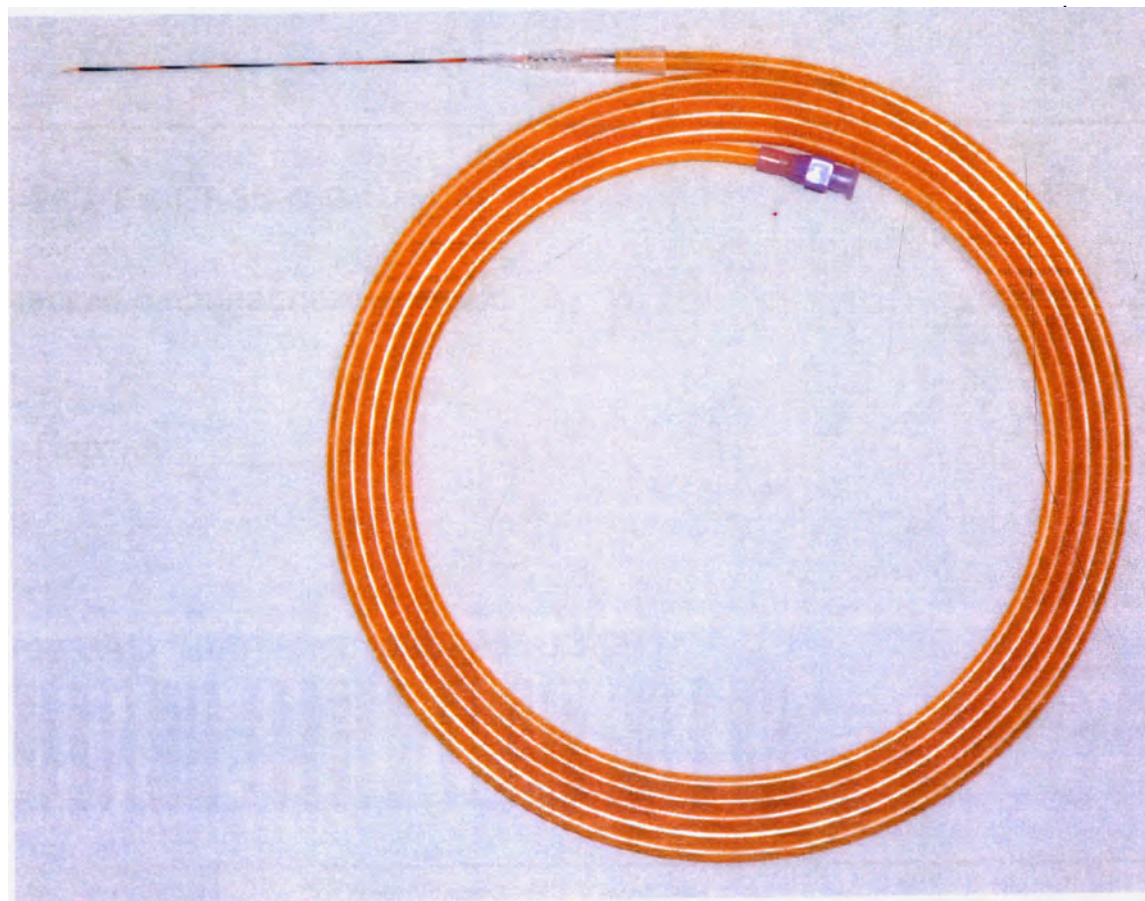

Макет маркировки:

FS-LT-35-205; FS-LT-35-260; FS-LT-35-480

Проводники эндоскопические с принадлежностями:

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег. уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09





FS-LT-35-260
FUSION LOOP TIP WIRE GUIDE

G50976




FS-LT-35-260

Положить в стерилизатор

Производитель: Wilson Cook Medical Inc. Соединенные Штаты
Срок годности см. упаковку Партия
№ 24 P3H 2015/2948 от 11.08.2015 г.
Импортер ЗАО "ЦАТ" тел. (495) 696-13-00



...ники эндоскопические с принадлежностями
...рианты исполнения: FSW-35

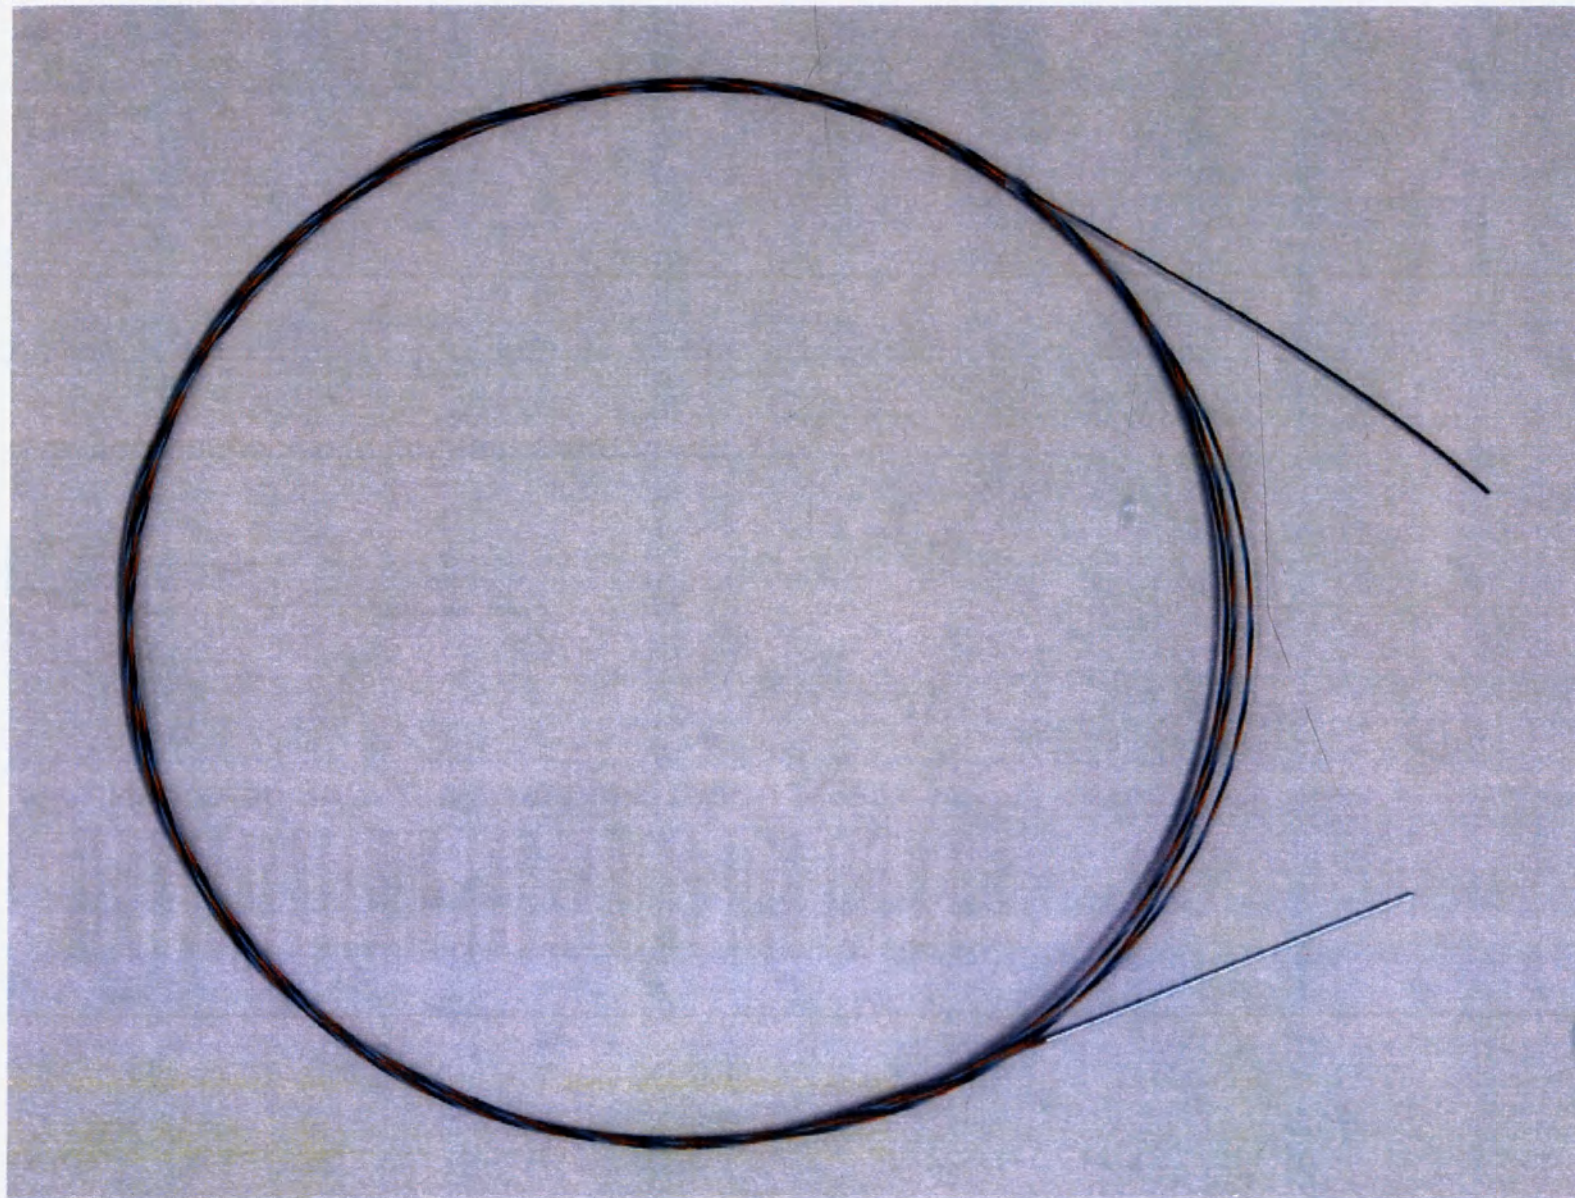

Макет маркировки:

FSW-35

Проводники эндоскопические с принадлежностями:

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег. уд.: _____



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



FSW-35
FUSION ULTRA SHORT WIRE GUIDE

G31910

.035 in

205 cm

DISPOSABLE SINGLE USE ONLY

LOT	W4032487	EXP	2021-02-14	EXP	2018-02-14
STERILE	BD	RxOnly			

COOK FSW-35 G31910

W4032487

COOK FSW-35 G31910

W4032487

COOK FSW-35 G31910

W4032487

COOK
MEDICAL

Wilson Cook Medical Inc.
1000 Wilson Road
Cook County, IL 60018
COOK Medical
Cook County Medical Technology Park
Lombard, IL 60148
www.cookmedical.com

CE 0088
MADE IN USA
ENH00000


FSW-35
Проводник эндоскопический

Производитель: Wilson Cook Medical Inc. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
Срок годности: 14.02.21 Партия: W4032487
Рег. у.в. РЗН 2015/2948 от 11.08.2015 г.
Импортер ЗАО "ШАГ" тел. (495) 958-13-06

РЗН
УИМ72



...ики эндоскопические с принадлежностями
...анты исполнения: НУВ-48015; НУВ-48025; НУВ-48015-А; НУВ-48025-А

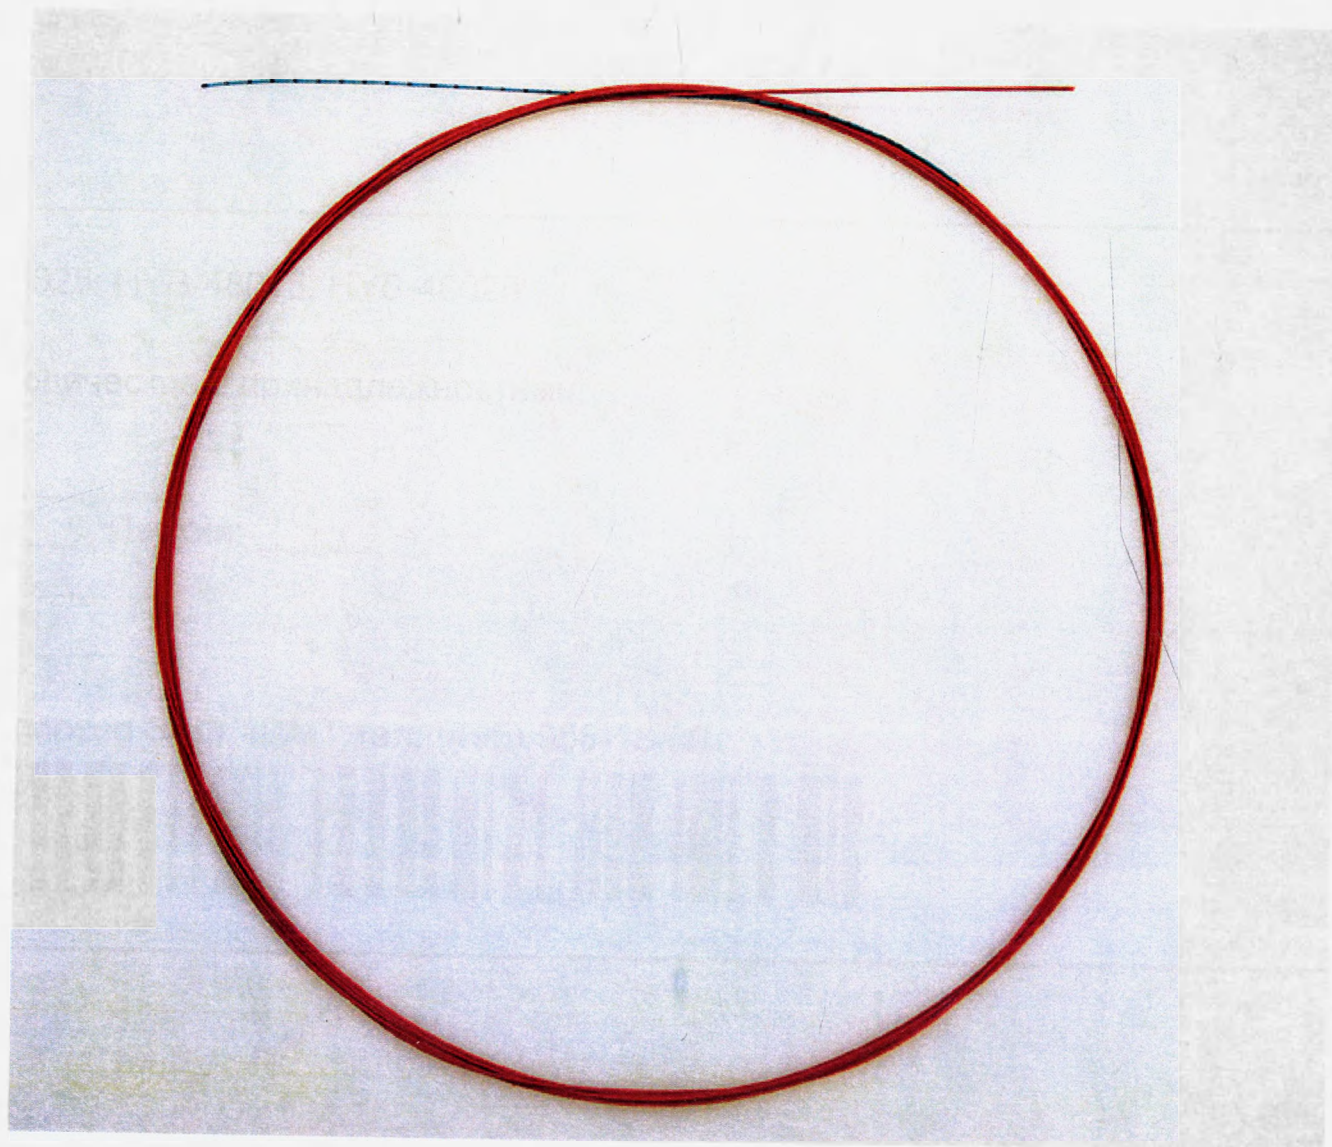

Макет маркировки:

НУВ-48015; НУВ-48025; НУВ-48015; НУВ-48025

Проводники эндоскопические с принадлежностями:

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег. уд.: _____



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



HYB-48015-A
TRACER HYBRID WIRE GUIDE

G22660



DISPOSABLE - SINGLE USE ONLY

LOT	W3728061	2018-04-02	2018-04-02
STERILE	NO	RxOnly	

COOK HYB-48015-A G22660



COOK HYB-48015-A G22660



COOK HYB-48015-A G22660



COOK Medical Inc.
2000 Lakeside Drive, Suite 200
Bloomington, IL 61840
USA
Tel: 815/336-7000
Fax: 815/336-7001
www.cookmedical.com



HYB-48015-A

Соединитель гибридного проводника для катетера Фокус-Вью

Производитель: Wilson Cook Medical Inc. Соединенные Штаты

1201 годности G2 DE-19 Партия W3728061


№: P3412018/2946 от 11.08.2015 г.

Интернет-3AG "ЮА" тел: (495) 956-13-00



проводники эндоскопические с принадлежностями

варианты исполнения: RR-18-260; RR-18-260-A; RR-18-480; RR-18-480-A; RR-18-480-MUSC

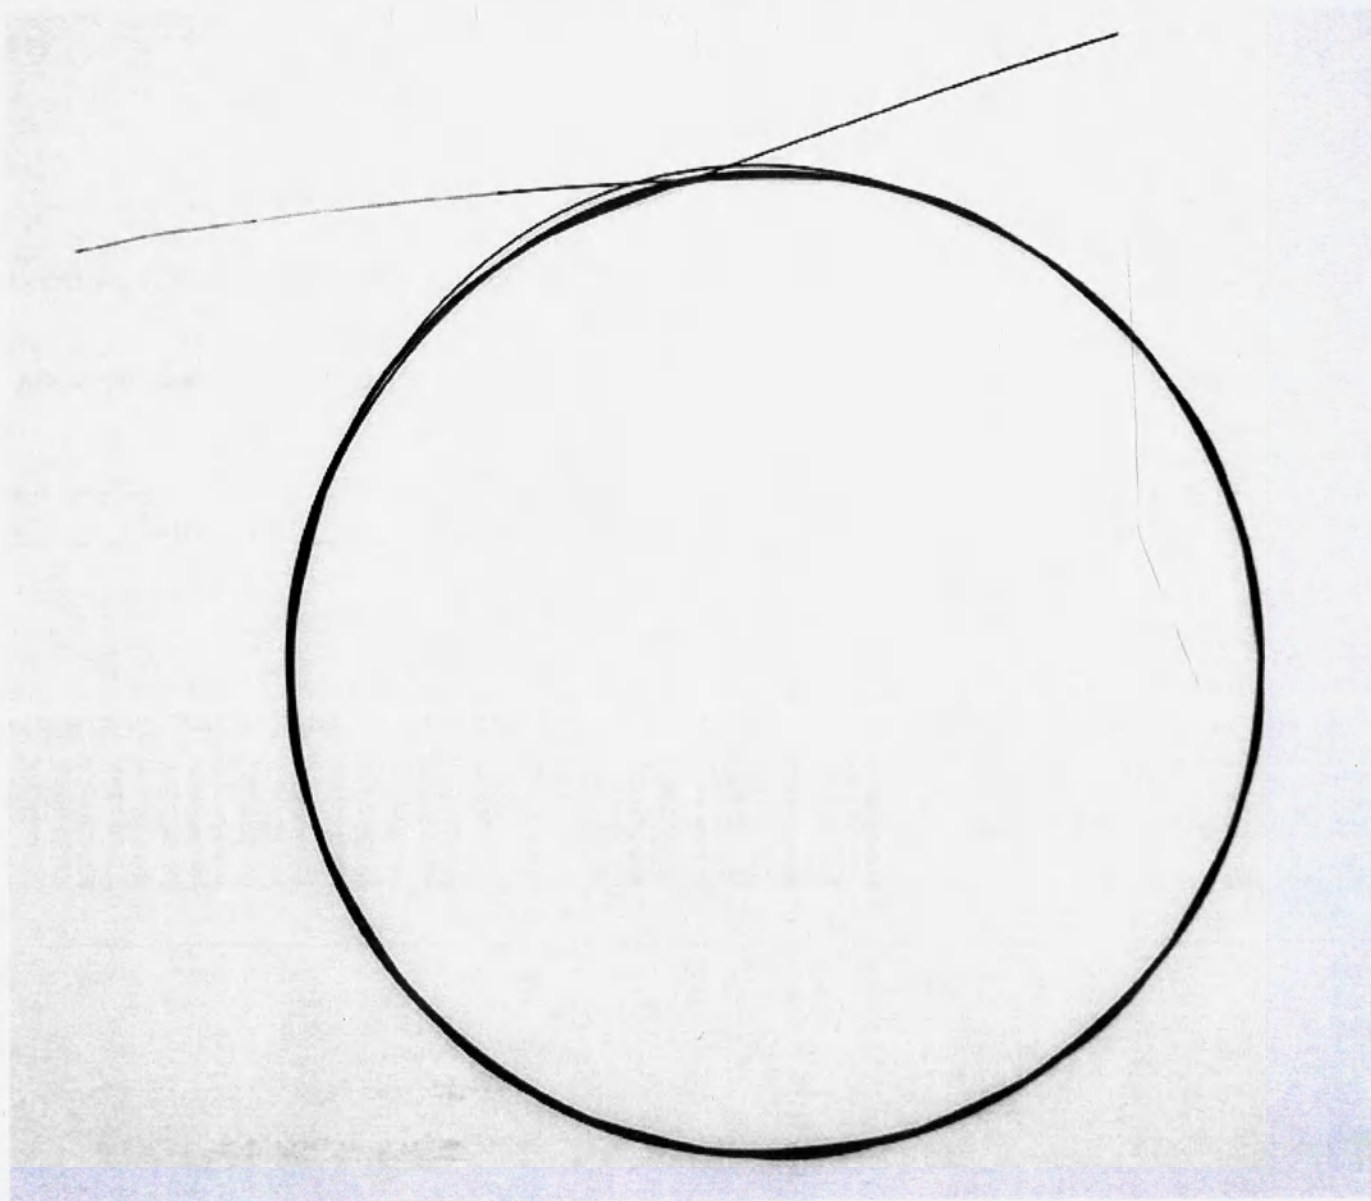

Макет маркировки:

RR-18-260; RR-18-260-A; RR-18-480; RR-18-480-A; RR-18-480-MUSC

Проводники эндоскопические с принадлежностями:

Производитель: _____


Срок годности: _____ Партия: _____

Рег. уд.: _____



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09





MADE IN USA
RR-18-160

CC

COOK MEDICAL

COOK.. RM-18-400 QZ2419 W415685

COOK 104-18-480 023418

[illegible]

LOT	W4186005	2021-12-11	2018-12-18

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.


480 CM

810

G22419

RR-18-480
ROADRUNNER WIRE GUIDE

Водники эндоскопические с принадлежностями
Варианты исполнения: THSF-35-400; THSF-35-480

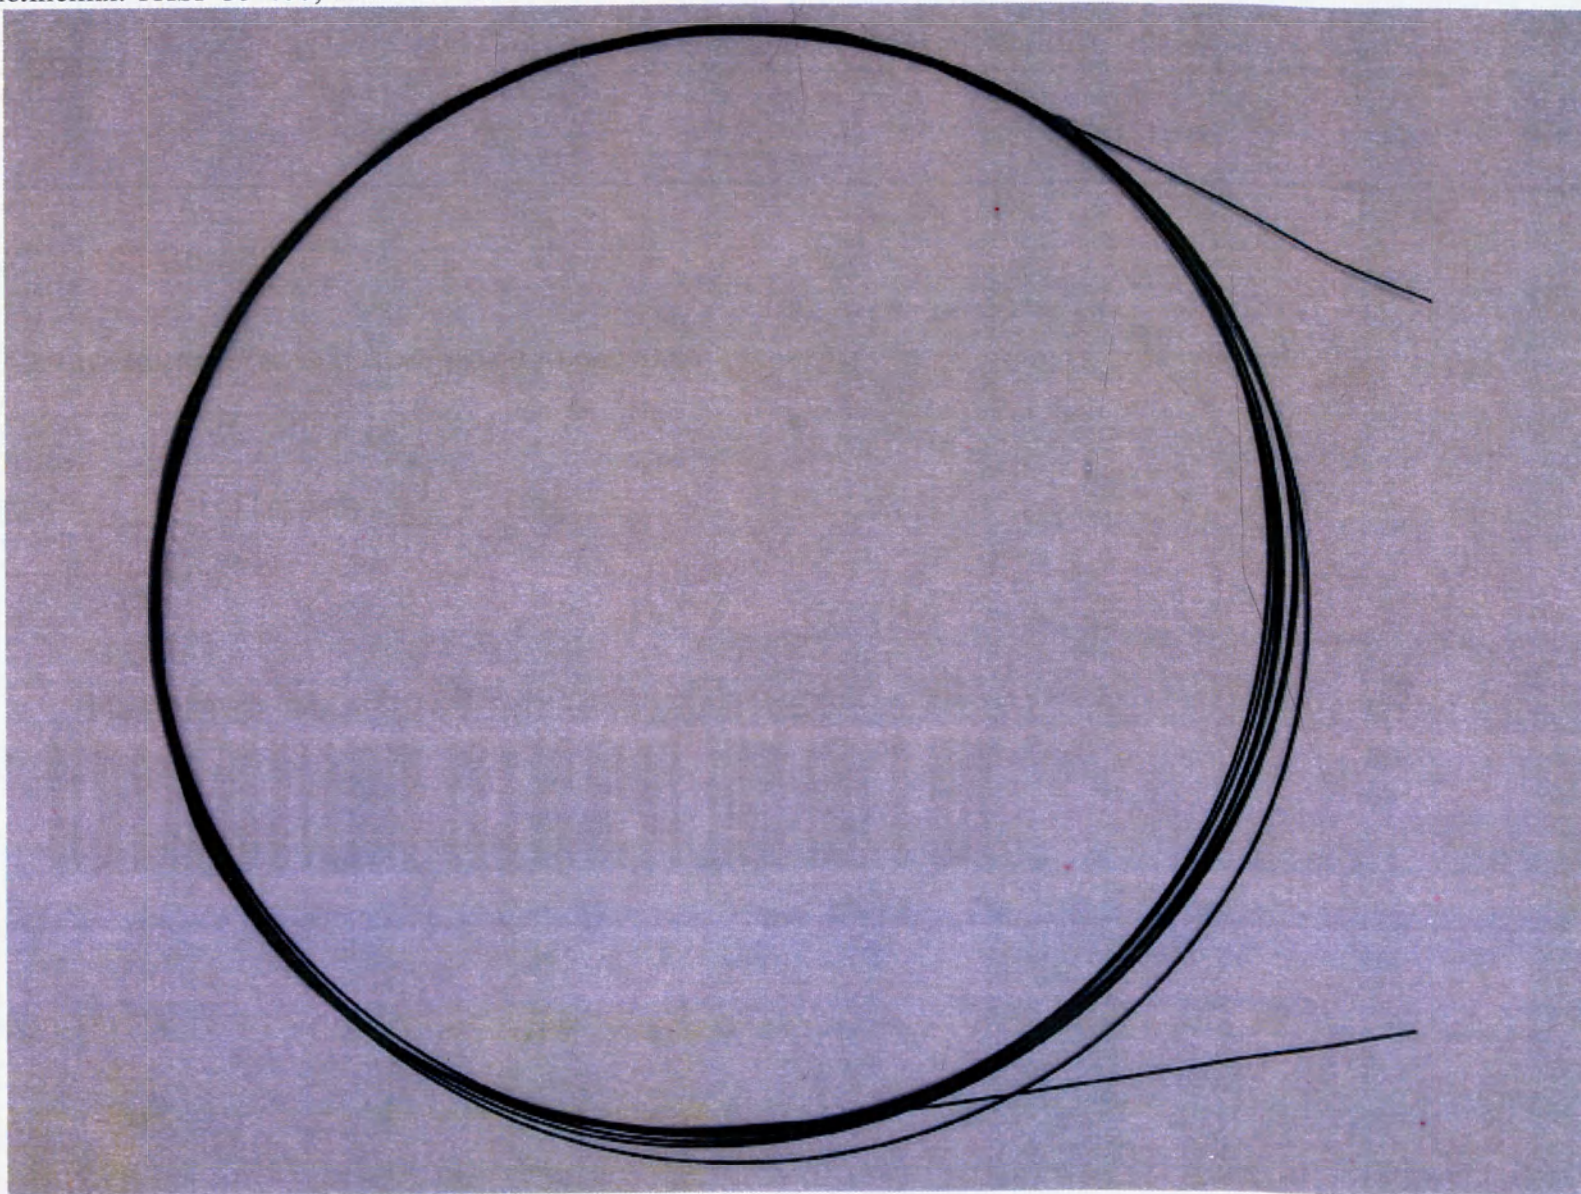

Макет маркировки:

THSF-35-400; THSF-35-480

Проводники эндоскопические с принадлежностями:

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____


Рег. уд.: _____



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



...ники эндоскопические с принадлежностями
...рианты исполнения: МЕТ-25-480; МЕТ-25-480-А; МЕТ-35-480; МЕТ-35-480-А

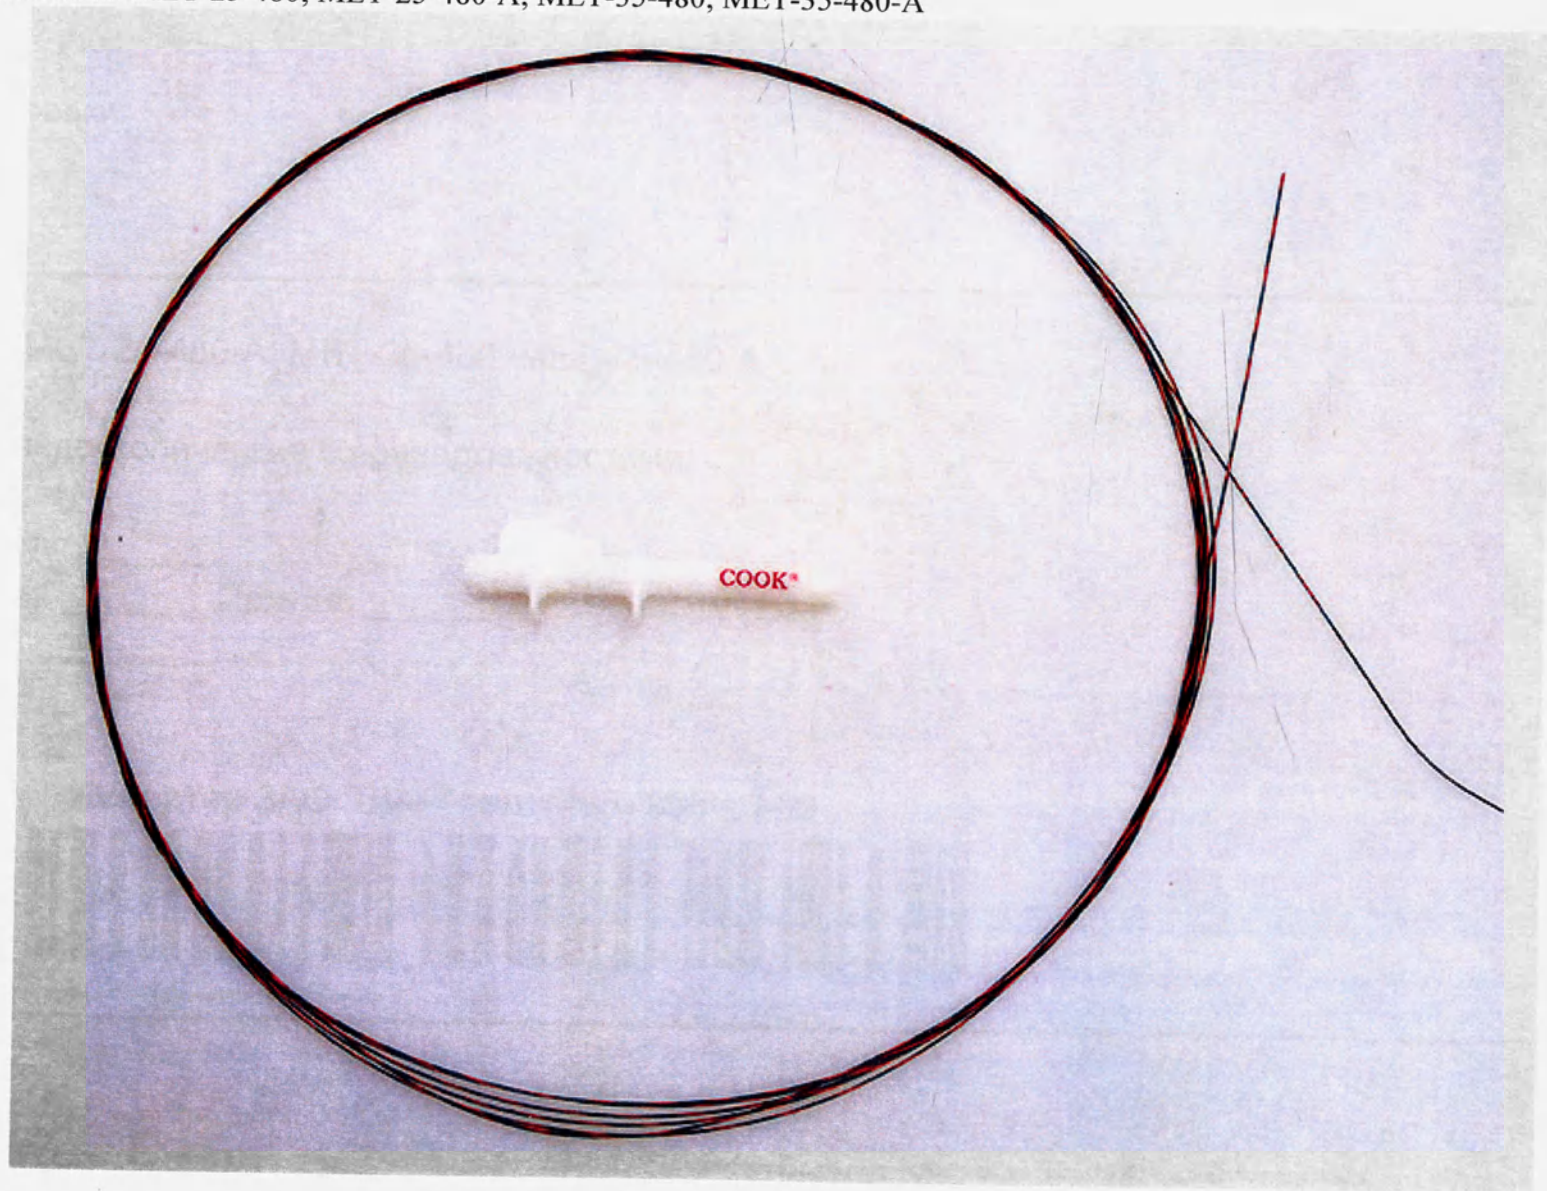

Макет маркировки:

МЕТ-25-480; МЕТ-25-480-А; МЕТ-35-480; МЕТ-35-480-А

Проводники эндоскопические с принадлежностями:

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег. уд.: _____



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



MET-35-480-A
TRACER METRO WIRE GUIDE

G25213



DISPOSABLE. SINGLE USE ONLY.

LOT	W4140127	EXP	2021-11-07	2018-11-07
STERILE	NO	RxOnly		

COOK MET-35-480-A	G25213
W4140127	

COOK MET-35-480-A	G25213
W4140127	

COOK MET-35-480-A	G25213
W4140127	

COOK MEDICAL

Wilson Cook Medical, Inc.
1000 Baltimore Station Road
Bloomington, IL 61820
COOK, Inc.
Chicago, IL 60606
www.cookmedical.com

CE 0088
MADE IN USA
11421096

MET-35-480-A

Проводник эндоскопический с адаптером Ocot Torque Device


Производитель: Wilson Cook Medical Inc. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
Срок годности: 05.11.21 Партия: W4140127

Рег. уд. РЗН 2015/2946 от 11.08.2015 г.

Импортер ЗАО "ШАГ" тел. (495) 956-13-09



скопические с принадлежностями
исполнения: МЕП-21-260; МЕП-21-480; МЕП-25-260; МЕП-25-480; МЕП-35-260; МЕП-35-480; МЕП-35-480-А; МЕП-

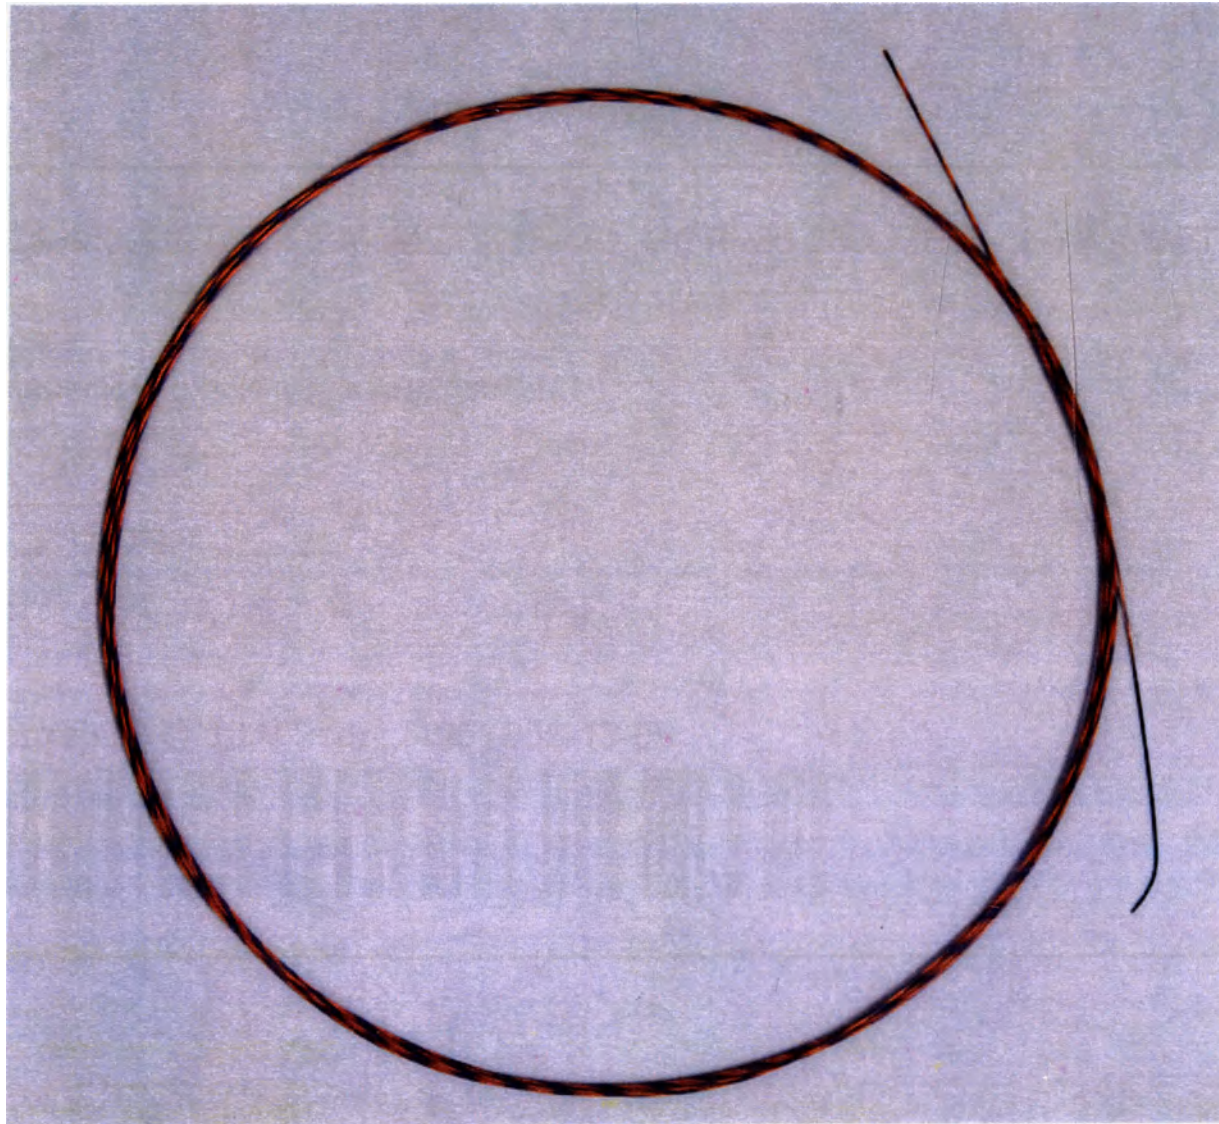

Макет маркировки:

МЕТII-21-260; МЕТII-21-480; МЕТII-25-260; МЕТII-25-480; МЕТII-35-260; МЕТII-35-480; МЕТII-35-480-A; МЕТII-35-600E

Проводники эндоскопические с принадлежностями:

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег. уд.: _____



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09




METII-35-480

Применение: интравенное введение лекарственных средств

Производитель: Wilson Cook Medical Inc., COOK MEDICAL
Срок годности: 07.09.21 Погашен: 04.01.2024

Рег. у.в. РЗН 2015/2546 от 11.09.2015 г.

Идентиф. ЗАО "ЦРМИ" (ИД) 056-13-08



METII-35-480
TRACER METRO DIRECT WIRE GUIDE

G25686



DISPOSABLE - SINGLE USE ONLY

LOT	W4110000	2021-01-01	2018-08-07
STERILE	NO	RxOn	

COOK METII-35-480 G25686



COOK METII-35-480 G25686



COOK METII-35-480 G25686



COOK
MEDICAL

Wilson-Cook Medical Inc.
4800 Eastman Street, Suite 200
Bloomington, IL 61814
USA
www.cookmedical.com

CE 0088
MADE IN USA
174201508

ники эндоскопические с принадлежностями:
принадлежности:
фиксатор проводника FS-WL-O-S; FS-WL-P-S



Макет маркировки:

FS-WL-O-S; FS-WL-P-S

Фиксатор проводника к проводнику эндоскопическому

Проводники эндоскопические с принадлежностями:

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег. уд.: _____



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



FS-WL-O-S
FUSION WIRE GUIDE LOCKING DEVICE

G31522



Olympus®
Fujinon®

DISPOSABLE - SINGLE USE ONLY

LOT	W3901105	2020-08-01	2017-08-01
STERILE	EO	RxOnly	

COOK FS-WL-O-S G31522
W3901105
1010082700231522817200801101W3901105

COOK FS-WL-O-S G31522
W3901105
1010082700231522817200801101W3901105

COOK FS-WL-O-S G31522
W3901105
1010082700231522817200801101W3901105

COOK
MEDICAL

Wilson-Cook Medical, Inc.
4900 Bethesda Station Road
Winston-Salem, NC 27105
COOK, Ireland
Chesiron Road National Technology Park
Limerick, Ireland
www.cookmedical.com

CE 0088
MADE IN USA
19430/0906

FS-WL-O-S
Фиксатор проводника к проводнику эндоскопическому

Производитель: Wilson Cook Medical Inc., СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
Срок годности: 01.08.20 Партия: W3901105
Рег. уд. РЗН 2015/2946 от 11.08.2015 г.
Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09

IM22



Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью 38 листов

Генеральный директор

С.Н.Курин

