


Иглы эндоскопические
Варианты исполнения: VIN-23, VIN-25

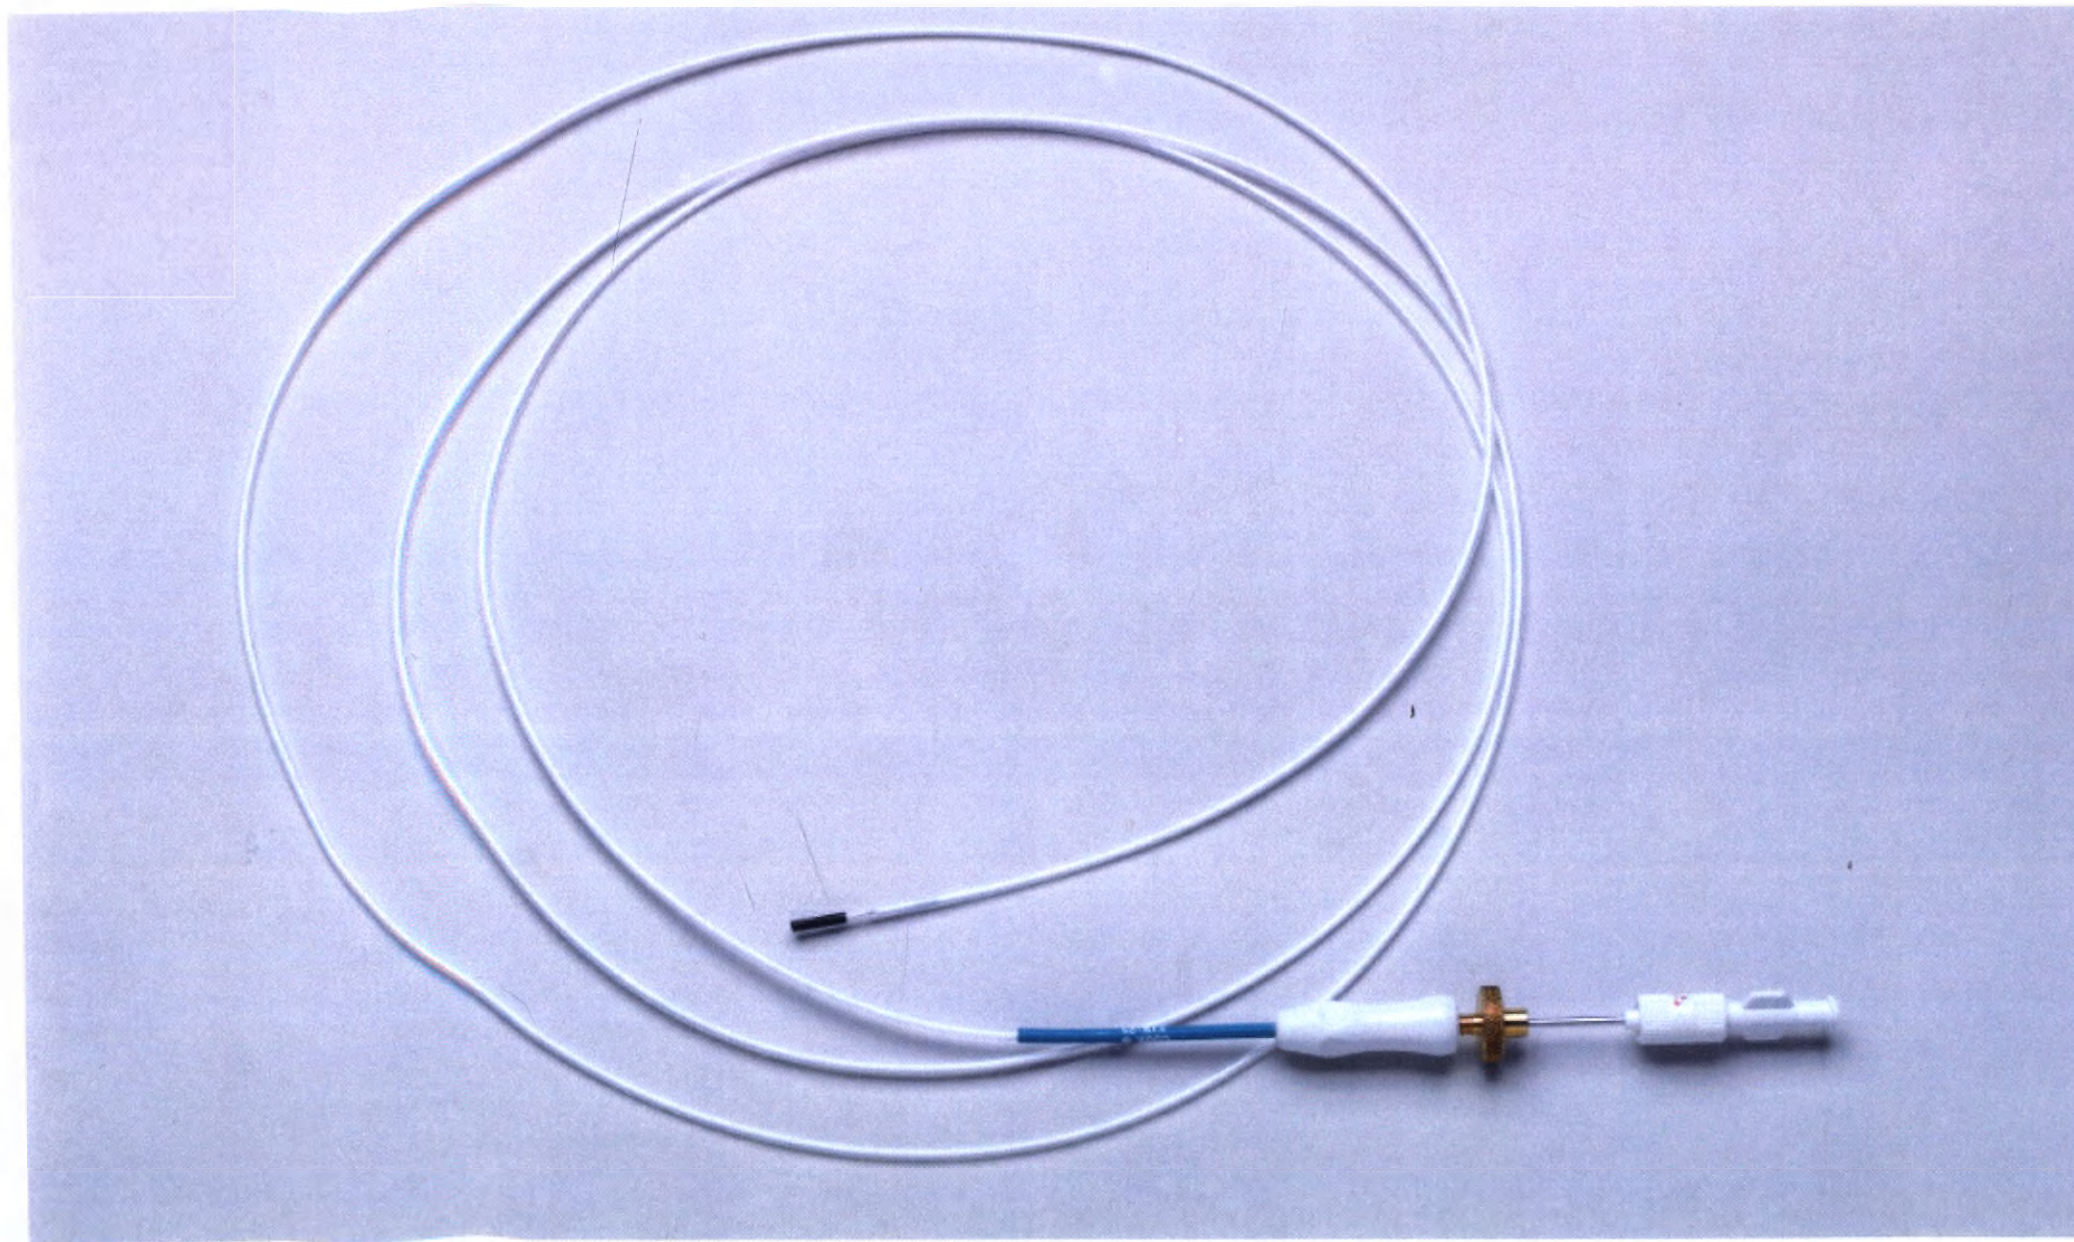

VIN-23
 Шприц инъекционный Асептик Variable Injection Needle

Производитель: Wilson Cook Medical Inc., СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
 Срок годности: 26.12.21 Партия: W4180419
 Рег. №: РДН 2017/8448 от 06.11.2017 г.
 Импортер: ЗАО "Цирми" (ИНН 50/056.13.08)

 ADRI



COOK MEDICAL

ВНИМАНИЕ! Проверьте целостность упаковки перед использованием.

Срок годности: 26.12.21

Партия: W4180419

Рег. №: РДН 2017/8448 от 06.11.2017 г.

Импортер: ЗАО "Цирми" (ИНН 50/056.13.08)

CE

VIN-23
 АСЕПТИК VARIABLE INJECTION NEEDLE

☒ G22525

 23 ga

 2.8 mm

 220 cm

 7 g

Инструкция по применению

1. Проверьте целостность упаковки перед использованием.

2. Извлеките иглу из упаковки, не касаясь кончика иглы.

3. Используйте иглу для инъекций.

4. После использования утилизируйте иглу.

5. Не пытайтесь повторно использовать иглу.

6. Не пытайтесь стерилизовать иглу.

7. Не пытайтесь модифицировать иглу.

8. Не пытайтесь использовать иглу для других целей.

9. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в глаза, уши, нос или рот.

10. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в позвоночник.

11. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в суставы.

12. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в мышцы.

13. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в кожу.

14. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в подкожную клетчатку.

15. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в вену.

16. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в артерию.

17. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в нерв.

18. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в спинной мозг.

19. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в головной мозг.

20. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в сердце.

21. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в легкие.

22. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в печень.

23. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в почки.

24. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в поджелудочную железу.

25. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в селезенку.

26. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в поджелудочную железу.

27. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в желчный пузырь.

28. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в мочевой пузырь.

29. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в матку.

30. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в яичники.

31. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в простату.

32. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в предстательную железу.

33. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в мочеточник.

34. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в мочевой пузырь.

35. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в кишечник.

36. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в желудок.

37. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в двенадцатиперстную кишку.

38. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в тонкий кишечник.

39. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в толстый кишечник.

40. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в прямую кишку.

41. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в анус.

42. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в влагалище.

43. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в шейку матки.

44. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в маточную трубу.

45. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в яичник.

46. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в фаллопиеву трубу.

47. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в матку.

48. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в яичники.

49. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в простату.

50. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в предстательную железу.

51. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в мочеточник.

52. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в мочевой пузырь.

53. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в матку.

54. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в яичники.

55. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в фаллопиеву трубу.

56. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в матку.

57. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в яичники.

58. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в простату.

59. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в предстательную железу.

60. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в мочеточник.

61. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в мочевой пузырь.

62. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в матку.

63. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в яичники.

64. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в фаллопиеву трубу.

65. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в матку.

66. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в яичники.

67. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в простату.

68. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в предстательную железу.

69. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в мочеточник.

70. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в мочевой пузырь.

71. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в матку.

72. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в яичники.

73. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в фаллопиеву трубу.

74. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в матку.

75. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в яичники.

76. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в простату.

77. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в предстательную железу.

78. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в мочеточник.

79. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в мочевой пузырь.

80. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в матку.

81. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в яичники.

82. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в фаллопиеву трубу.

83. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в матку.

84. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в яичники.

85. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в простату.

86. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в предстательную железу.

87. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в мочеточник.

88. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в мочевой пузырь.

89. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в матку.

90. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в яичники.

91. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в фаллопиеву трубу.

92. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в матку.

93. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в яичники.

94. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в простату.

95. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в предстательную железу.

96. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в мочеточник.

97. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в мочевой пузырь.

98. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в матку.

99. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в яичники.

100. Не пытайтесь использовать иглу для инъекций в фаллопиеву трубу.

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Наименование

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____


Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Иглы эндоскопические
Варианты исполнения: LDVI, DVI

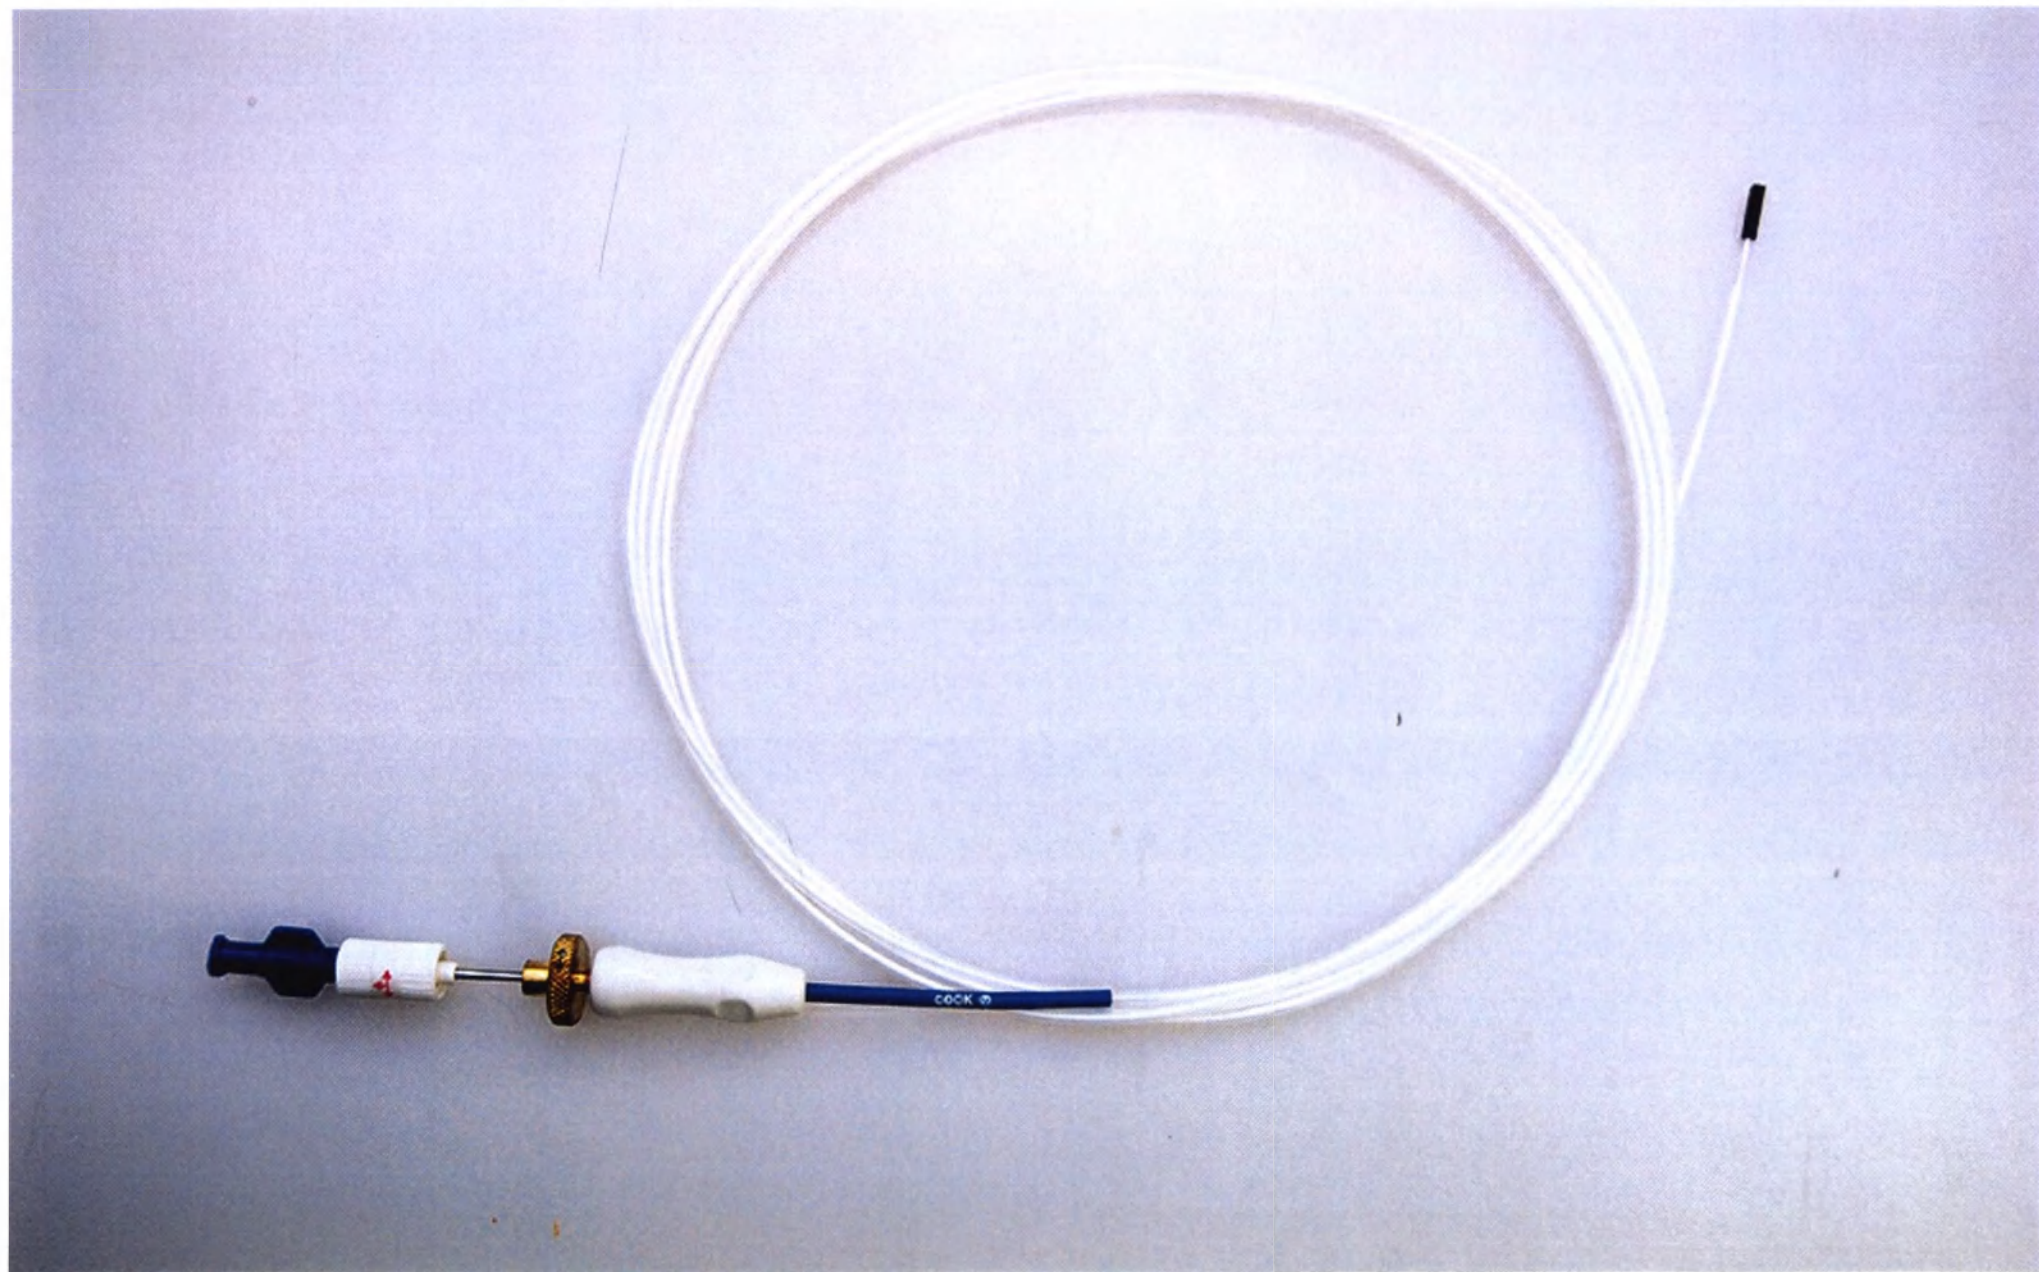

Производитель: Wilson Cook Medical Inc. Соединенные Штаты
Срок годности: 22.05.22 Партия: W4218231
Reg. у: РЗН 17/6448 от 09.11.2017 г.
Импортер: ЗАО "ША" тел: (495) 956-13-09

 G21866

DISPOSABLE - SINGLE USE ONLY

[illegible]

L07	VW4218231	2023-06-22	2018-06-23
STERILE	80	RxOnly	

COOK® LCV-23-340 021866




COOK LDI-23-240 021868



LDV-23-240 Q2186



© 1999 Aspen Medical, Inc.



Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Наименование

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____


Рег.уд.: _____



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Иглы эндоскопические
Варианты исполнения: МНІ

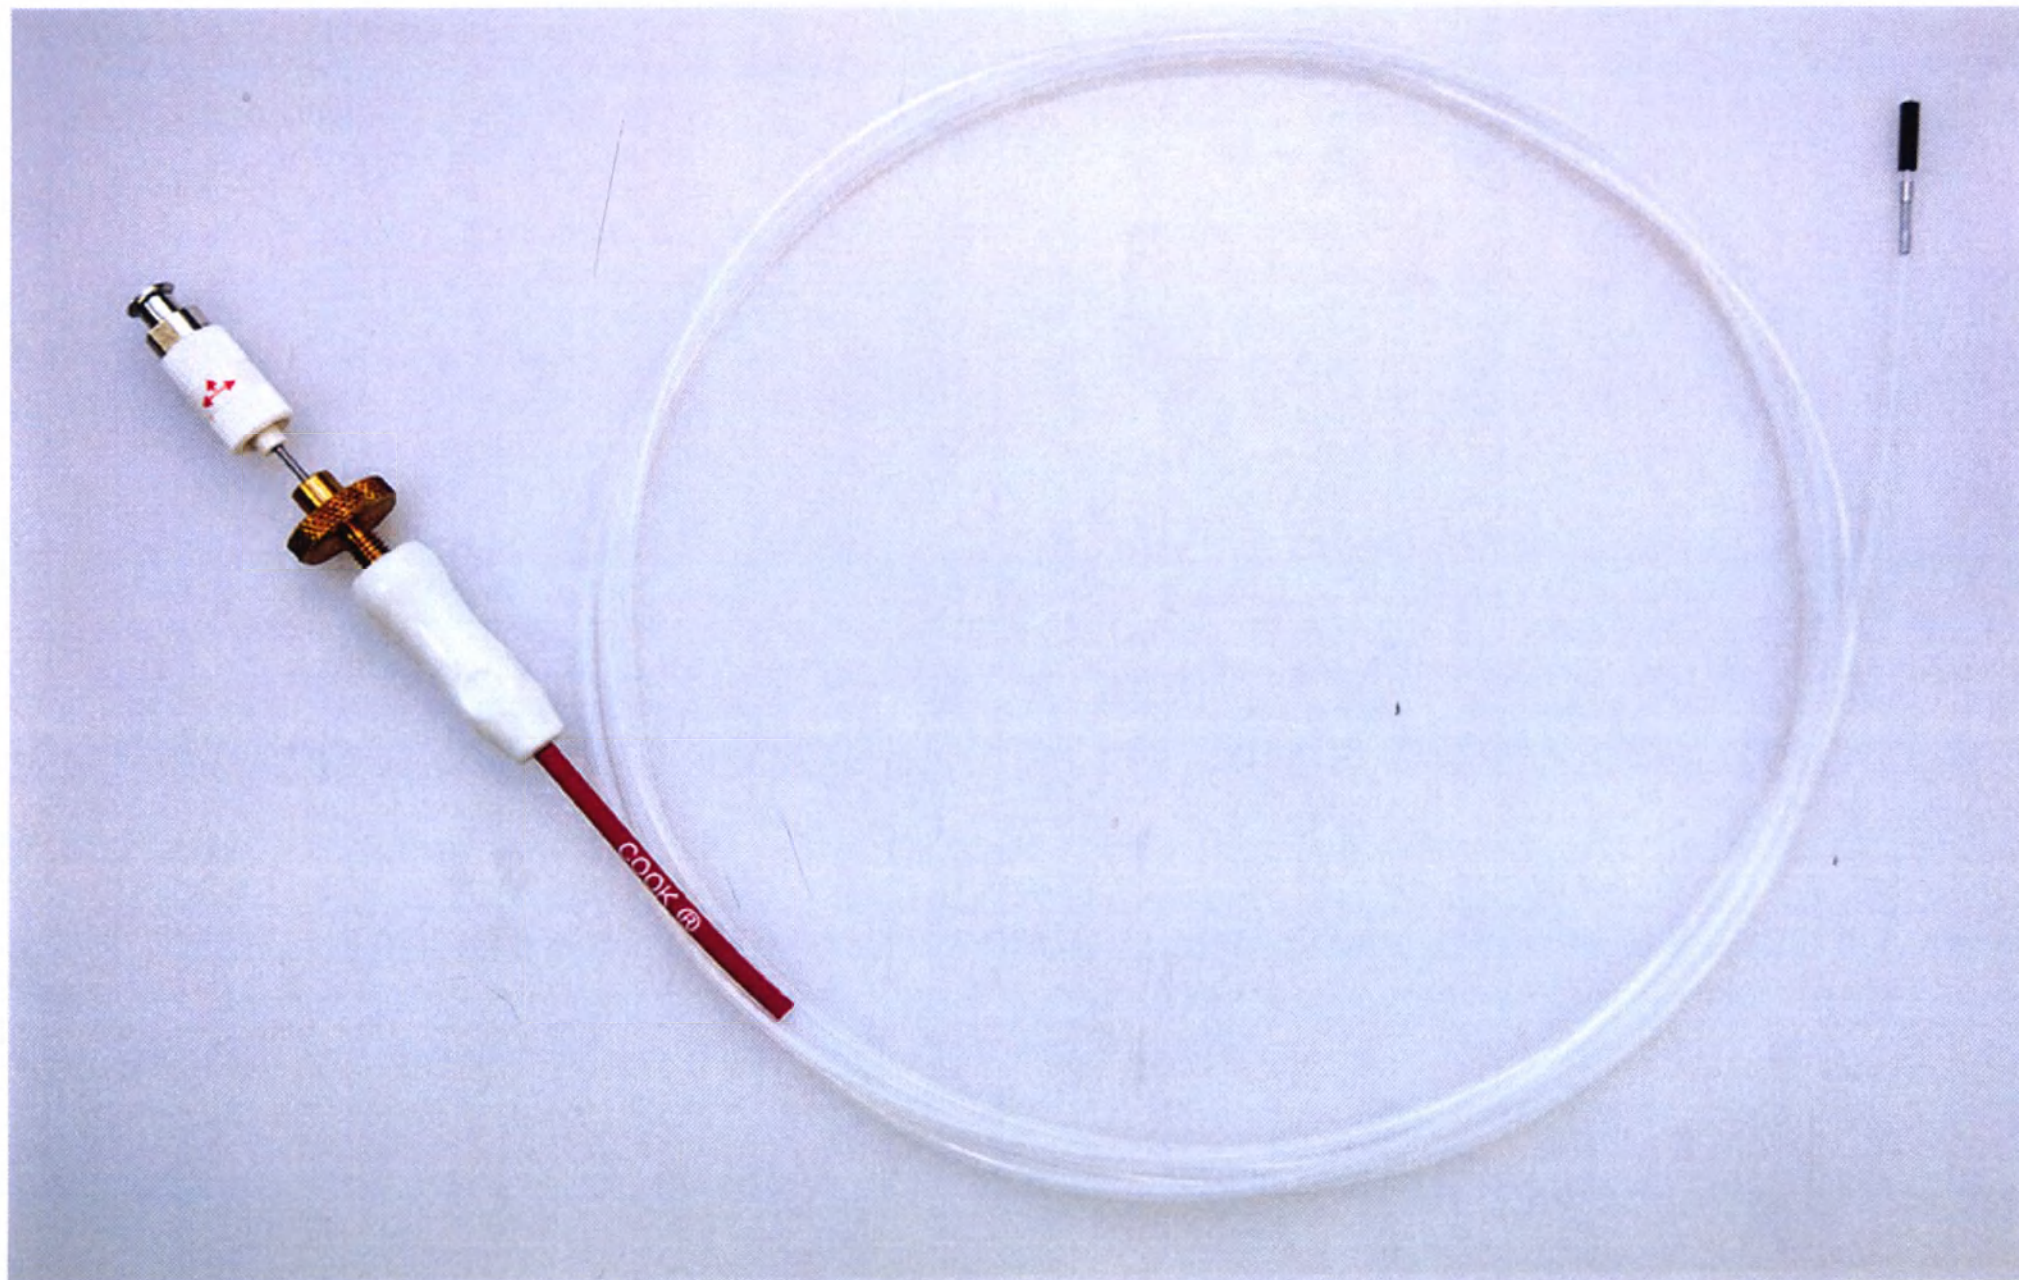



Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Наименование

Производитель: _____


Срок годности: _____ Партия: _____


Рег.уд.: _____



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



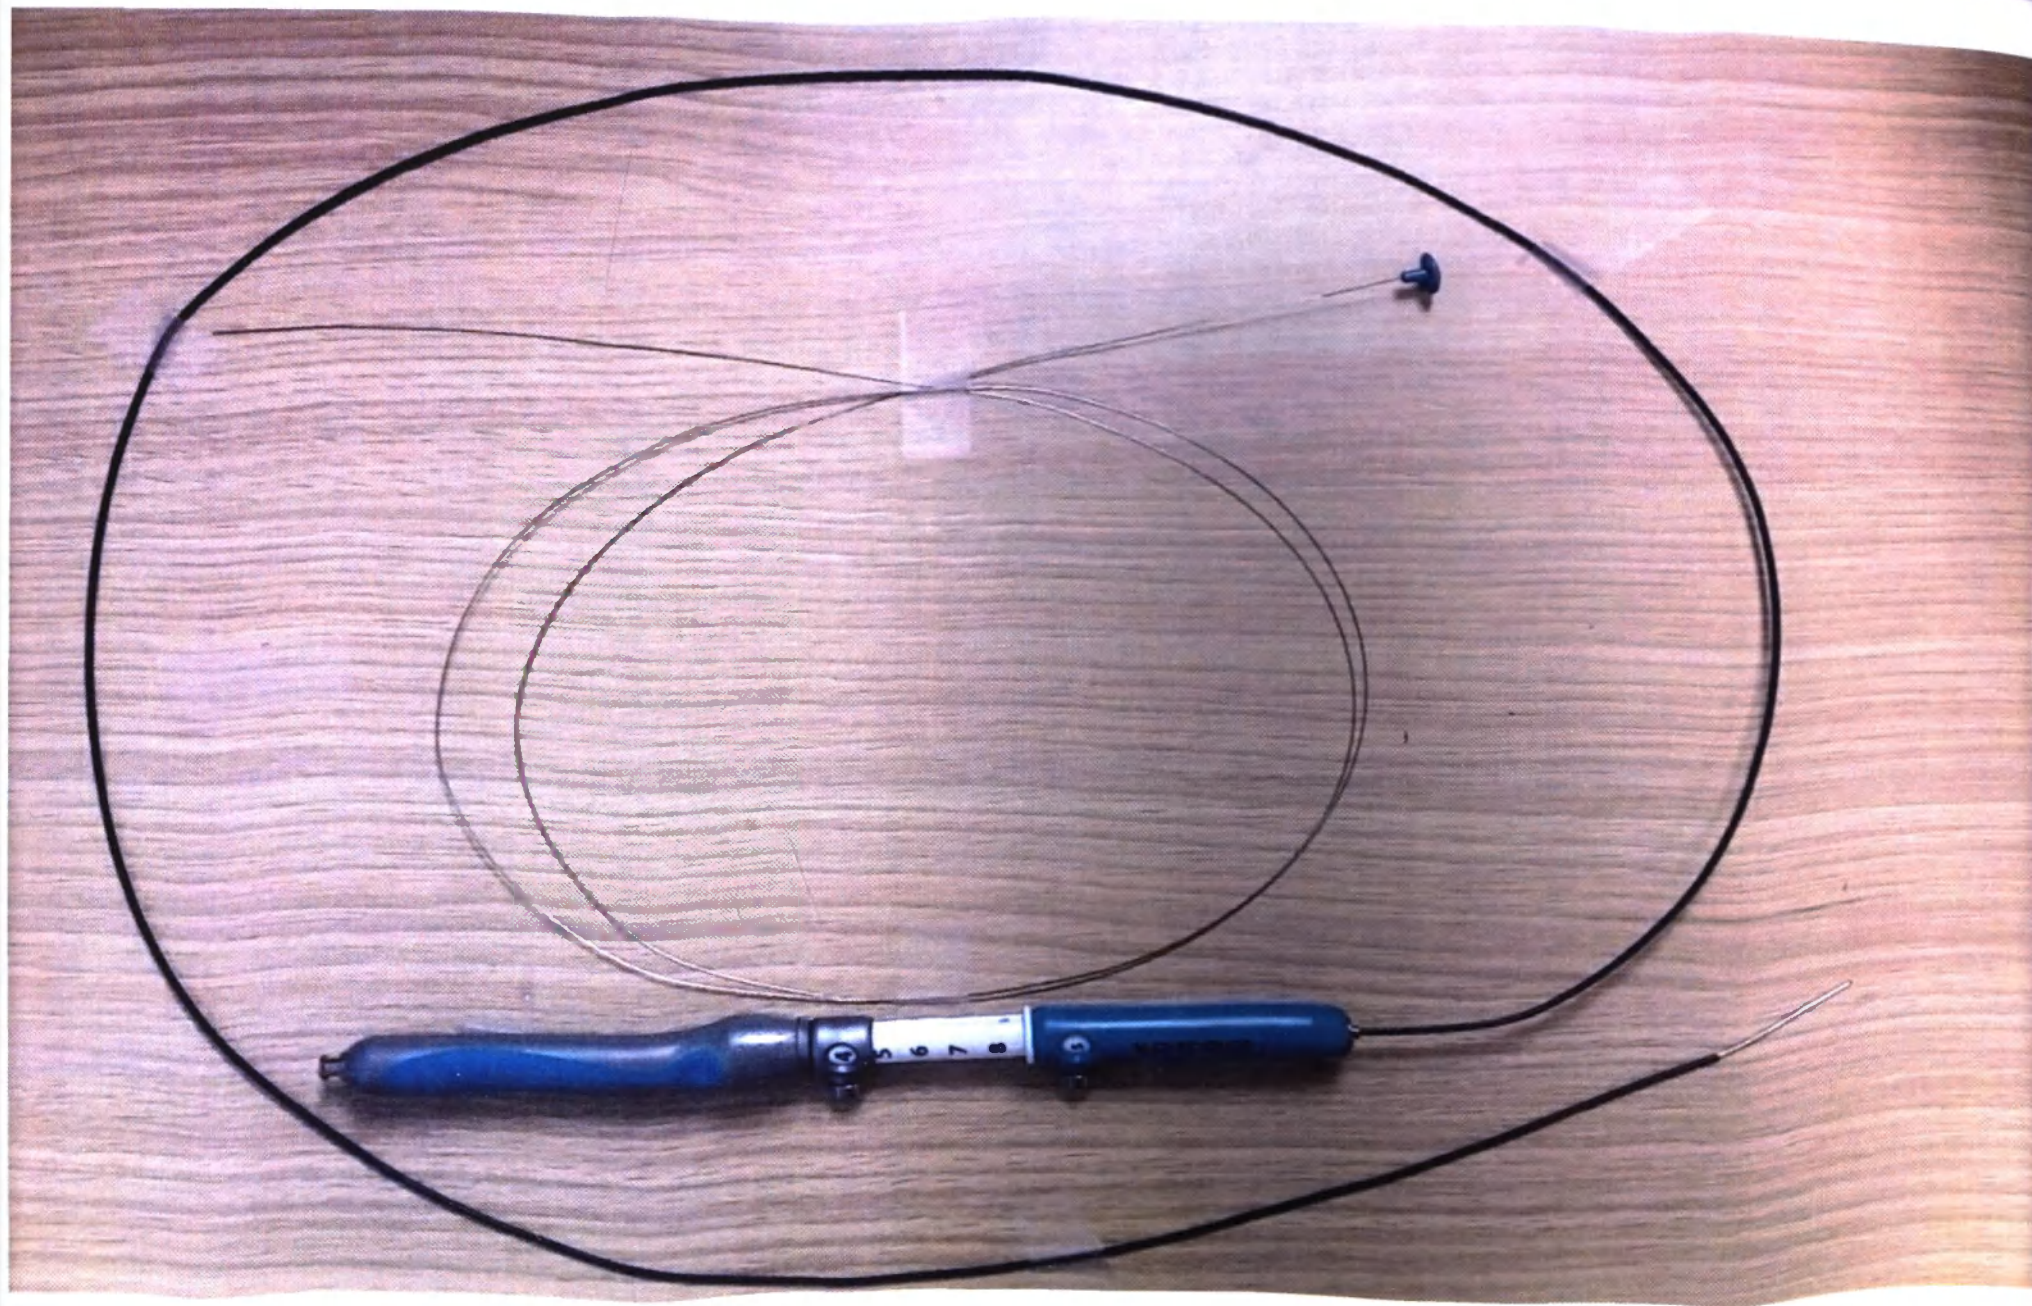


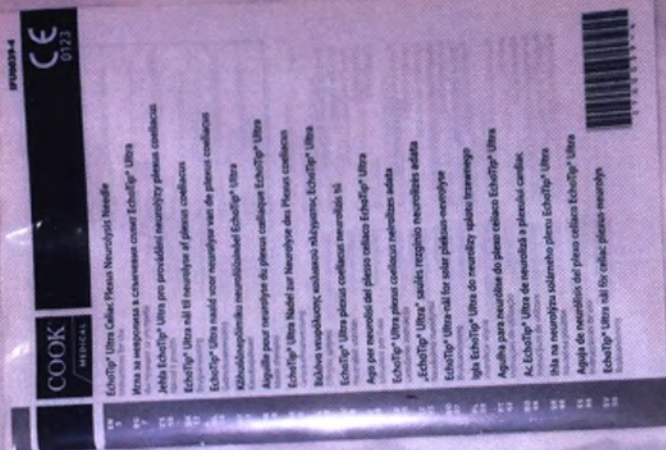

Echotip® Ultra Celiac Plexus Neurolysis Needle

REF **ECHO-20-CPN**

REF **G49257**

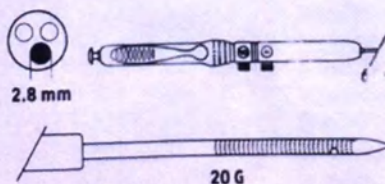

STERILE EO	2022 04 02	Rx ONLY
LOT C1601068	2019 04 02	

COOK MEDICAL

www.cookmedical.com

Manufactured by:
Cook Ireland Ltd,
O'Halloran Road, National Technology Park,
Limerick, Ireland.

CE 0123

ECHO-20-CPN
Игла эндориническая EchoTip Ultra Celiac Plexus Neurolysis Needle

Производитель: Cook Ireland Limited, ИРЛАНДИЯ
Срок годности: 02.04.22. Партия: C1601068
Пер. уа: РЗН 2017/8448 от 09.11.2017 г.
Импортер ЗАО "ШАГ" тел. (485) 956-13-09

PG A238

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Наименование

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____





Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



иглы эндоскопические

Варианты исполнения: ECHO-22-F

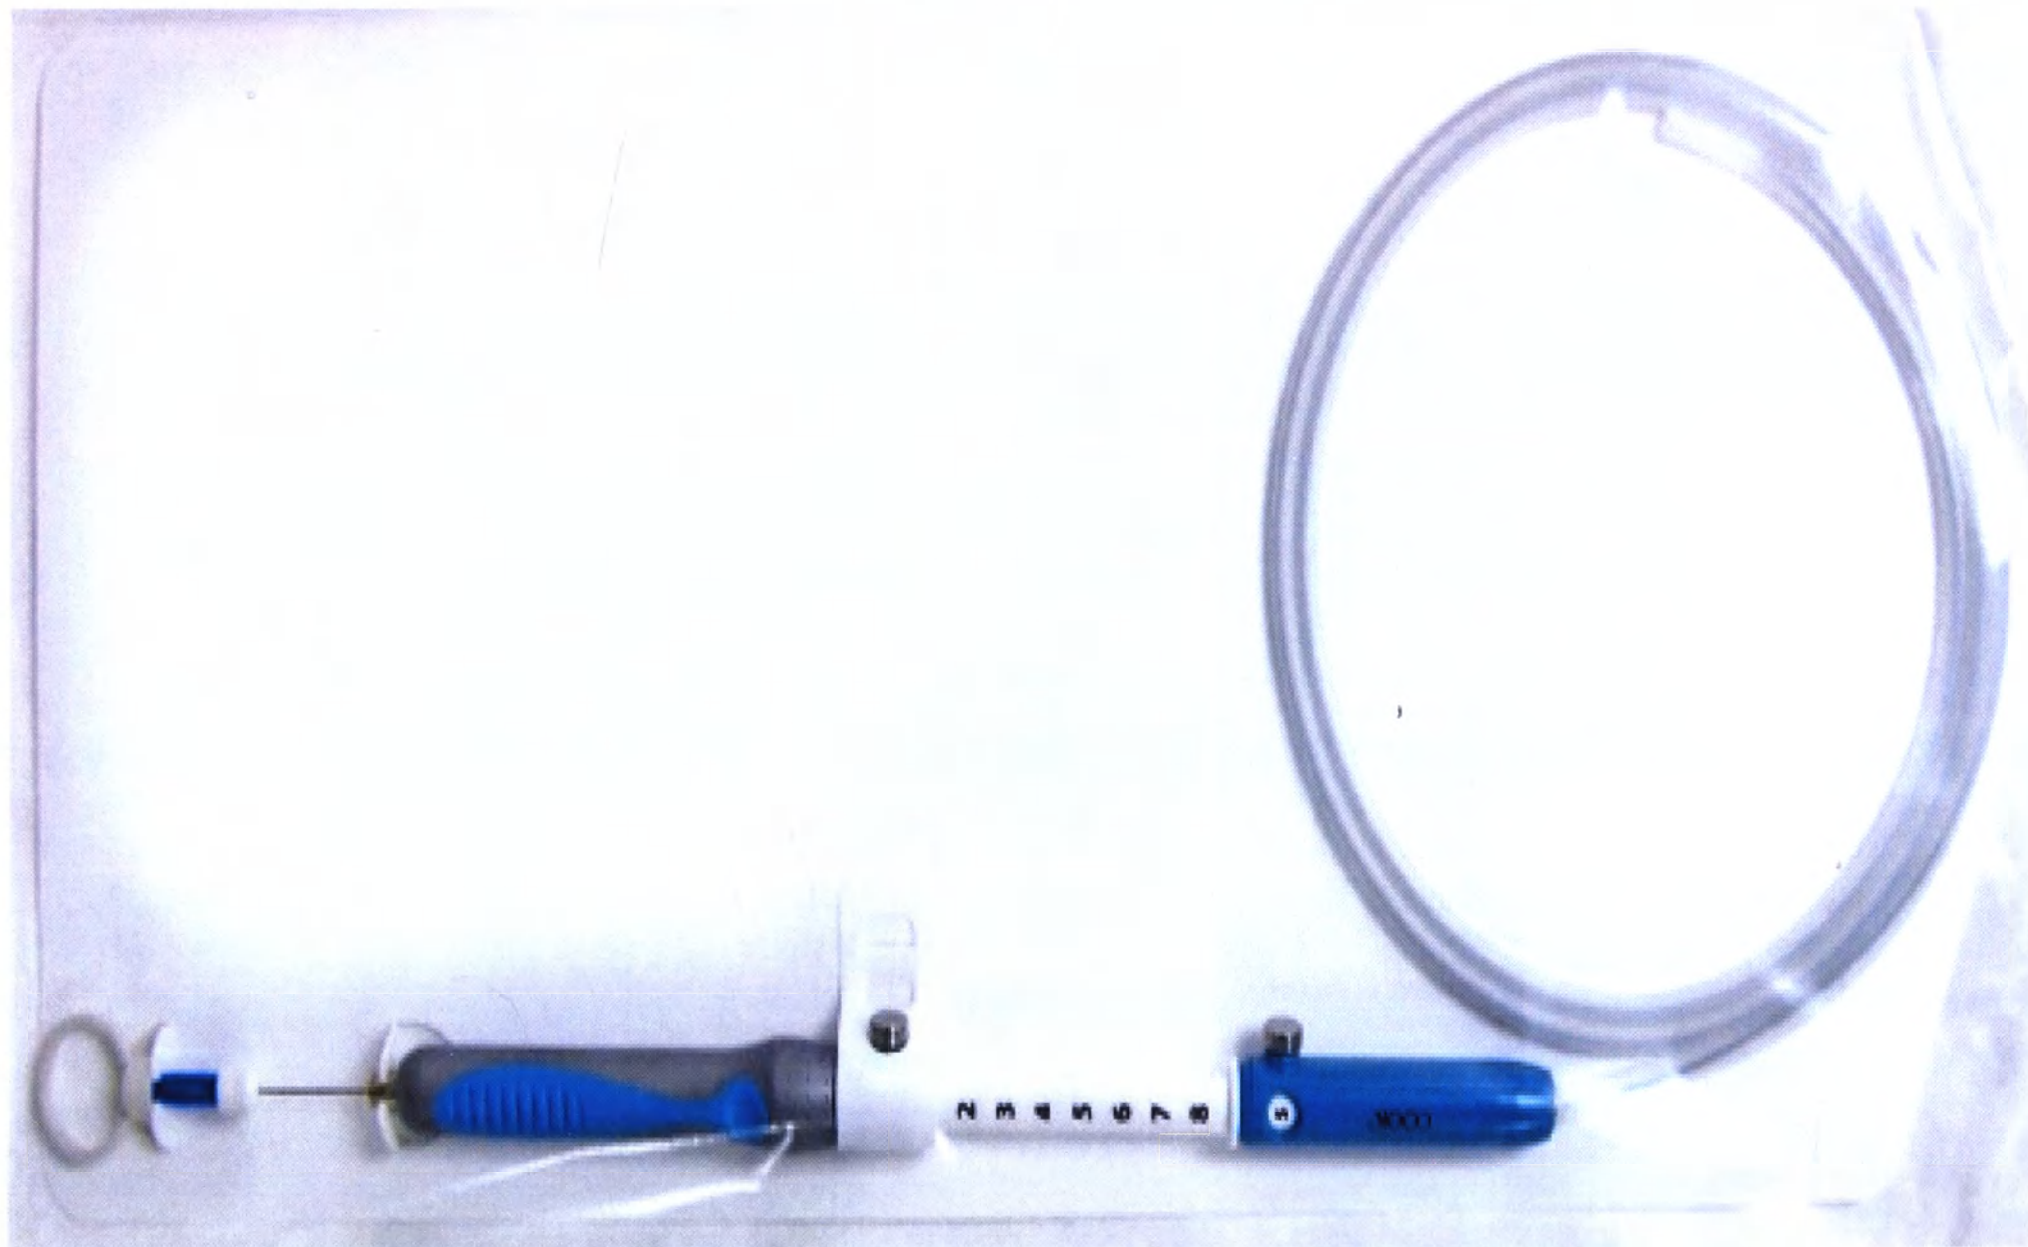

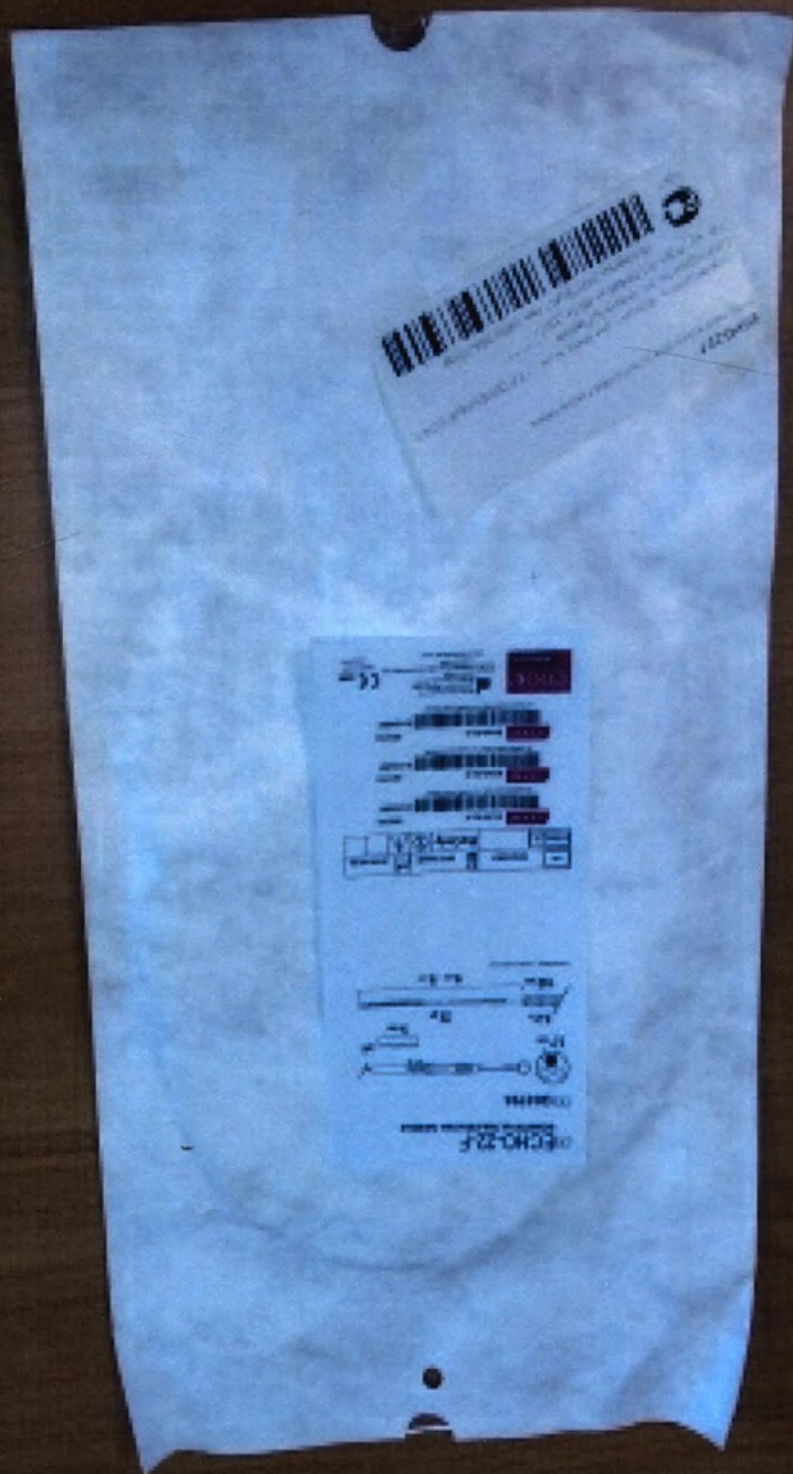

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Наименование

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортёр ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



ИГЛЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ

Варианты исполнения: 090001; 090001-S26, 090001-S34, 090001-S10, 090001-S9

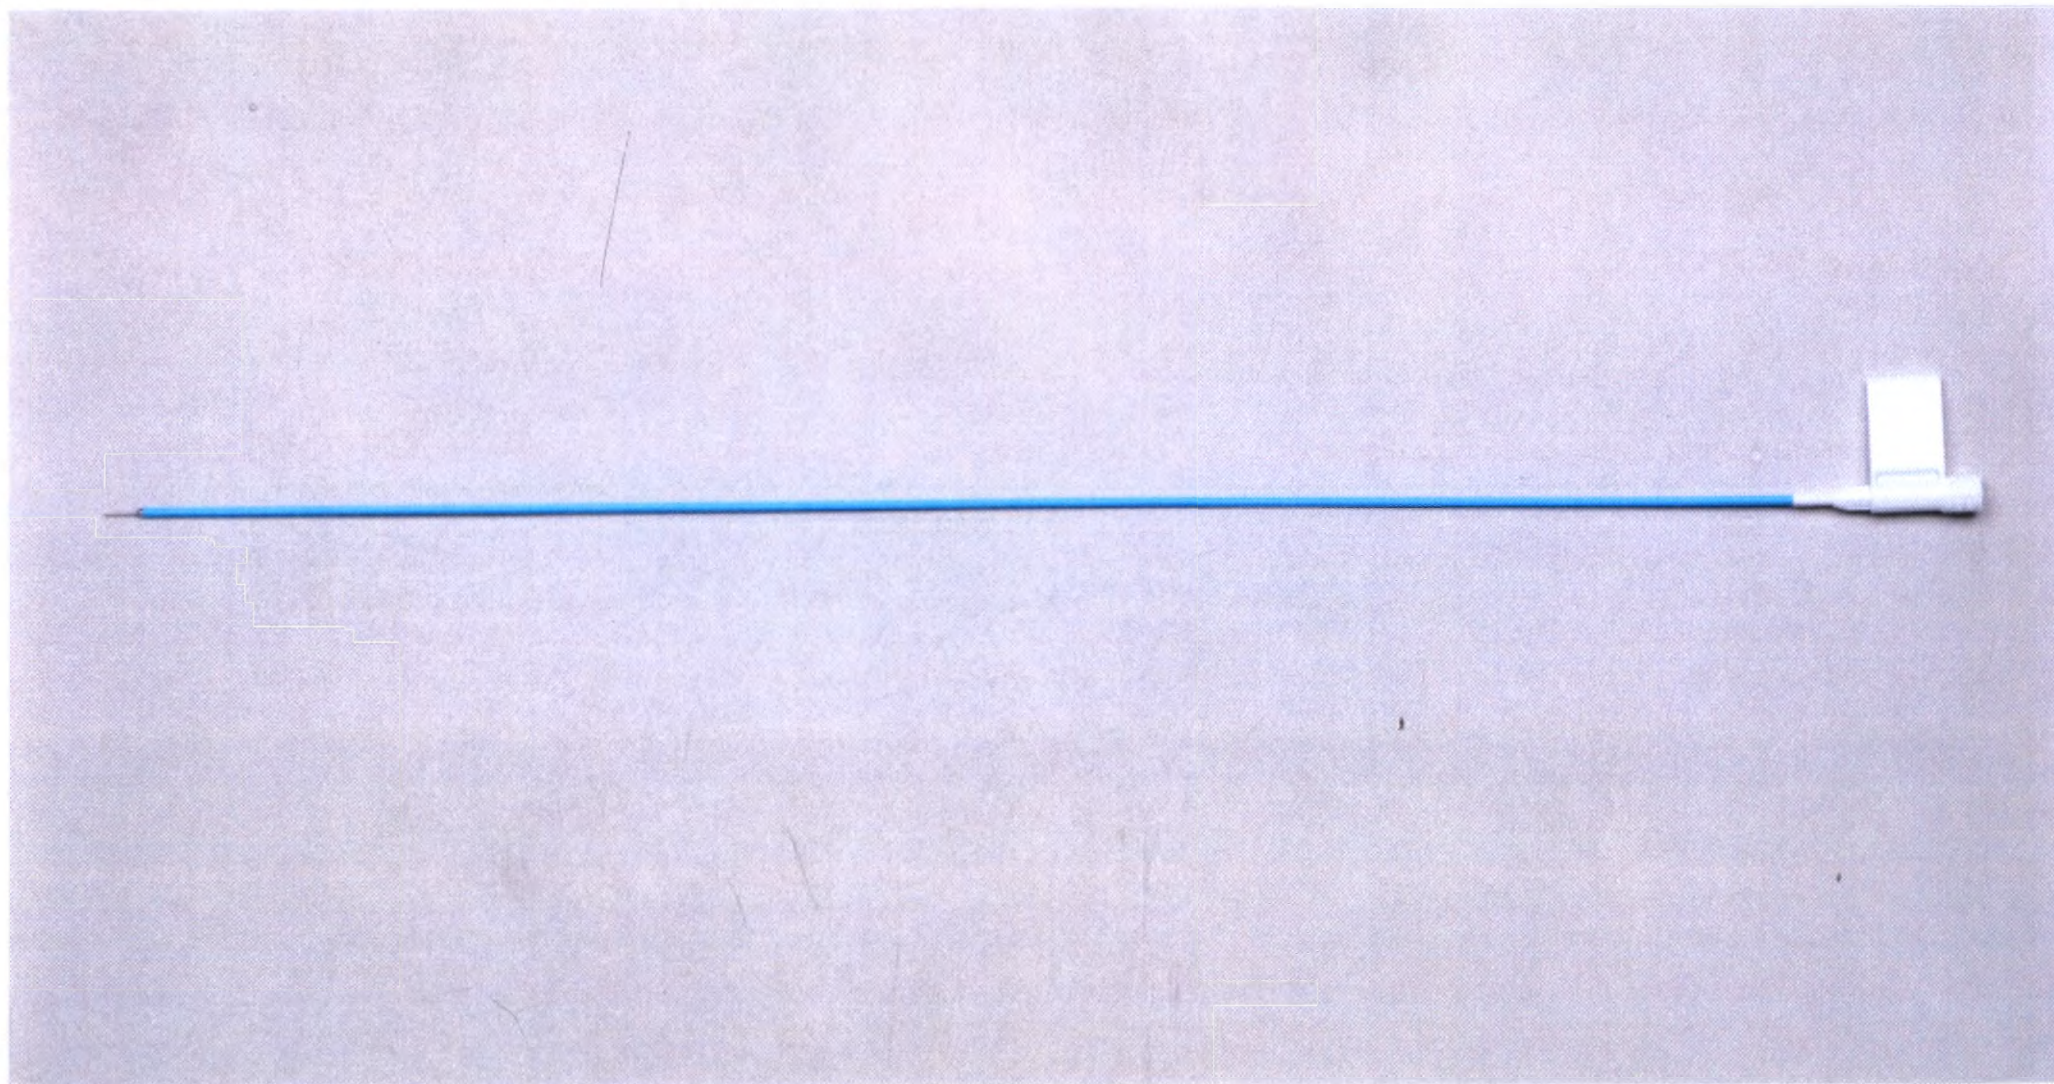



Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Наименование

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 18 листов
Генеральный директор



С.Н.Курин