



Фотографии медицинского изделия

**«Тест-полоски MEDITAPE UC для анализатора автоматического физико-химических свойств мочи для диагностики in vitro UC -3500, варианты исполнения MEDITAPE UC-9A, MEDITAPE UC-11A»
производства компании SYSMEX CORPORATION, Япония**

Тест-полоски MEDITAPE UC для анализатора автоматического физико-химических свойств мочи для диагностики in vitro UC -3500, вариант исполнения MEDITAPE UC-9A (флакон, лот AC 8021)

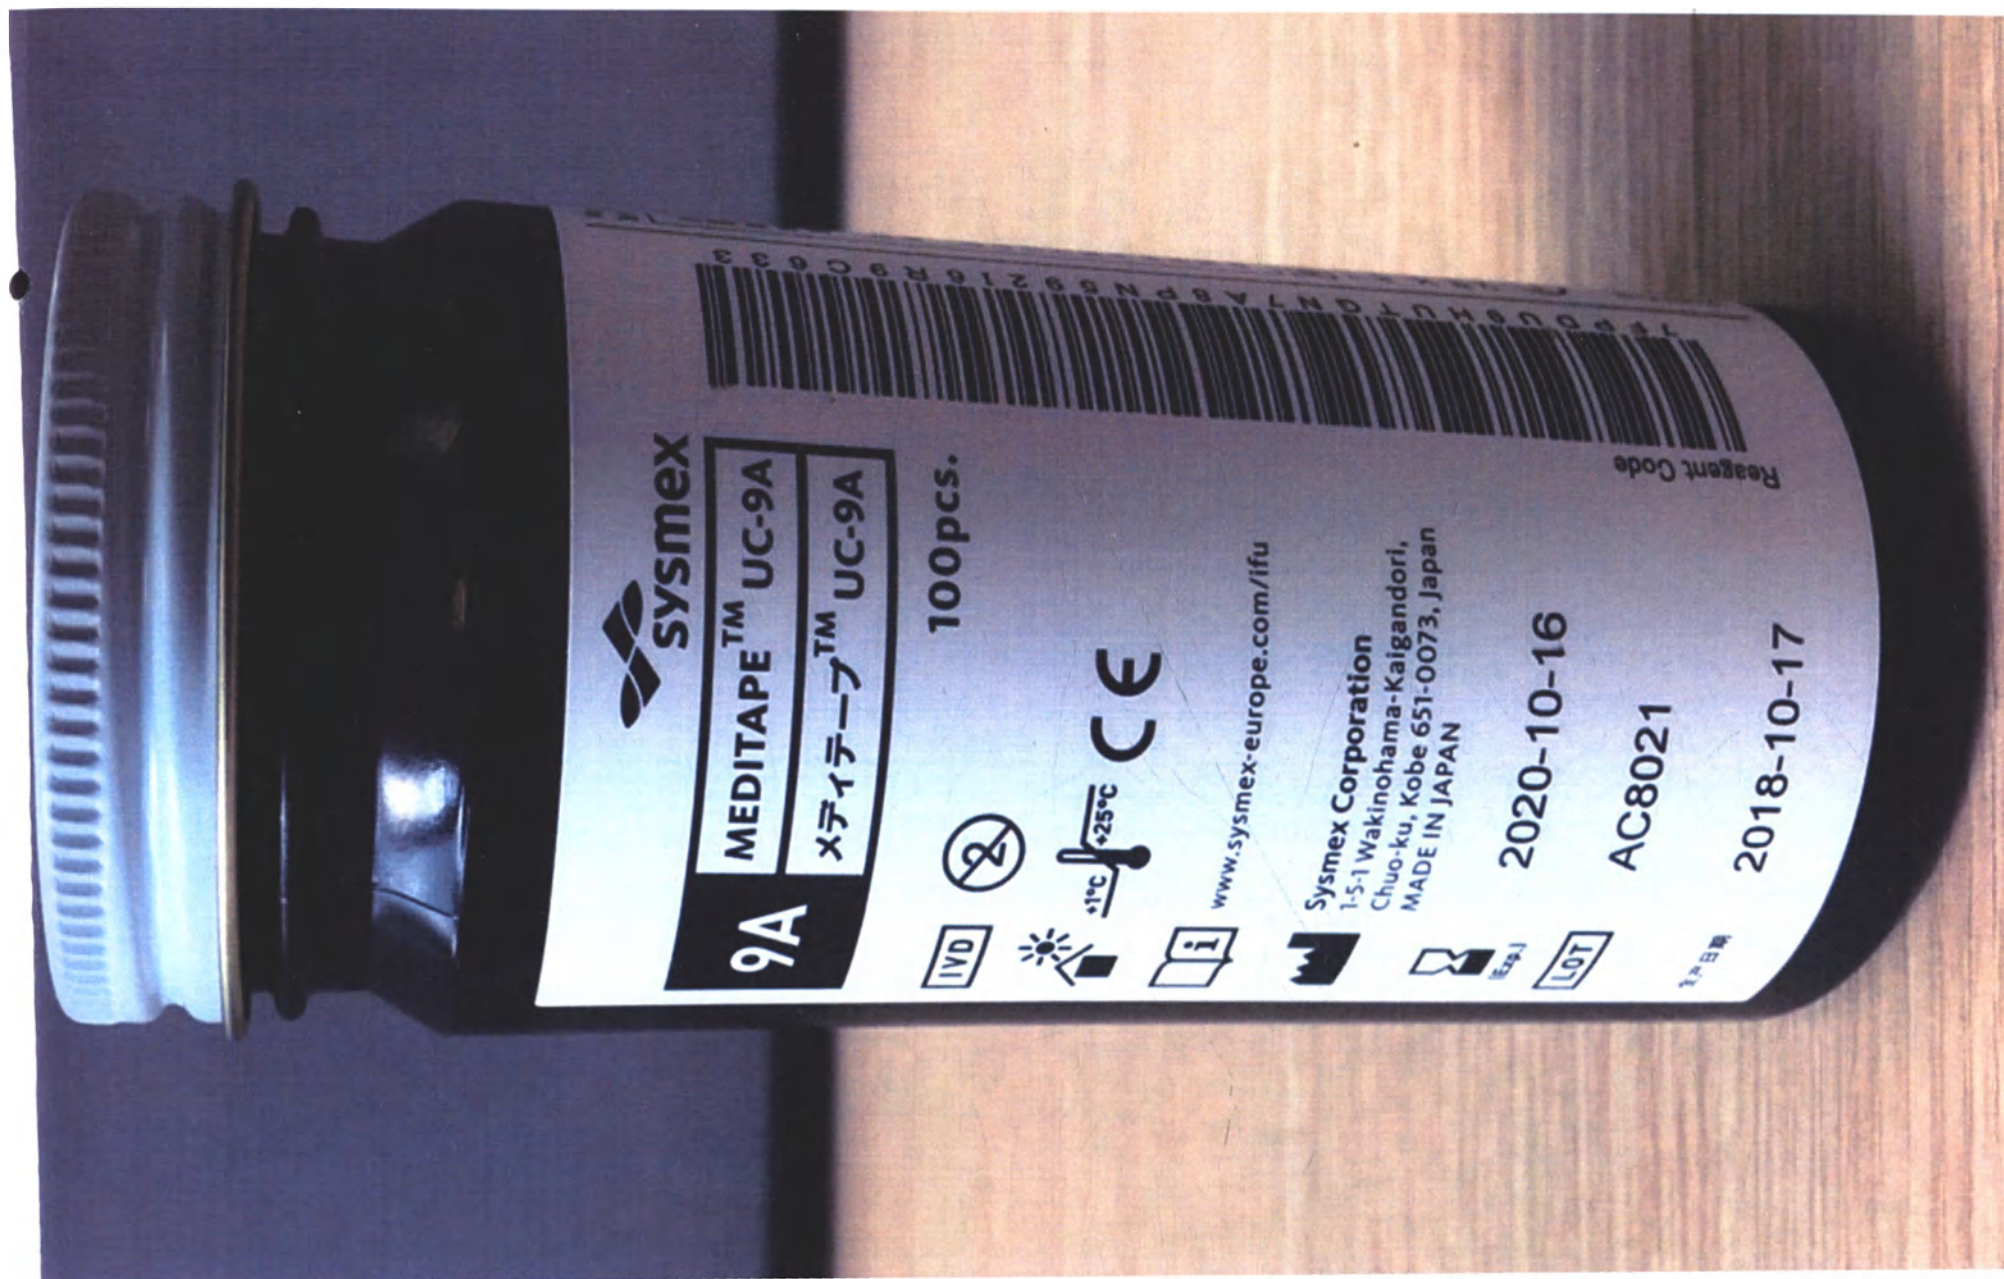


Тест-полоски MEDITAPE UC для анализатора автоматического физико-химических свойств мочи для диагностики in vitro UC -3500, вариант исполнения MEDITAPE UC-9A (флакон, лот AC 8024)

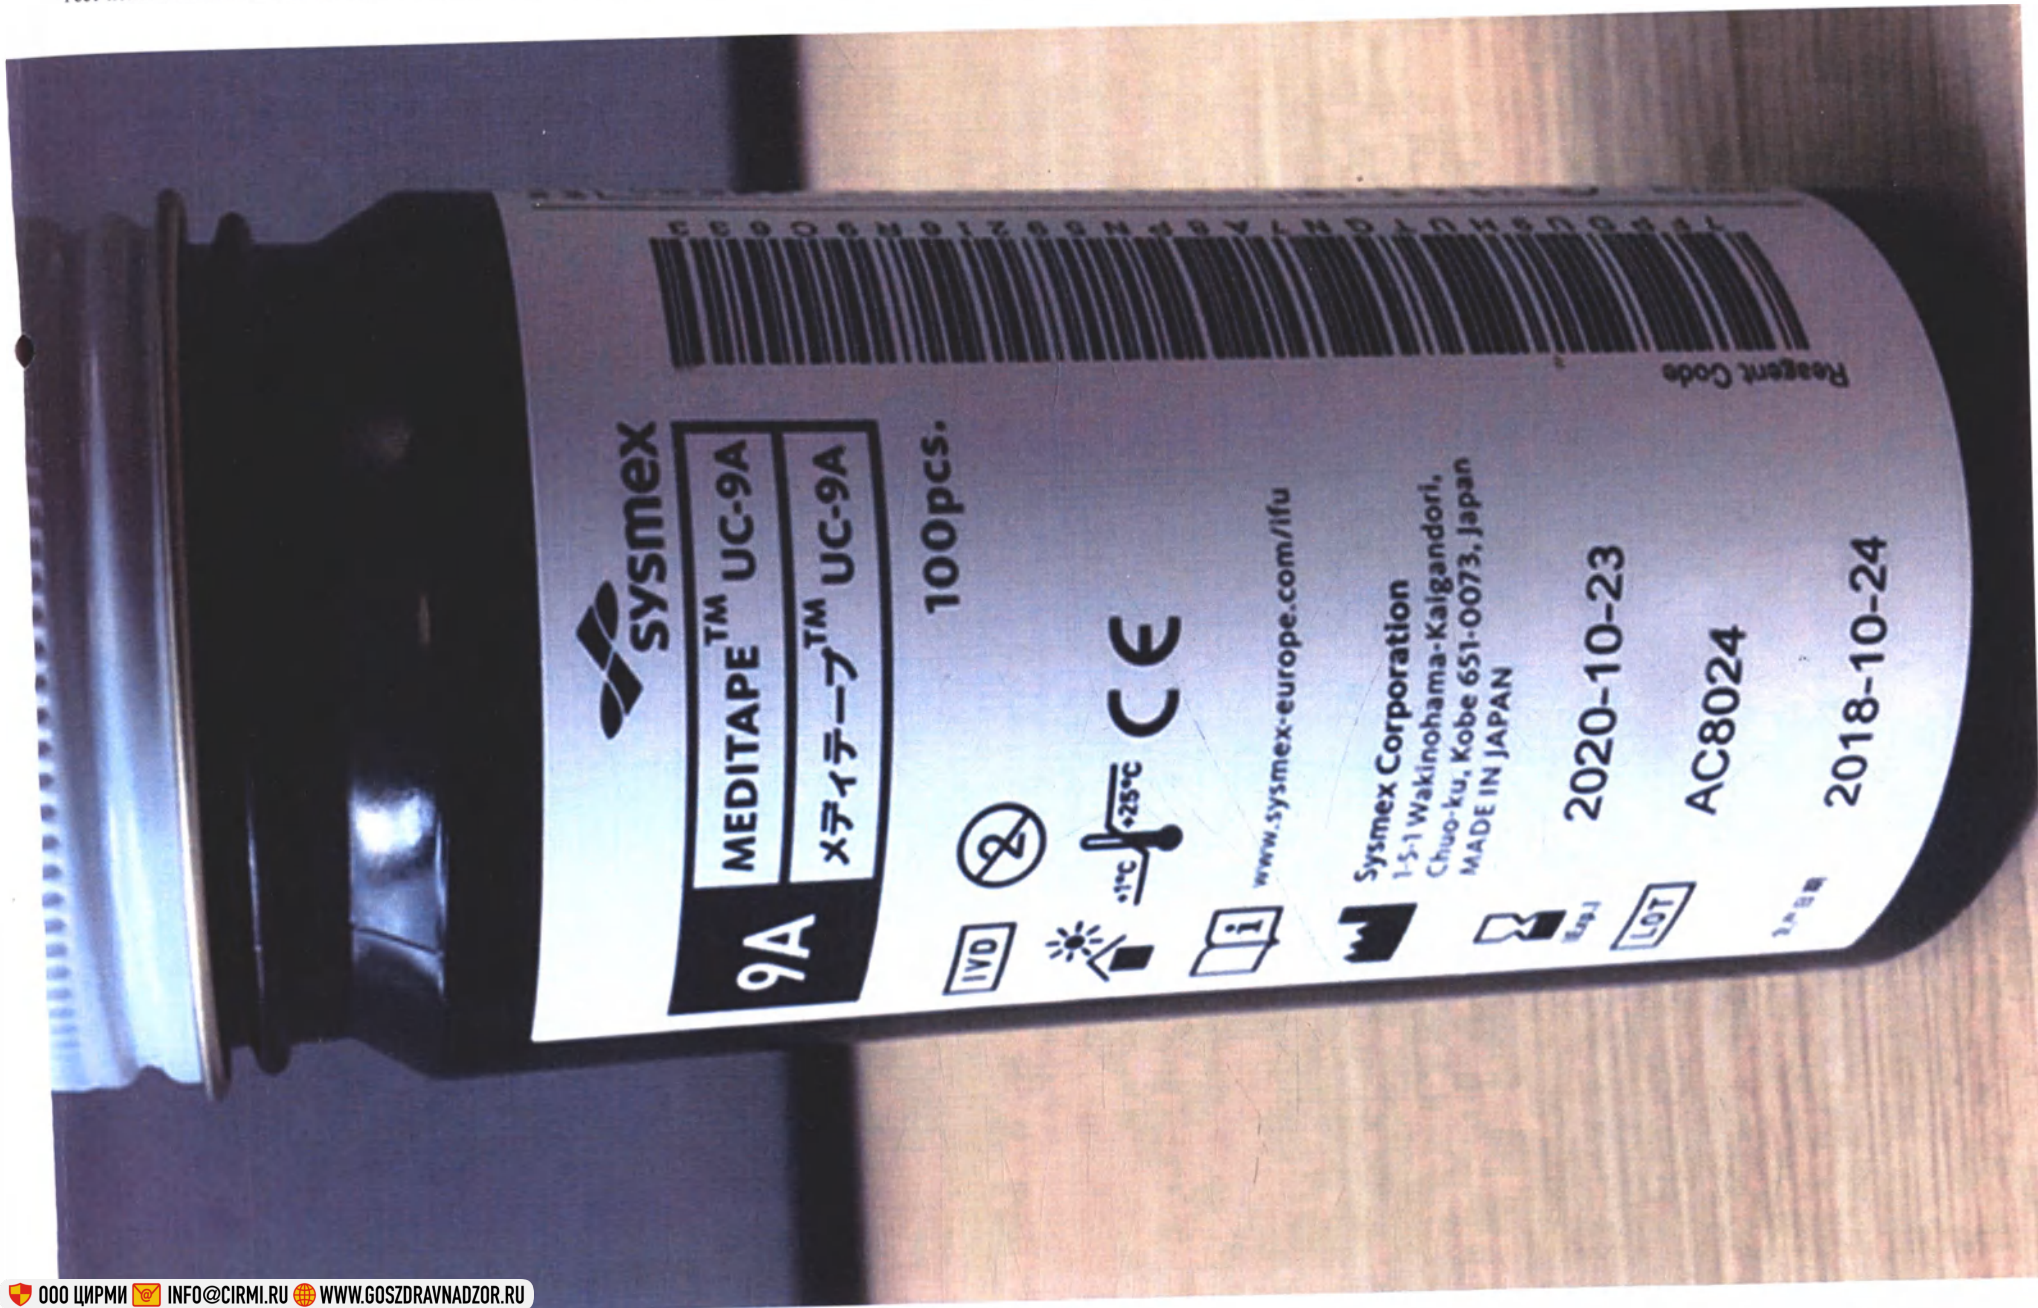


Тест-полоски MEDITAPE UC для анализатора автоматического физико-химических свойств мочи для диагностики in vitro UC -3500, вариант исполнения MEDITAPE UC-11A (флакон, лот AC 8012)




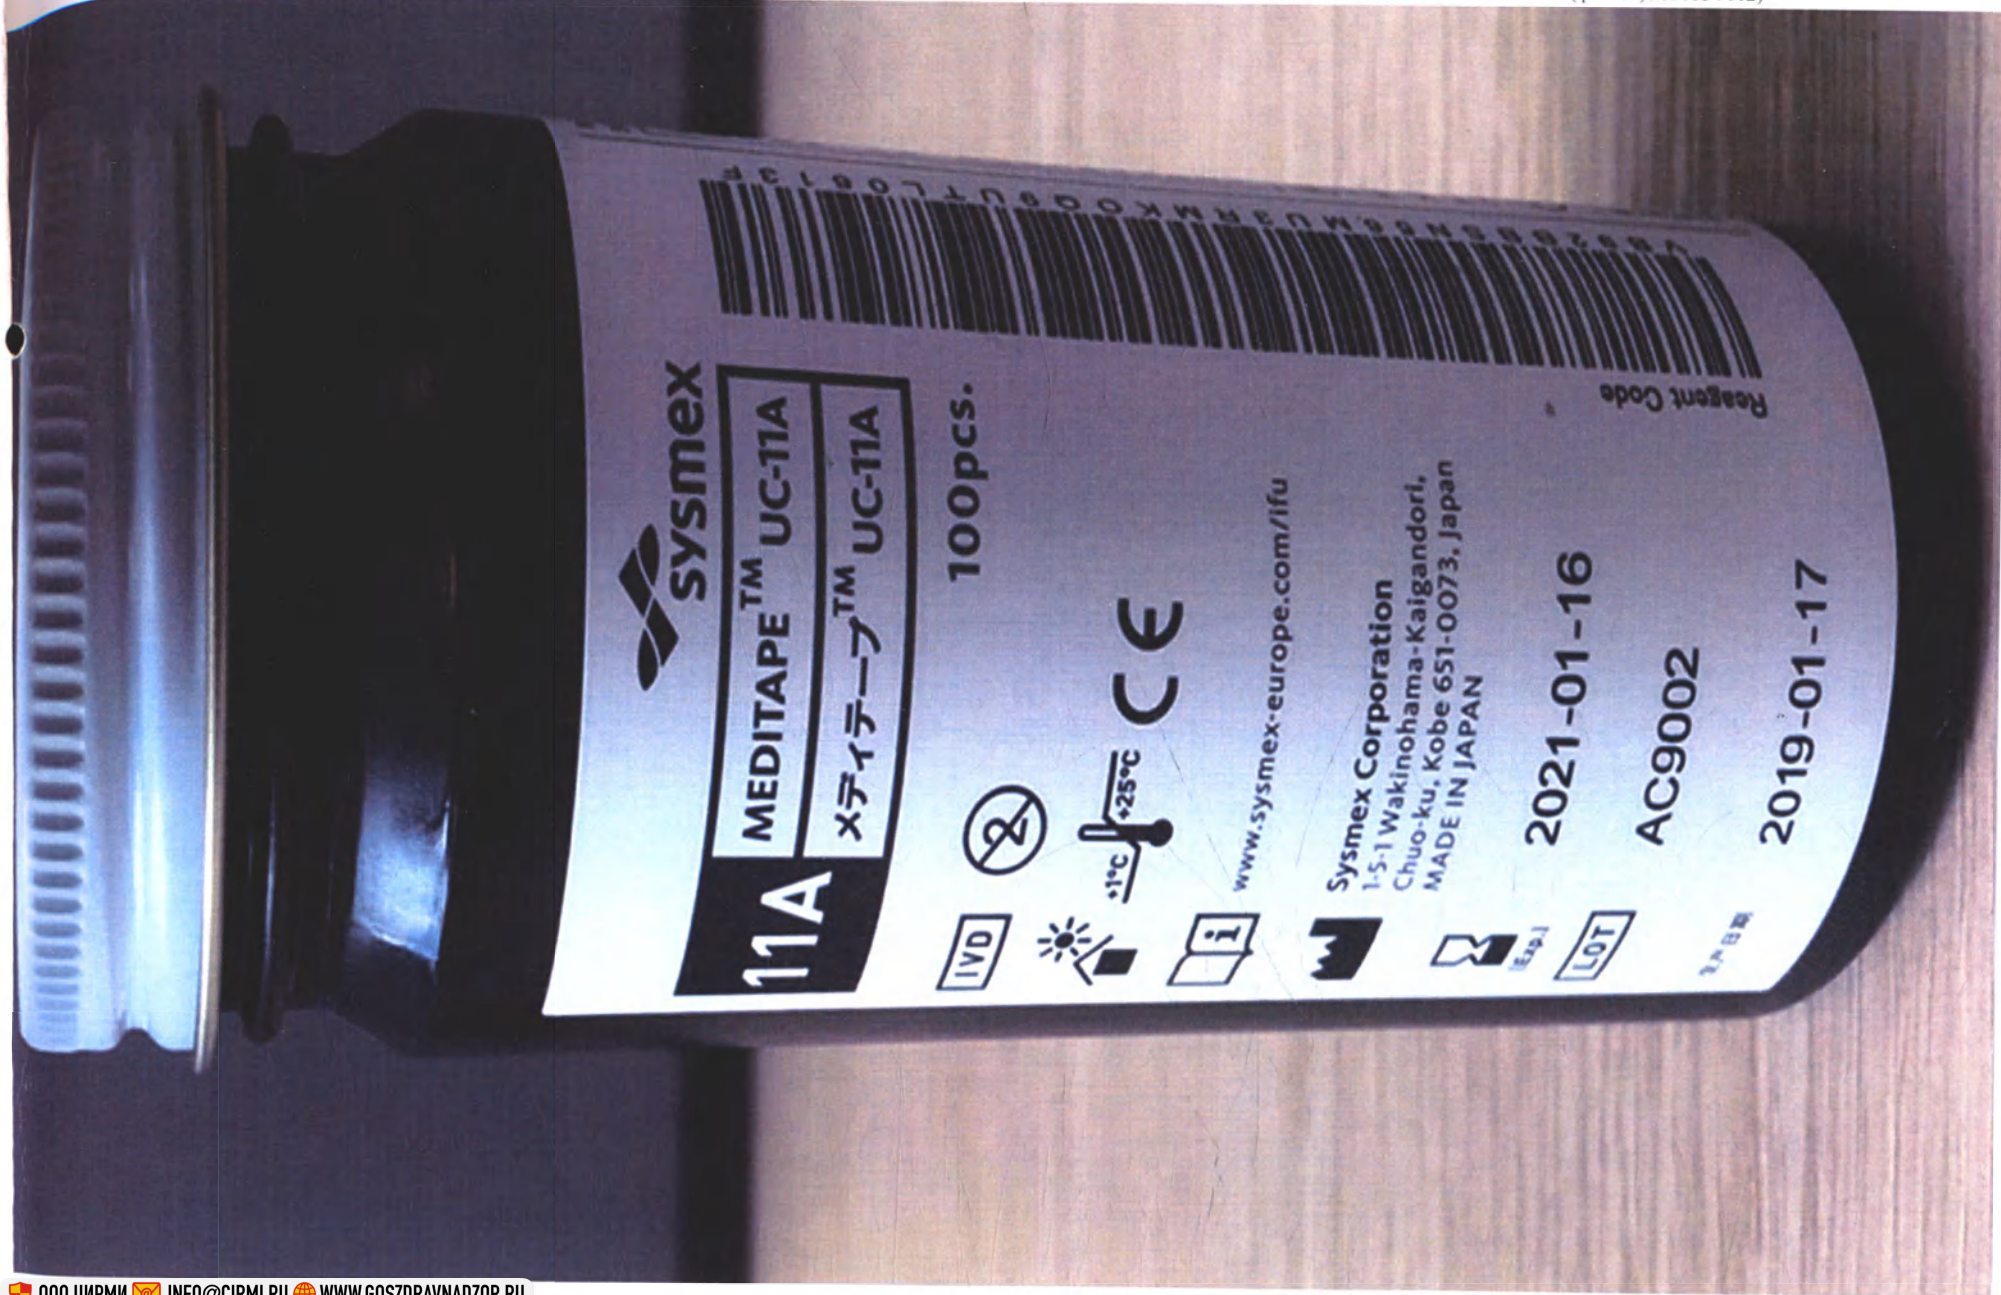


Тест-полоски MEDITAPE UC для анализатора автоматического физико-химических свойств мочи для диагностики in vitro UC -3500, вариант исполнения MEDITAPE UC-9A (упаковка, лот AC 9024)

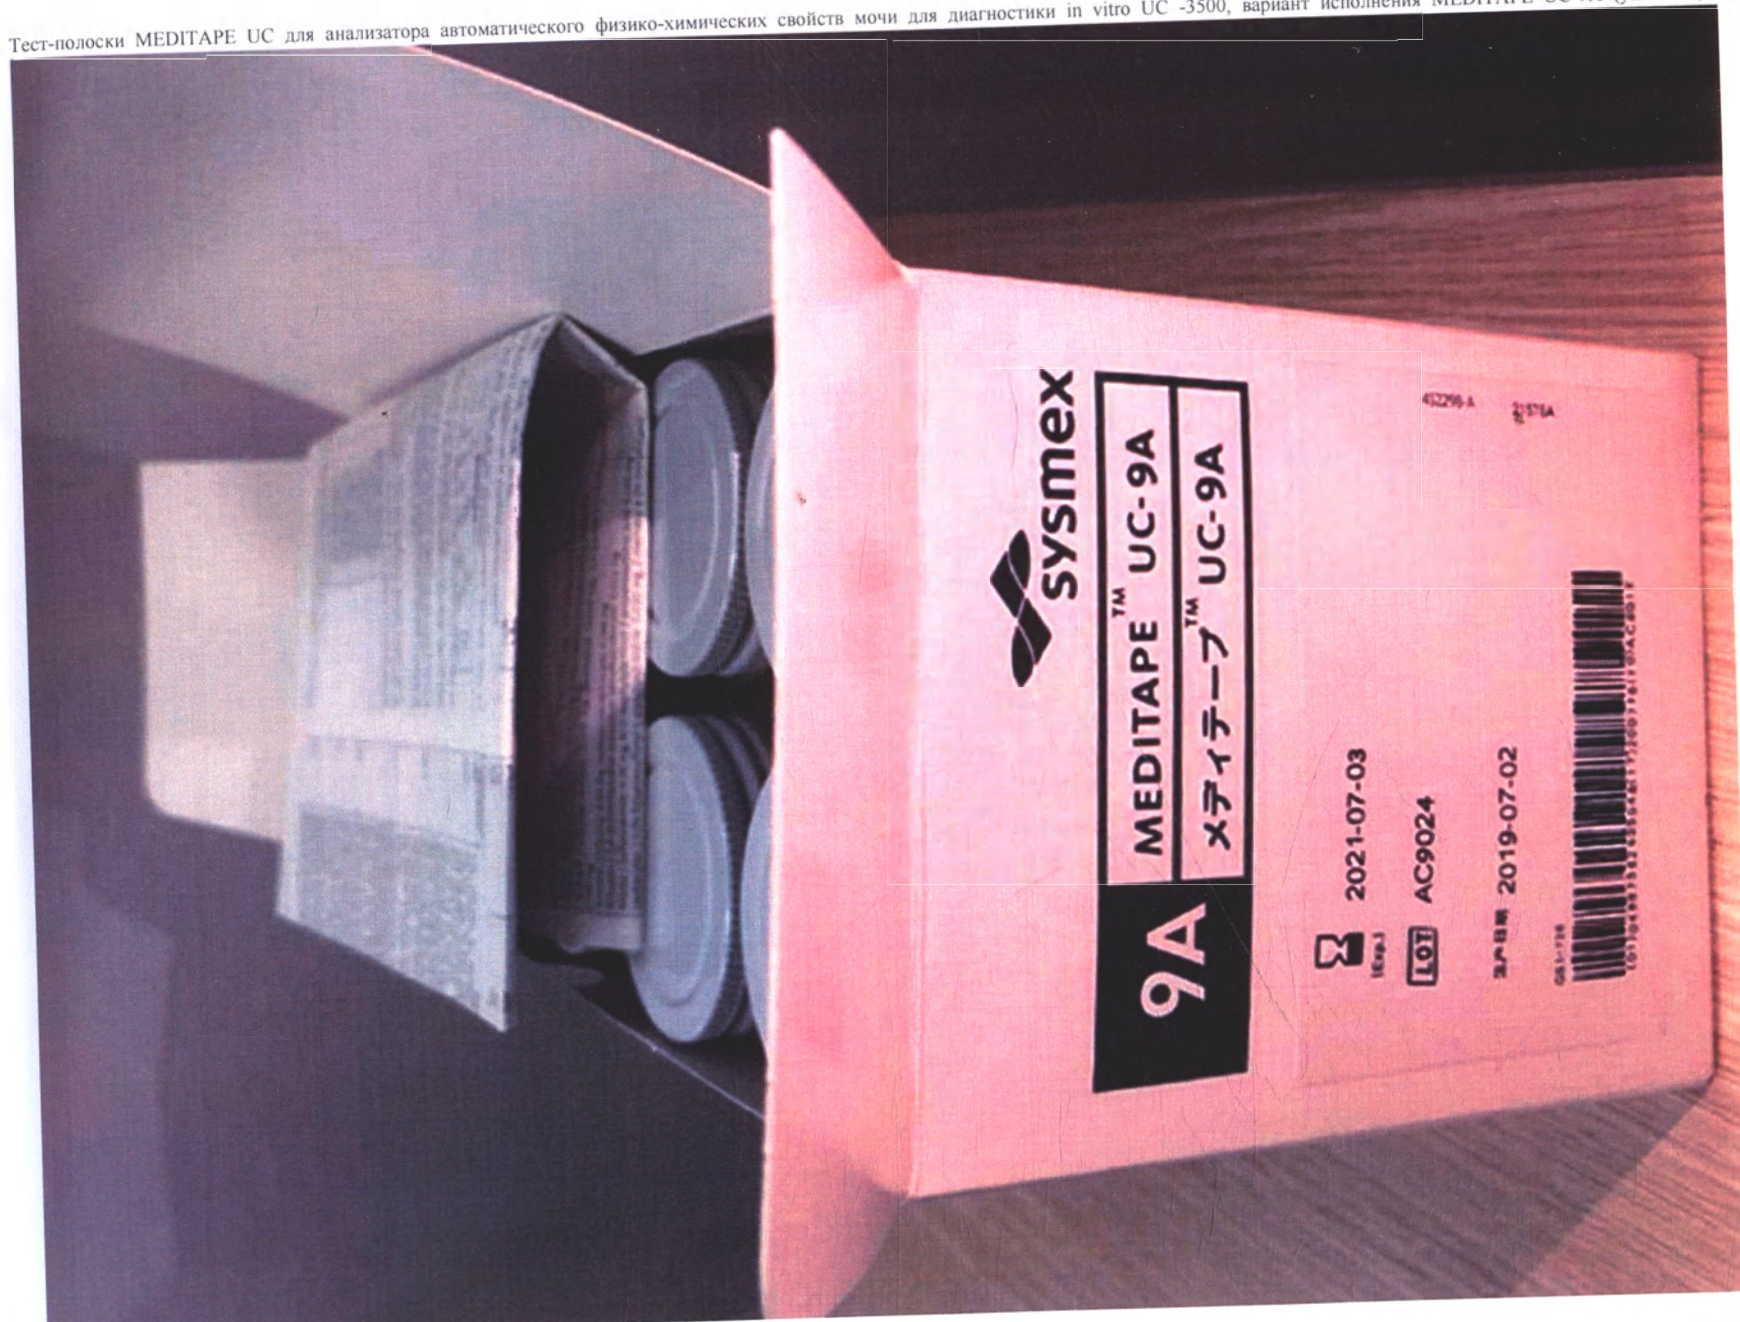

Тест-полоски MEDITAPE UC для анализатора автоматического физико-химических свойств мочи для диагностики in vitro UC -3500, вариант исполнения MEDITAPE UC-9A (упаковка, лот AC 9025)

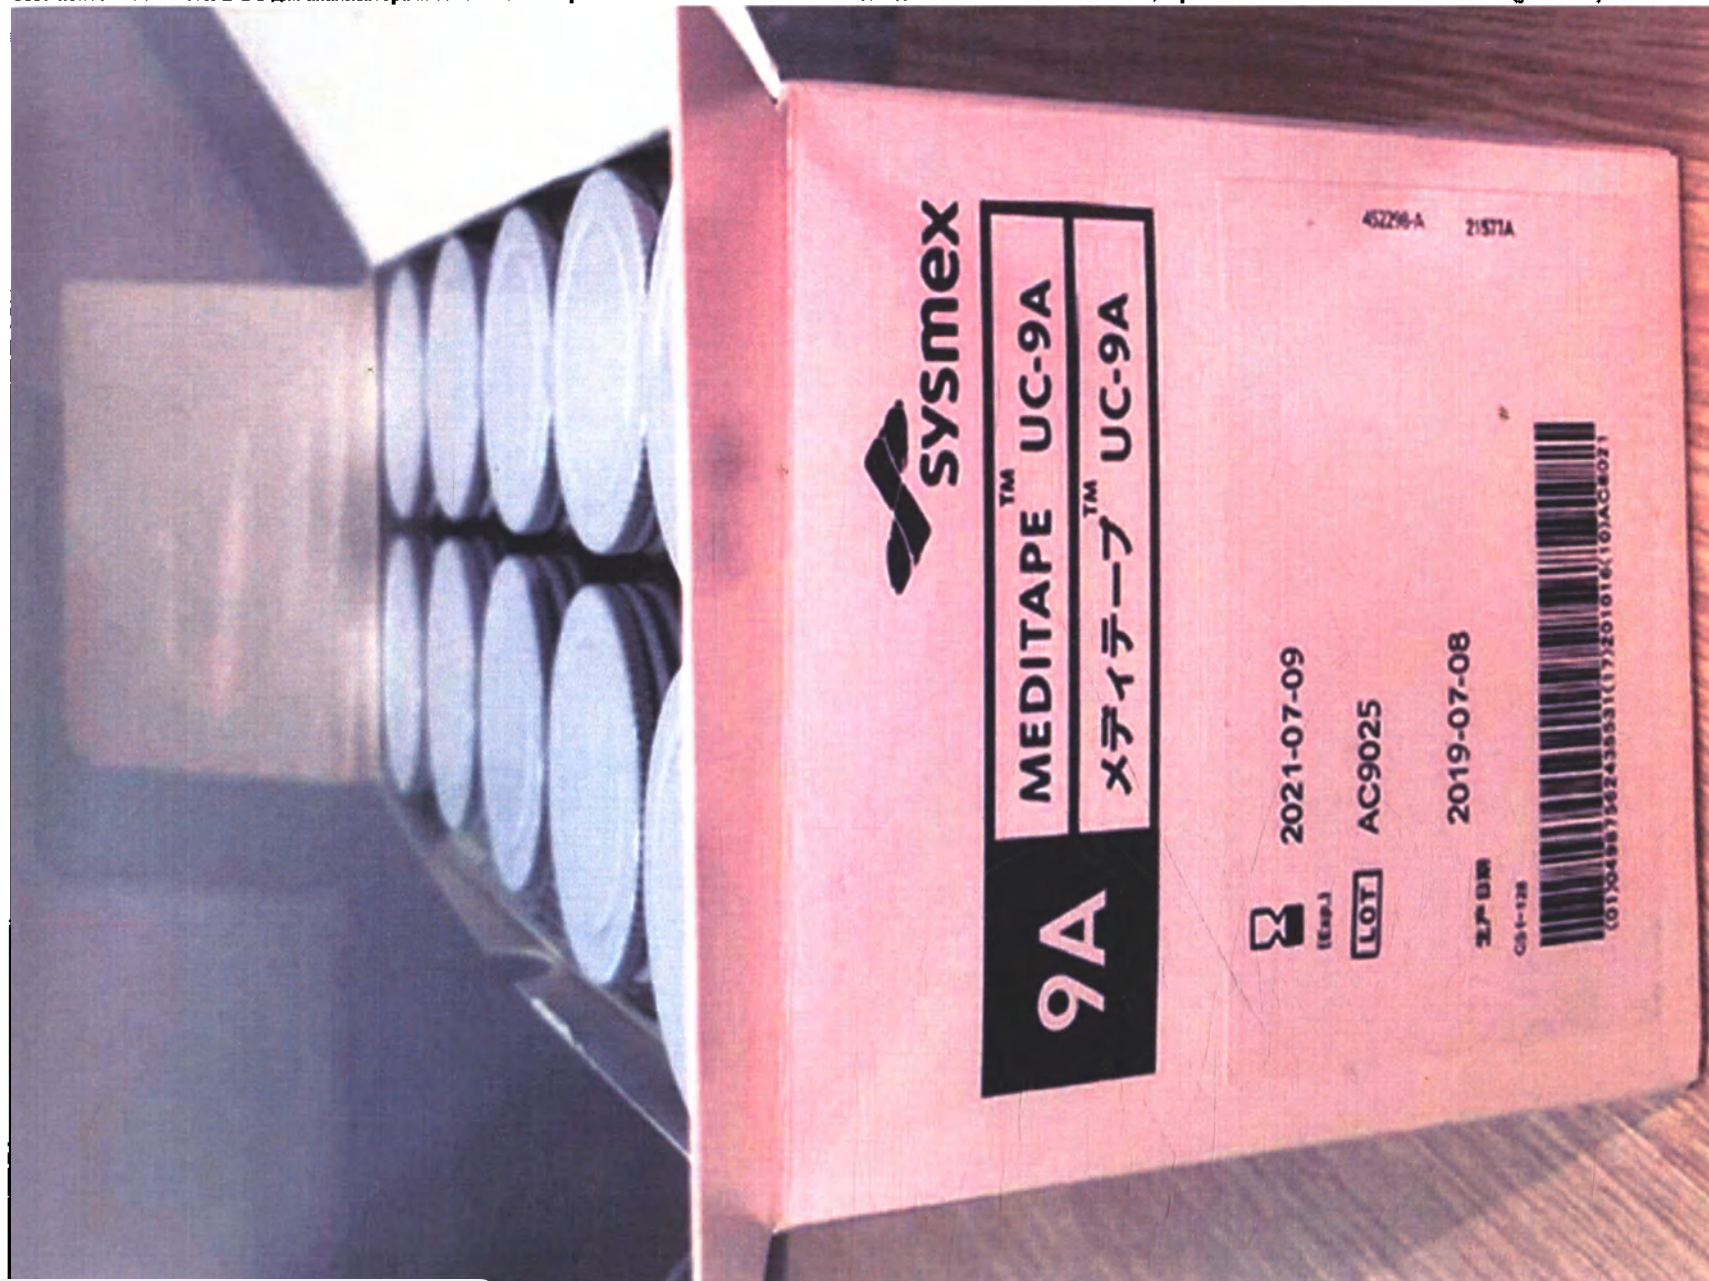

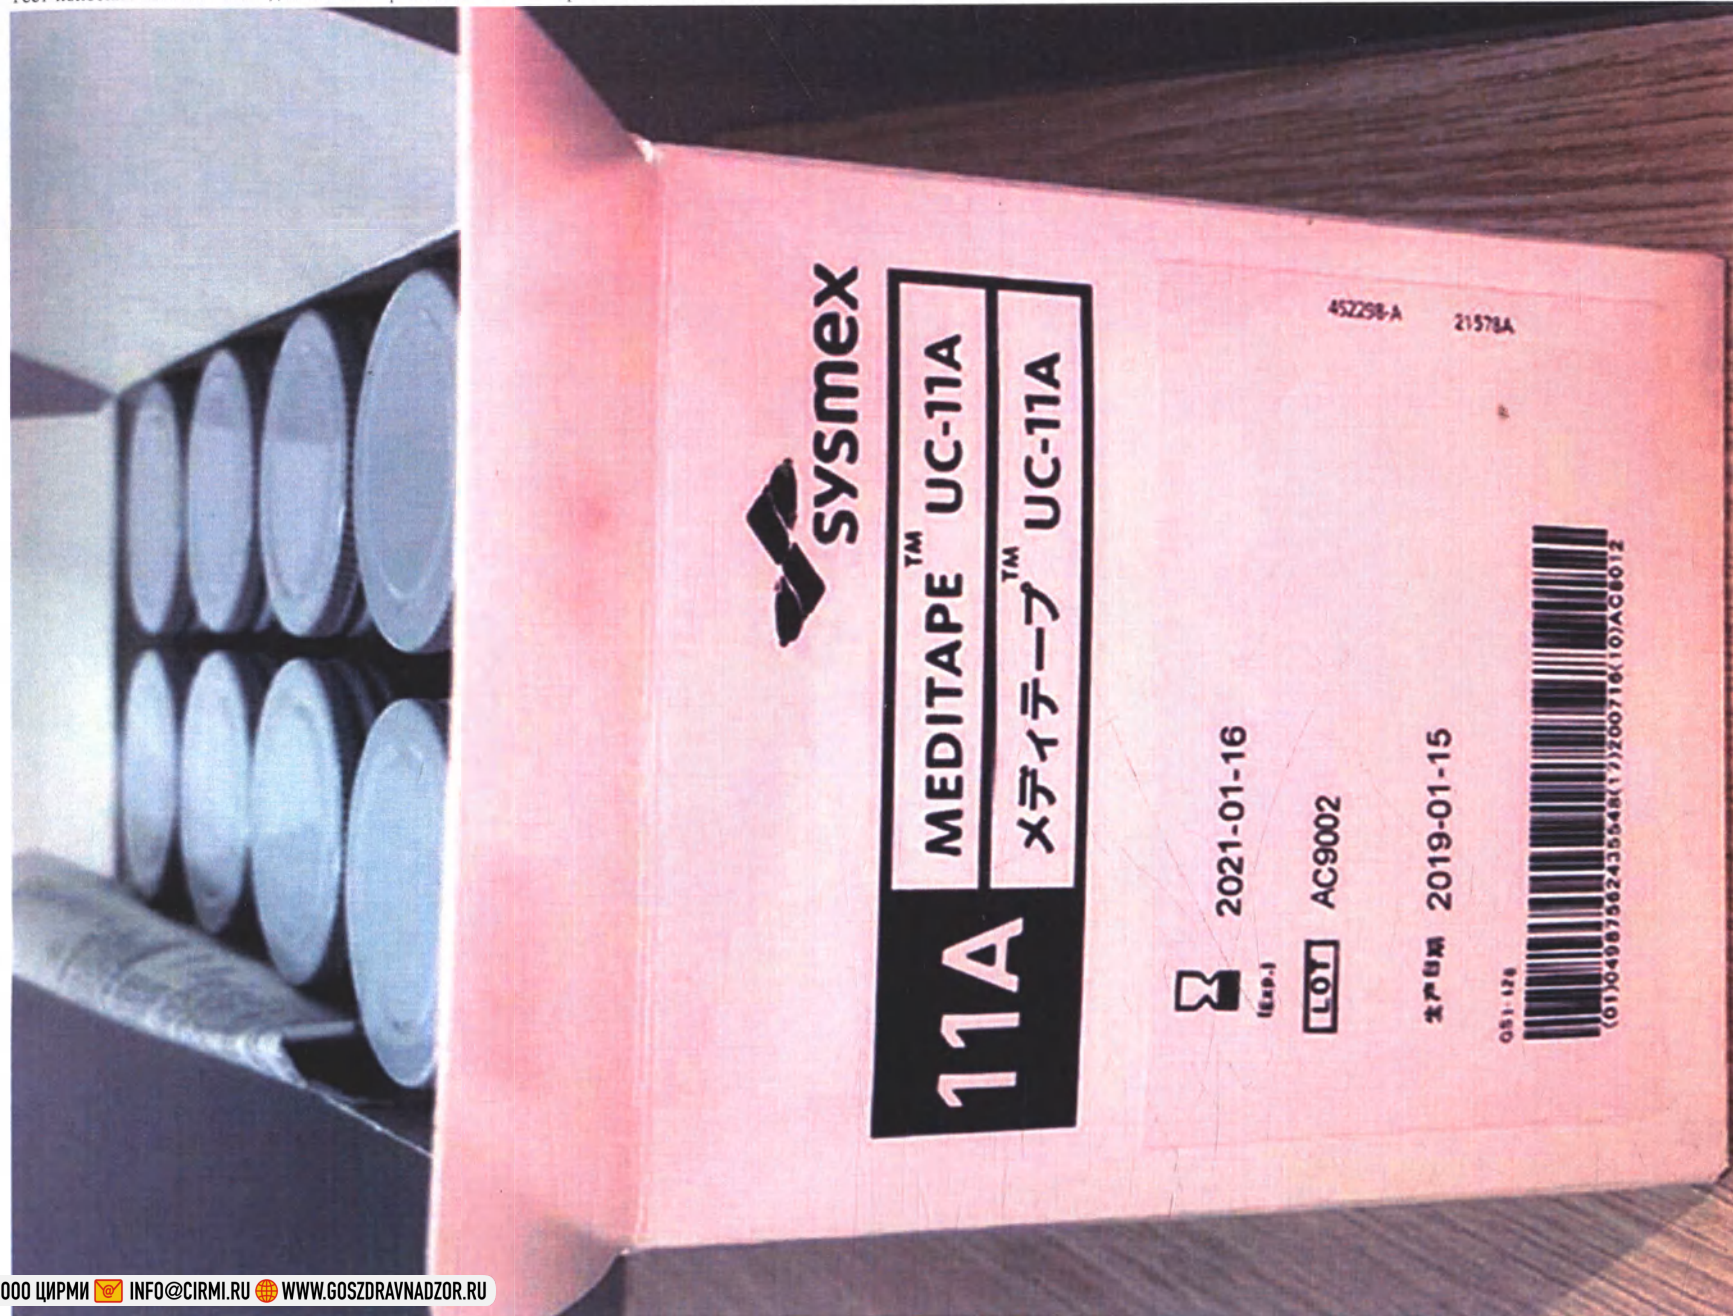

Тест-полоски MEDITAPE UC для анализатора автоматического физико-химических свойств мочи для диагностики in vitro UC -3500, вариант исполнения MEDITAPE UC-11A (упаковка, лот AC 9013)



Пронумеровано, прошнуровано, прошито
и скреплено печатью

9 (девять)

листов

Руководитель департамента
по регистрации, сертификации
и качеству медицинских изделий
ООО «Сисмекс РУС» _____ А.О. Виглинская

