


Фотографии медицинского изделия
«Устройство автоматическое микроскопического анализа мочи UD-10 для
диагностики in vitro, с принадлежностями»
производства компании SYSMEX CORPORATION, Япония


I. Устройство автоматическое микроскопического анализа мочи UD-10 , в составе:

1. Устройство автоматическое микроскопического анализа мочи UD-10, блок основной в составе с комплектующими:



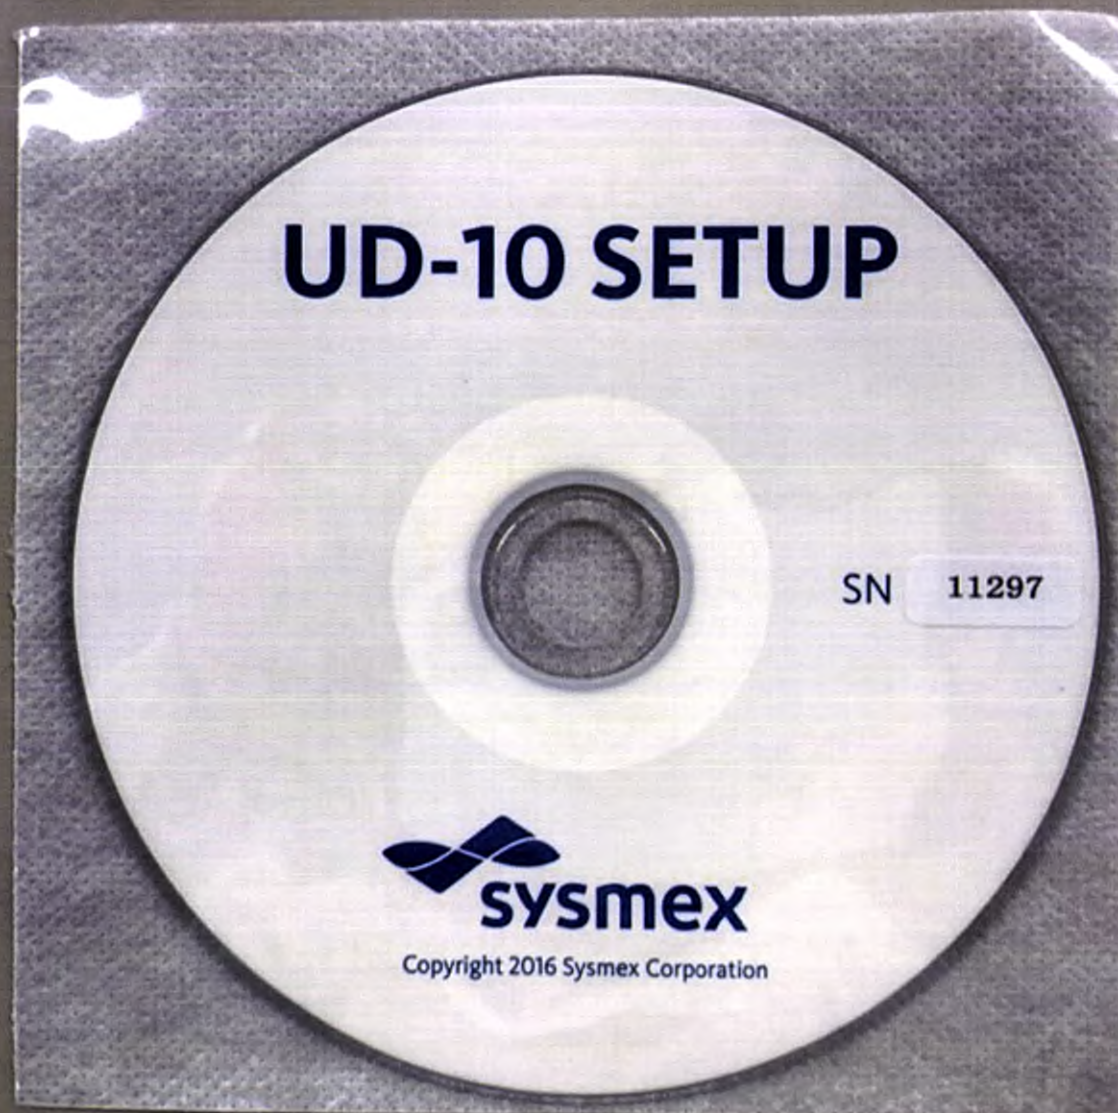

-Бутыль для отходов U1K в сборе (основная), объем 20 л.

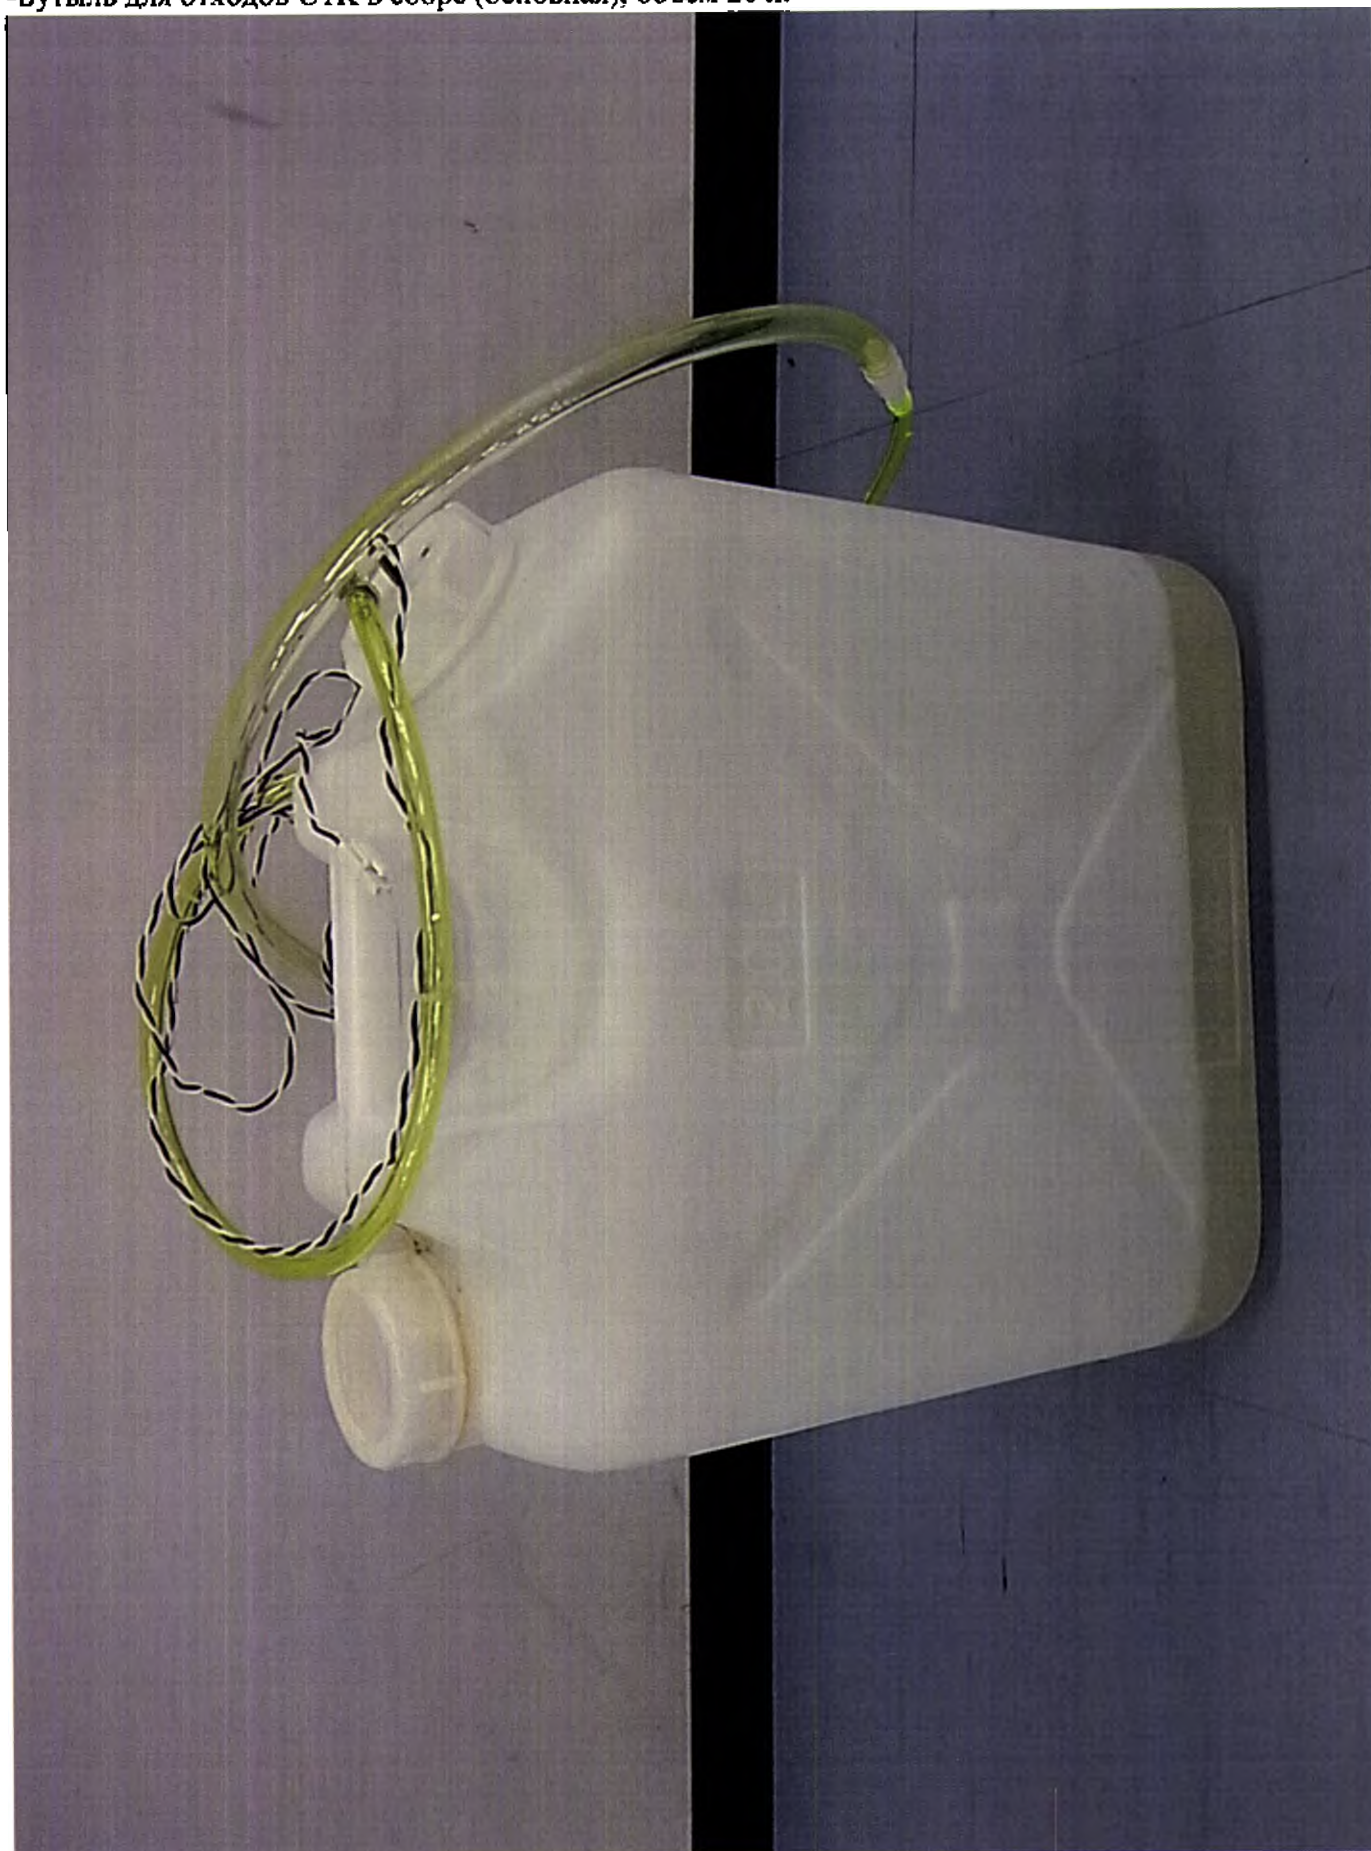


-Бутыль для отходов UIK в сборе (дополнительная), объем 20 л.




-Стойка для ПК (1)



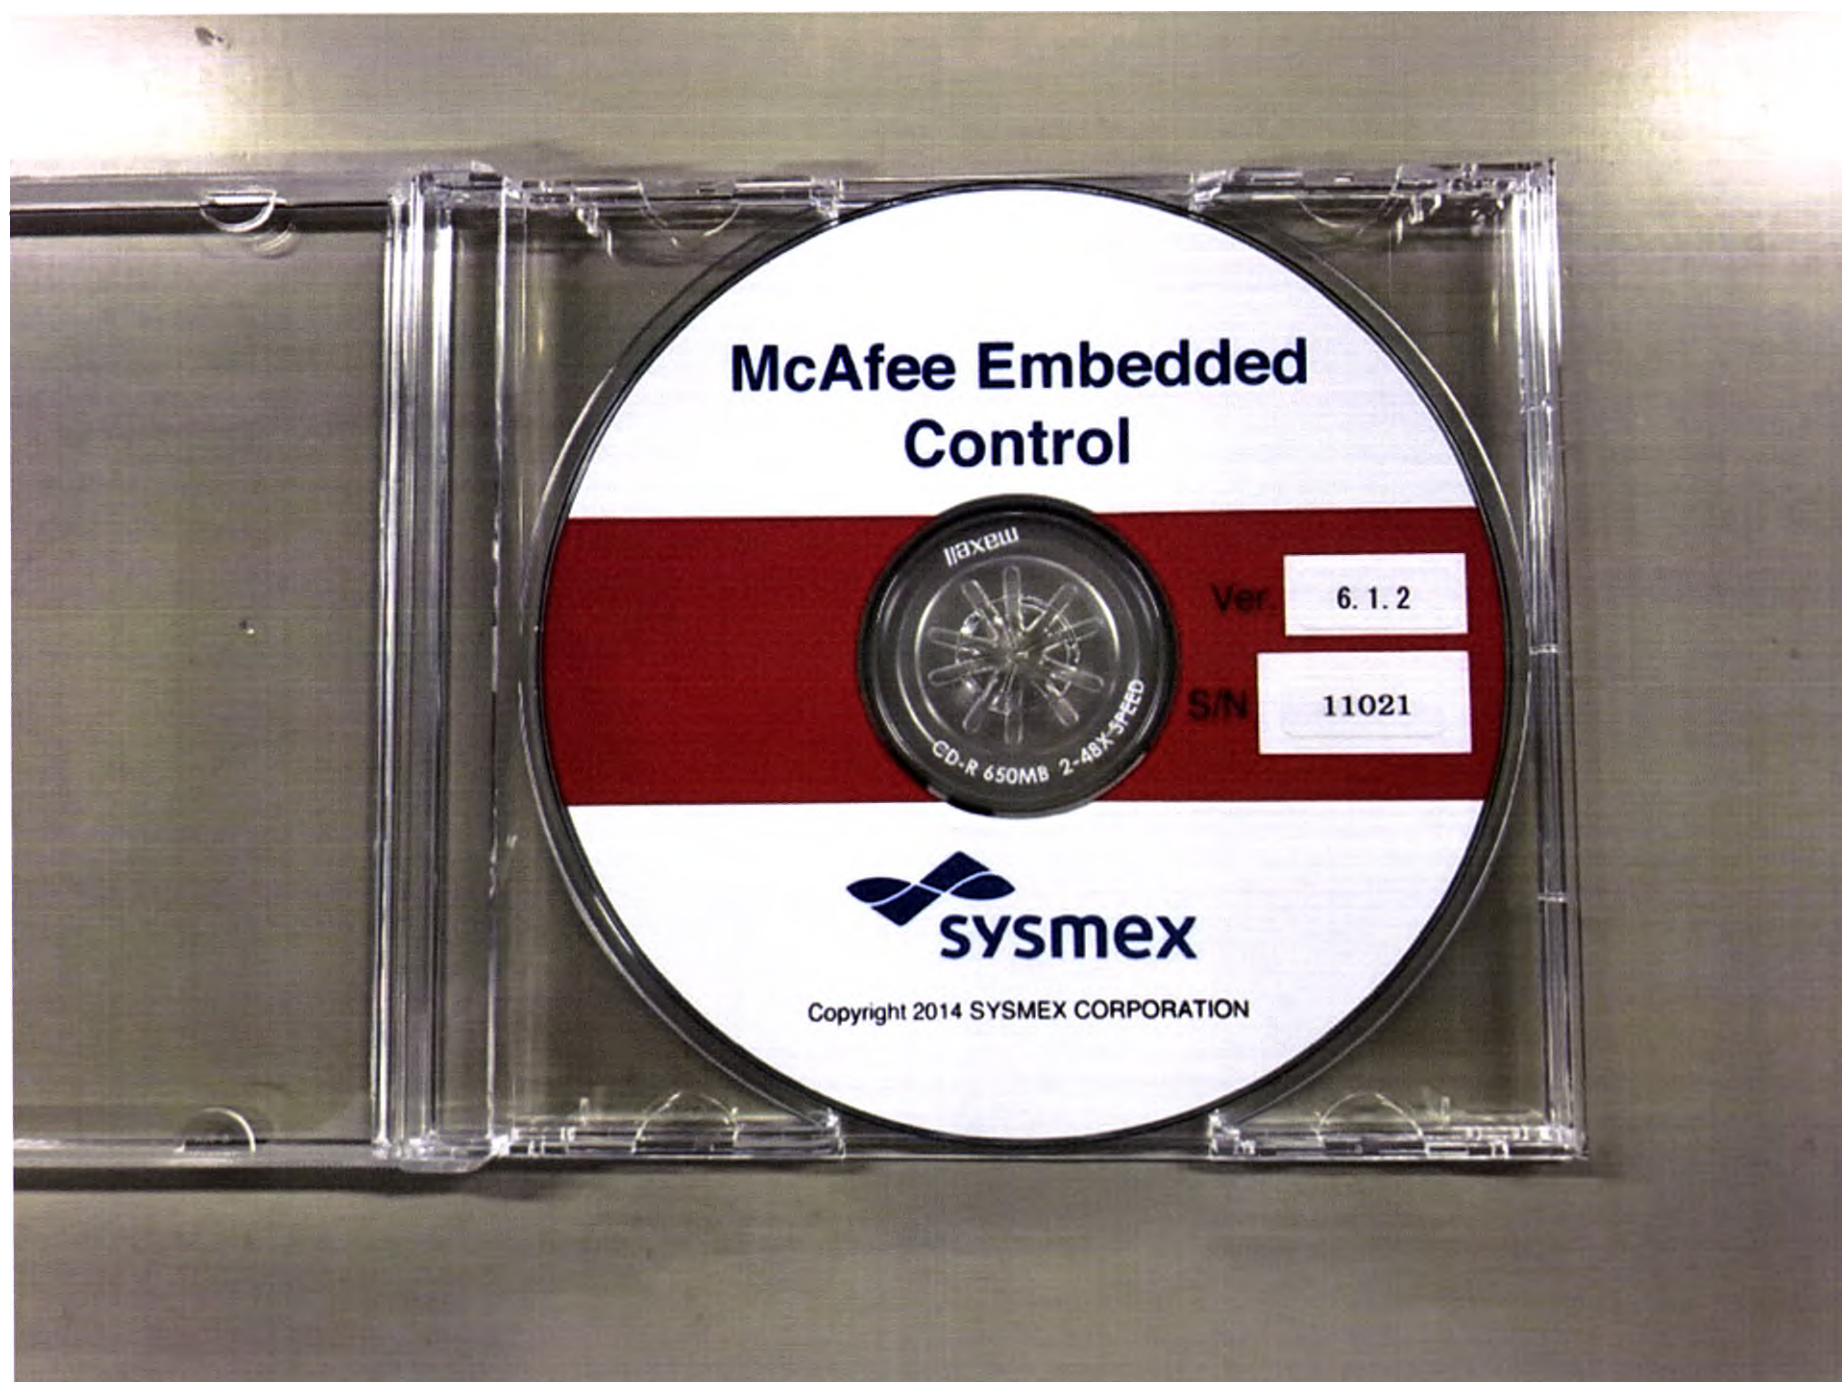

-Диск с инструкцией по применению

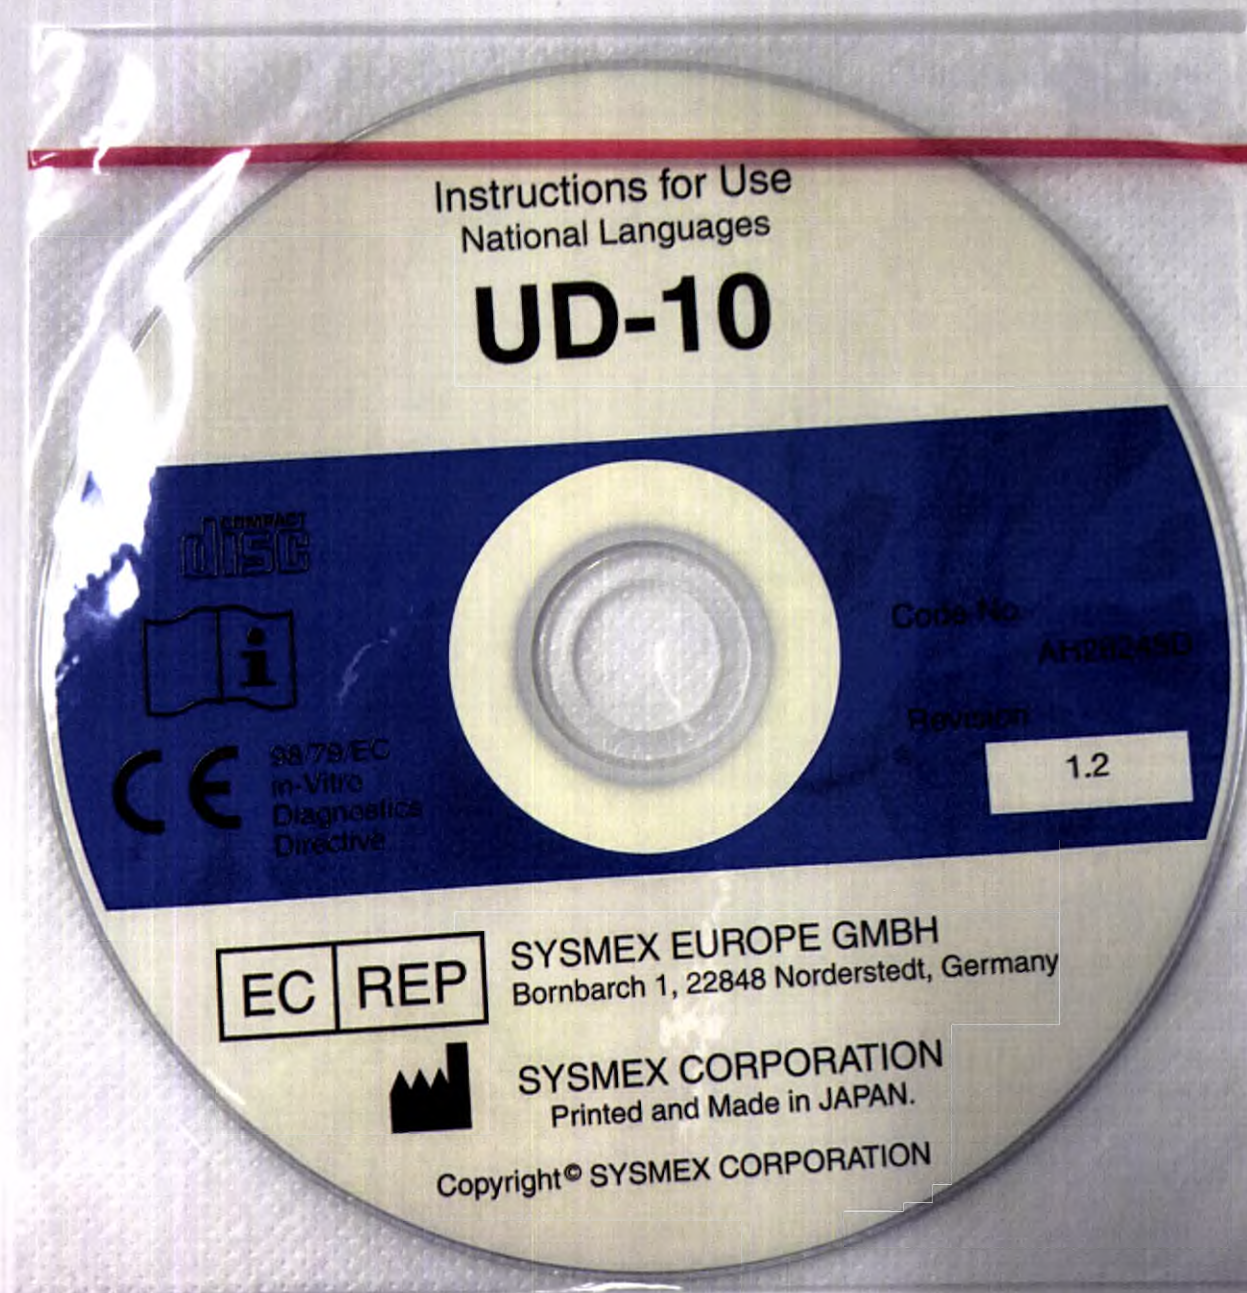

2. Набор комплектующих к устройству автоматическому UD-10:
-Инструкция "Общая информация"



Fully Automated Urine Particle Digital Imaging Device

UD-10

General Information

This manual provides important safety information and specifications of the instrument.
Read this manual before using the instrument.

The following manuals are provided as Instructions for Use:

- General Information
 - Basic Operation
 - Troubleshooting
-
-

Sysmex Corporation

KOBE, JAPAN



Fully Automated Urine Particle Digital Imaging Device

UD-10

Troubleshooting

Read this manual when you encounter a problem, and to perform instrument maintenance.
The explanations in this manual assume that you have already read "General Information".

The following manuals are provided as Instructions for Use:

- General Information
 - Basic Operation
 - Troubleshooting
-

Sysmex Corporation

KOBE, JAPAN



Fully Automated Urine Particle Digital Imaging Device

UD-10

Basic Operation

Read this manual to operate the instrument.
The explanations in this manual assume that you have already read "General Information".

The following manuals are provided as Instructions for Use:

- General Information
 - Basic Operation
 - Troubleshooting
-

Sysmex Corporation

KOBE, JAPAN

-Диск CD-R №232



-Узел отбора №11 в сборе




-Пластина опорная выключателя поплавкового



-Адаптер №368



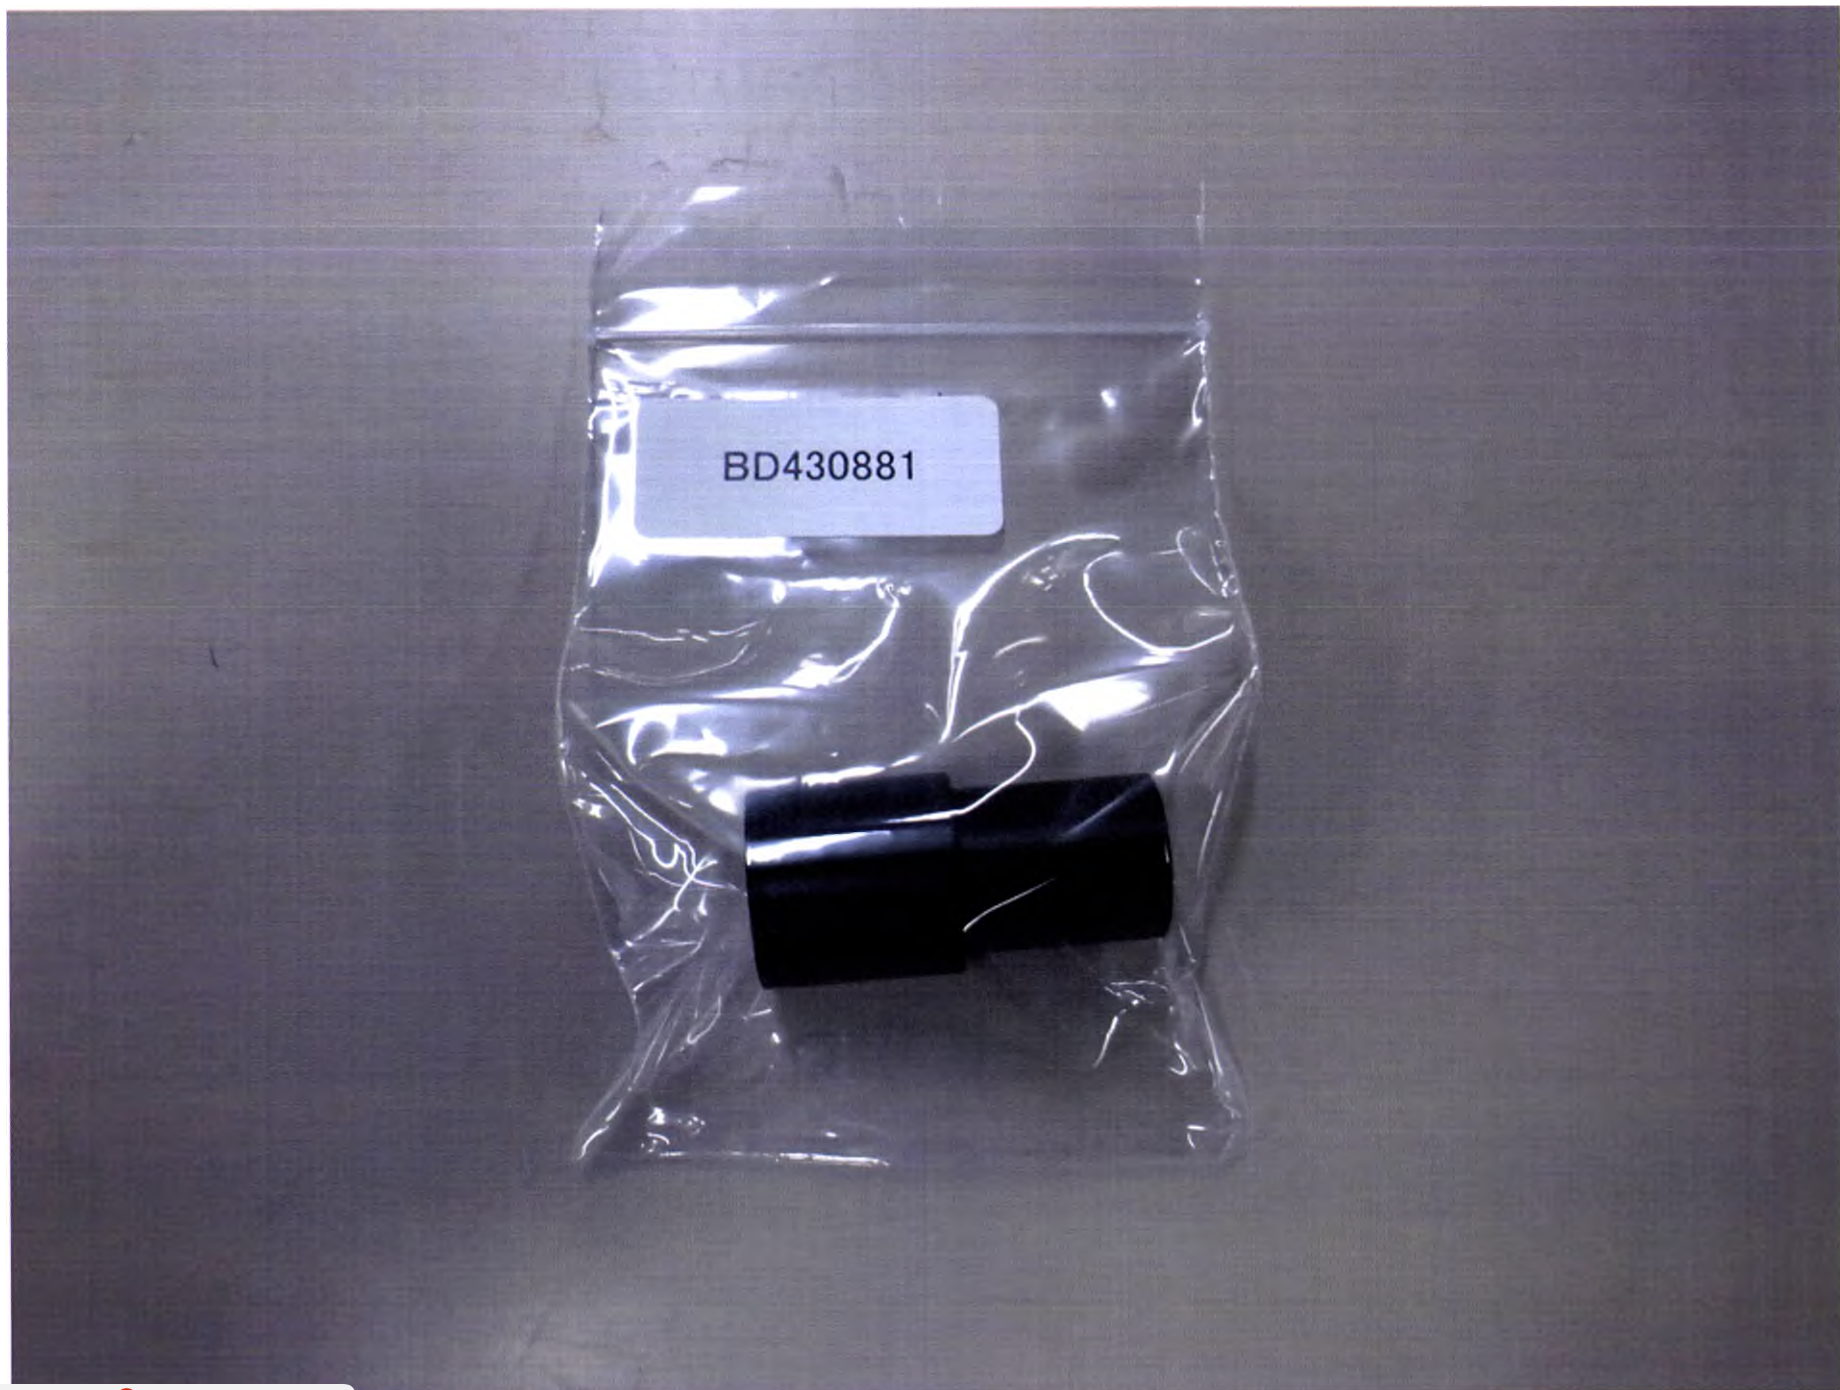




-Штатив для проб (WH) (U1K)



-Устройство ручное для считывания штрих-кодов 2М-С-37-USB



-Подставка для устройства ручного для считывания штрих-кодов STD-4101

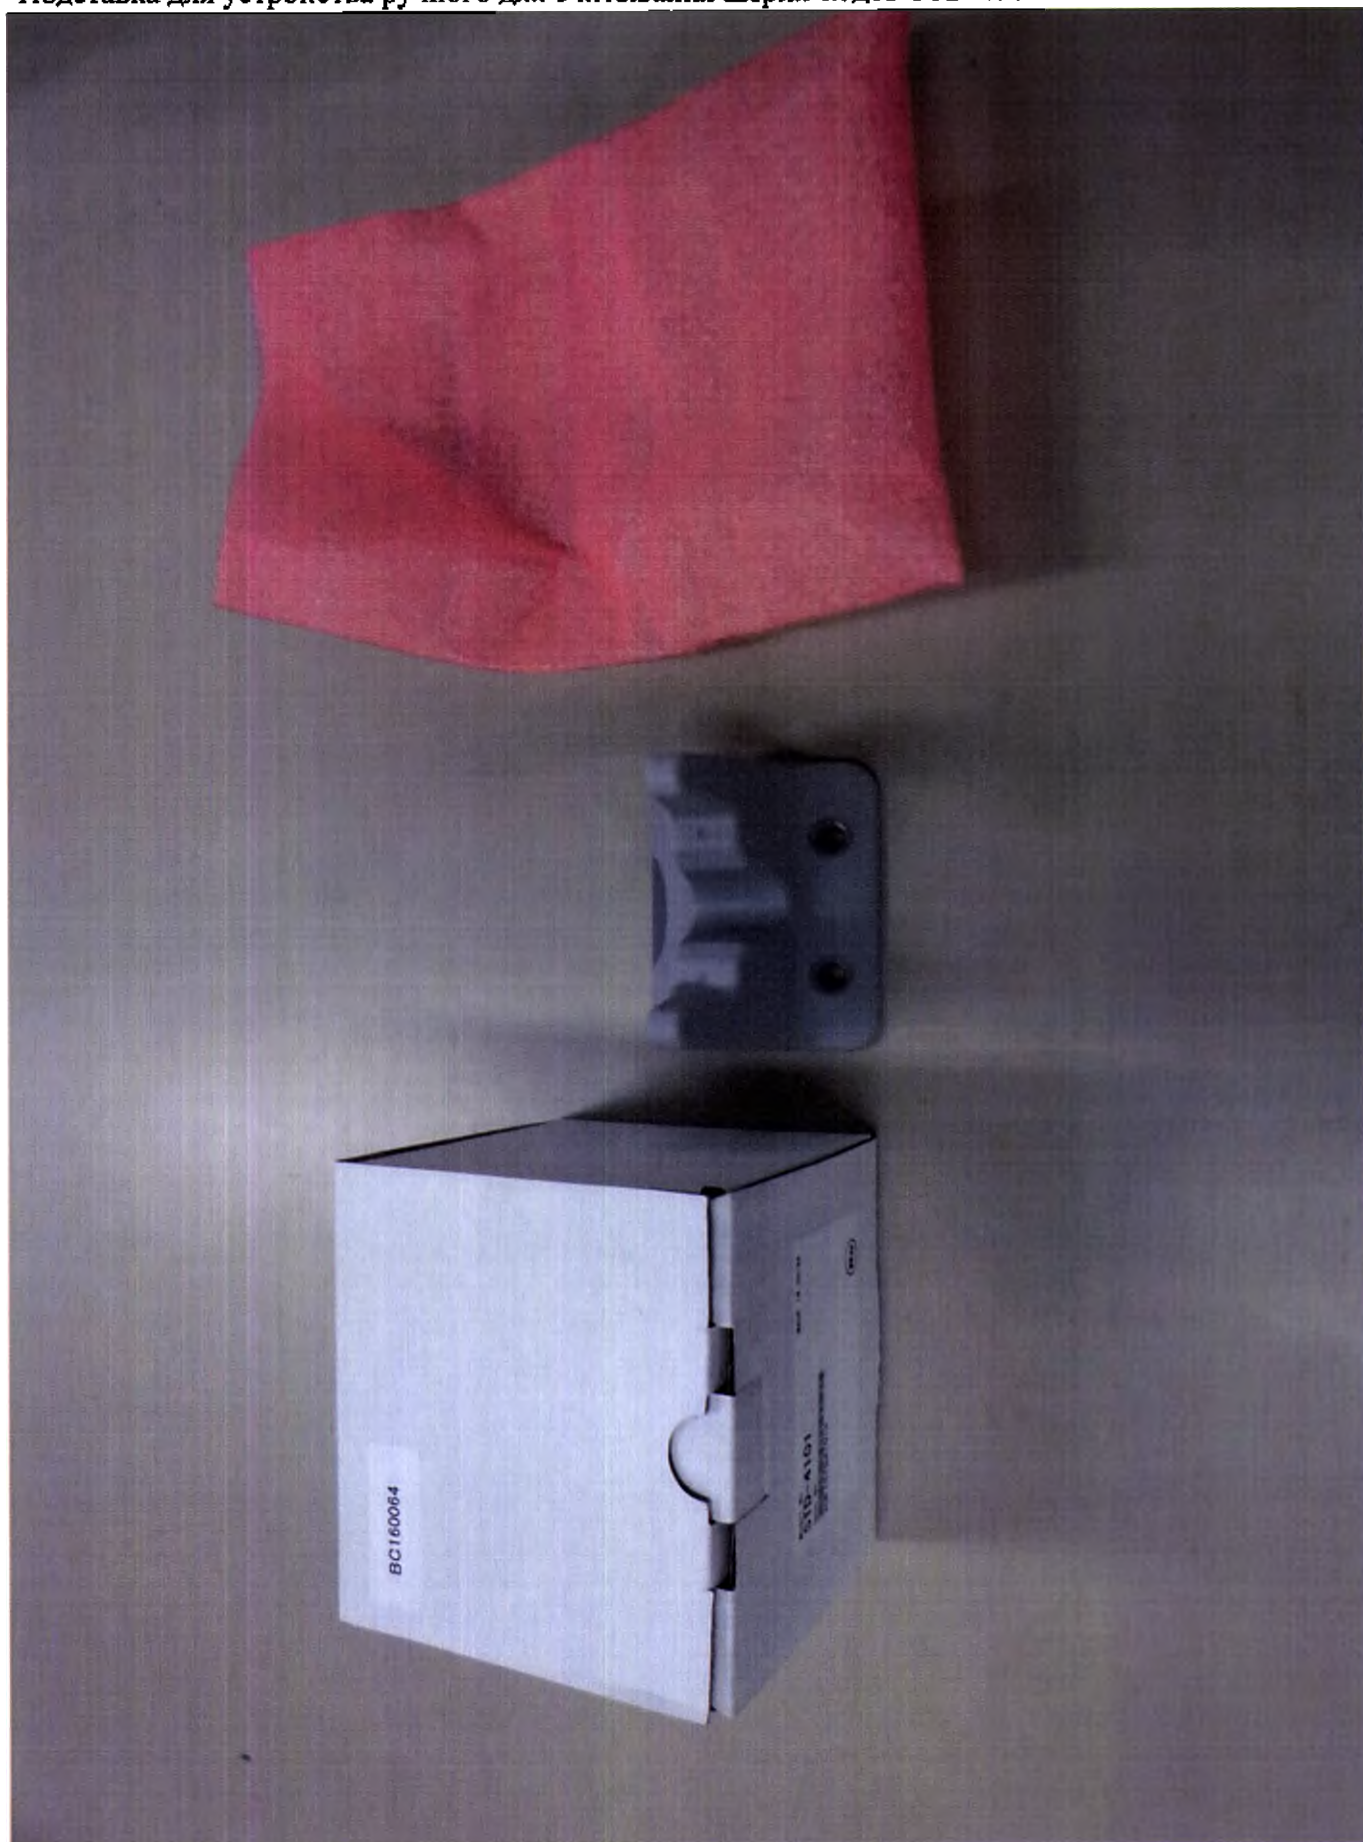

-Кабель электропитания ТА-6Р(А)+ТА(А) Н05VV-F



-Предохранитель 50T100H - 2 шт.



-Кабель электропитания в сборе №9349



-Зажим №1381



-Зажим №1777





-Трубка 6 мм х 4 мм, длиной 15 м (1)



-Трубка 3,4 мм х 1,8 мм, длиной 3 м (2)



-Трубка 14 мм х 10 мм, длиной 10 м



-Трубка 9 мм х 6 мм, длиной 1 м (3)



-Соединитель №29




-Уплотнитель №14



-Винт установочный №18



-Выключатель поплавковый №13 в сборе

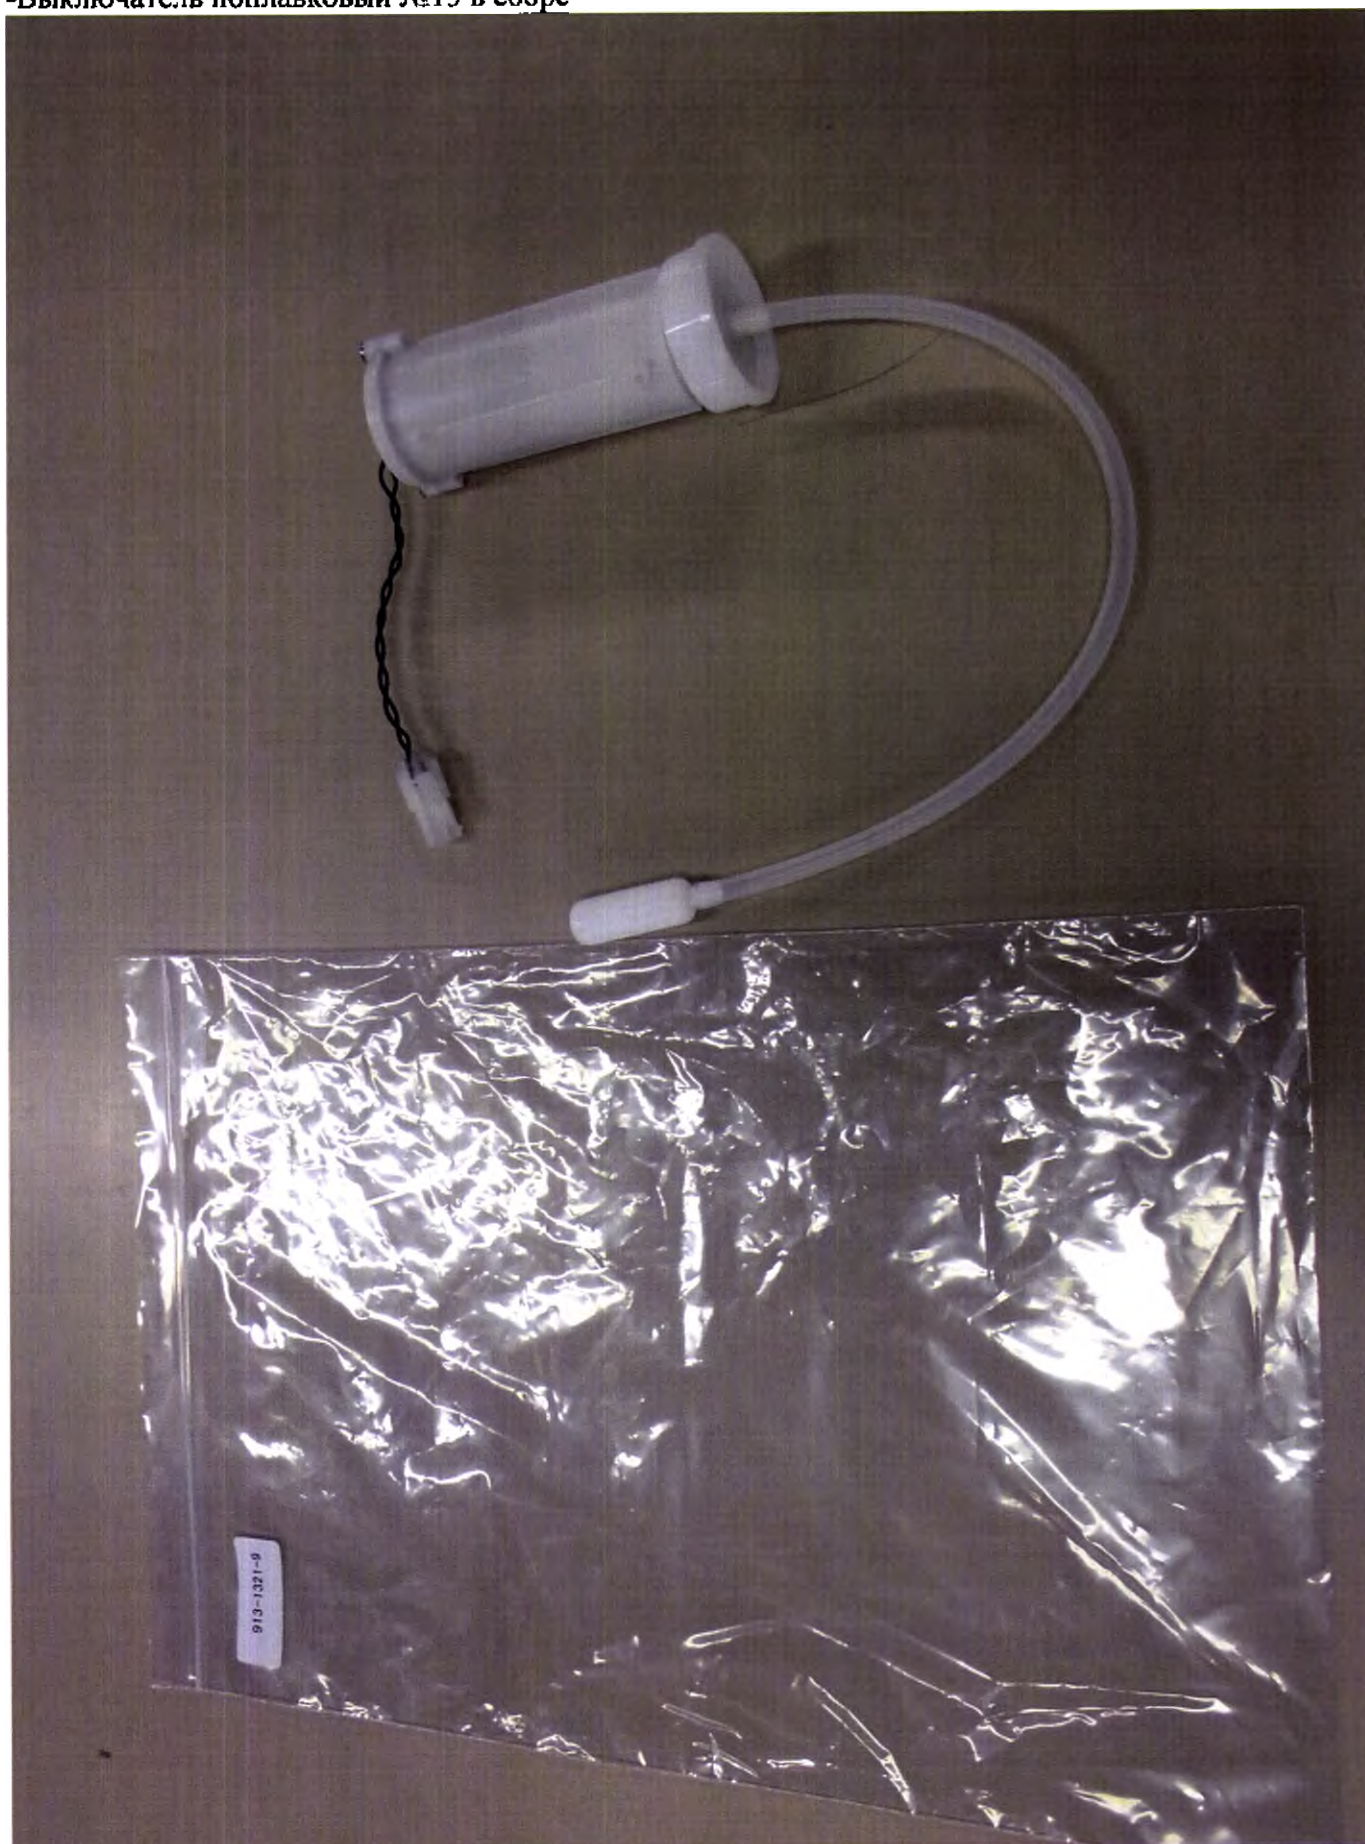

-Крышка №550 - 2 шт.



-Держатель №357 в сборе



-Бутыль № 31 в сборе, объем 2.1 л



3. Программное обеспечение U-WAM.



II. Принадлежности:


1. Блок системный HP WIN7PRO EMBEDDED



2. Клавиатура 50SH PLUS (US)



3. Пневматический блок PU-17, основной комплект(220 – 240 В) (Белый) в составе с комплектующими:

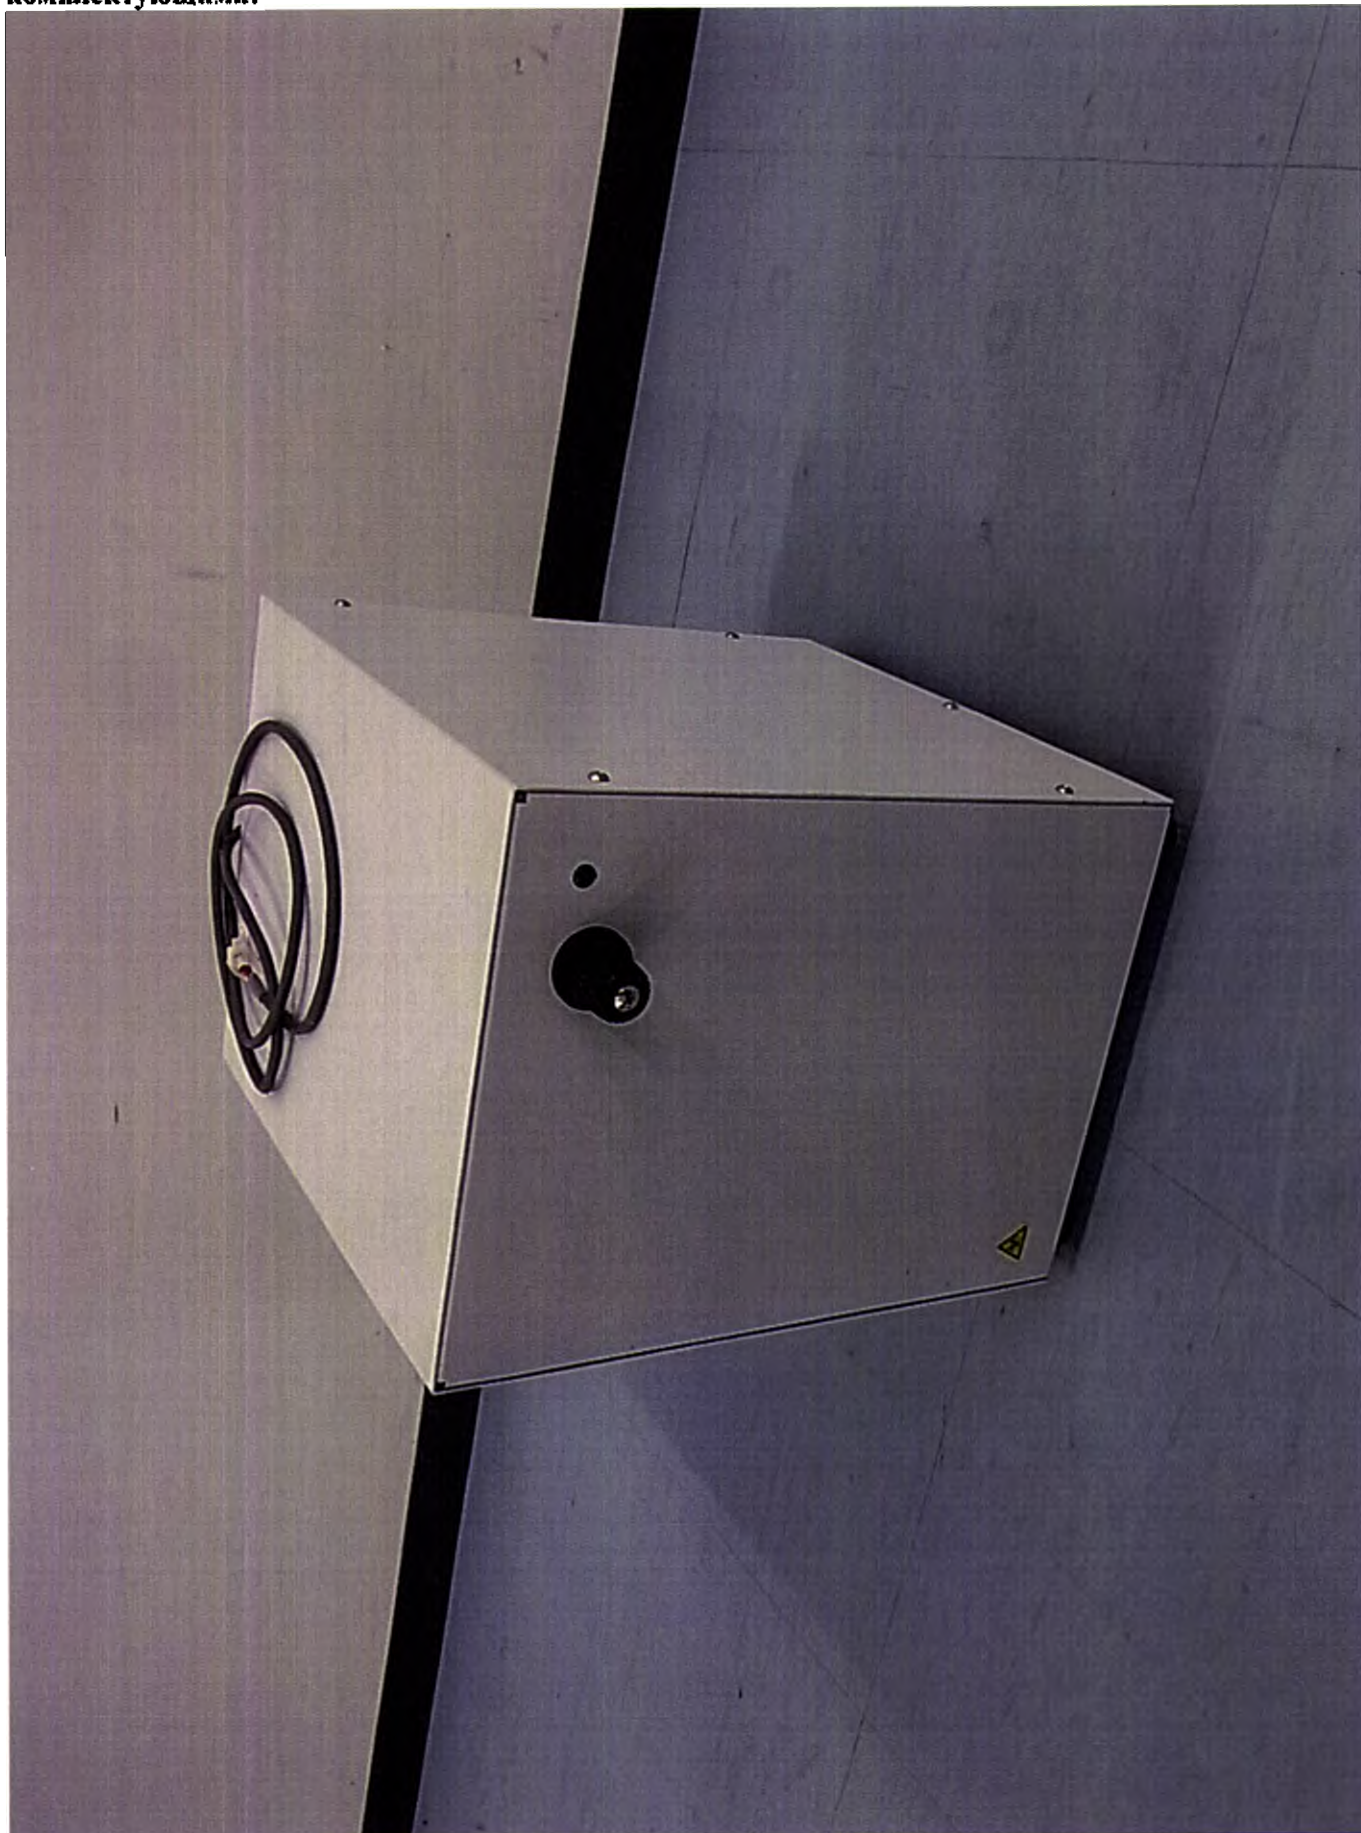

-Кабель электропитания TA-6P(A)+TA(A) H05VV-F



-Предохранитель 02183.15МХР (250 В3,15 А) - 2 шт.




4. Чашка для проб коническая, 4 мл., 1500 шт. в упаковке




III. Устройство автоматическое микроскопического анализа мочи UD-10 в комплектации с блоком транспортировки CV-11:

1. Устройство автоматическое UD-10, блок основной в составе с комплектующими:

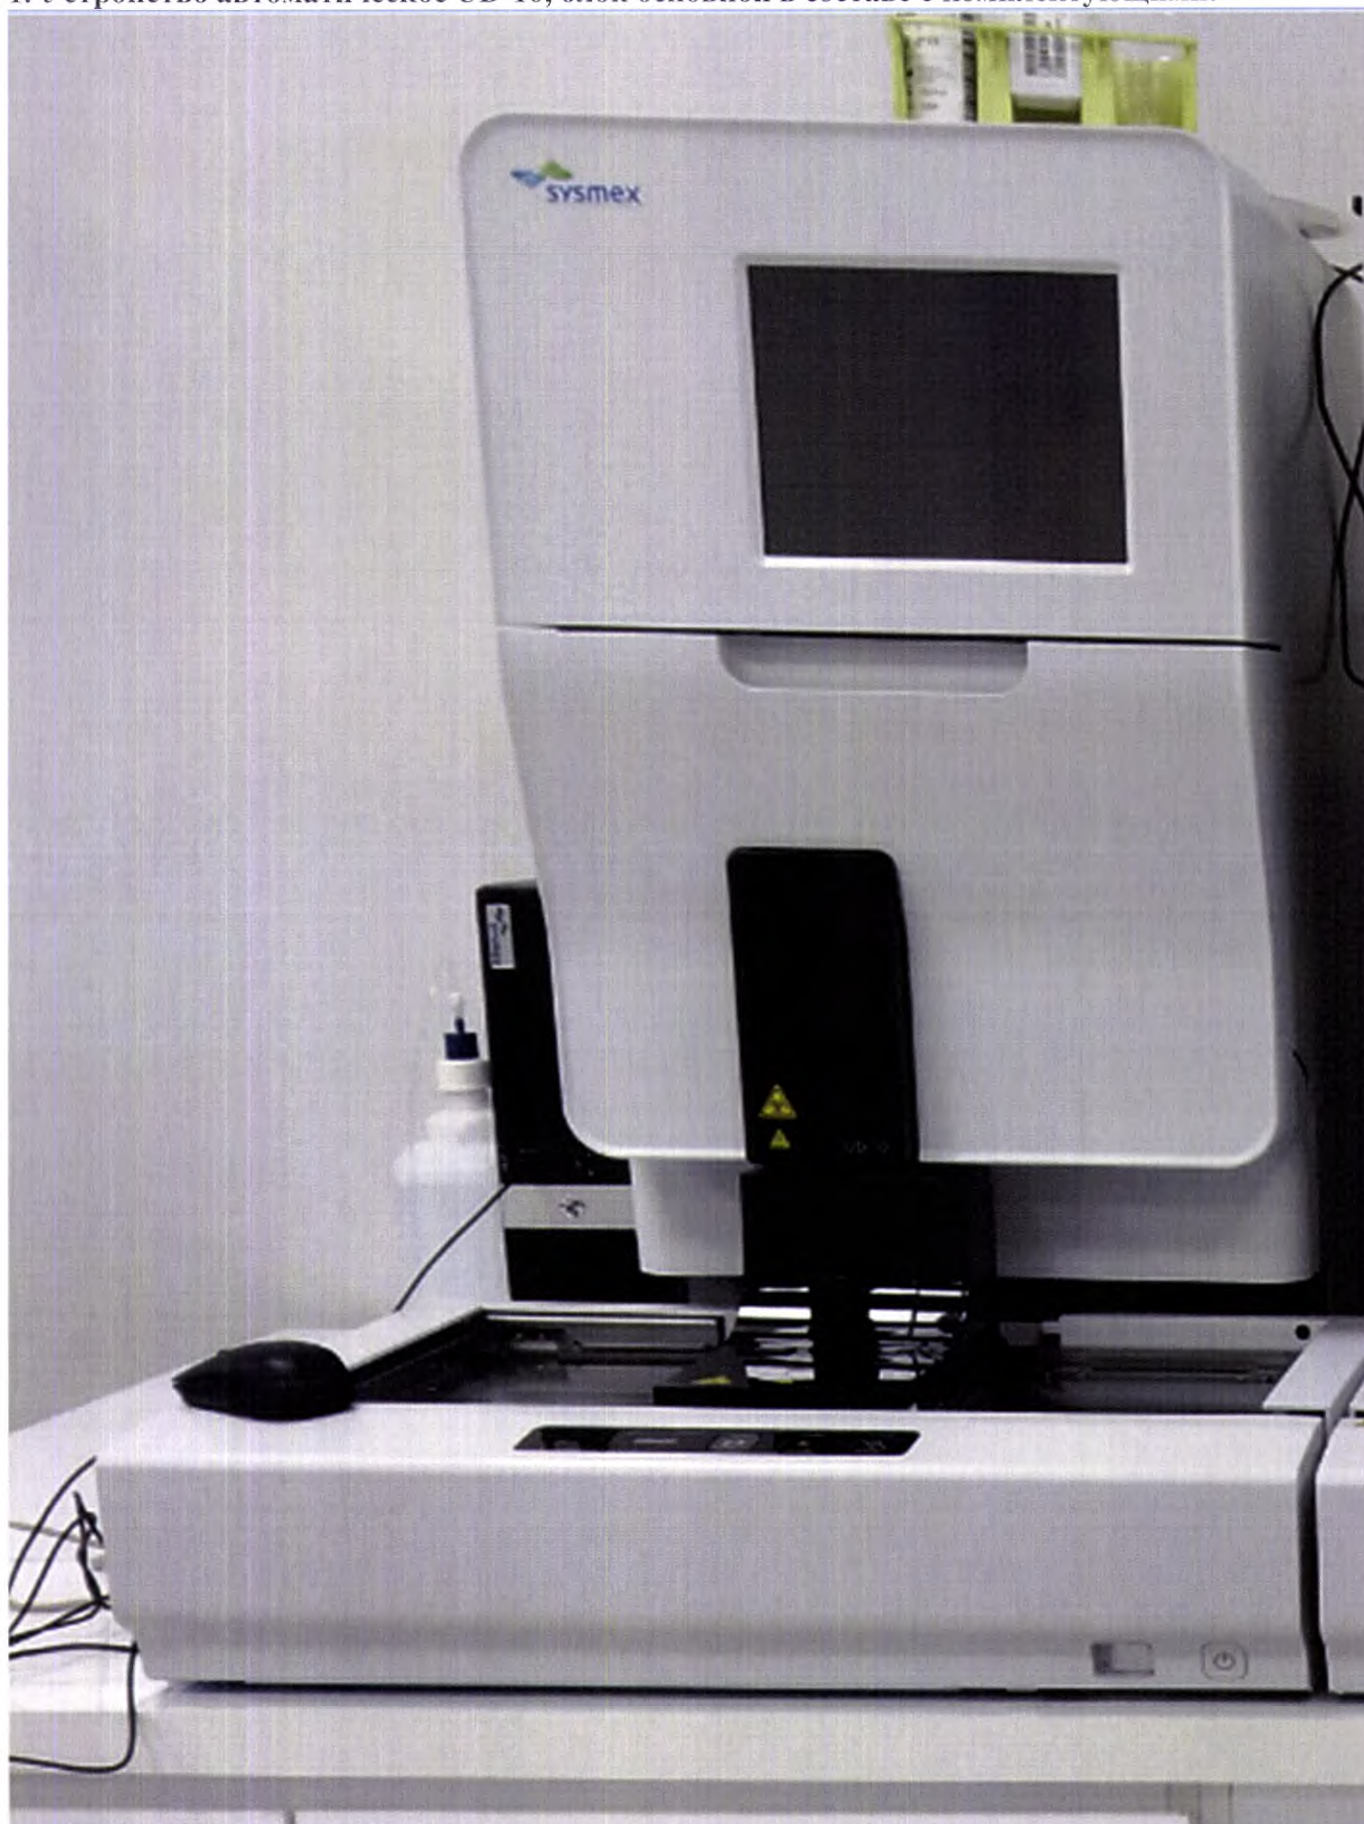

-Соединитель трубок полипропиленовый PD-ML_5-4042-31



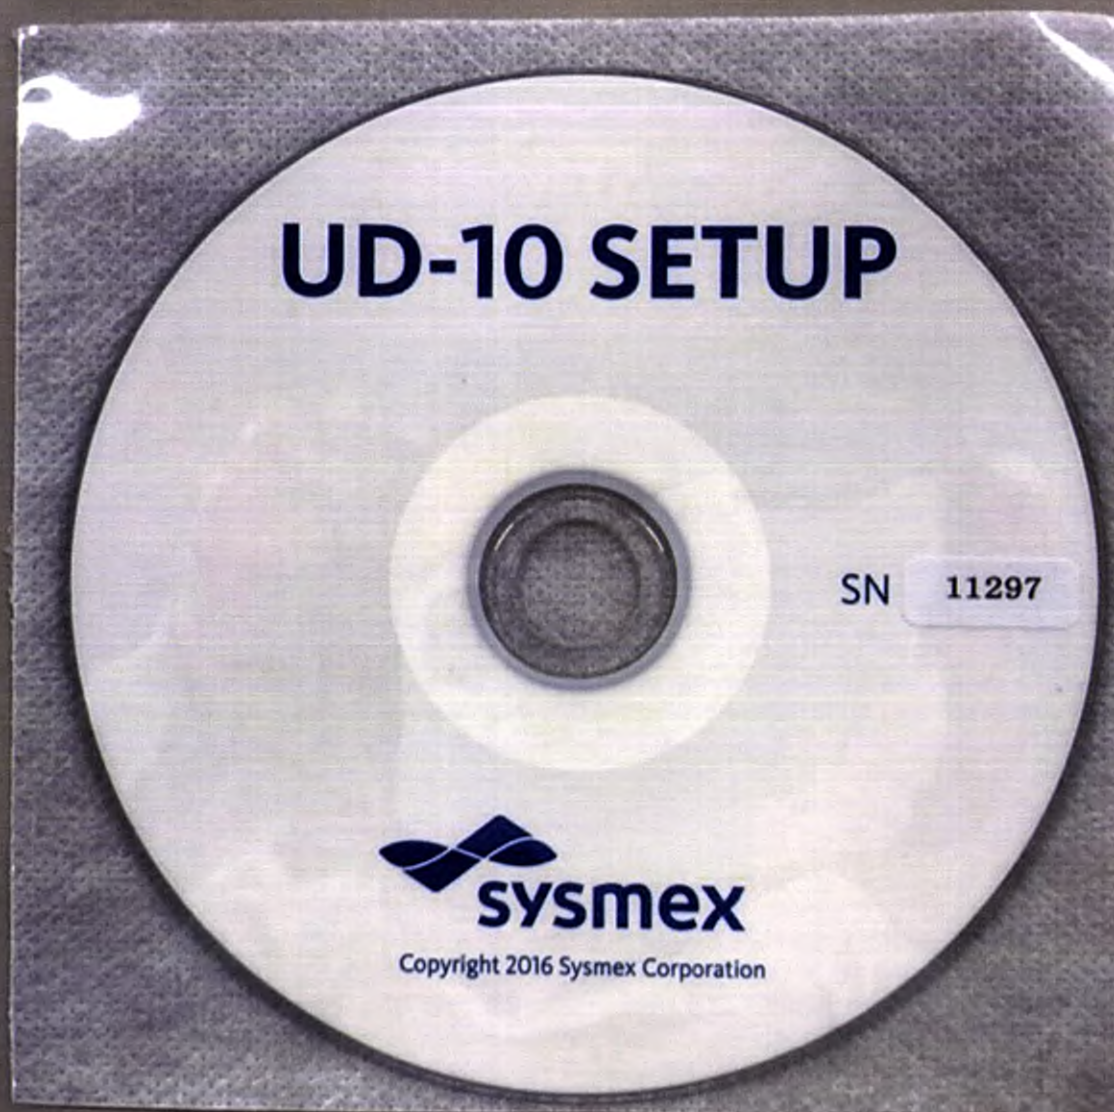

-Бутыль для отходов U1K в сборе (основная), объем 20 л.




-Бутыль для отходов UIK в сборе (дополнительная), объем 20 л.




-Стойка для ПК (1)



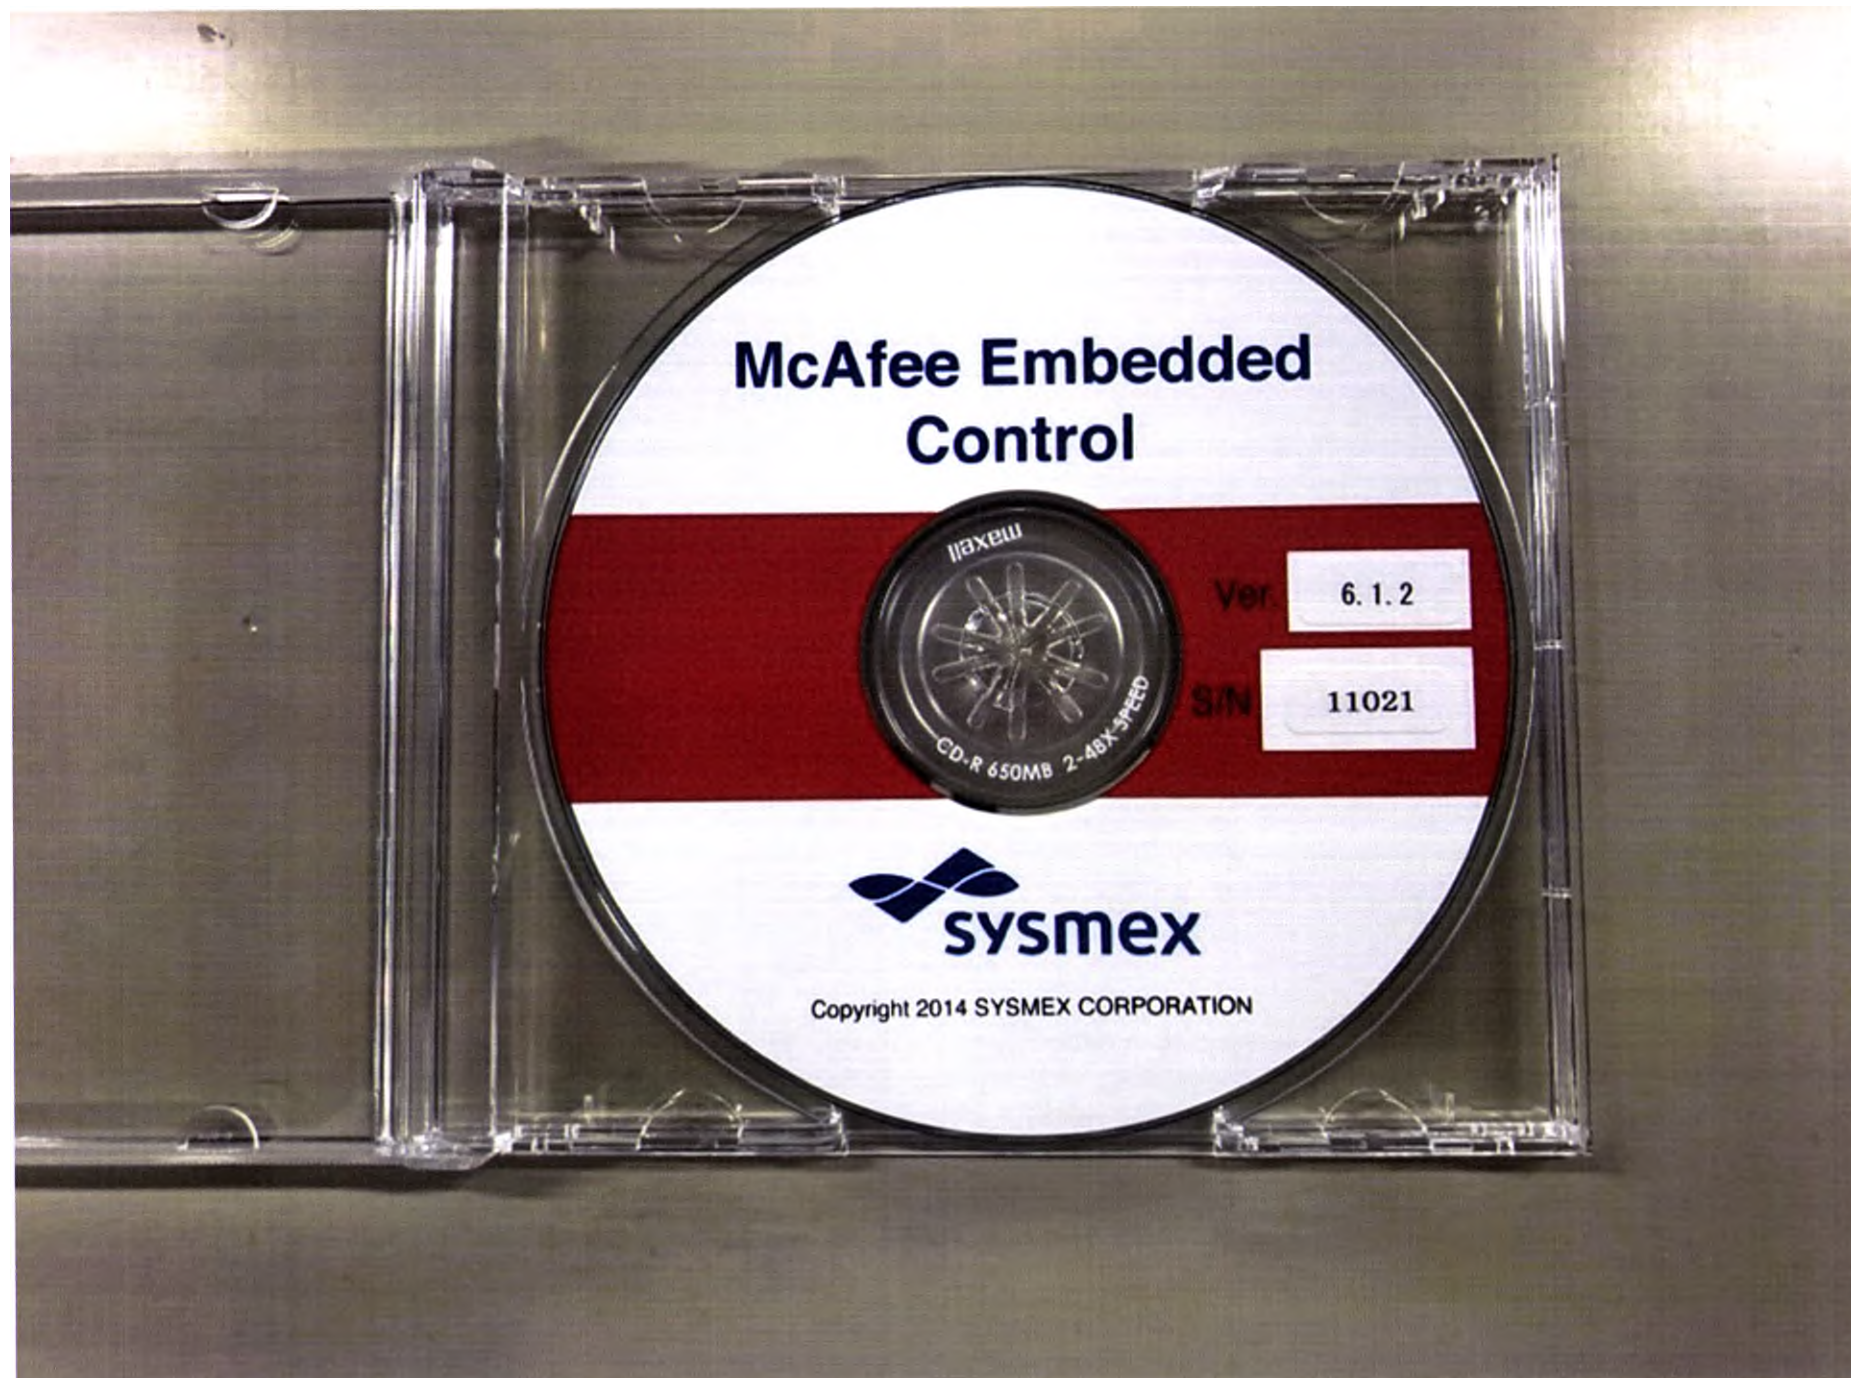

-Диск с инструкцией по применению

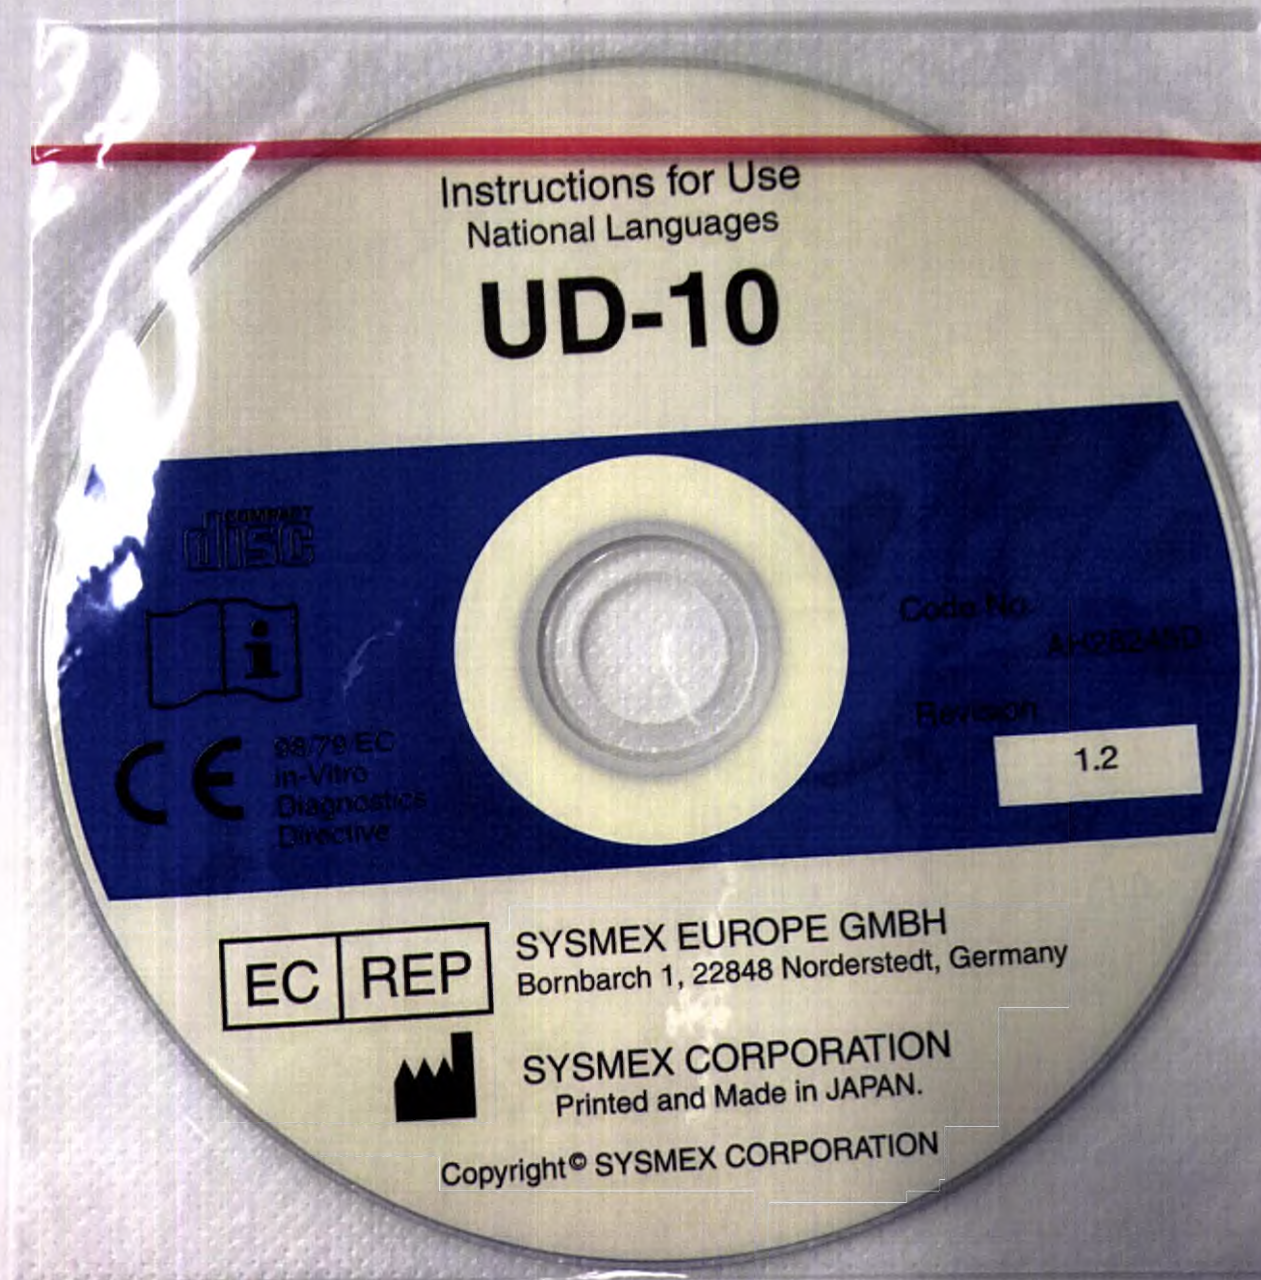

2. Комплектующие к устройству автоматическому UD-10:
- Инструкция "Общая информация"



Fully Automated Urine Particle Digital Imaging Device

UD-10

General Information

This manual provides important safety information and specifications of the instrument.
Read this manual before using the instrument.

The following manuals are provided as Instructions for Use:

- General Information
 - Basic Operation
 - Troubleshooting
-
-

Sysmex Corporation

KOBE, JAPAN



Fully Automated Urine Particle Digital Imaging Device

UD-10

Troubleshooting

Read this manual when you encounter a problem, and to perform instrument maintenance.
The explanations in this manual assume that you have already read "General Information".

The following manuals are provided as Instructions for Use:

- General Information
 - Basic Operation
 - Troubleshooting
-

Sysmex Corporation

KOBE, JAPAN



Fully Automated Urine Particle Digital Imaging Device

UD-10

Basic Operation

Read this manual to operate the instrument.
The explanations in this manual assume that you have already read "General Information".

The following manuals are provided as Instructions for Use:

- General Information
 - Basic Operation
 - Troubleshooting
-

Sysmex Corporation

KOBE, JAPAN

- Диск CD-R №232



- Узел отбора №11 в сборе



- Опорная пластина выключателя поплавкового



- Адаптер №368



- Адаптер №394



- Адаптер (РМ) №19



- Штатив для проб (WH) (U1K)



- Устройство ручное для считывания штрих-кодов 2М-С-37-USB



- Подставка для устройства ручного для считывания штрих-кодов STD-4101



- Кабель электропитания TA-6P(A)+TA(A) H05VV-F



- Предохранитель 50T100H - 2 шт.



- Кабель электропитания в сборе №9349



- Зажим №1381



- Зажим №1777



- Зажим №1825



- Трубка 6 мм х 4 мм, длиной 15 м (1)



- Трубка 3,4 мм х 1,8 мм, длиной 3 м (2)



- Трубка 14 мм х 10 мм, длиной 10 м.



-Трубка 9 мм х 6 мм, длиной 1 м (3)



-Соединитель №29




-Уплотнитель №14



-Винт установочный №18



-Выключатель поплавковый №13 в сборе

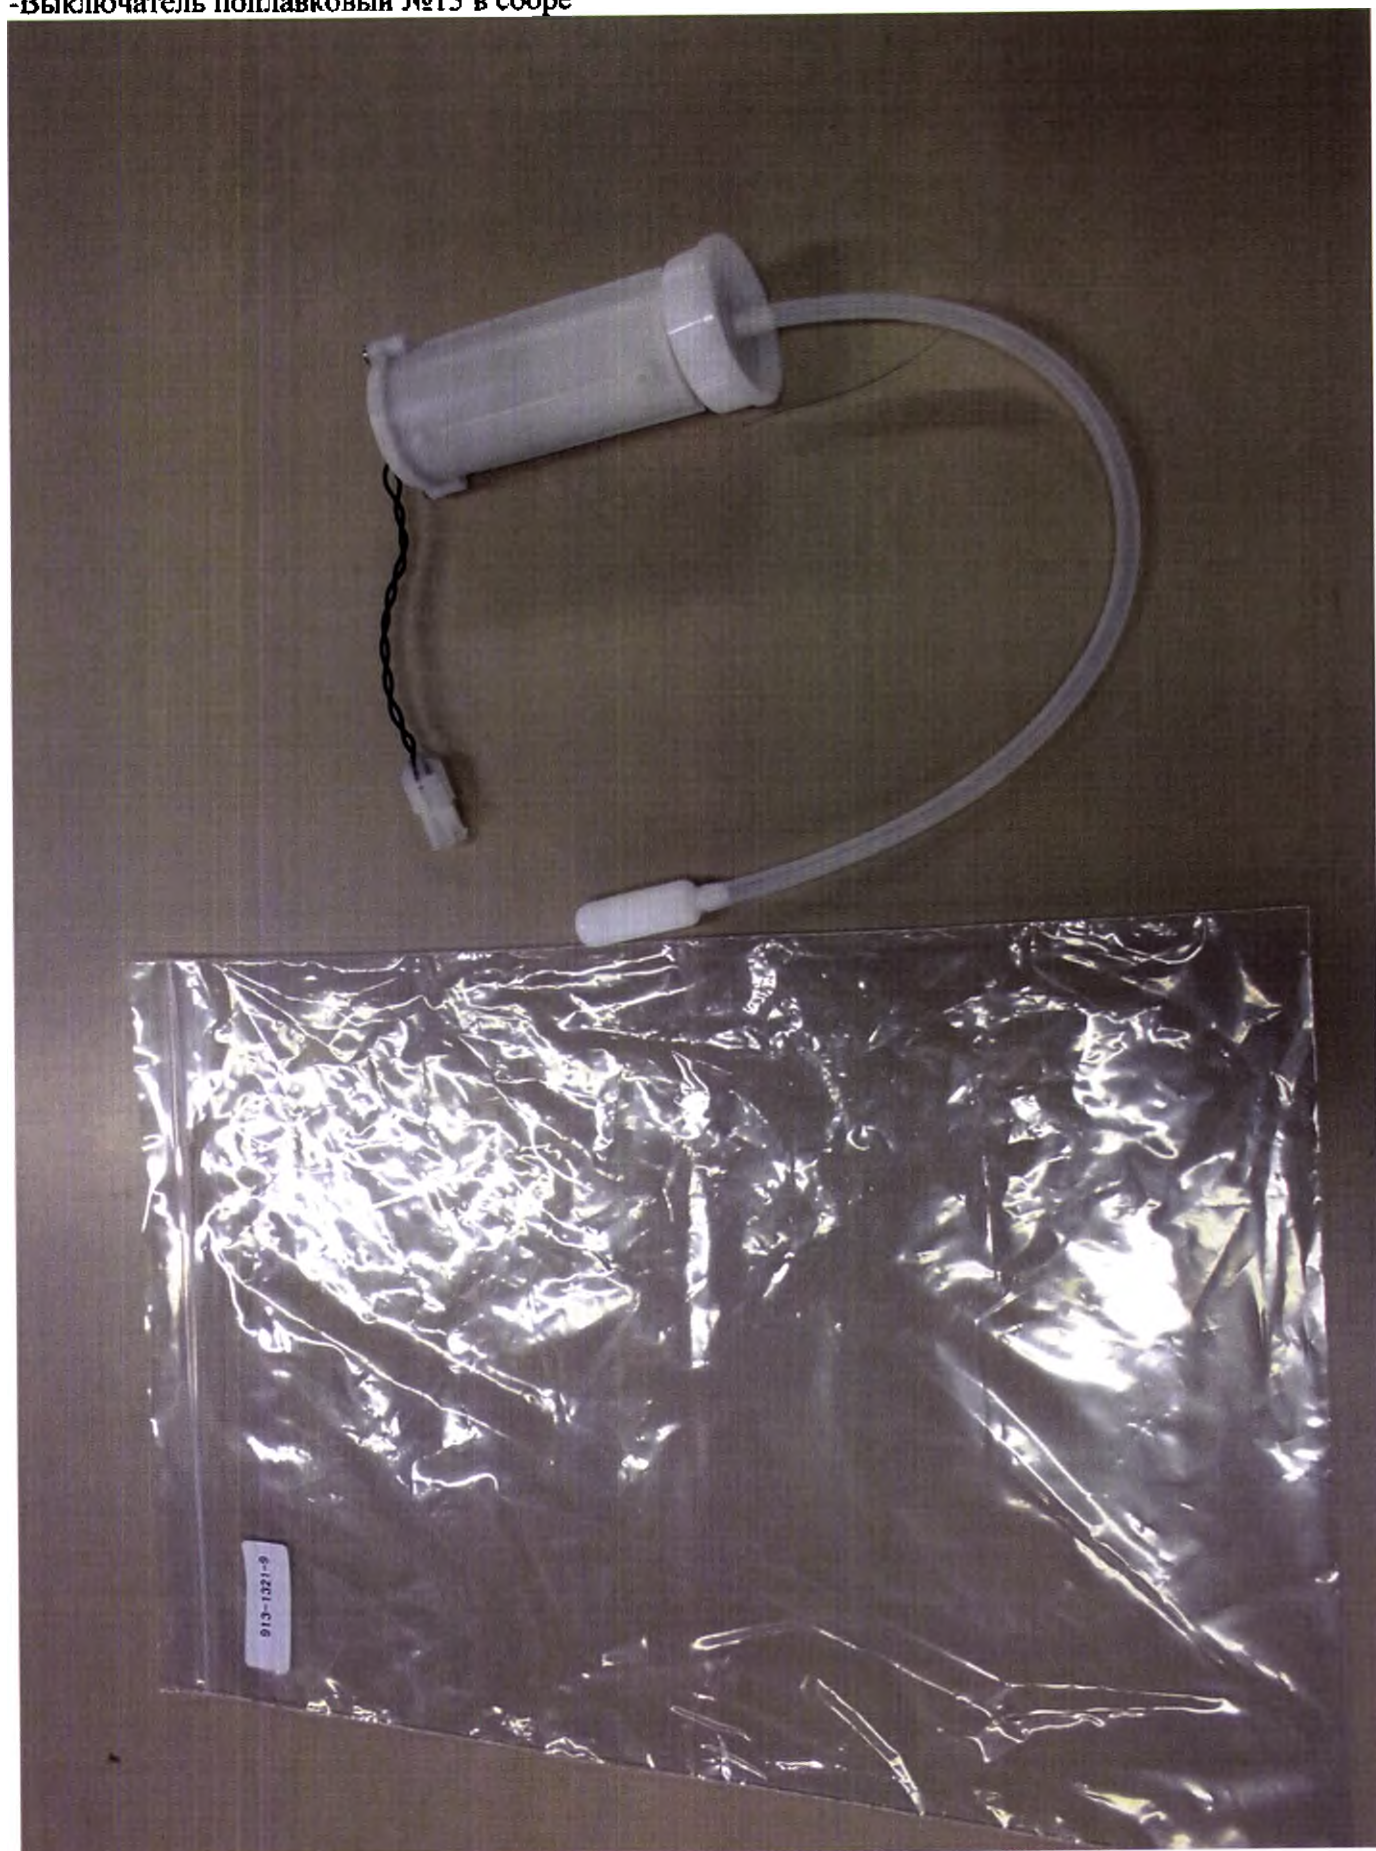

-Крышка №550 - 2 шт.



-Держатель №357 в сборе



-Бутыль № 31 в сборе, объем 2.1 л.



3. Программное обеспечение U-WAM.



IV. Принадлежности (опционные компоненты):

1. Штатив №287



2. Крепление №8280




3.Блок системный HP WIN7PRO EMBEDDED



4.Клавиатура 50SH PLUS (US)



5. Пневматический блок PU-17, основной комплект(220 – 240 В) (Белый) в составе с комплектующими:

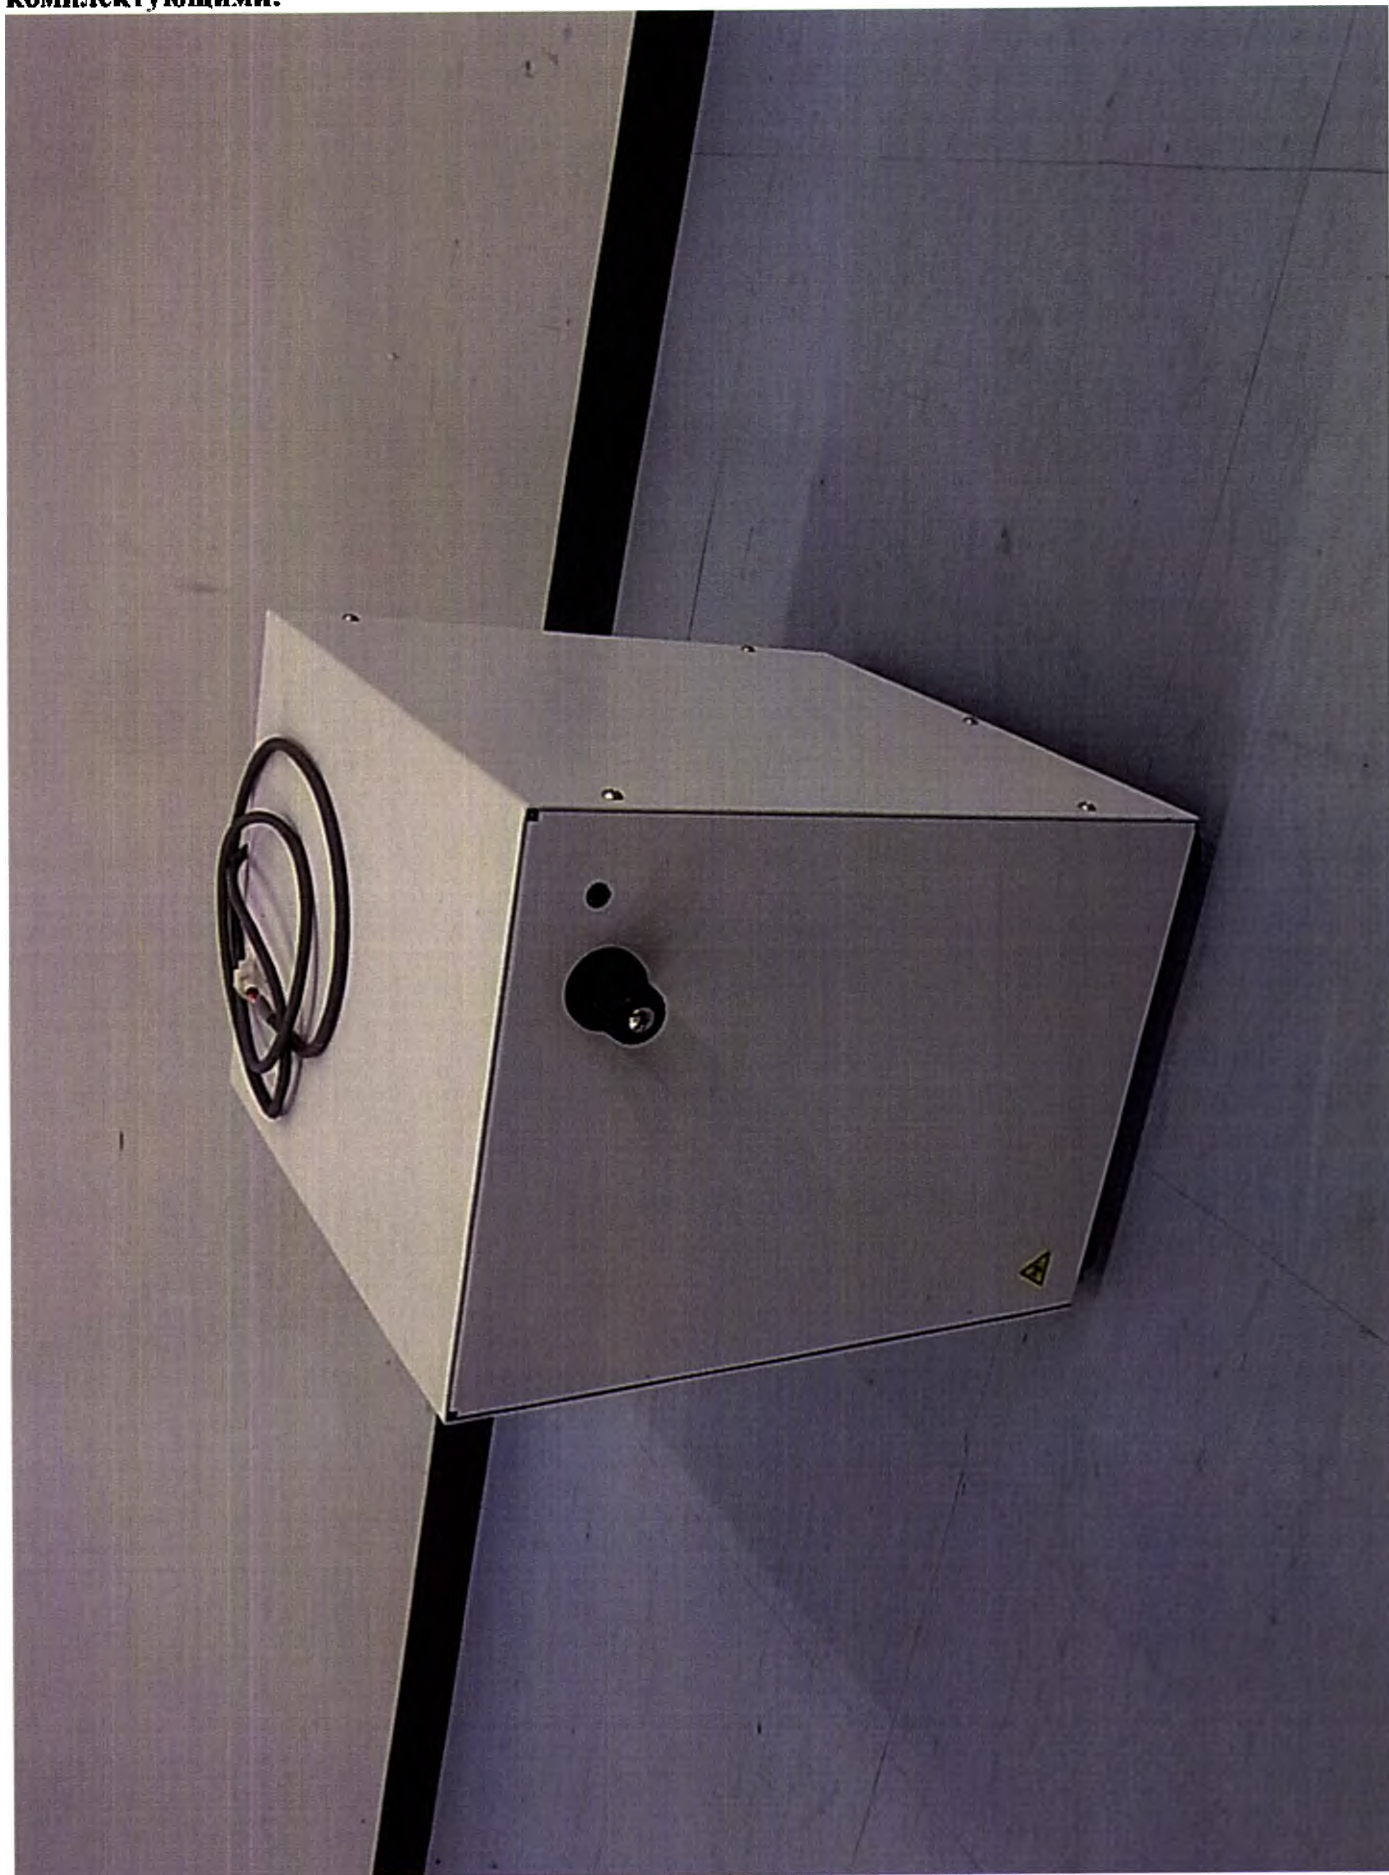

-Кабель электропитания TA-6P(A)+TA(A) H05VV-F



-Предохранитель 02183.15МХР (250 В3,15 А) - 2 шт.



6. Чашка для проб коническая, 4 мл., 1500 шт. в упаковке, не более 100 упаковок



7.Кожух защитный №4612




8.Кожух защитный №452




9.Считыватель штрих-кодов №431 в составе:




- Считыватель штрих-кодов в сборе №47 (1)

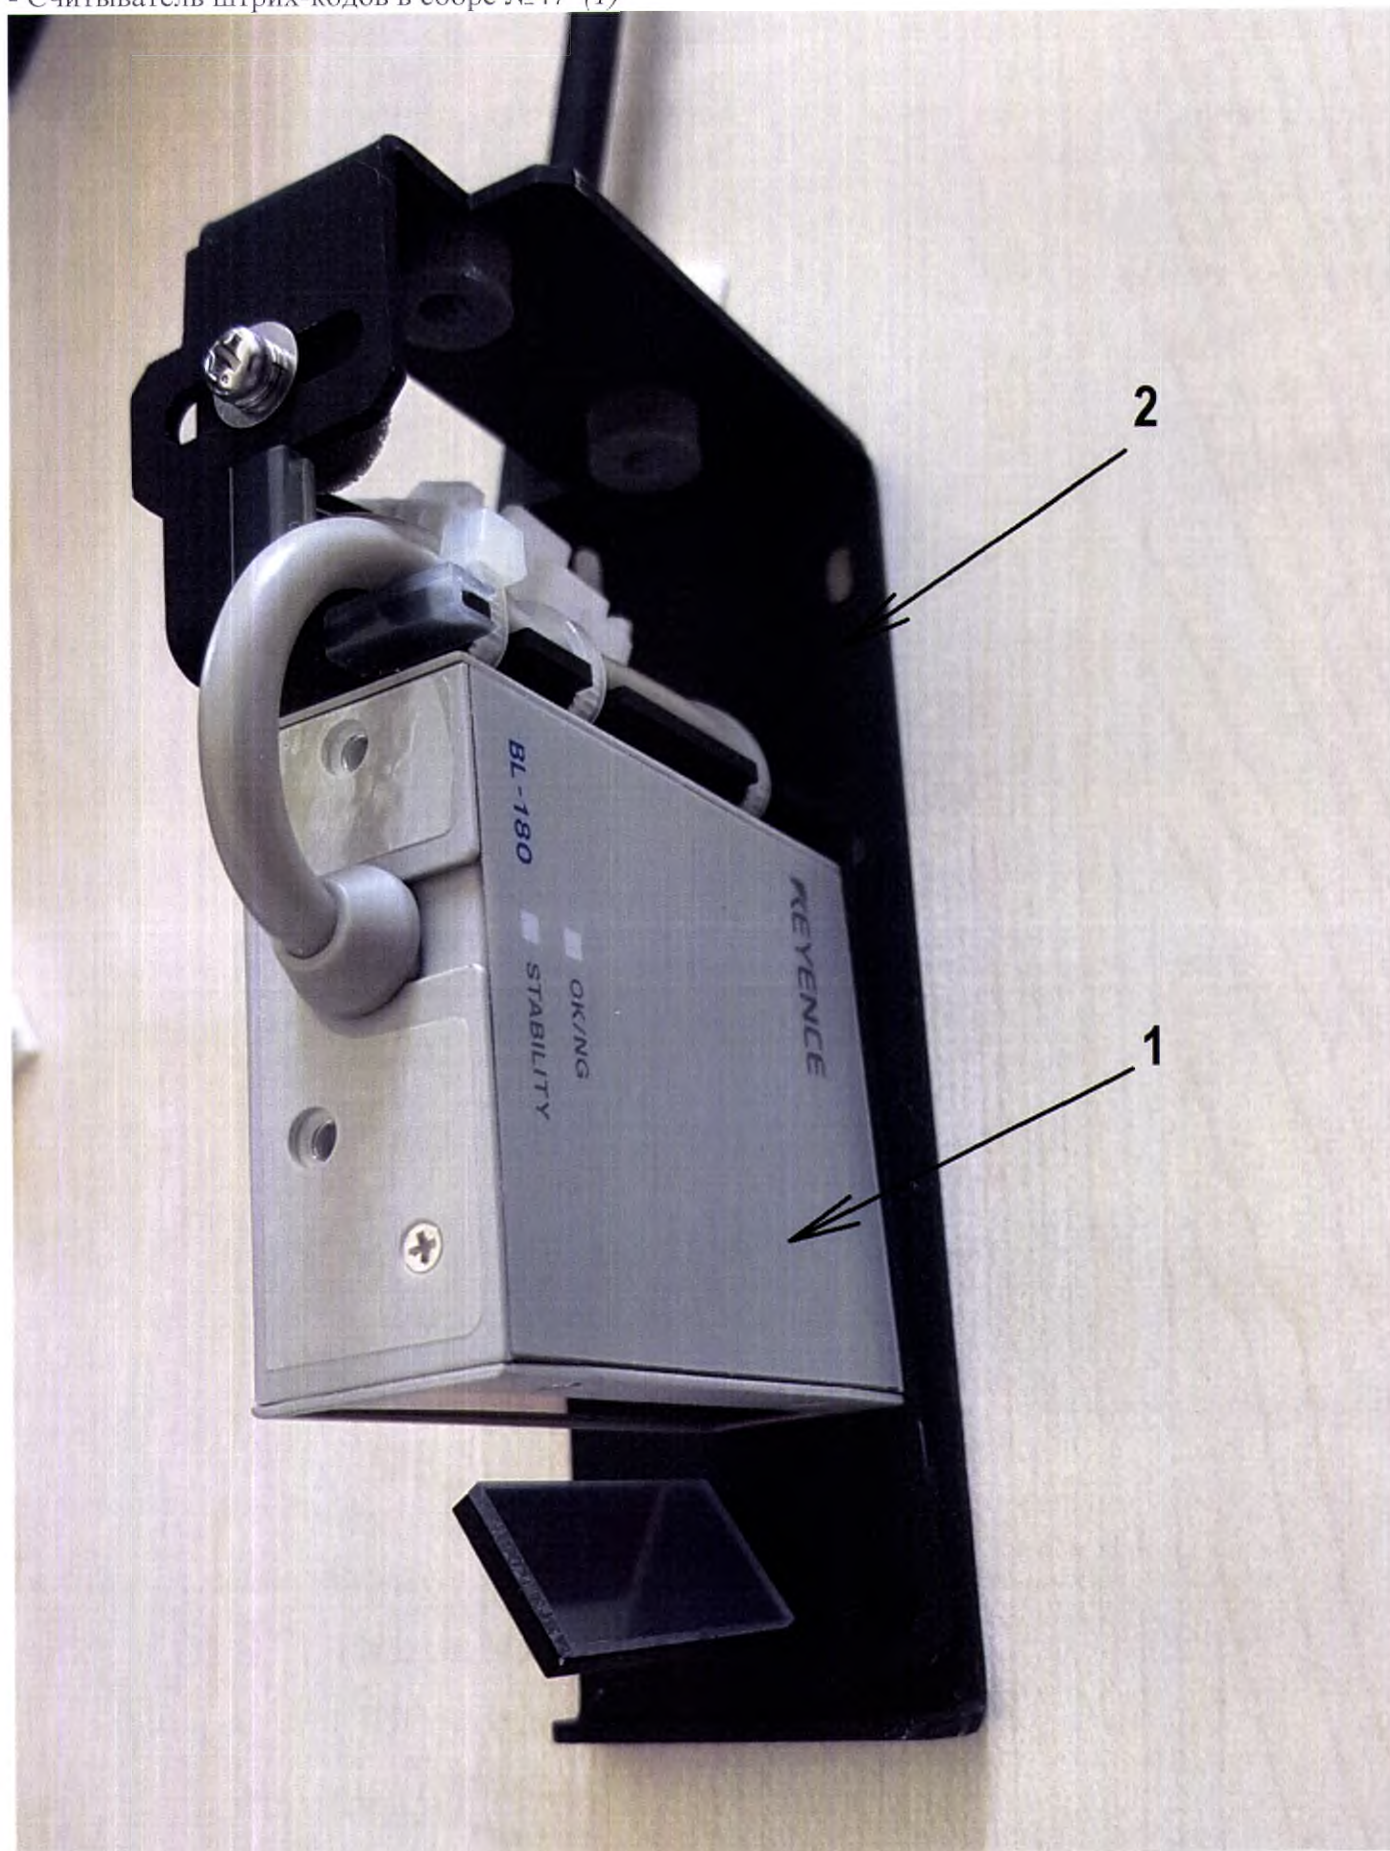

- Держатель в сборе №380 (2)

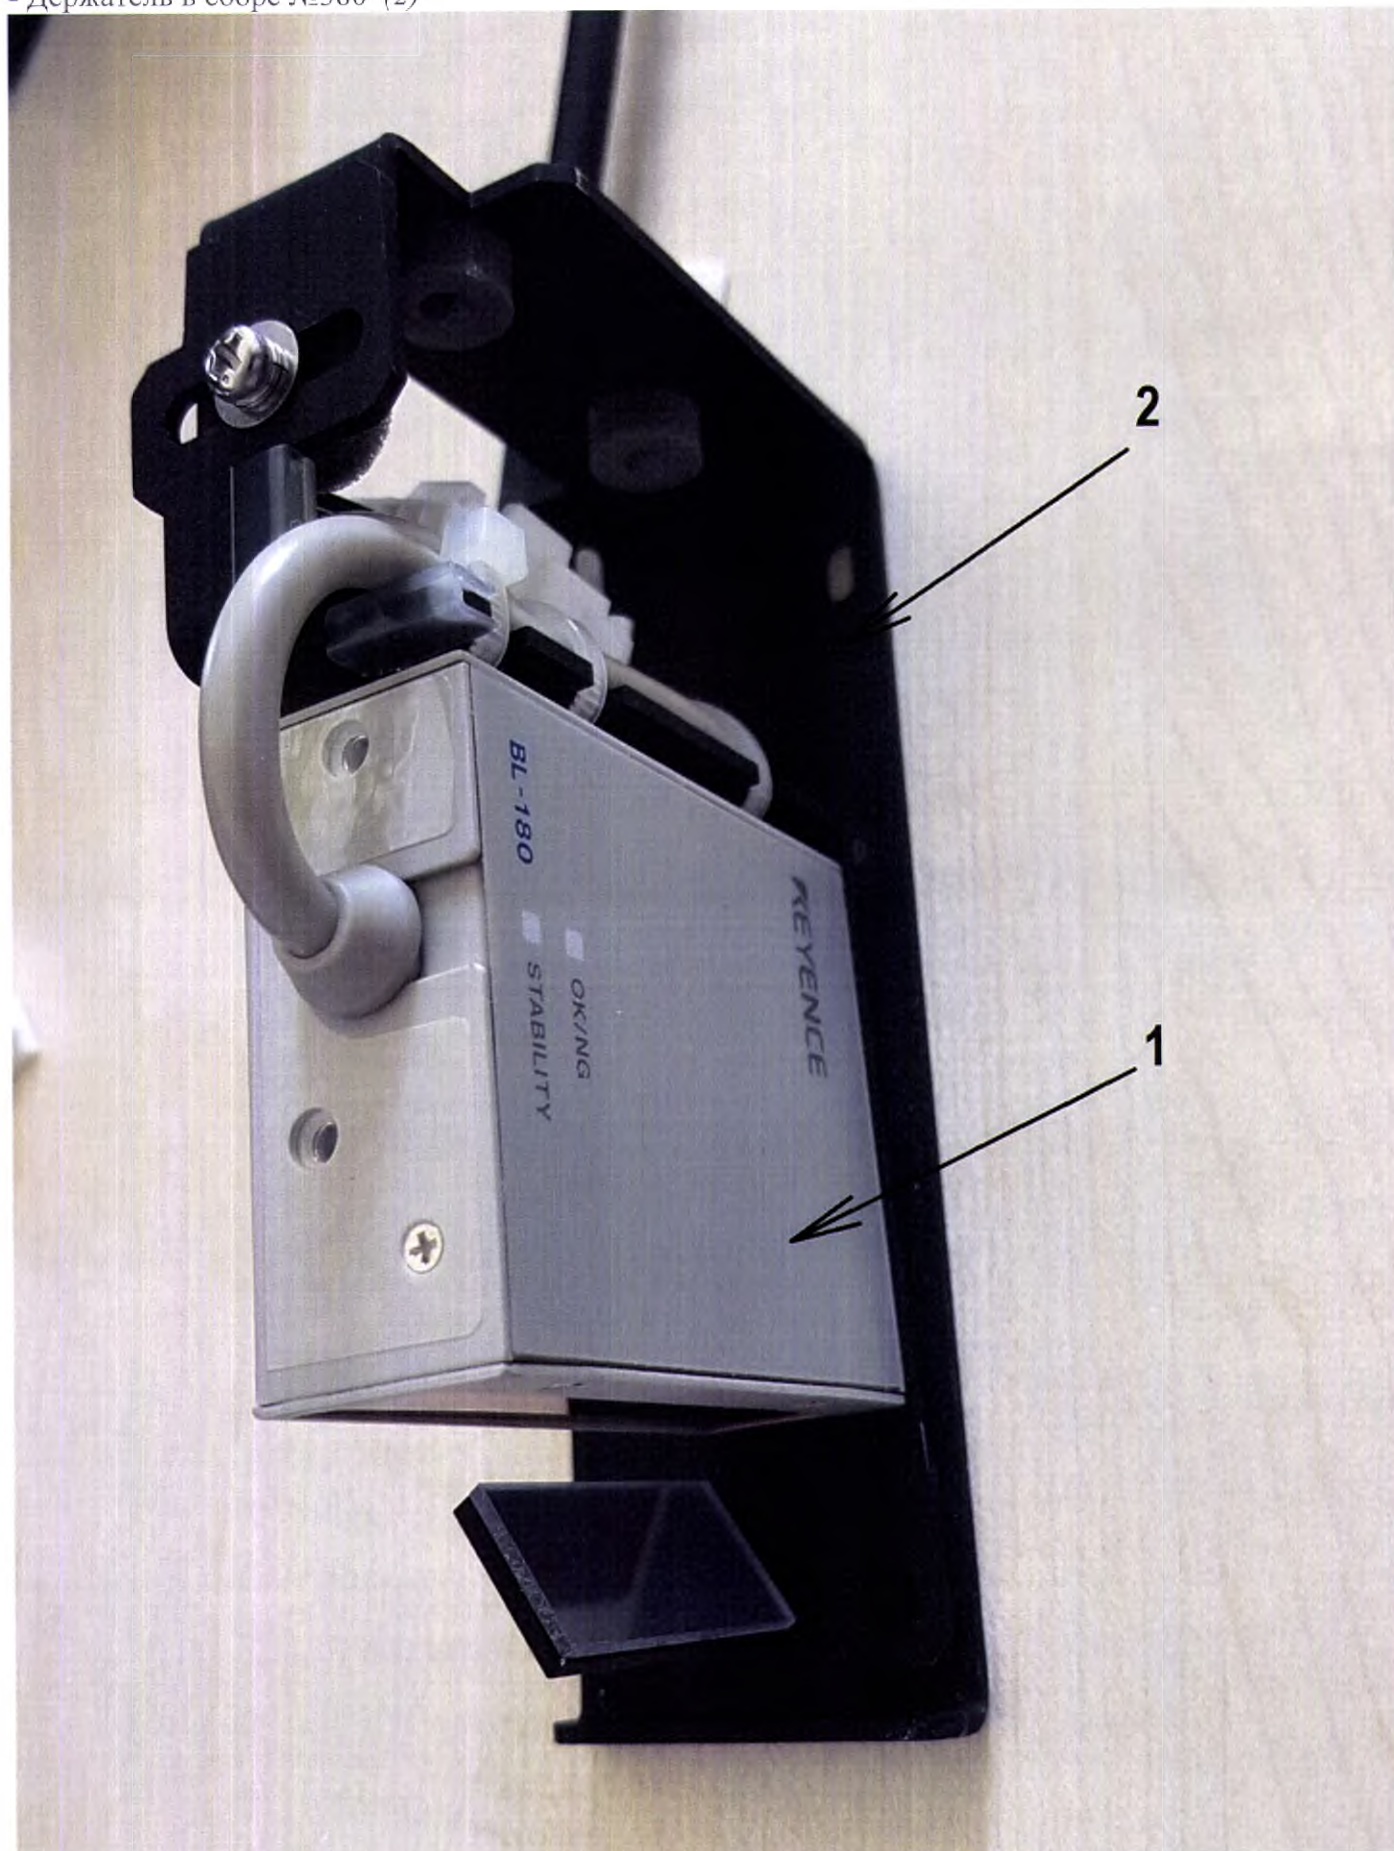

- Крышка №4795 (1)

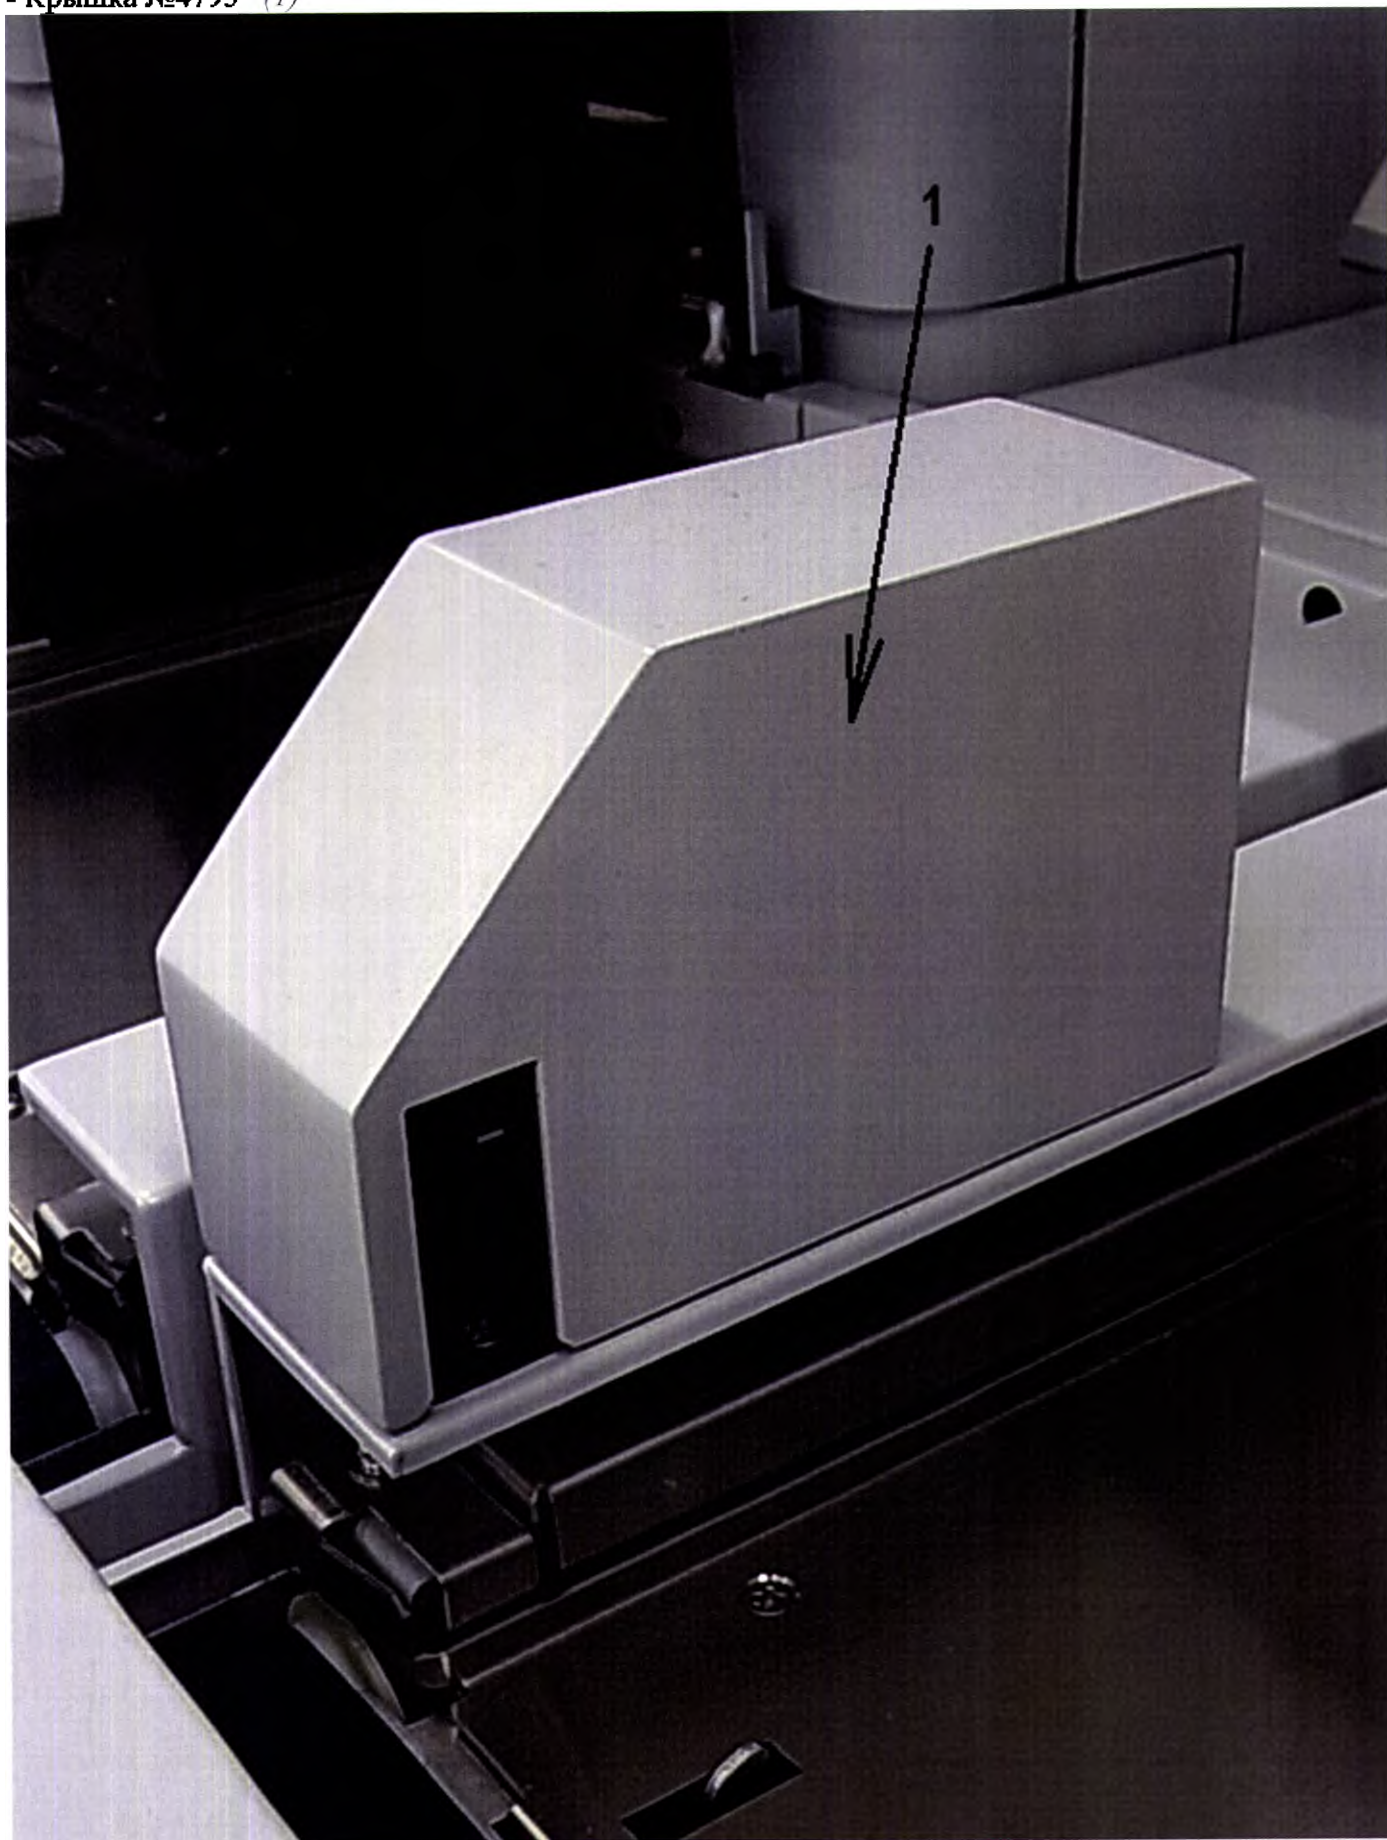

- Кабель электропитания в сборе №9563




-Стяжка для кабеля CV-100, не более 6 шт.



-Винт плоский М3х6

348-4100-1

- Винт крепежный с шайбой (для тонкого листа толщиной 0,5), М3 х6 – 4 шт

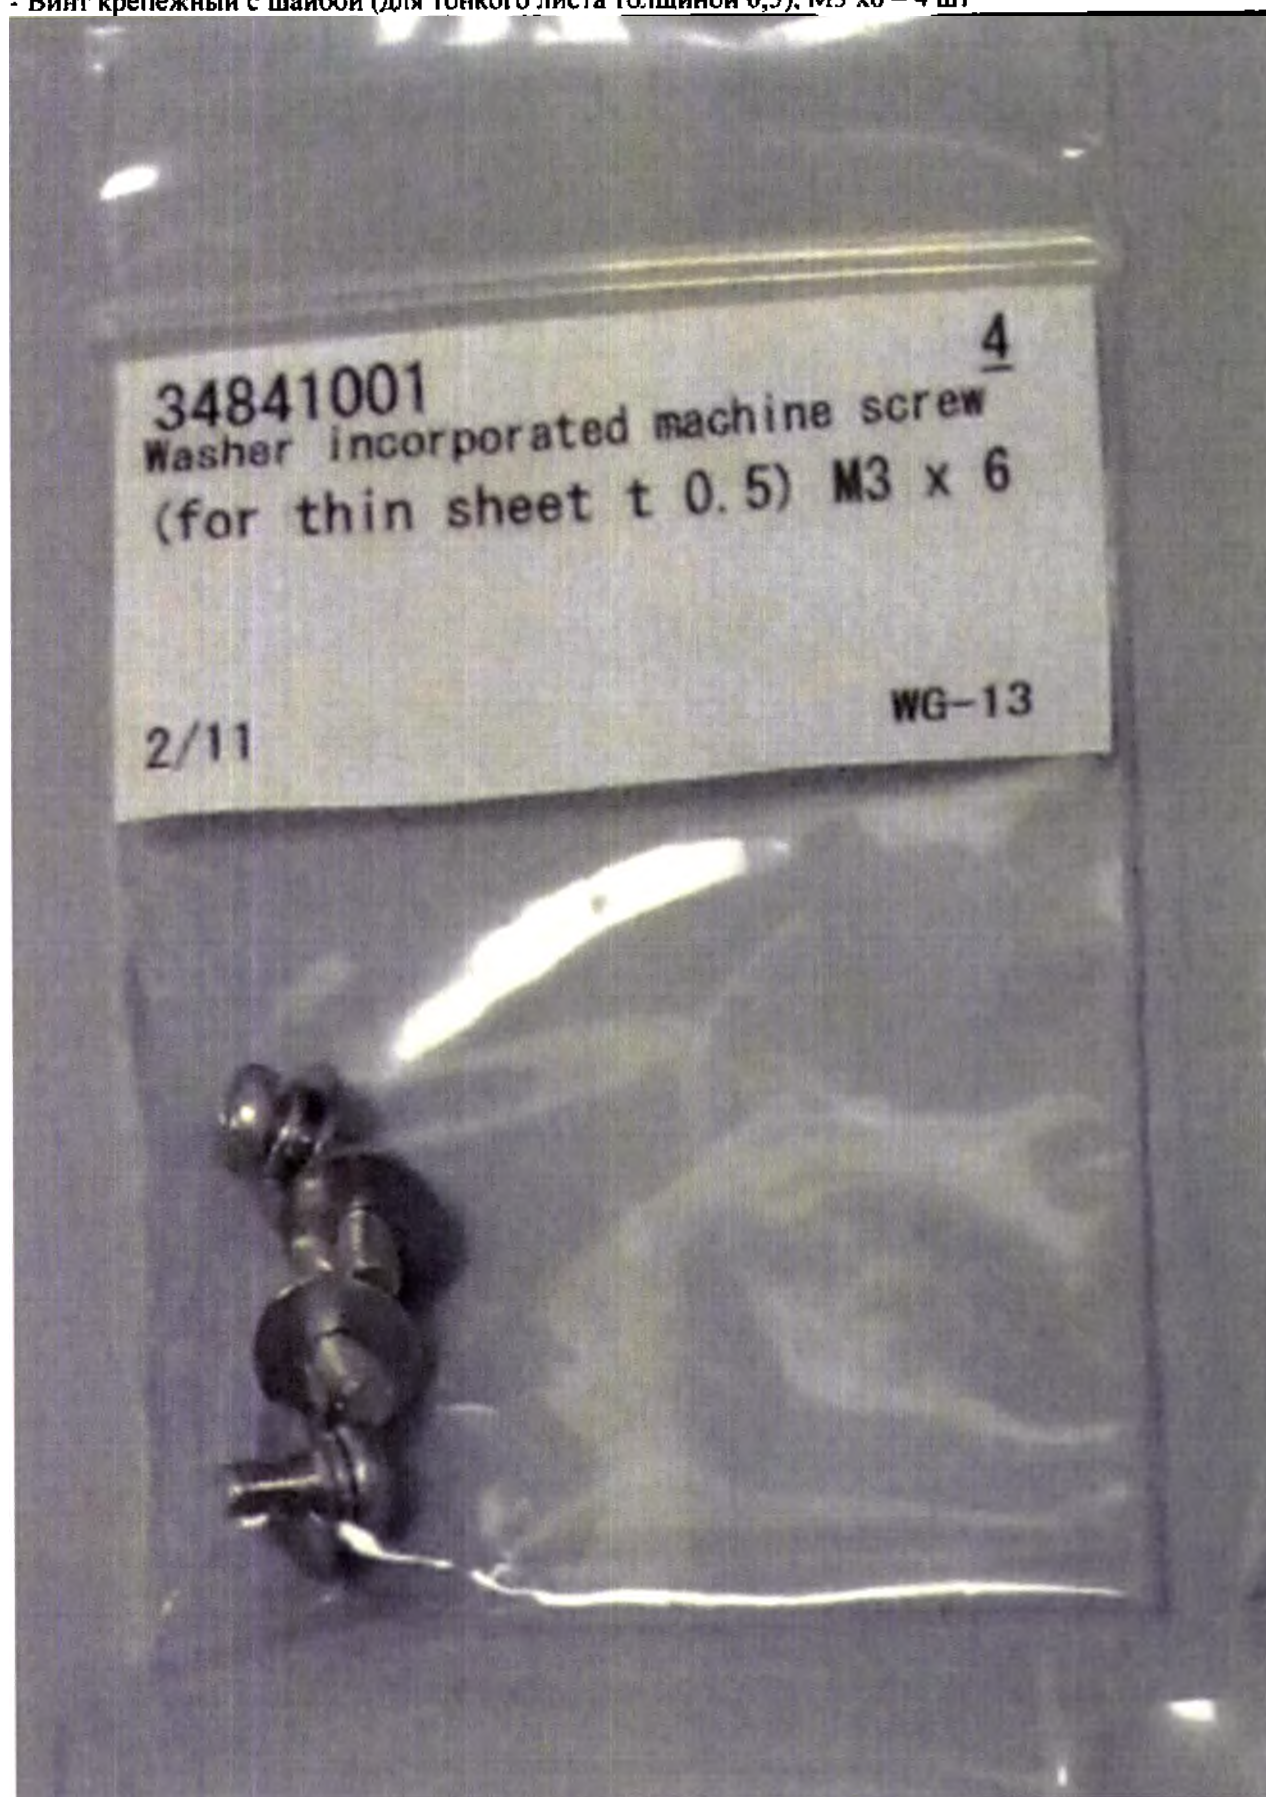


10. Тележка WG-13 в составе с комплектующими:
-Тележка WG-13



-Основание №472 – 3 шт.



-Держатель №3028 – 2 шт.

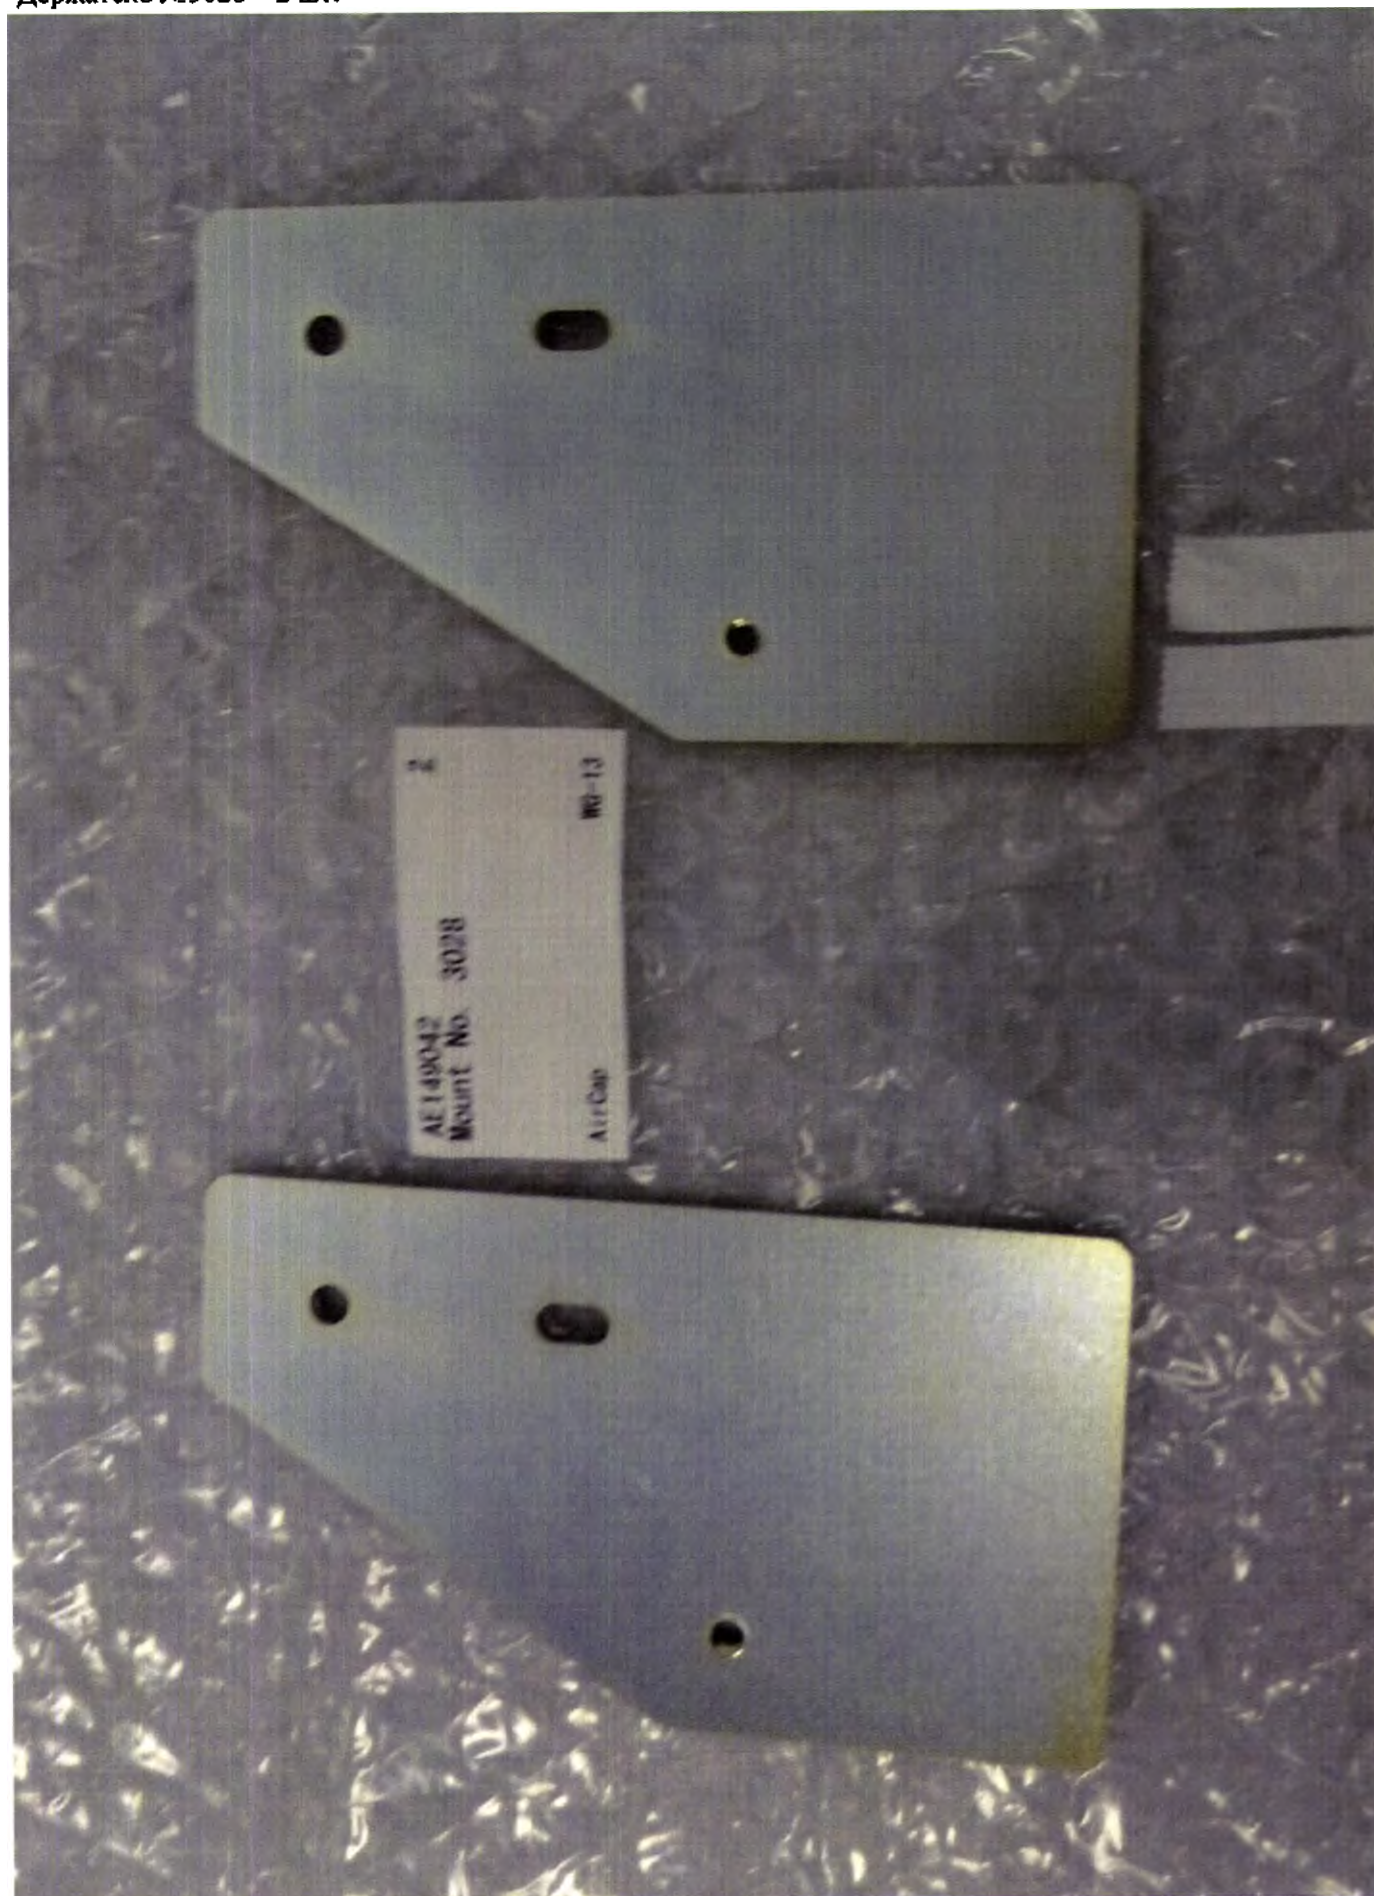

-Держатель №3802



-Держатель №8469 – 2 шт.

CG848670
Mount No. 8469

2

AirCap

WG-13

- Держатель №8471




-Держатель №8472



- Держатель №8473 – 2 шт.



-Трубопровод №218 – 3 шт.

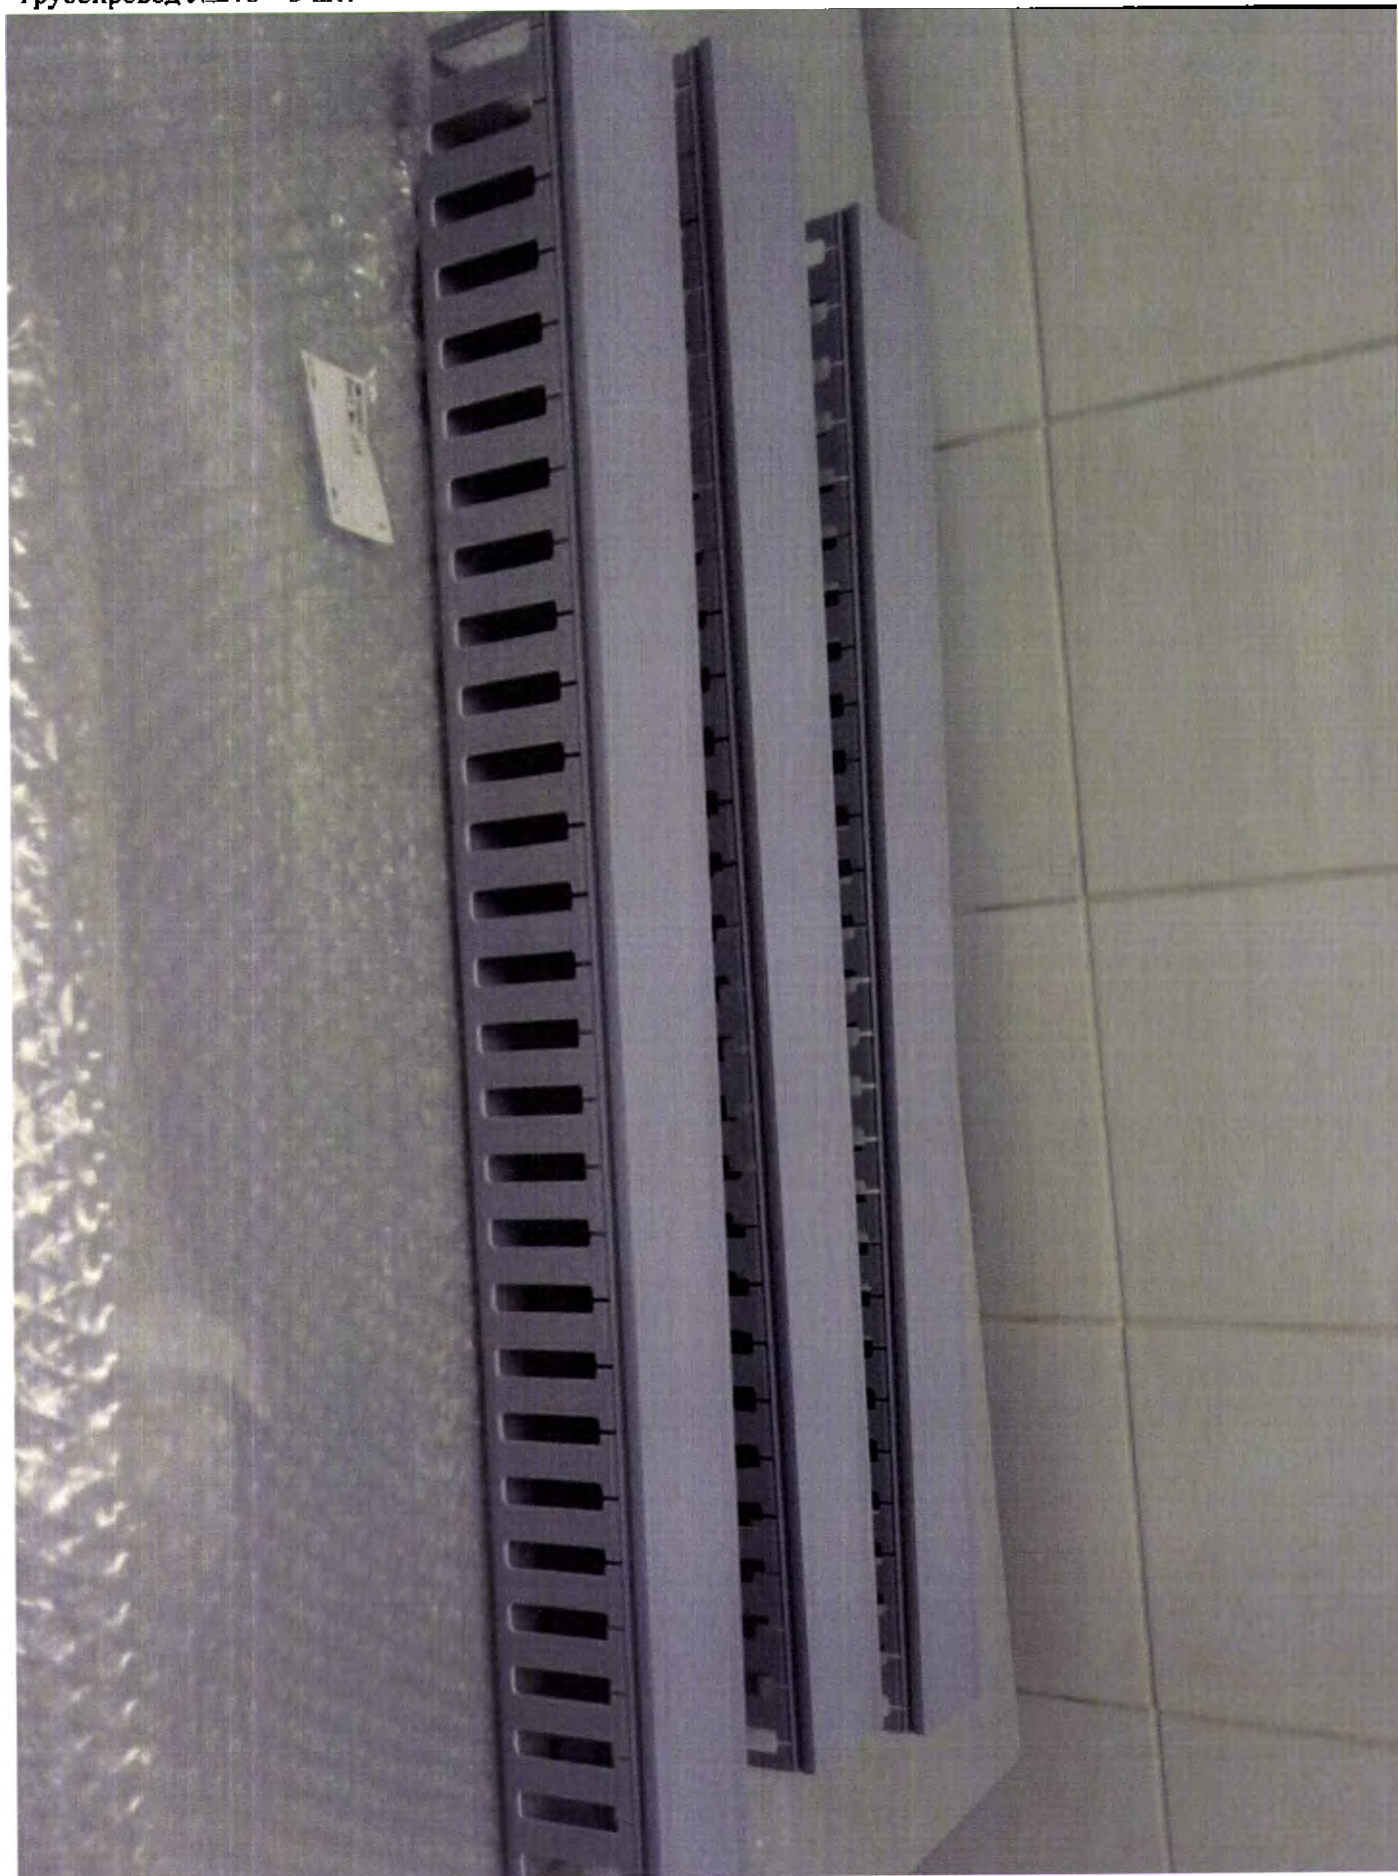

-Крышка №4430




Одноразовые халаты

Желтые пакеты


-Крышка №4434



-Пластина №1339

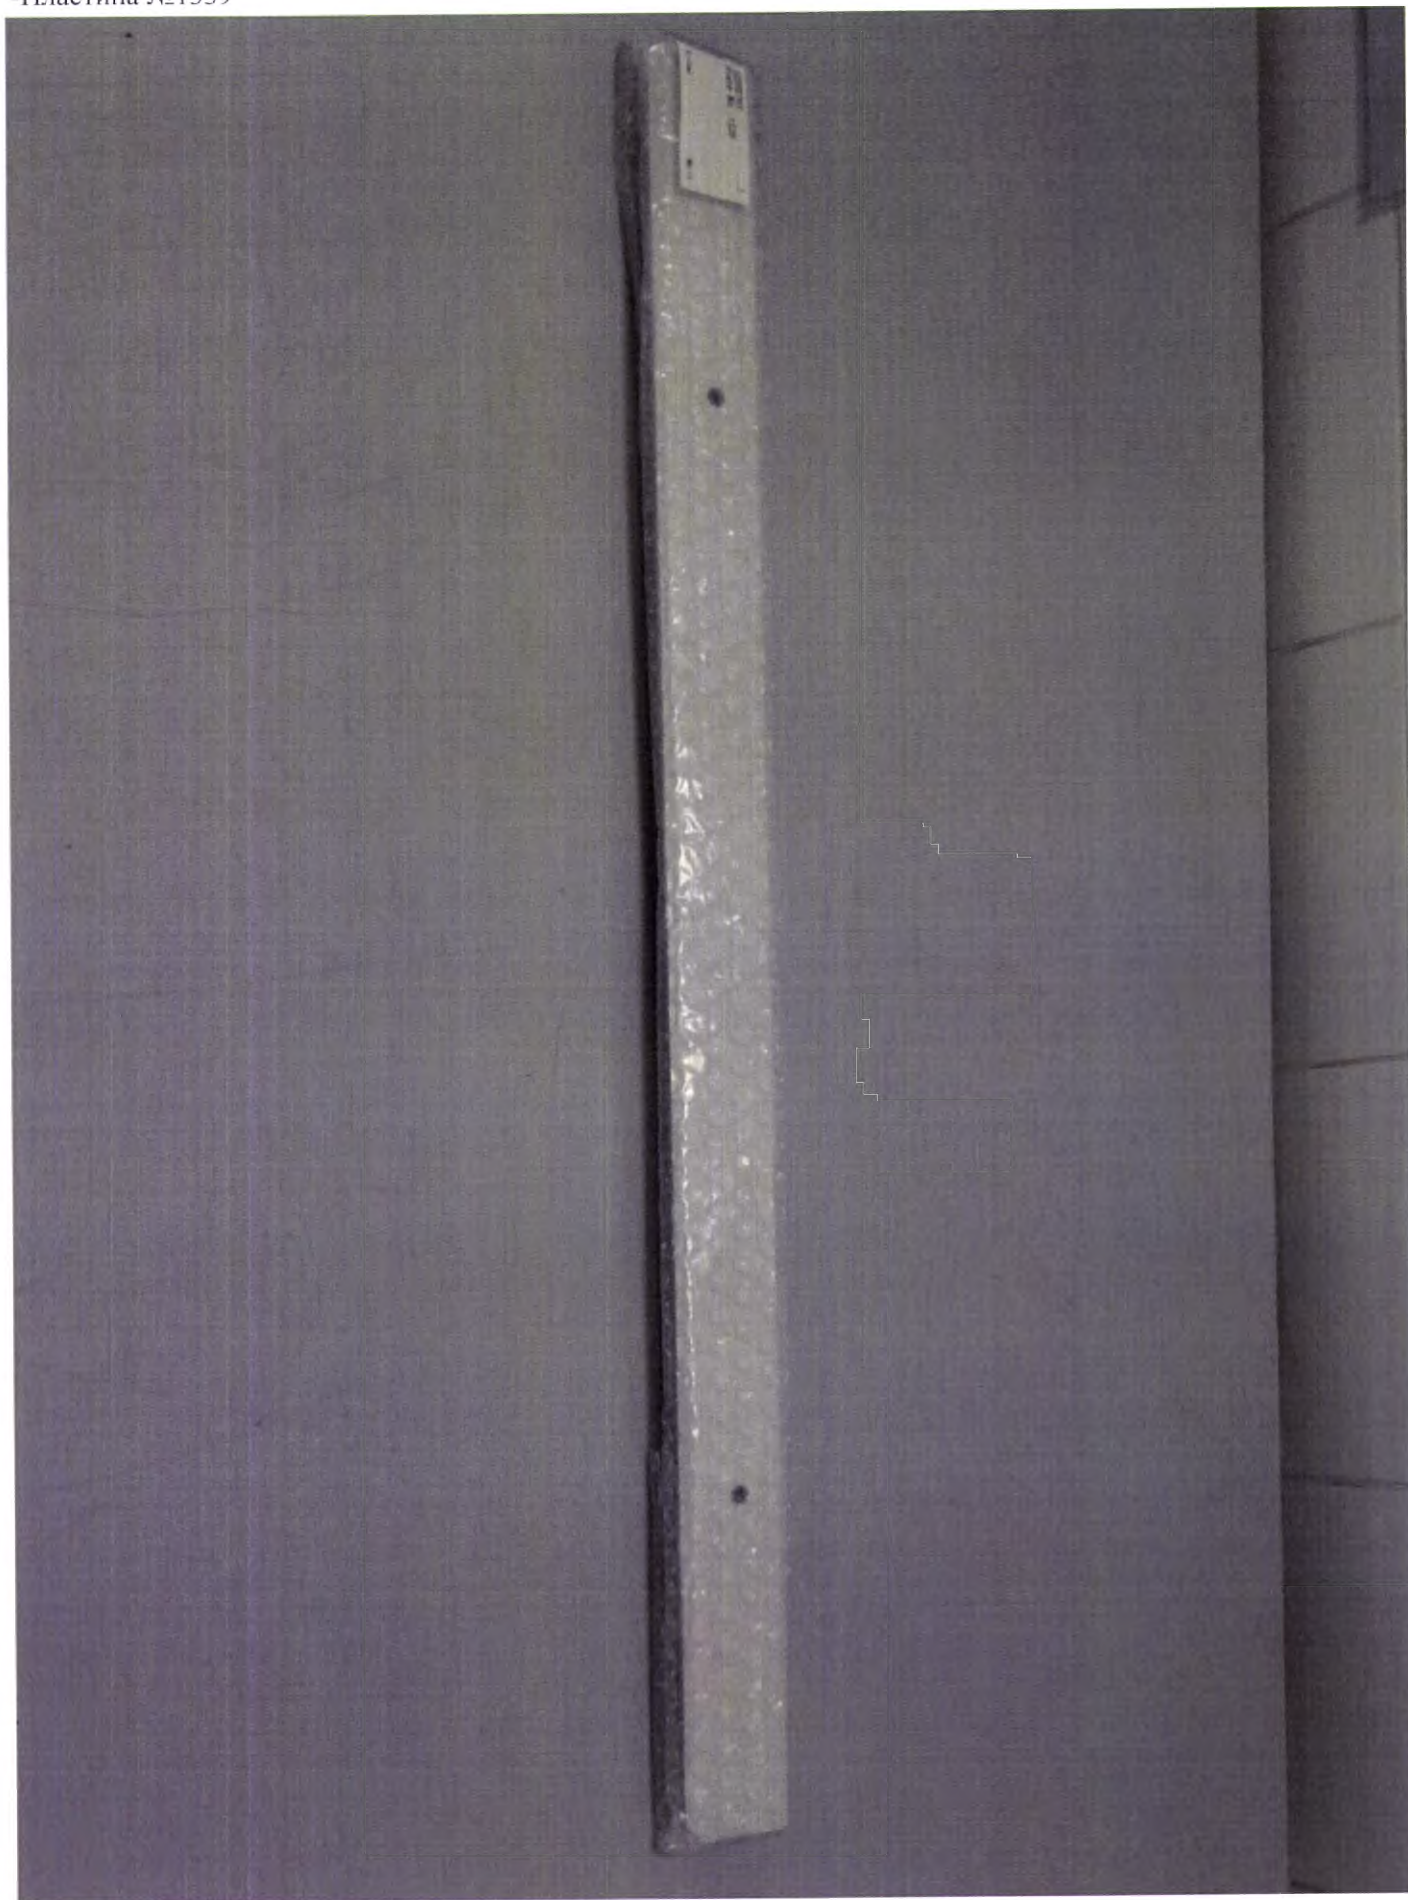

- Крепежный винт с шайбой (для тонкого листа 0,5) М3 х 6 – 4 шт.

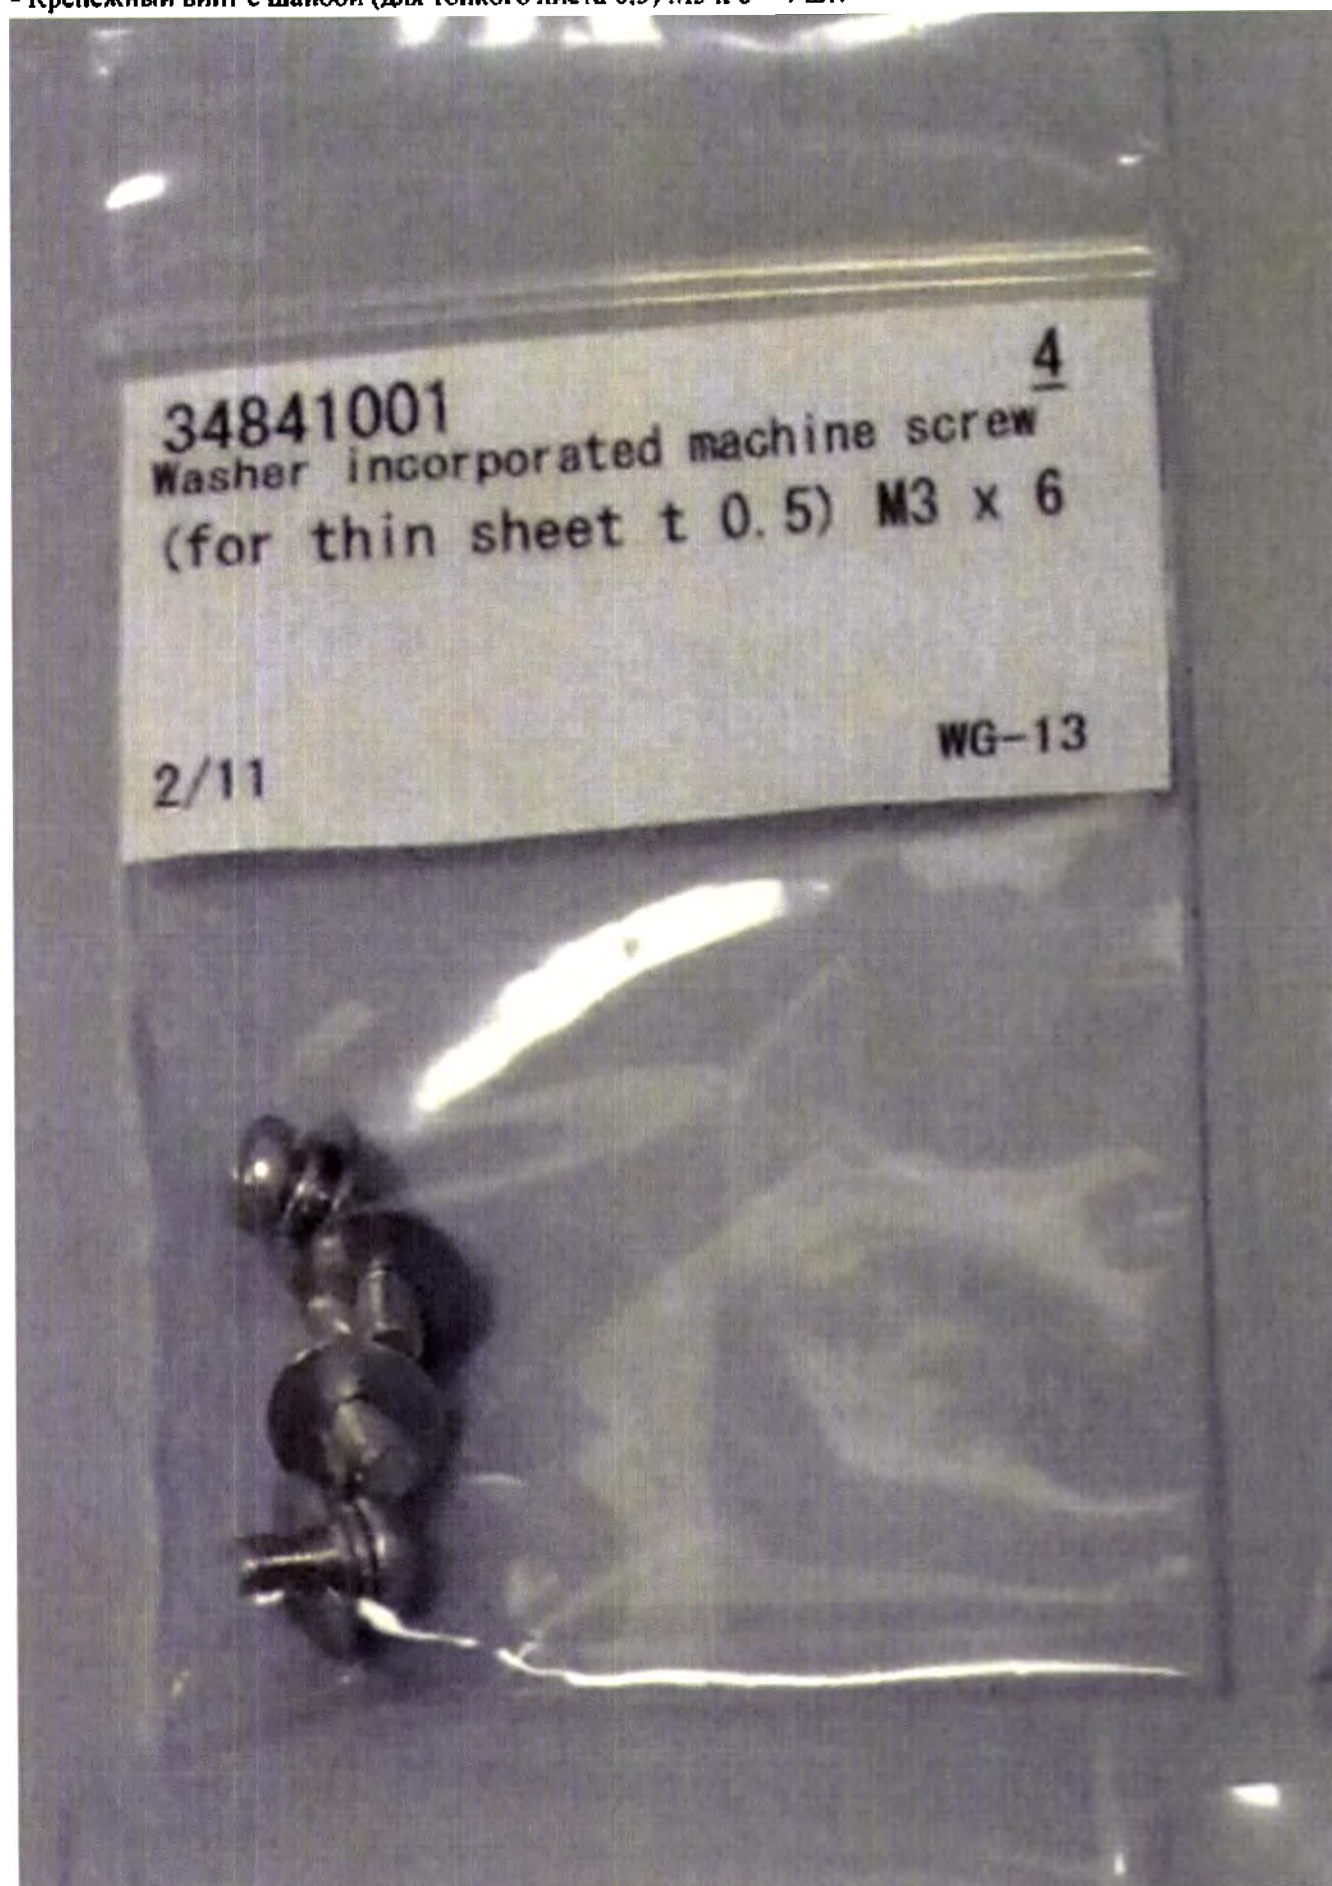

- Крепежный винт с шайбой (для тонкого листа 0,8) M4 x 8 – 36 шт.



34841081

36

Washer incorporated machine screw
(for thin sheet t 0.8) M4 x 8

3/11

WG-13

-Крепежный винт с шайбой (для тонкого листа 0,8) М4 х 10 – 6 шт.



-Крепежный винт с шайбой (для тонкого листа 0,8) М4 х 12 – 4 шт.




-Винт с шестигранной головкой М4 х 12 – 3 шт.




-Винт с шестигранной головкой М6 х 30 – 3 шт.



-Шайба квадратная, номинальный диаметр 6 – 3 шт.

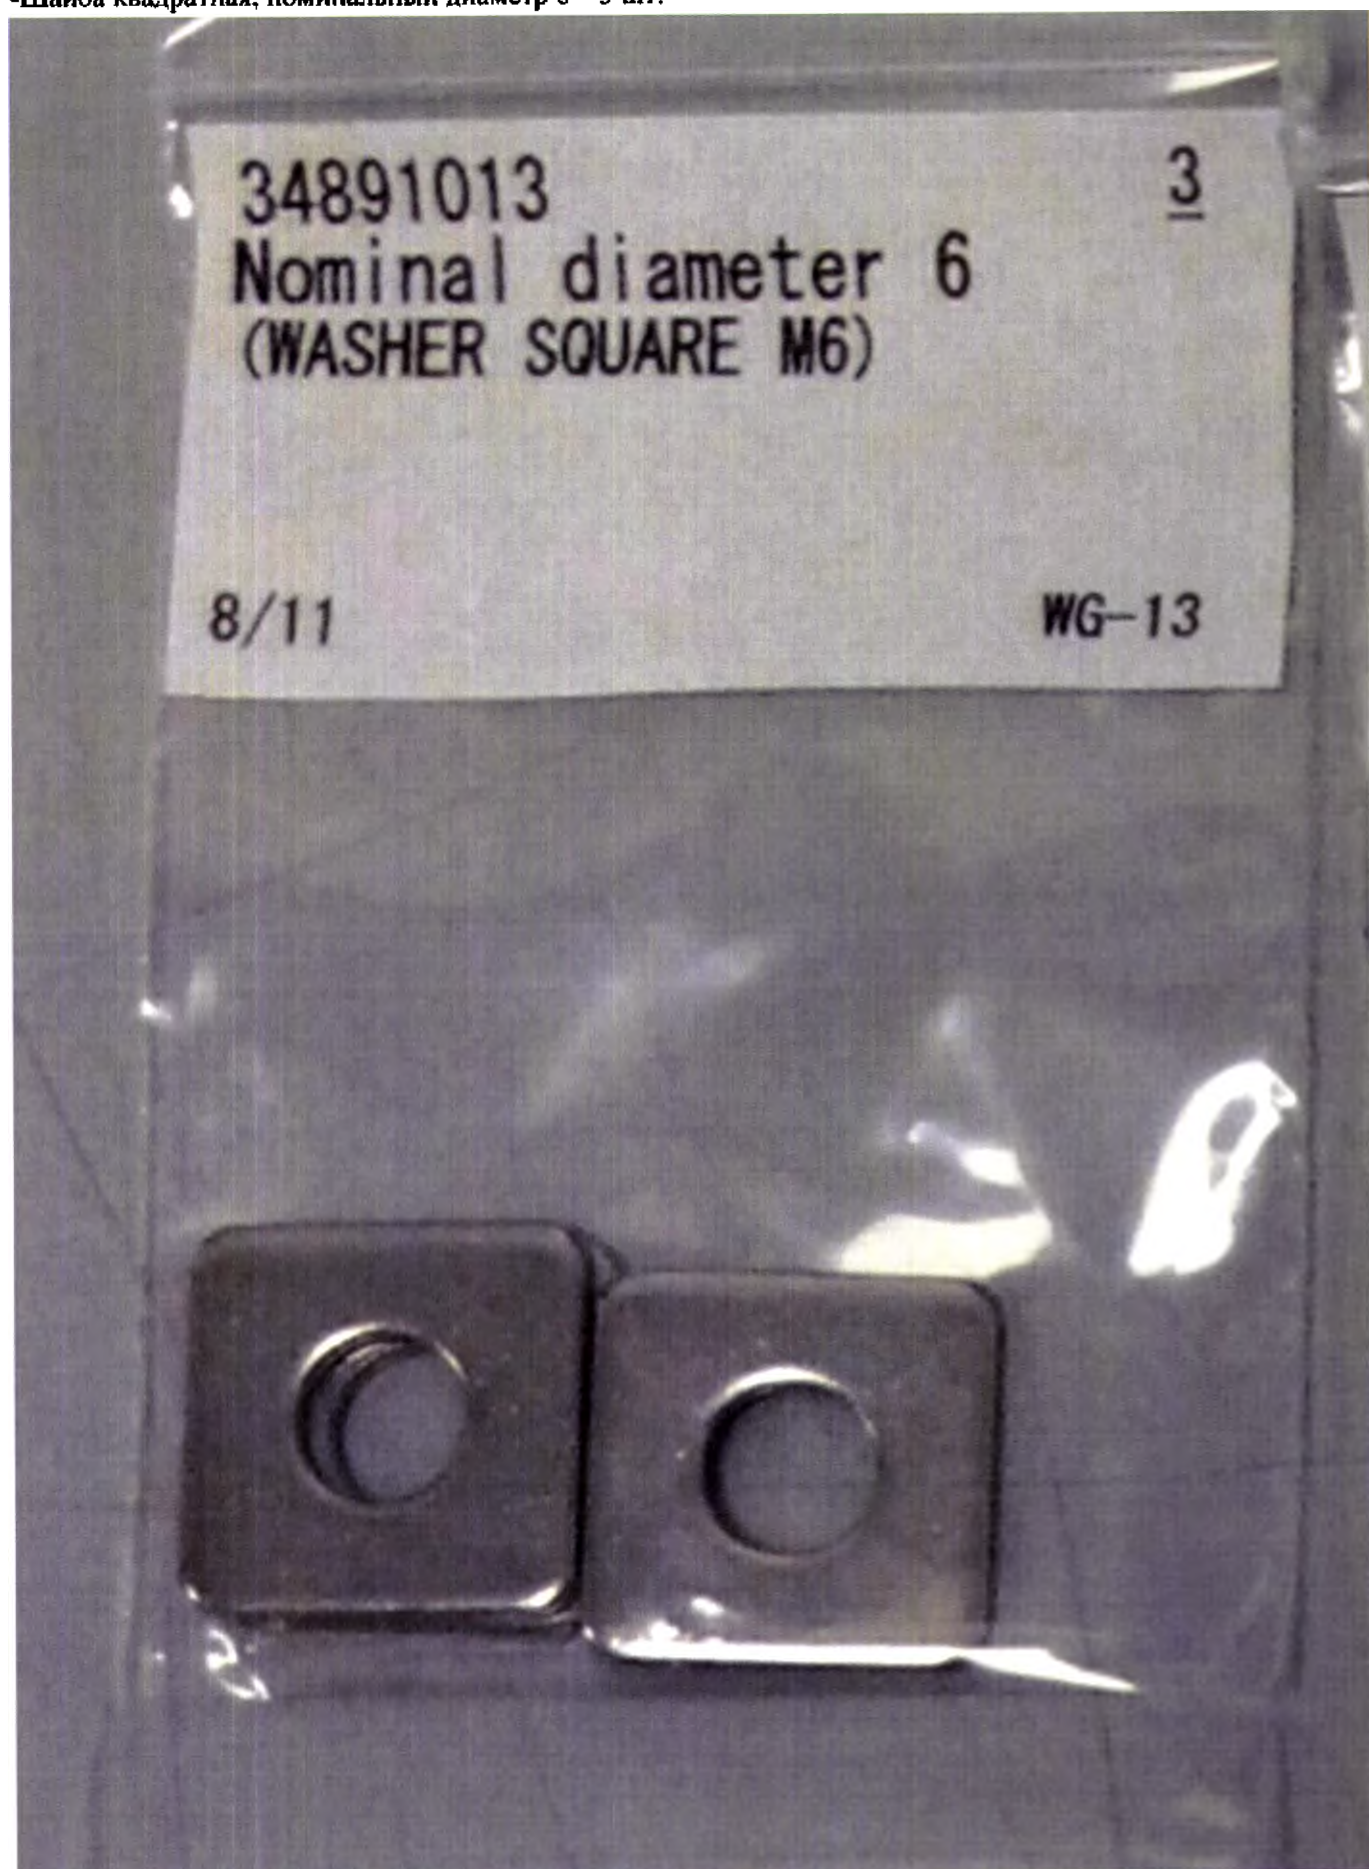

-Шайба плоская, номинальный диаметр 4 – 3 шт.

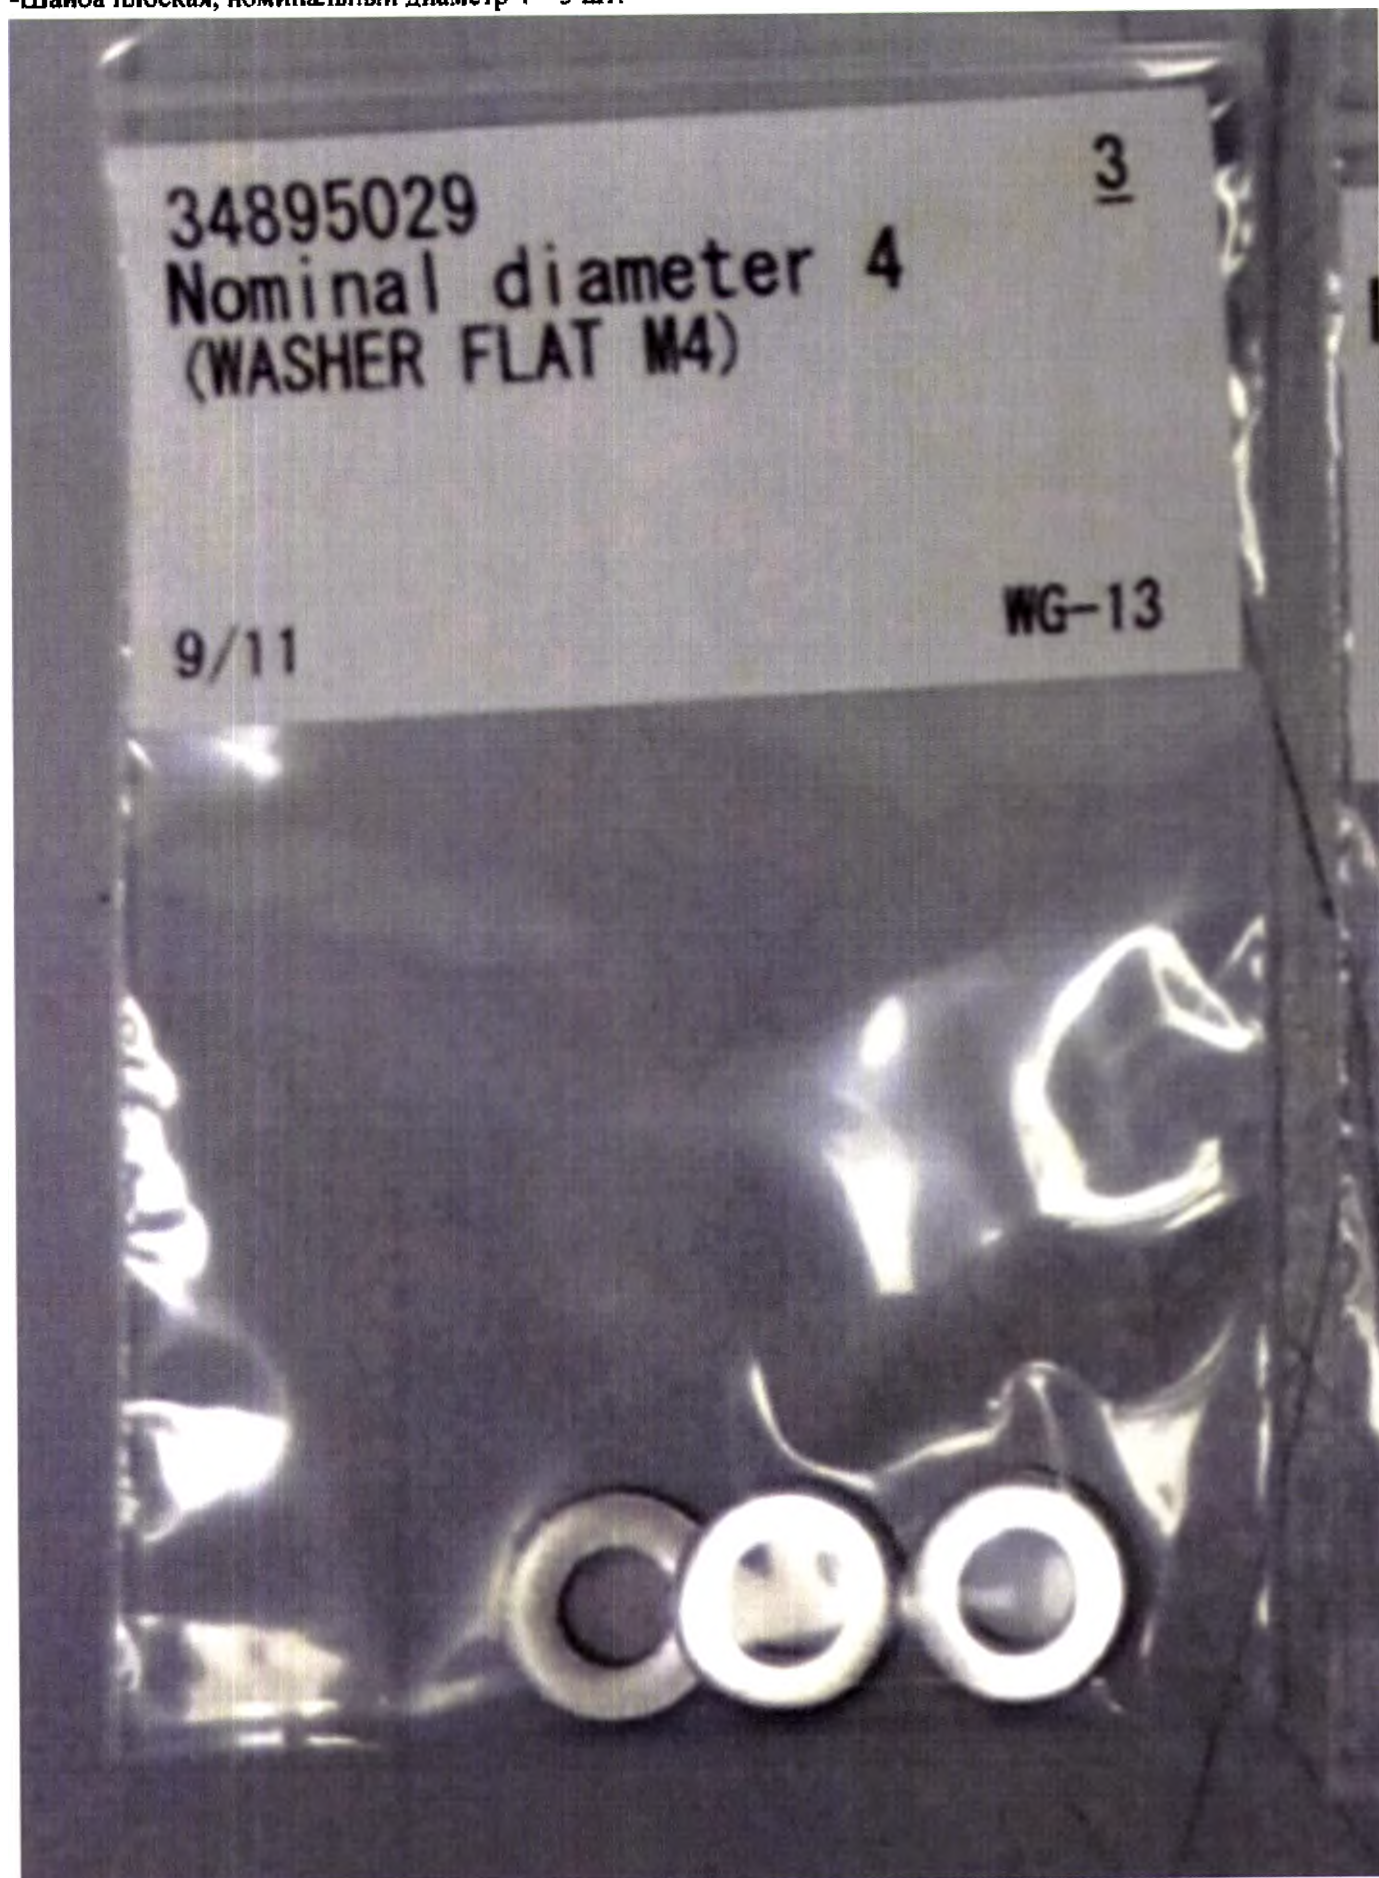

-Шайба пружинная, Номинальный диаметр 4



- Шайба, номинальный диаметр 6 – 3 шт.

34895161

3


Nominal diameter 6
(WASHER SPRING M6)


11/11

WG-13




- Держатель №2795

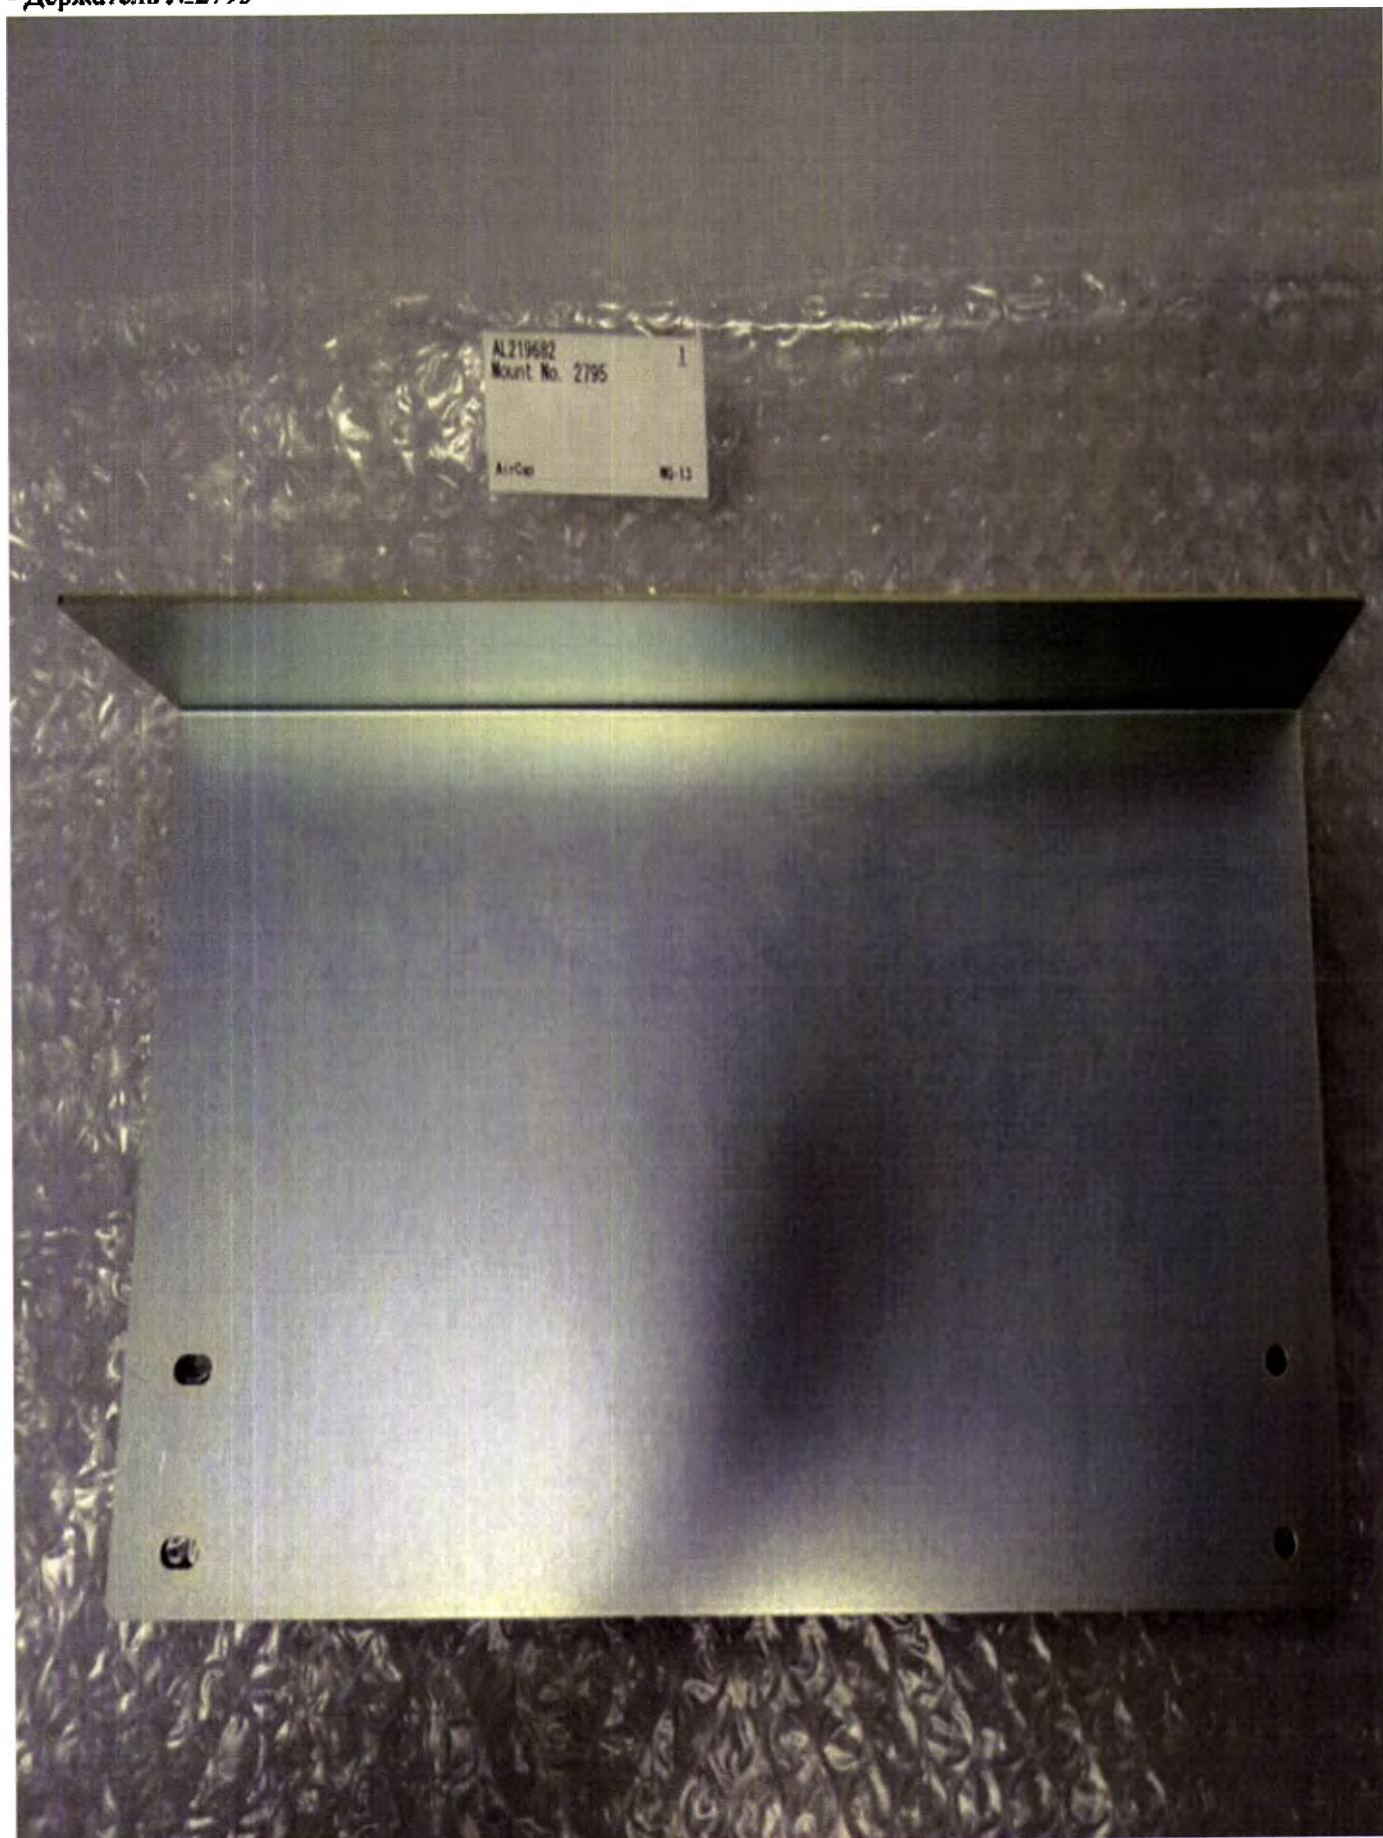


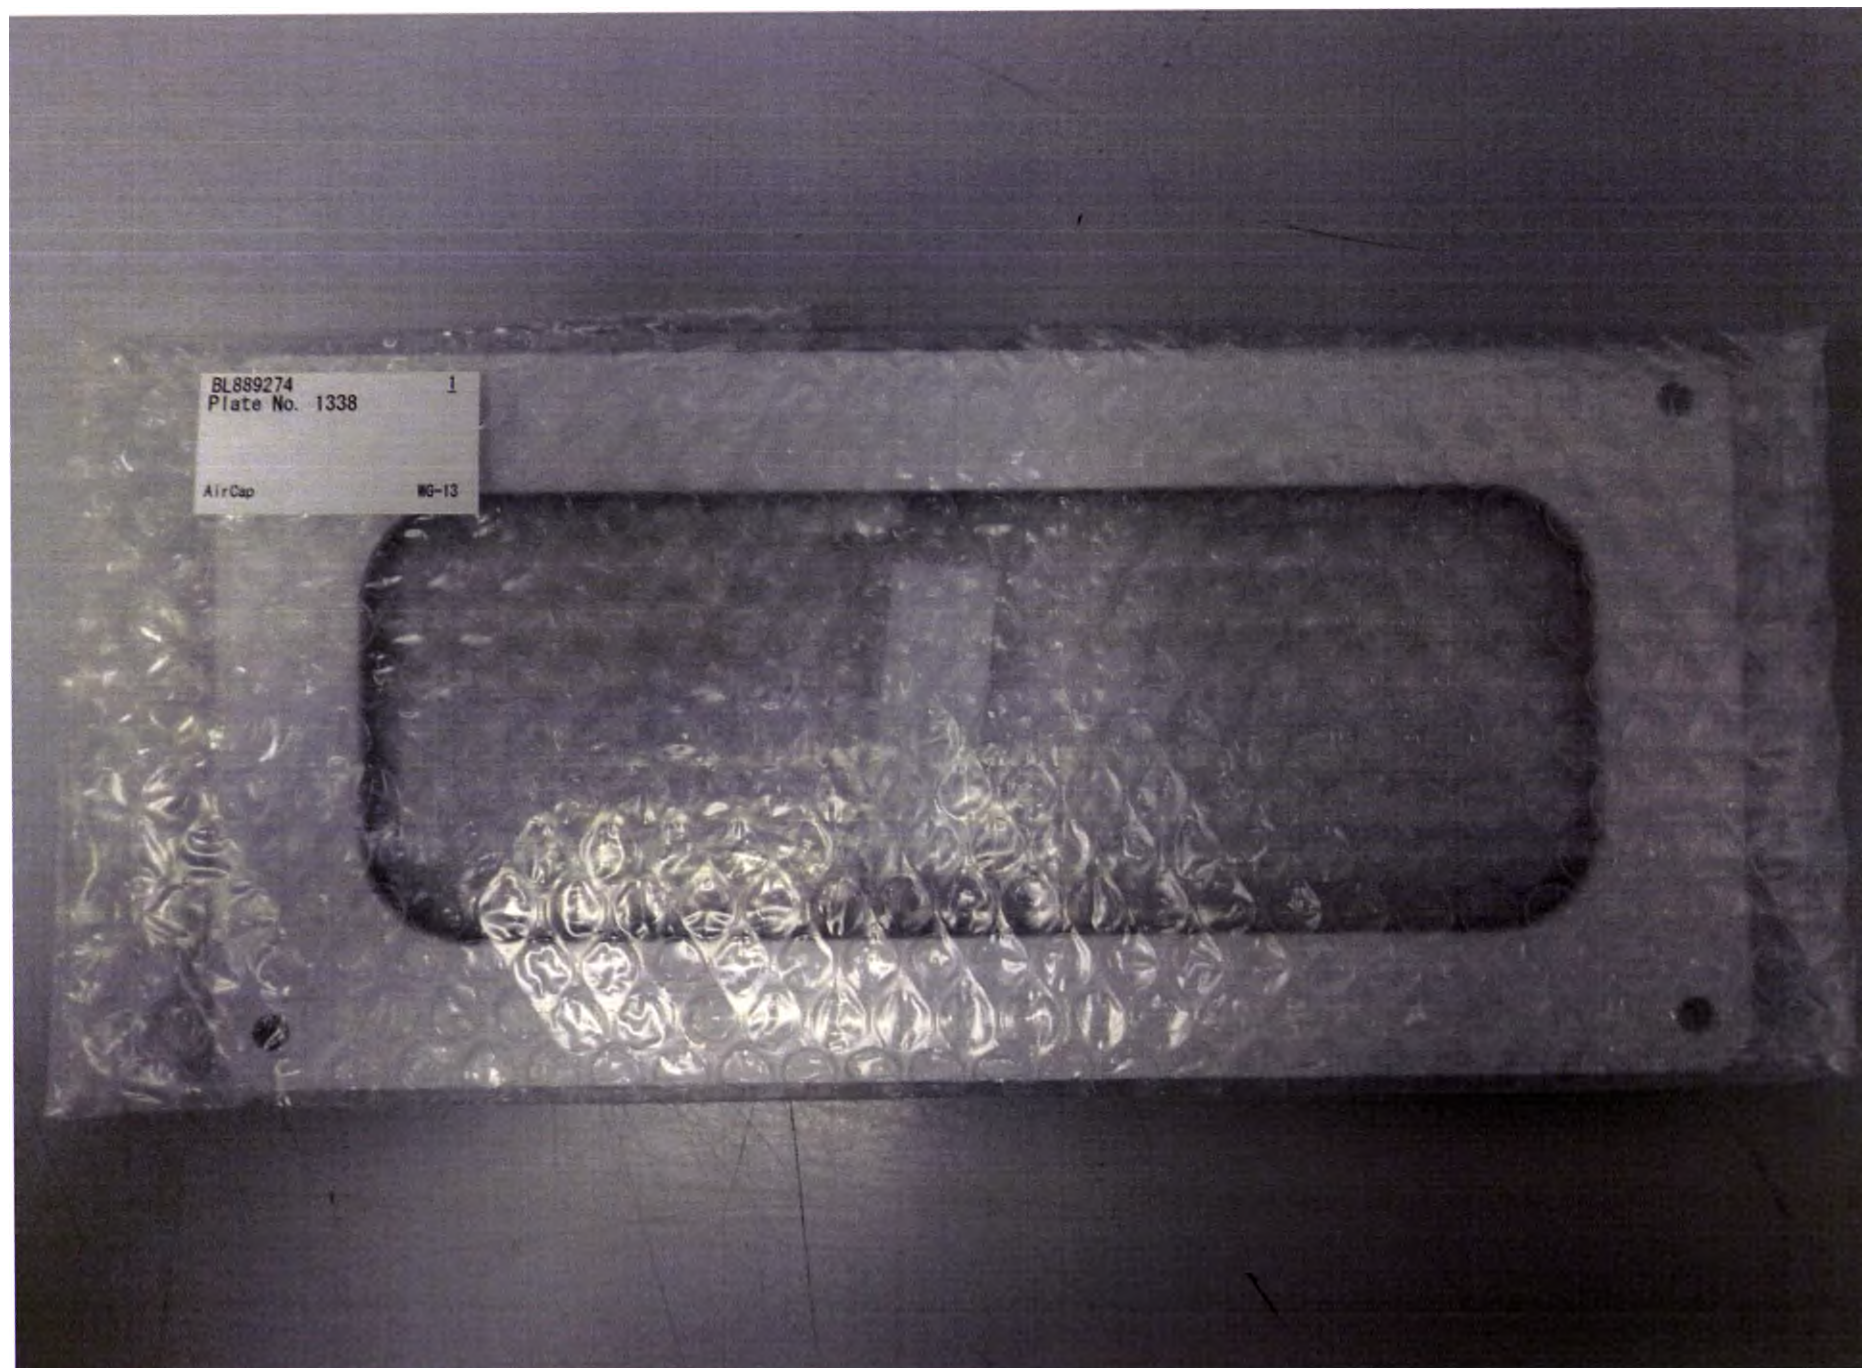

11. Панель боковая в составе:
-Панель №497

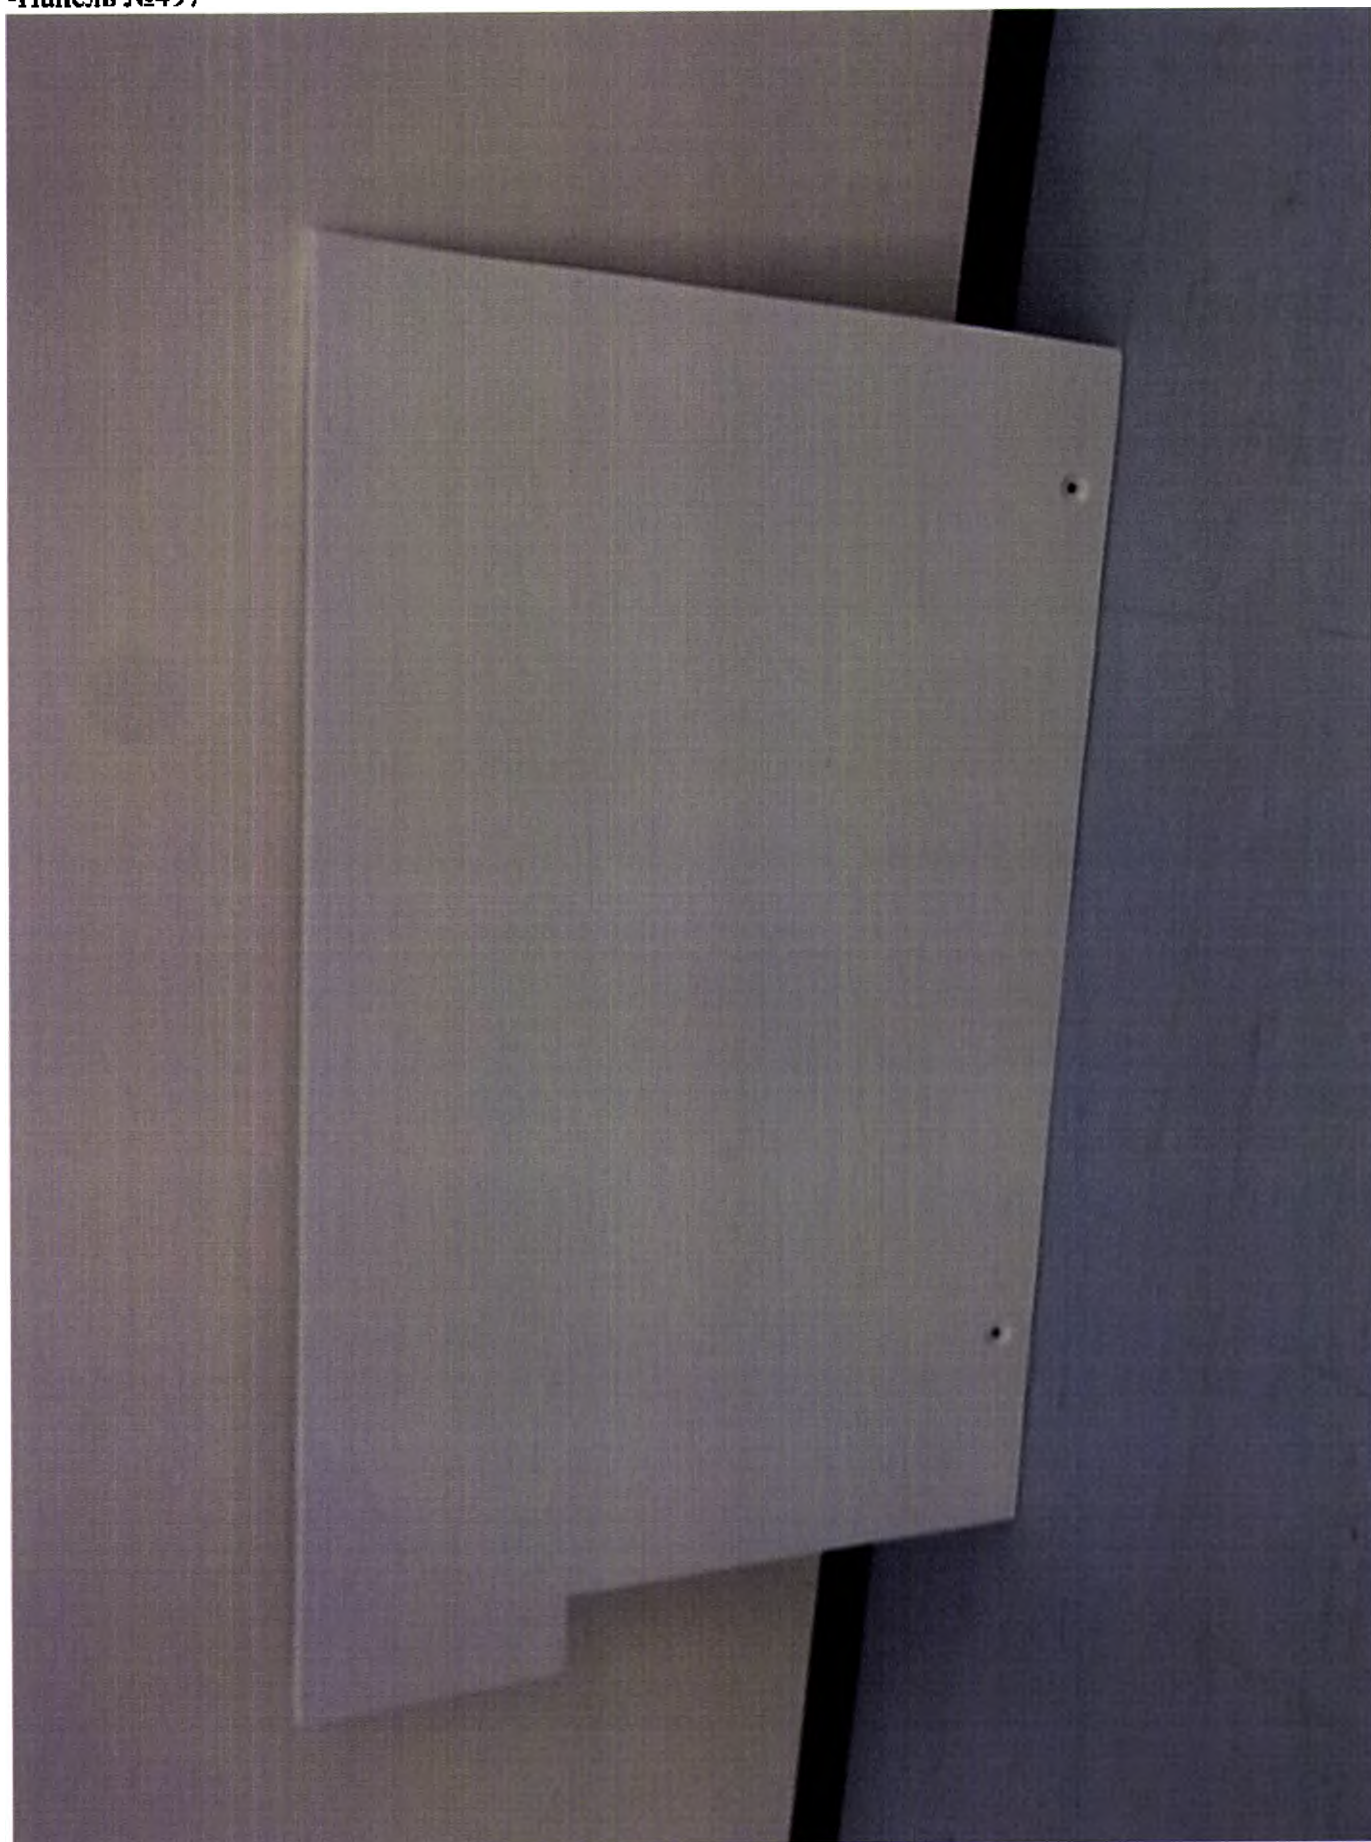

-Панель №498

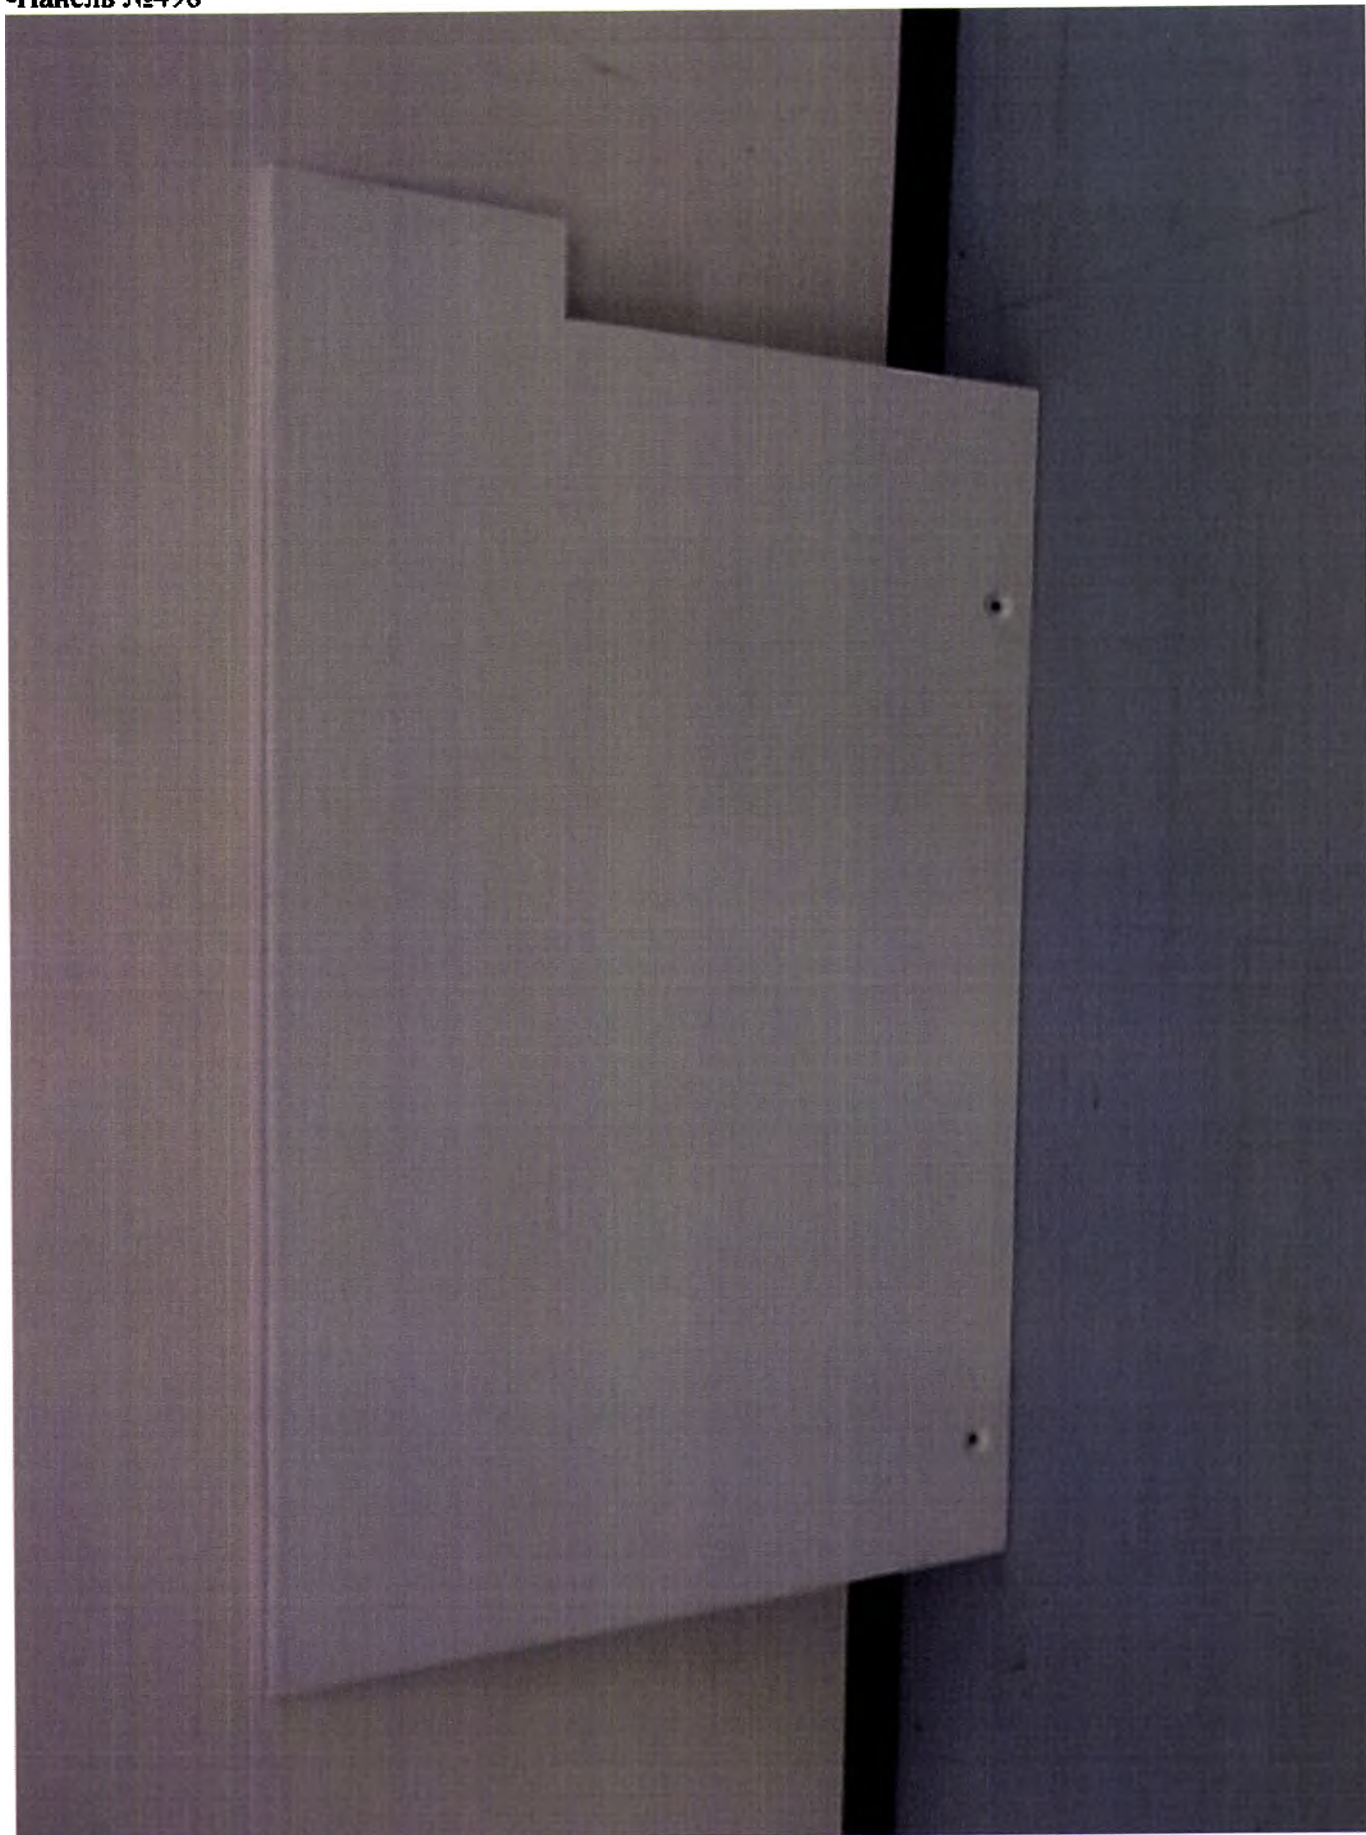

- Крепежный винт с шайбой (для тонкого листа 1,0) М4 х 20 – 4 шт.

348 411 26 М4 х 20




- Крепежный винт с шайбой (для тонкого листа 0,8) М4 х 8

348 4/08/


М4х8



12.Комплект для подключения (UD-CV):
Комплект для подключения (UD-CV):
-Стол в сборе № 114

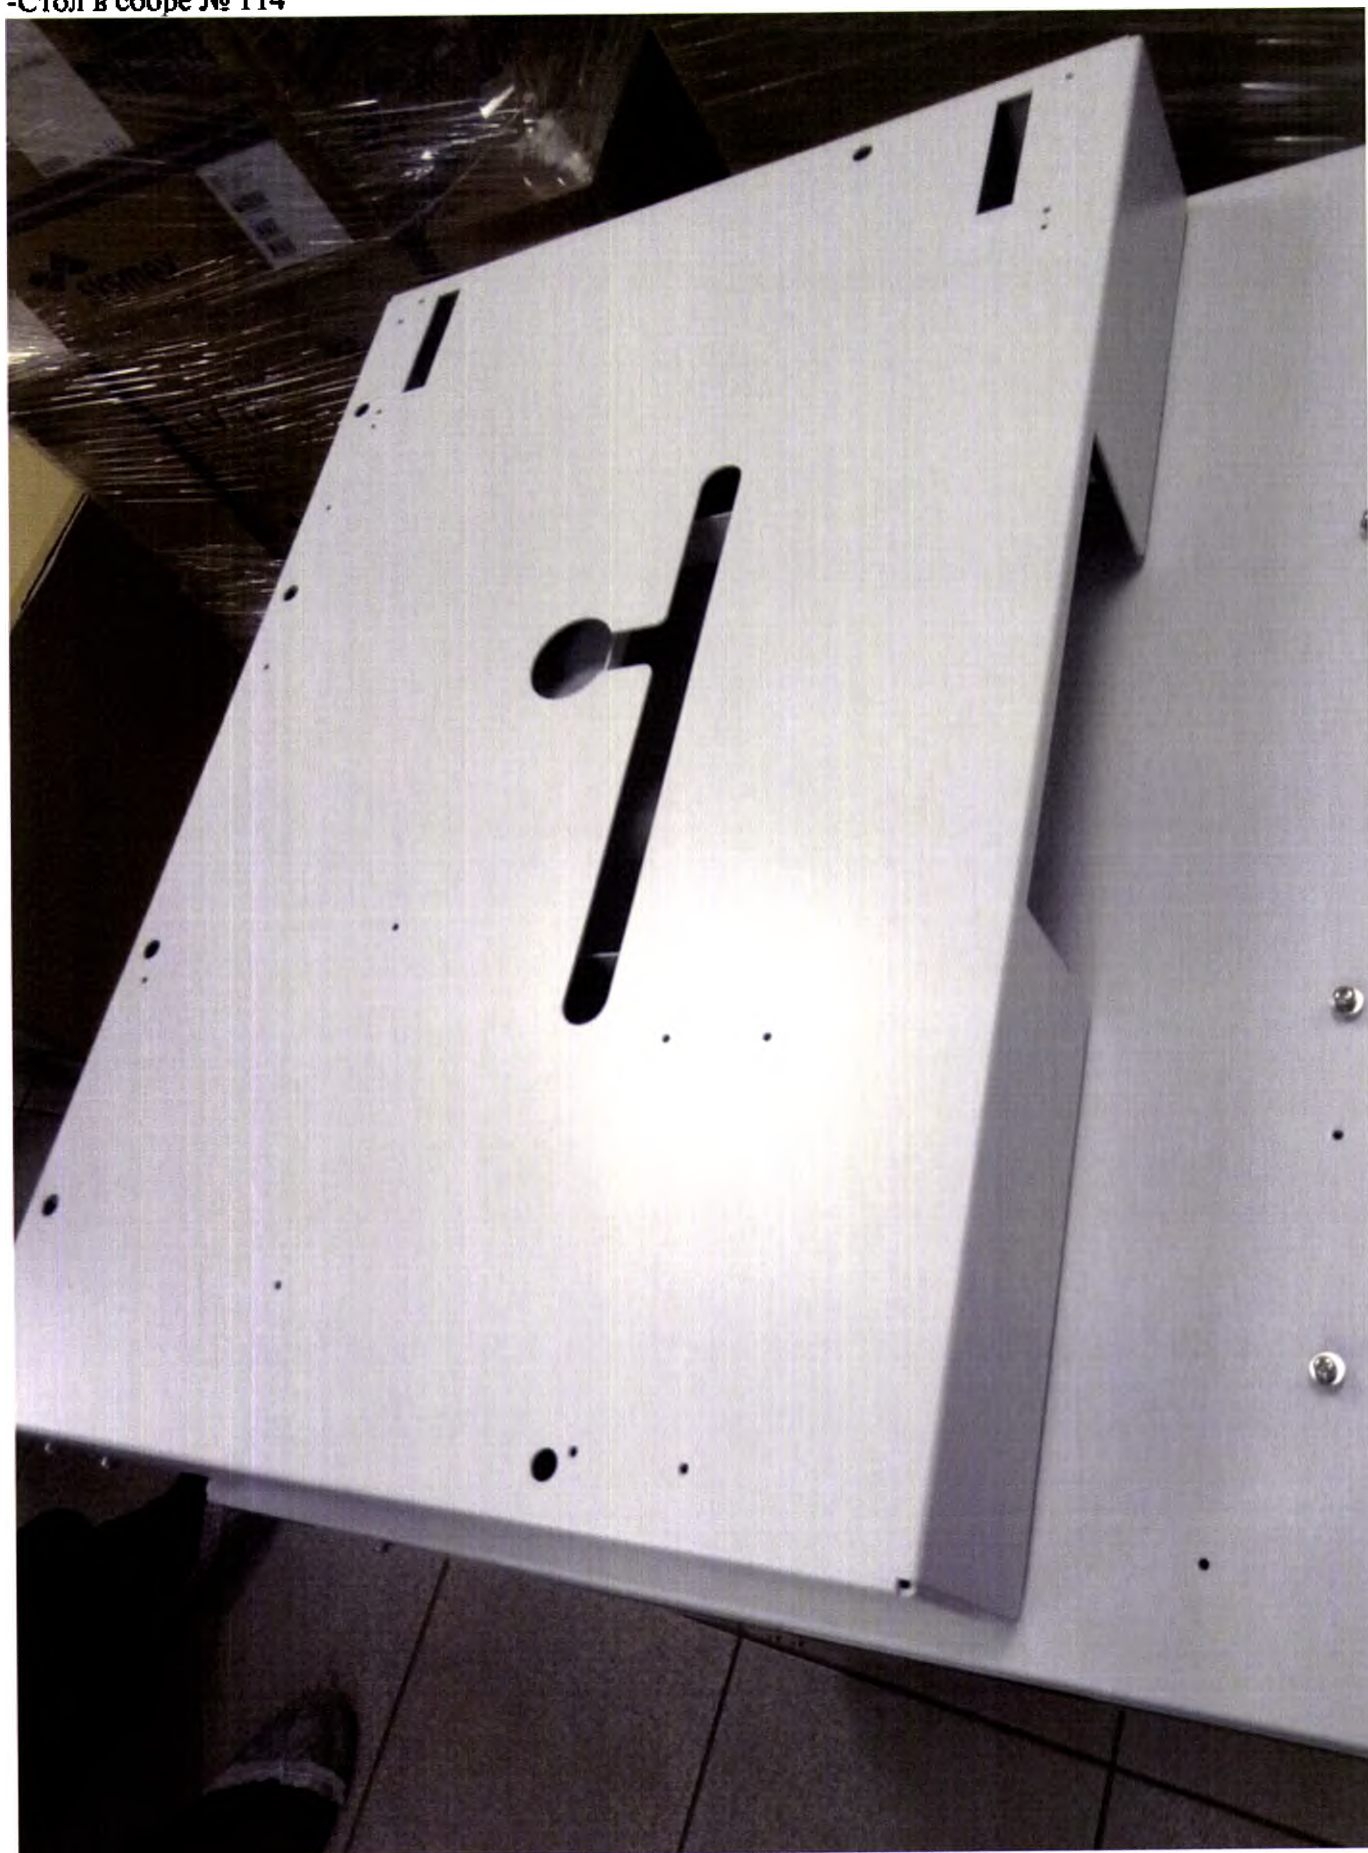


-Основание в сборе № 153

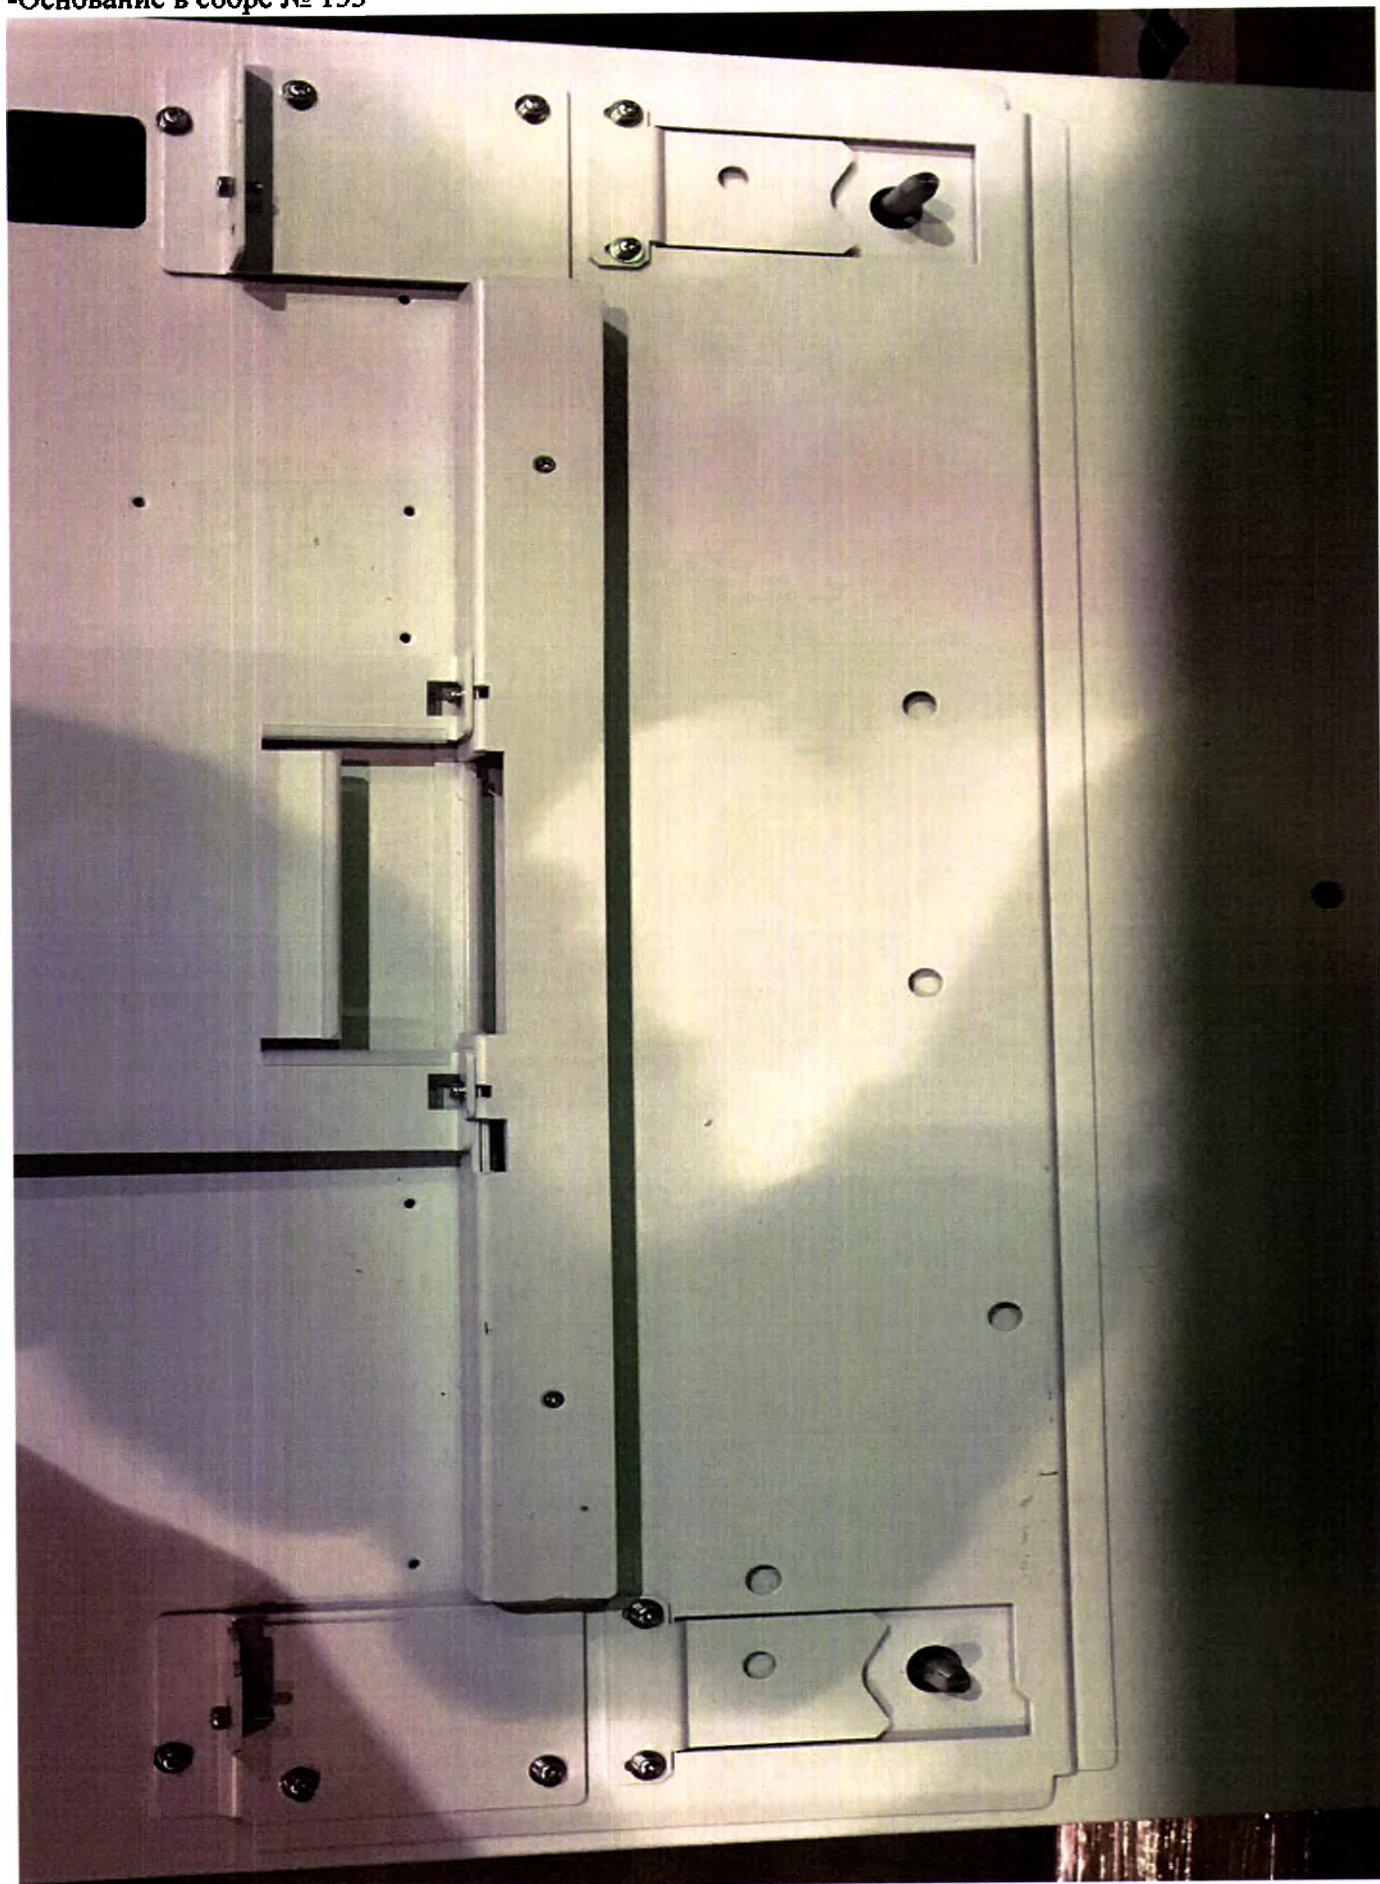

-Держатель № 8837



-Держатель № 8465

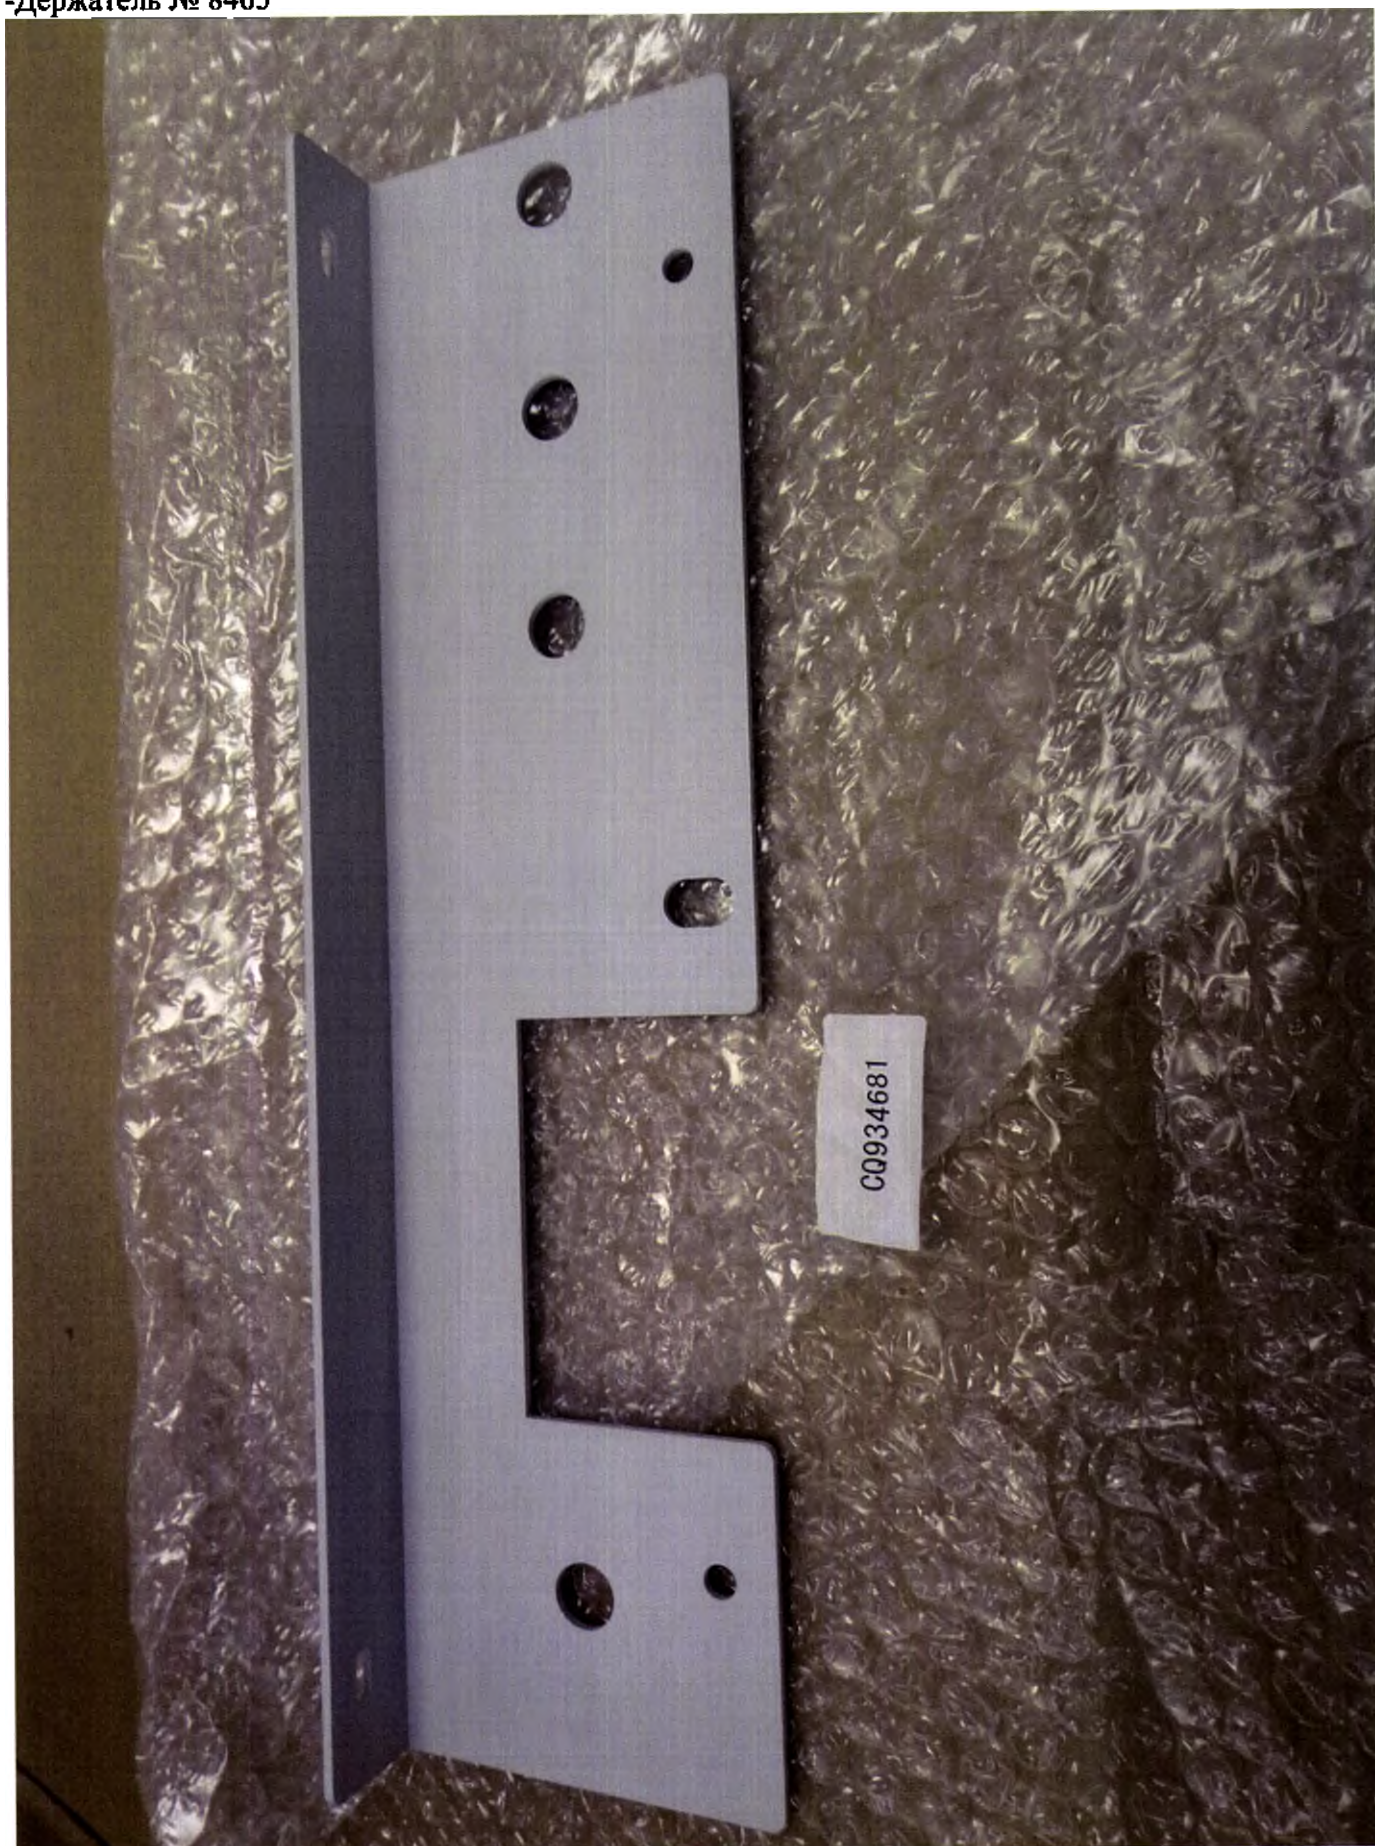

-Держатель № 8464



-Держатель № 8455 2шт




-Держатель № 8528



-Держатель № 8457 2шт.




-Столик № 630

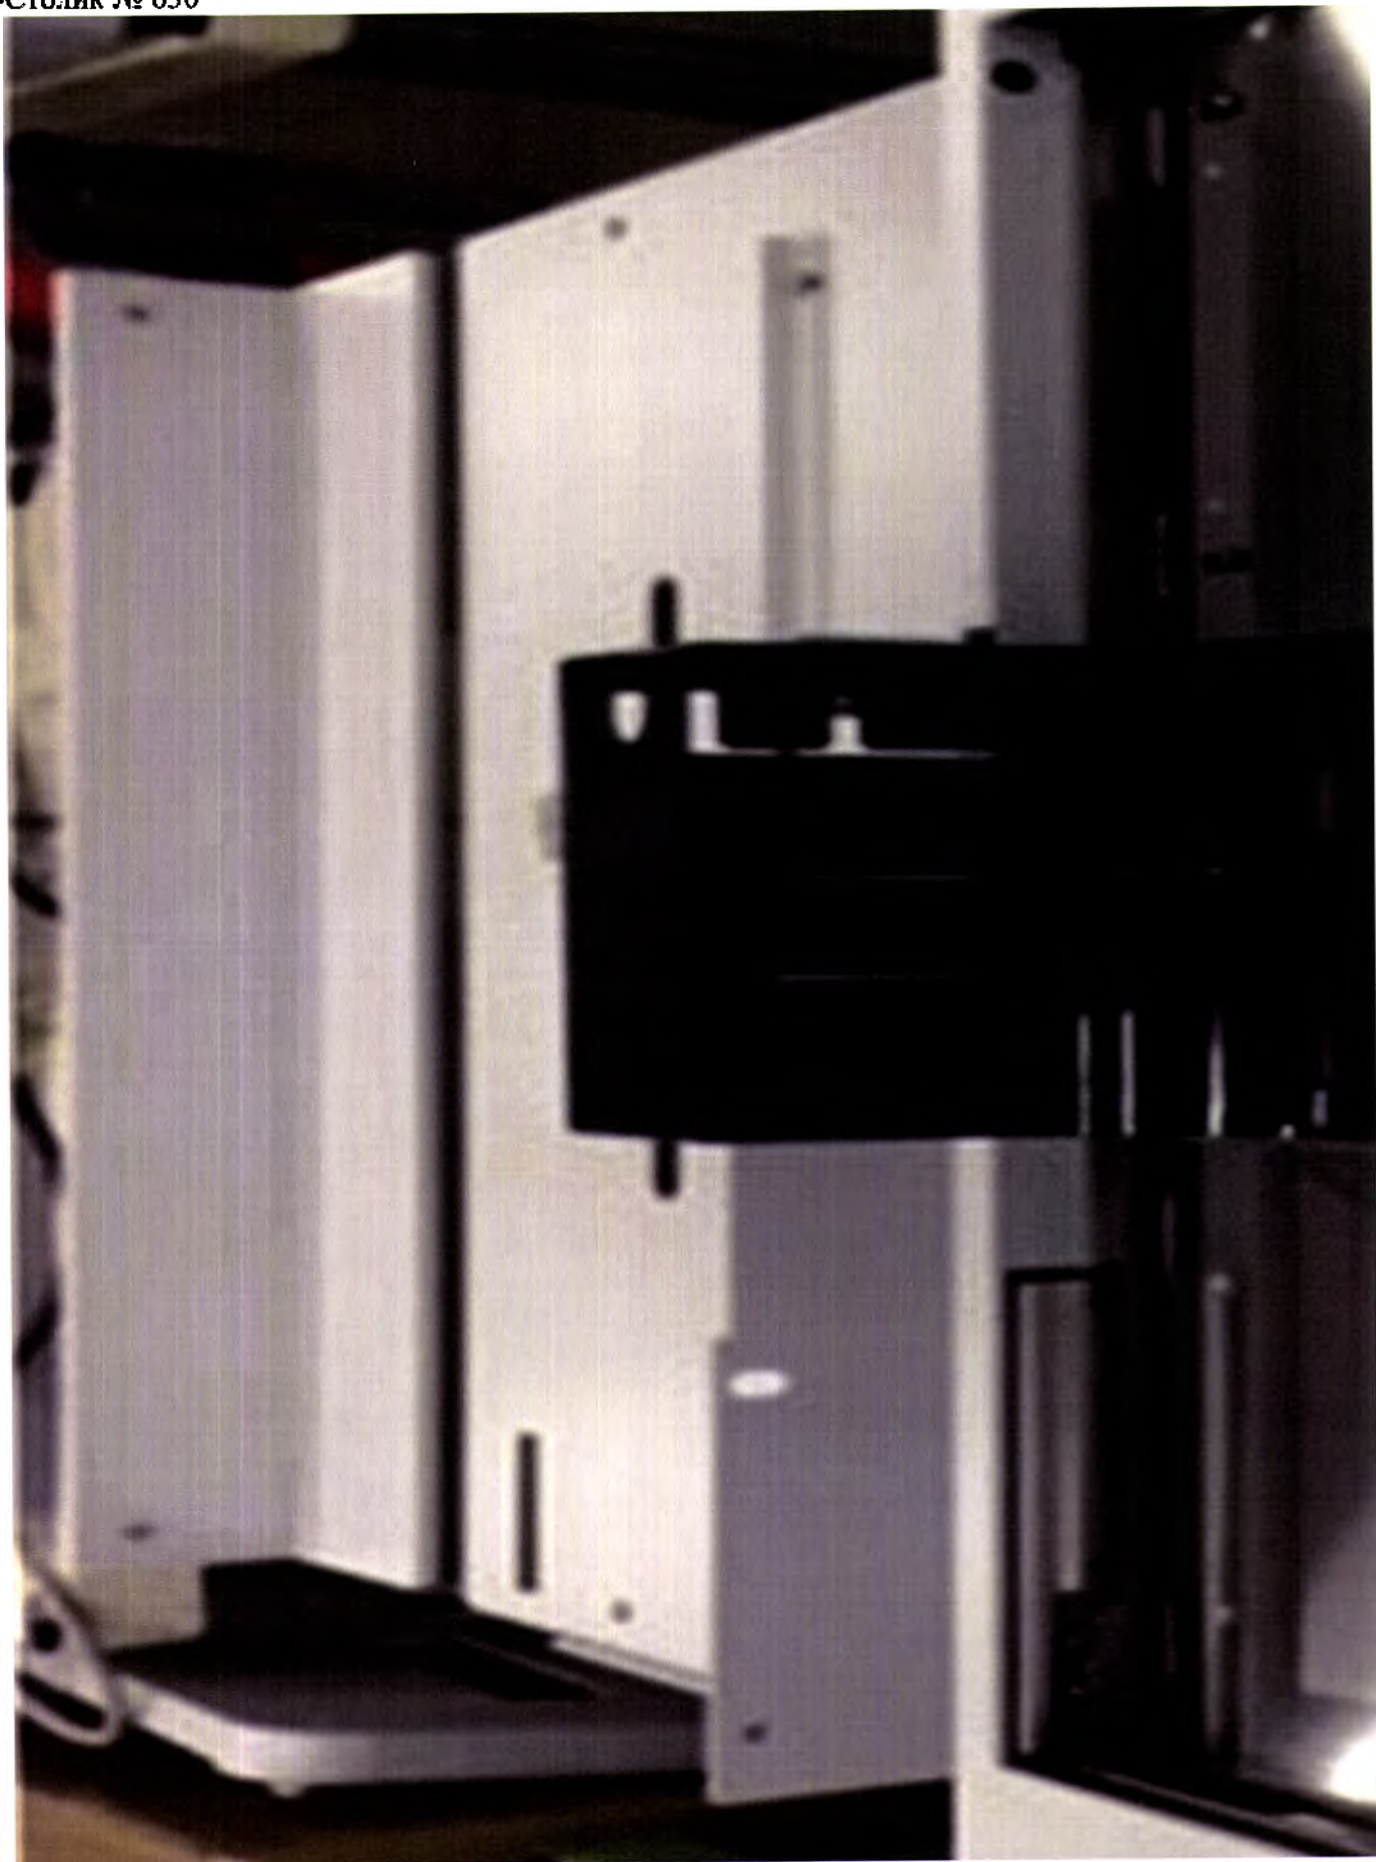

-Винт № 169



-Крышка № 4394

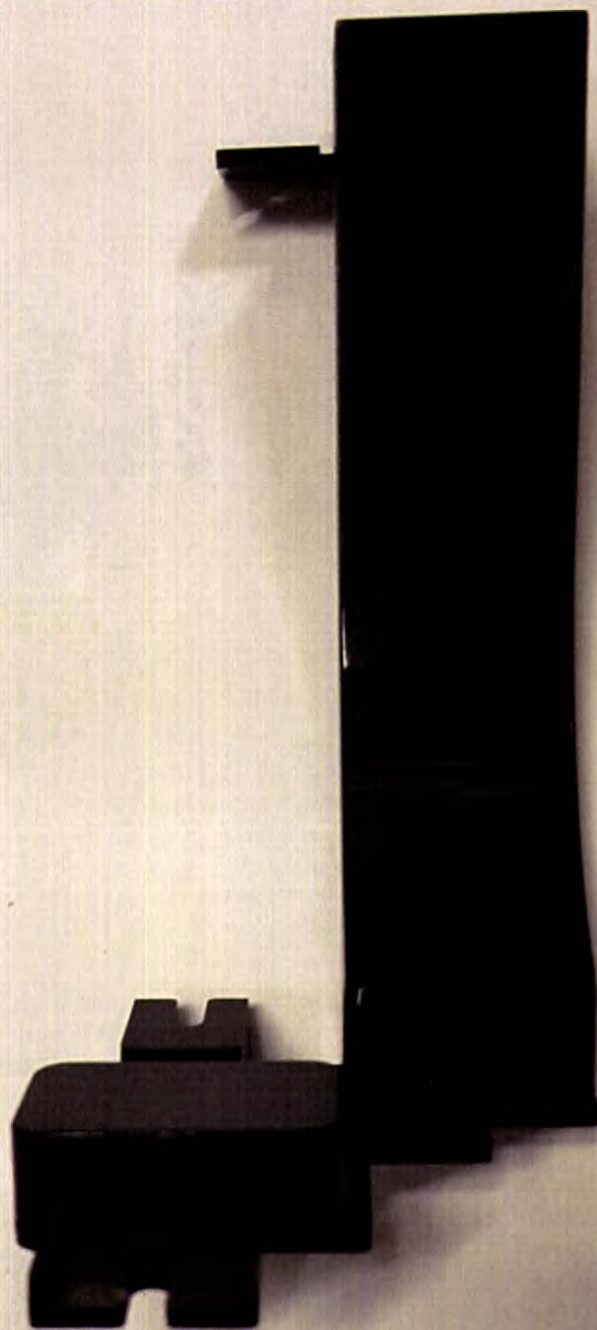

БВ 174 111

-Крышка в сборе № 388




-Держатель в сборе № 308



-Ползун в сборе No. 215



-Устройство считывания штрих-кодов в сборе № 36

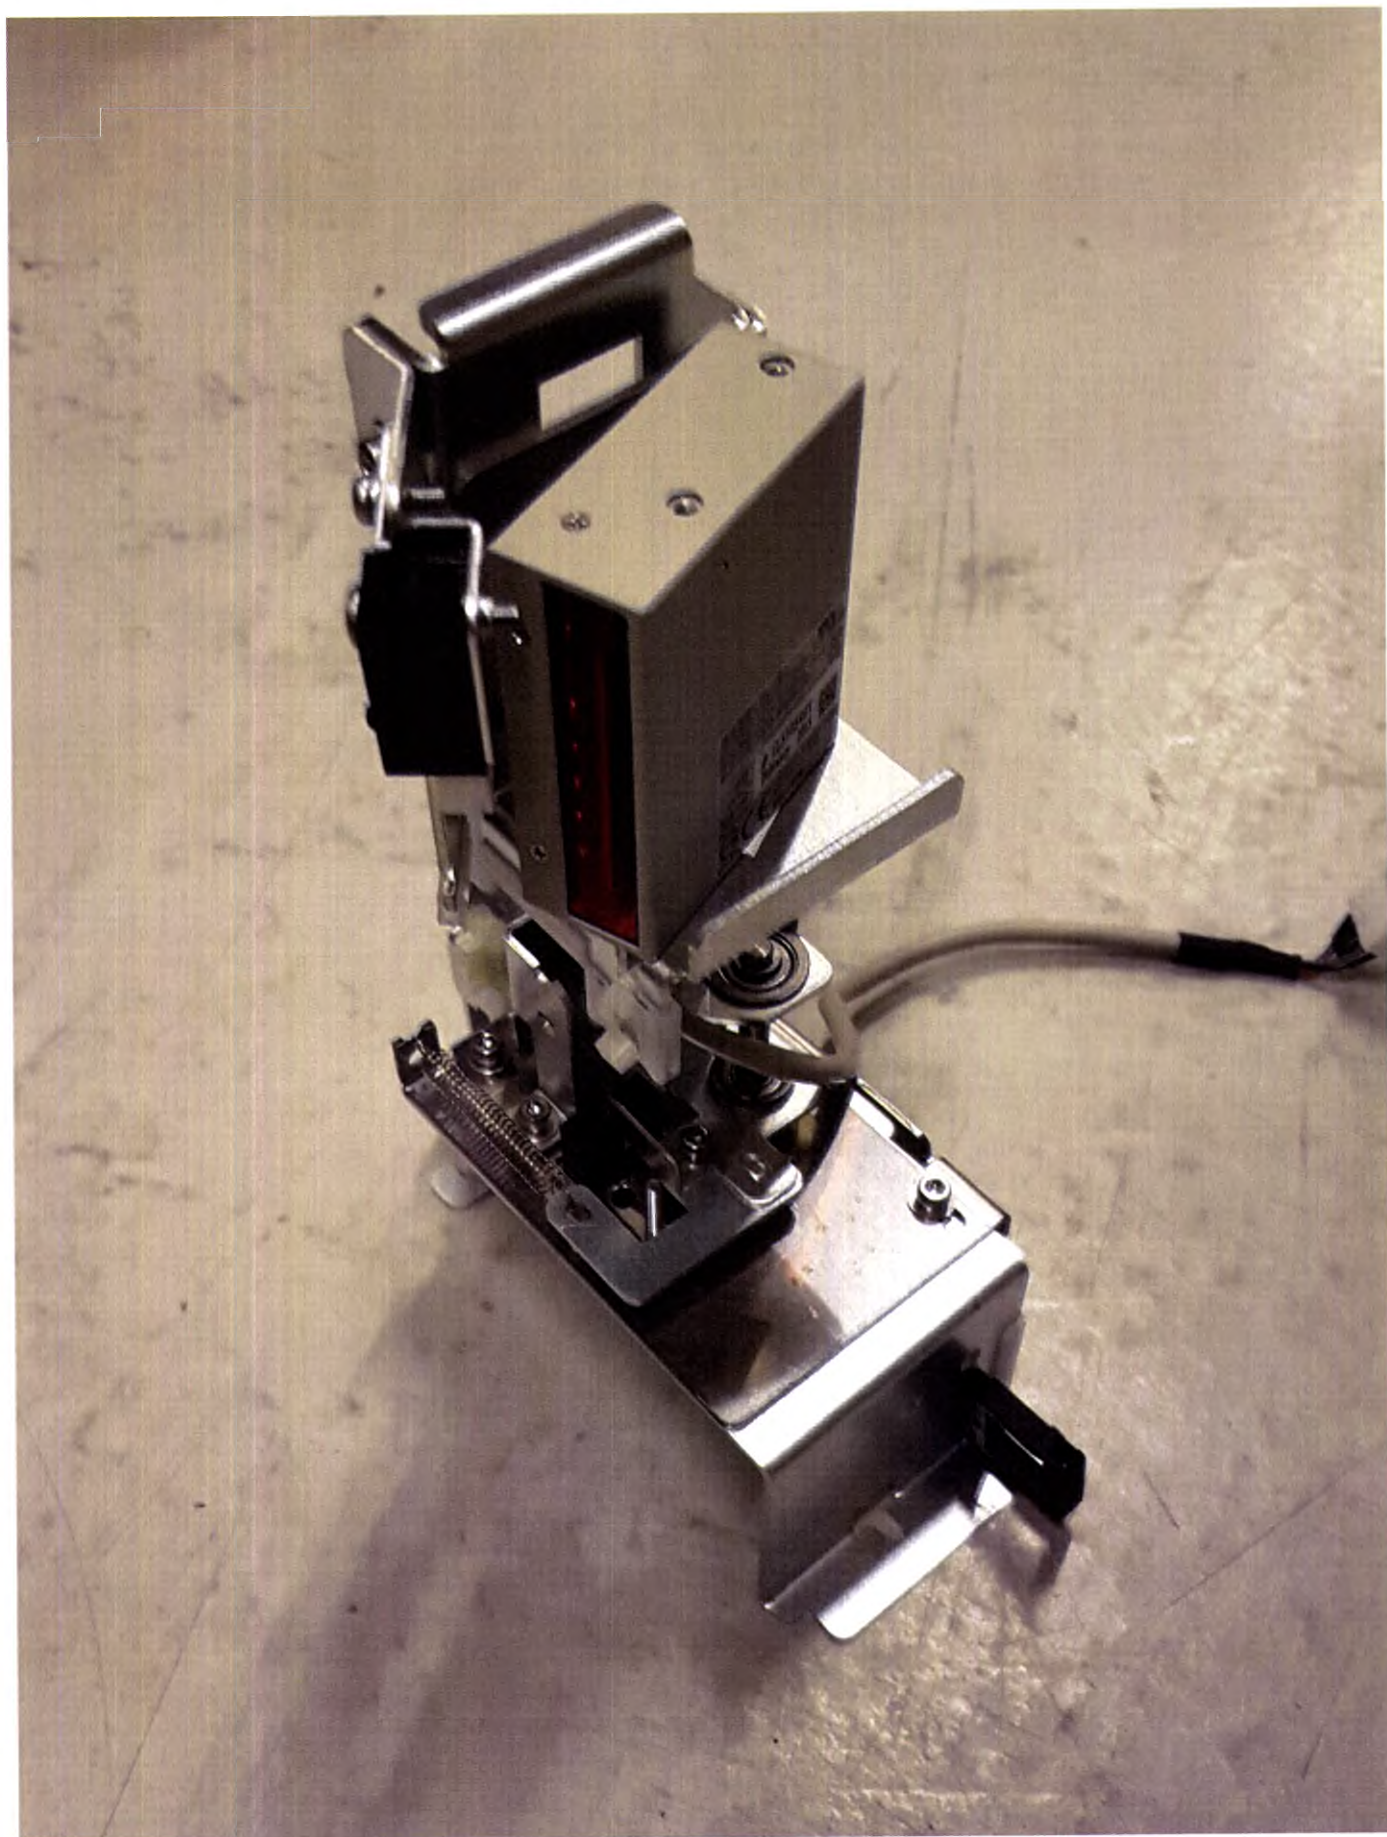

-Кабель электропитания в сборе № 9258



- Крепежный винт с шайбой (для тонкого листа толщиной 0,5), М3 х 8 шт.

34841015

M3 x 8



-М4 х 8 (пружинная шайба + плоская шайба) 16шт.

348172313

M4x8



-М5 х 8 (пружинная шайба + плоская шайба) 4шт.


34872411 М5х8



-Стяжка для кабеля CV-100, не более 6 шт.



13. Блок транспортировки CV-11 в составе комплектующими:

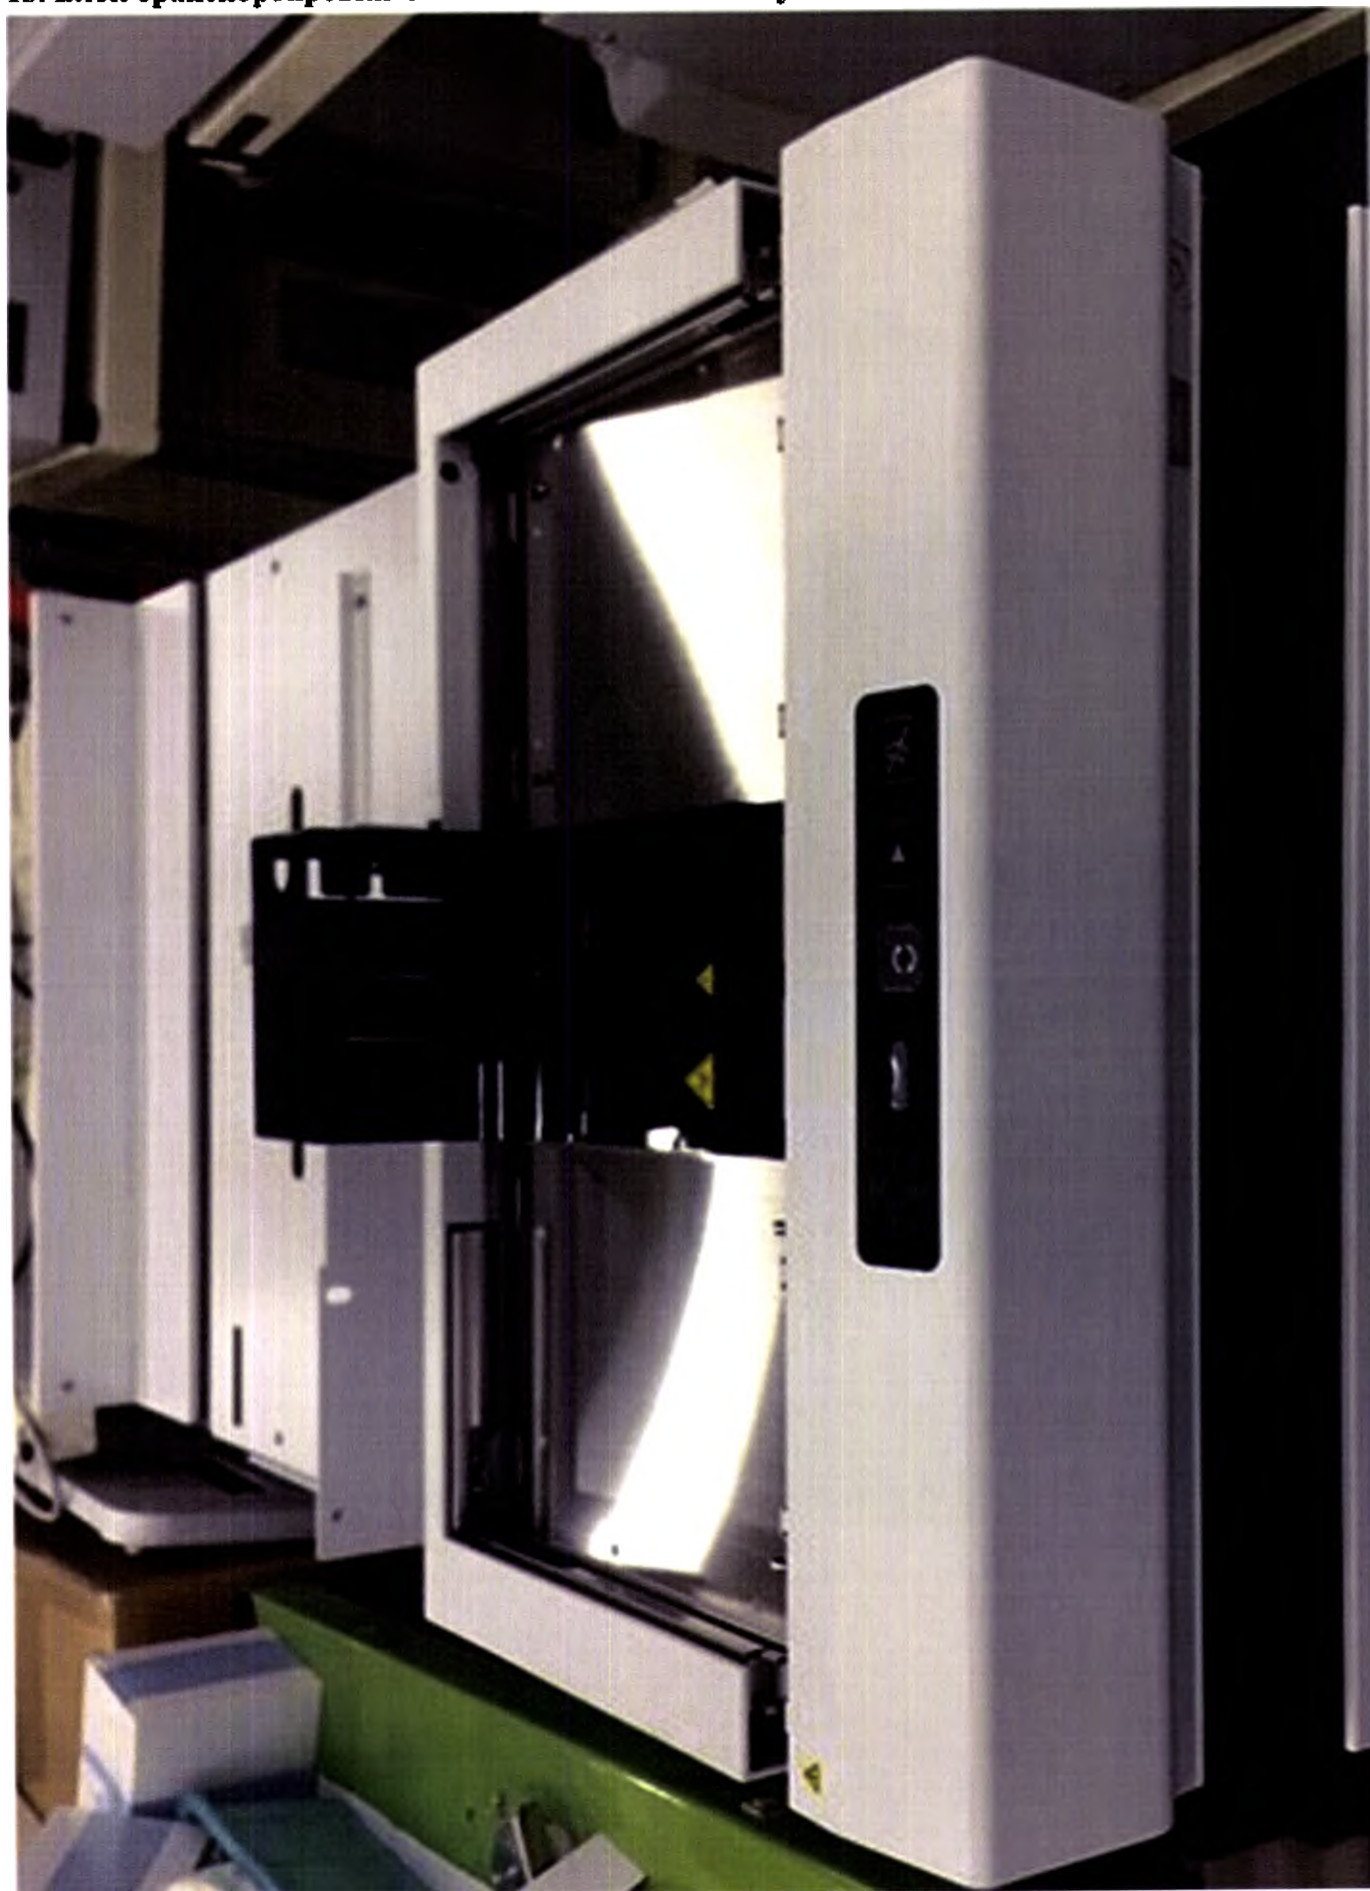

Комплектующие к пробоподатчику CV-11:
-Штатив для проб (WH) (U1K) - 2 шт.



-Опора №433 - 120 шт.



-Кабель электропитания TA-6P(A)+TA-5(A) H05VV-F



-Предохранитель 50T032H - 2 шт.



-Диск CD-R №251

BF266363

IC11X

00-04

-Диск CDR №192

AQ170366

1PSCX

00-05

-Кабель S3IO-L20



-Этикетка № 5178







Urine Sample Transportation Unit

CV-11

Instructions for Use

Sysmex Corporation

KOBE, JAPAN



14.Тележка ST-10 (модуль выгрузки образцов) в составе:

-Тележка ST-10 (модуль выгрузки образцов)



保証書

	製造番号 No.
	年 月 日

(お客様控)

この保証書は、本書に示す期間における無償修理を行うことを証するものです。本証明期間中に故障が発生した場合、お買い上げいただいた販売店または当社支店・営業所へ修理をお申し付けください。
 ※本書の記入モレがありますと、無償修理が受けられません。

販売店

住所

電話

シスメックス株式会社

本社 神戸市中央区臨海通1丁目5番11号

名称

Model

UD-10

製品検査合格証

Certificate of Product Inspection

製造番号

Serial No.

11172

この製品は当社の厳密な検査に合格し、
仕様を十分満足しております。

This product has been tested and
passed the inspection requirements.


検査者

Inspector

Hideki Yoshii

SYSMEX CORPORATION

- Метка (клеящаяся) №183

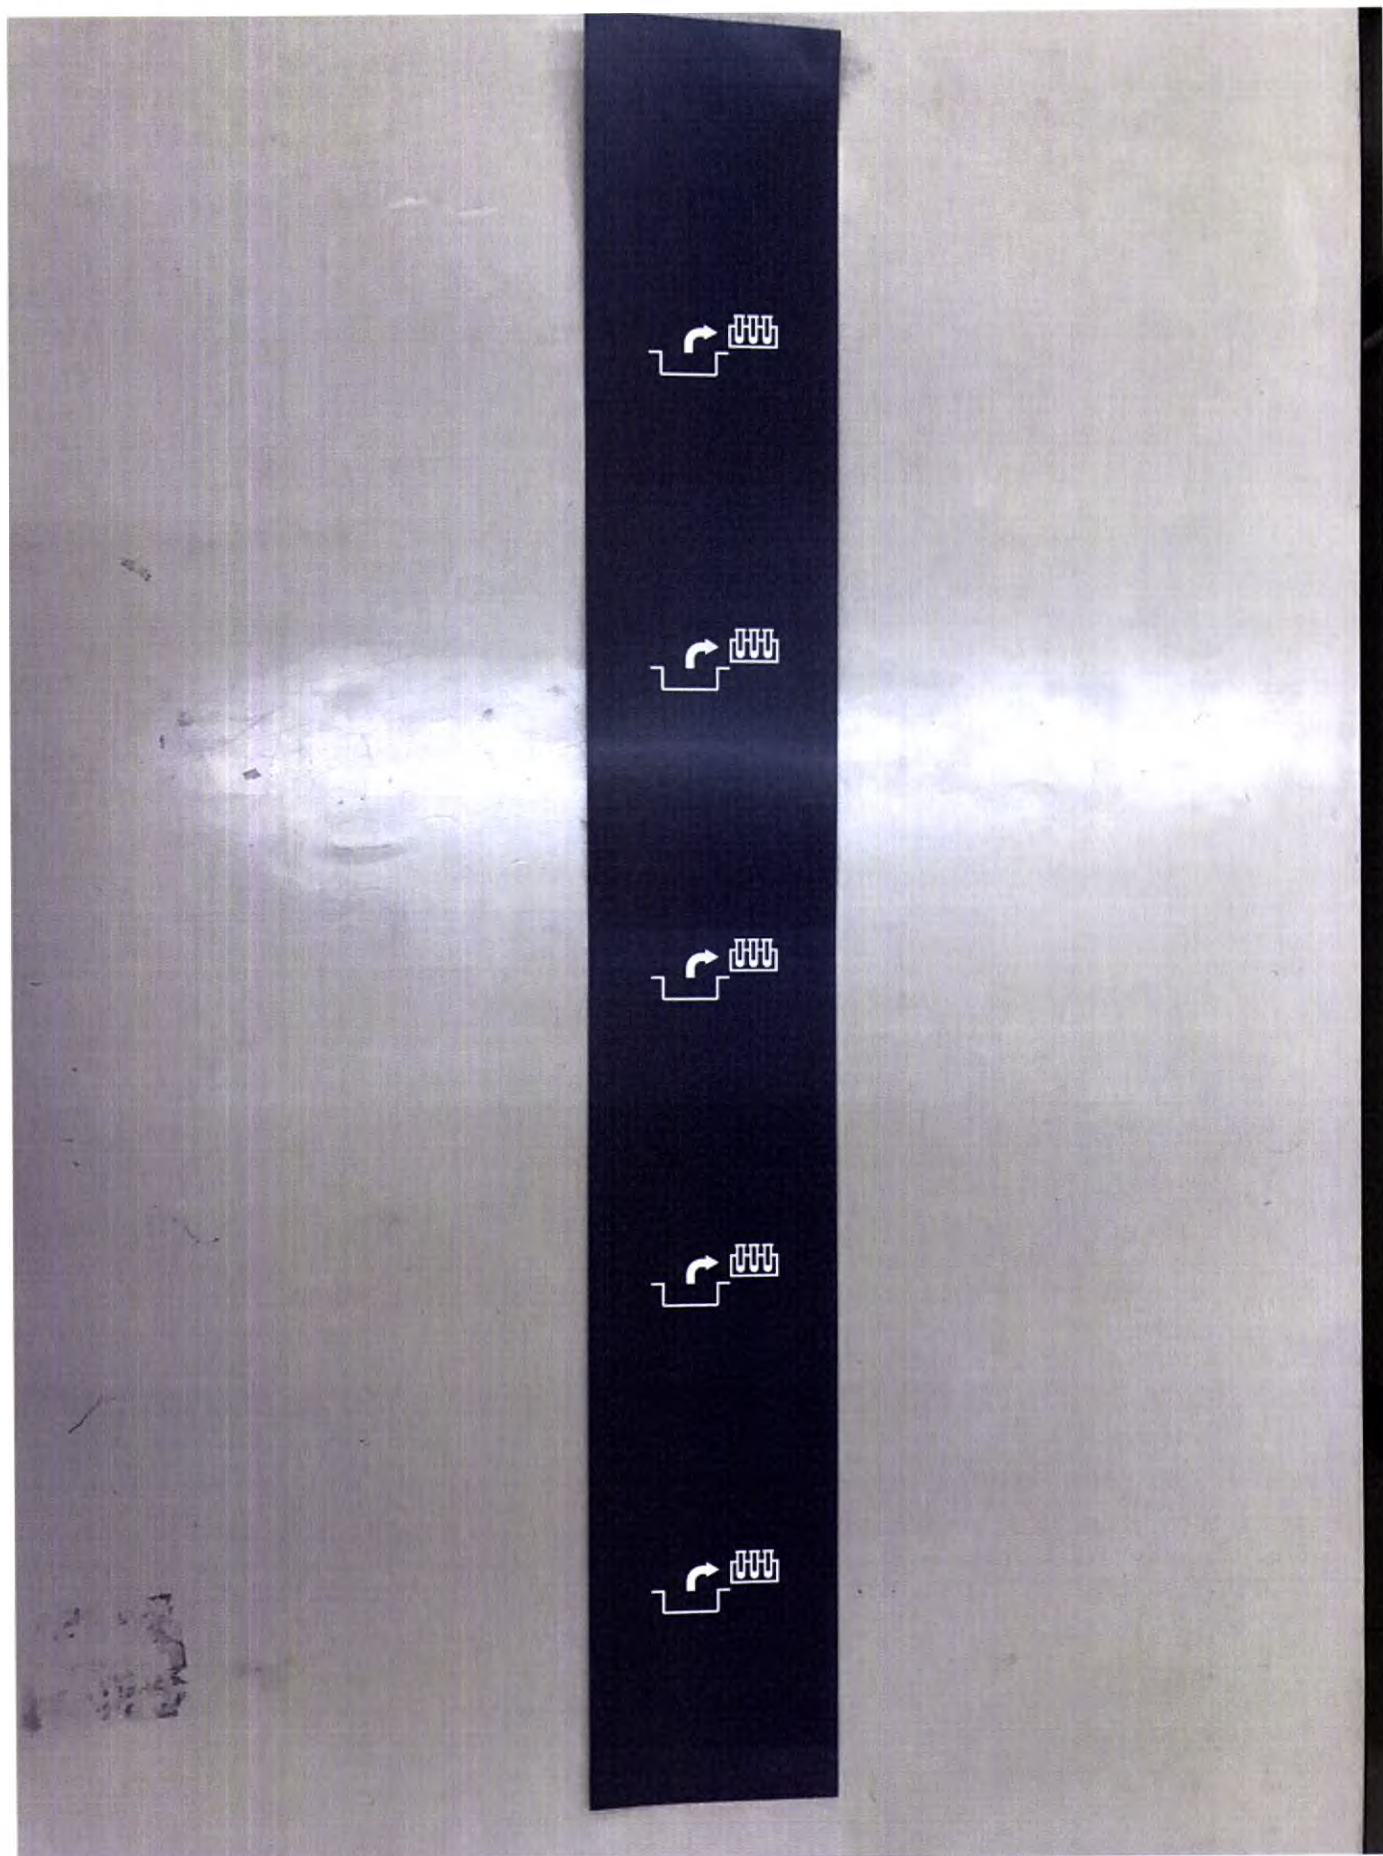

- Кабель электропитания TA-3(A)+TA-5(A)SJT



- Кабель электропитания ТА-6Р(А)+ТА-5(А) H05VV-F




- Кабель электропитания ТА-8СН+ТА-5(А)



- Диск CD-R №265




- Предохранитель 50T032H – 2 шт.

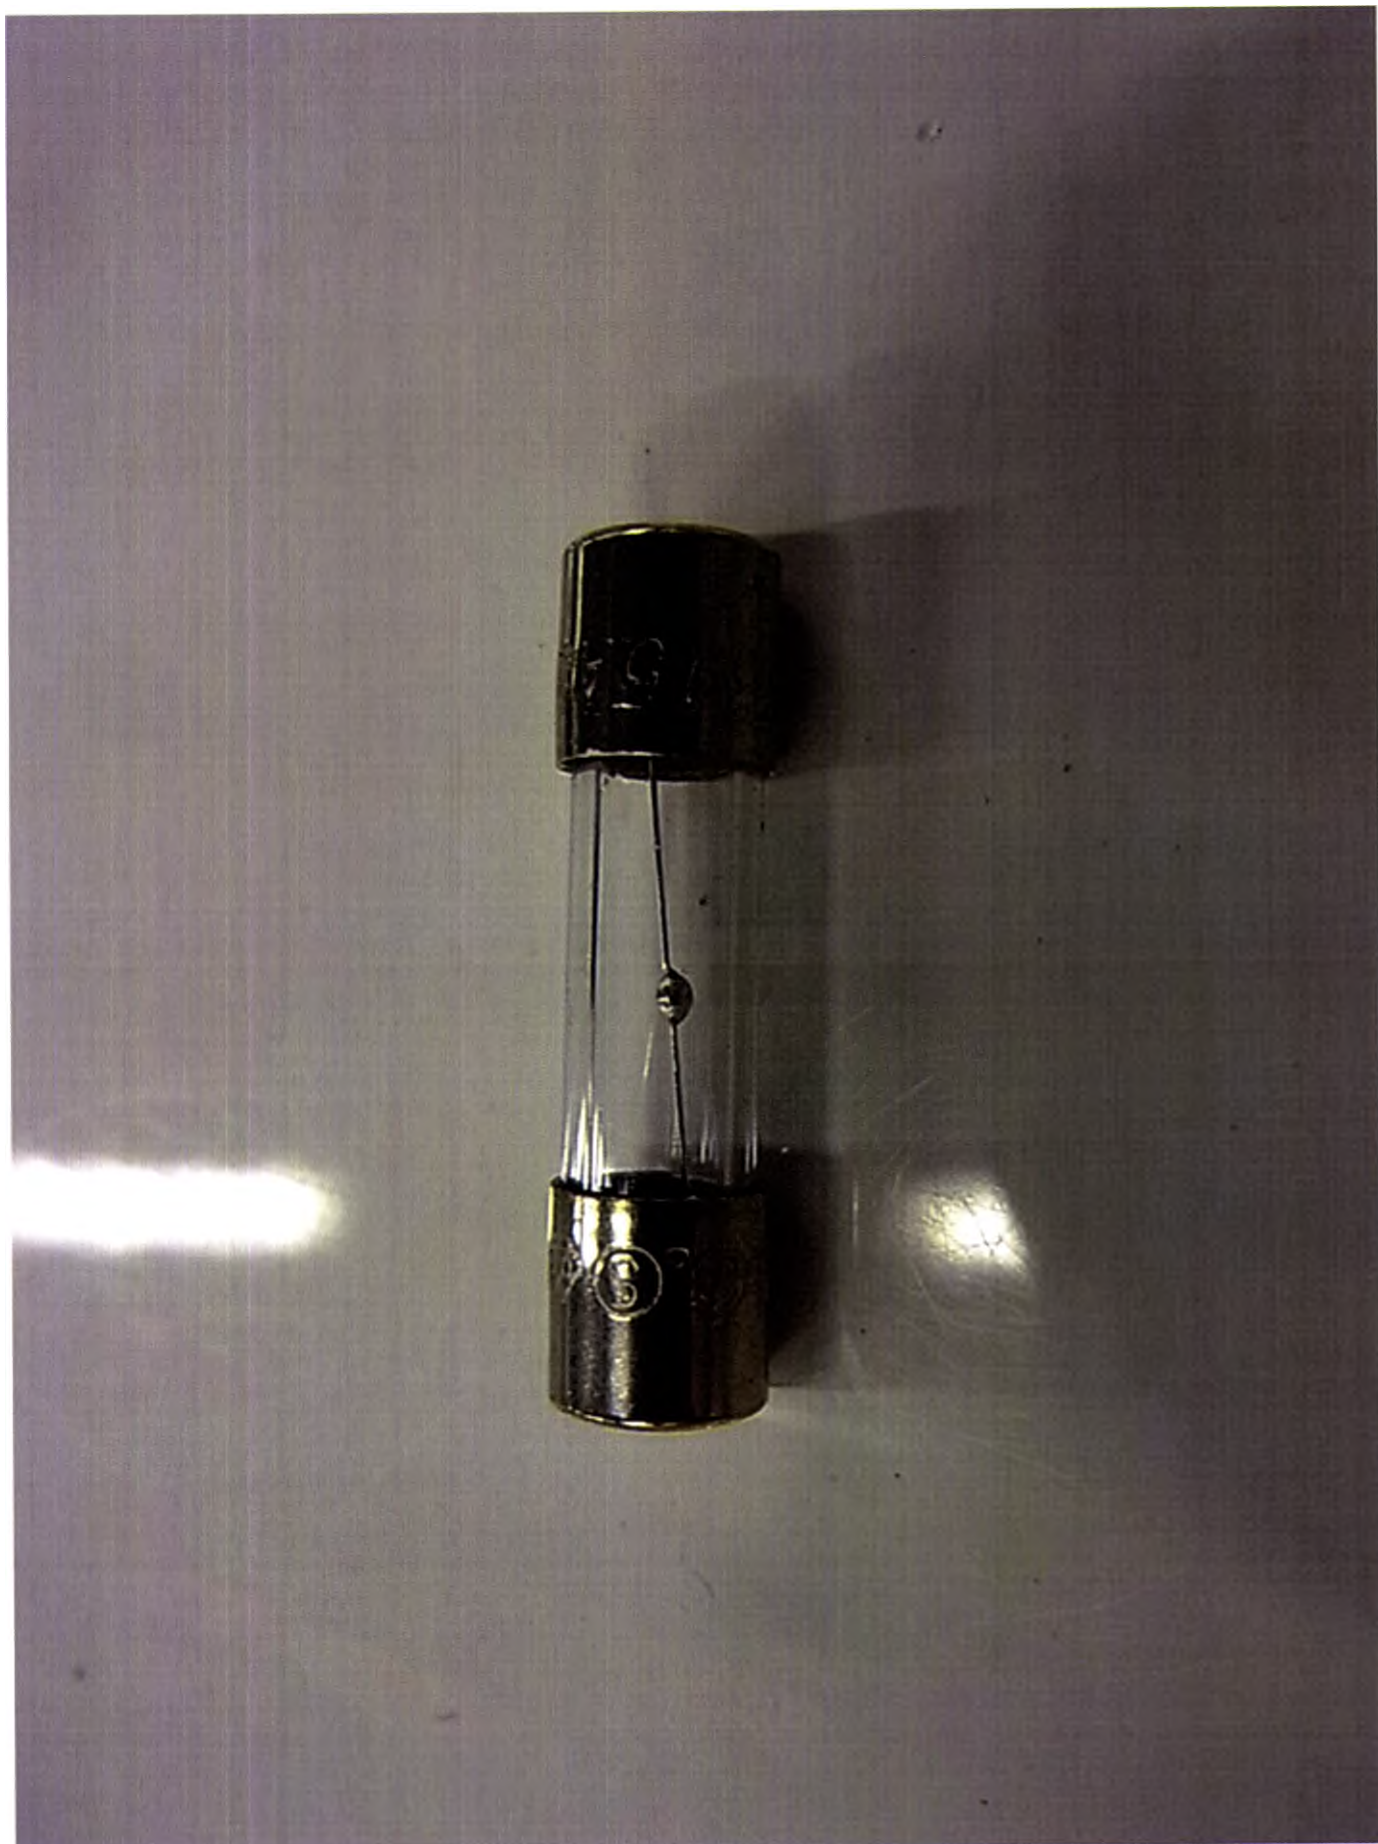

- Кабель S3IO-L20



- Кабель электропитания в сборе №9261

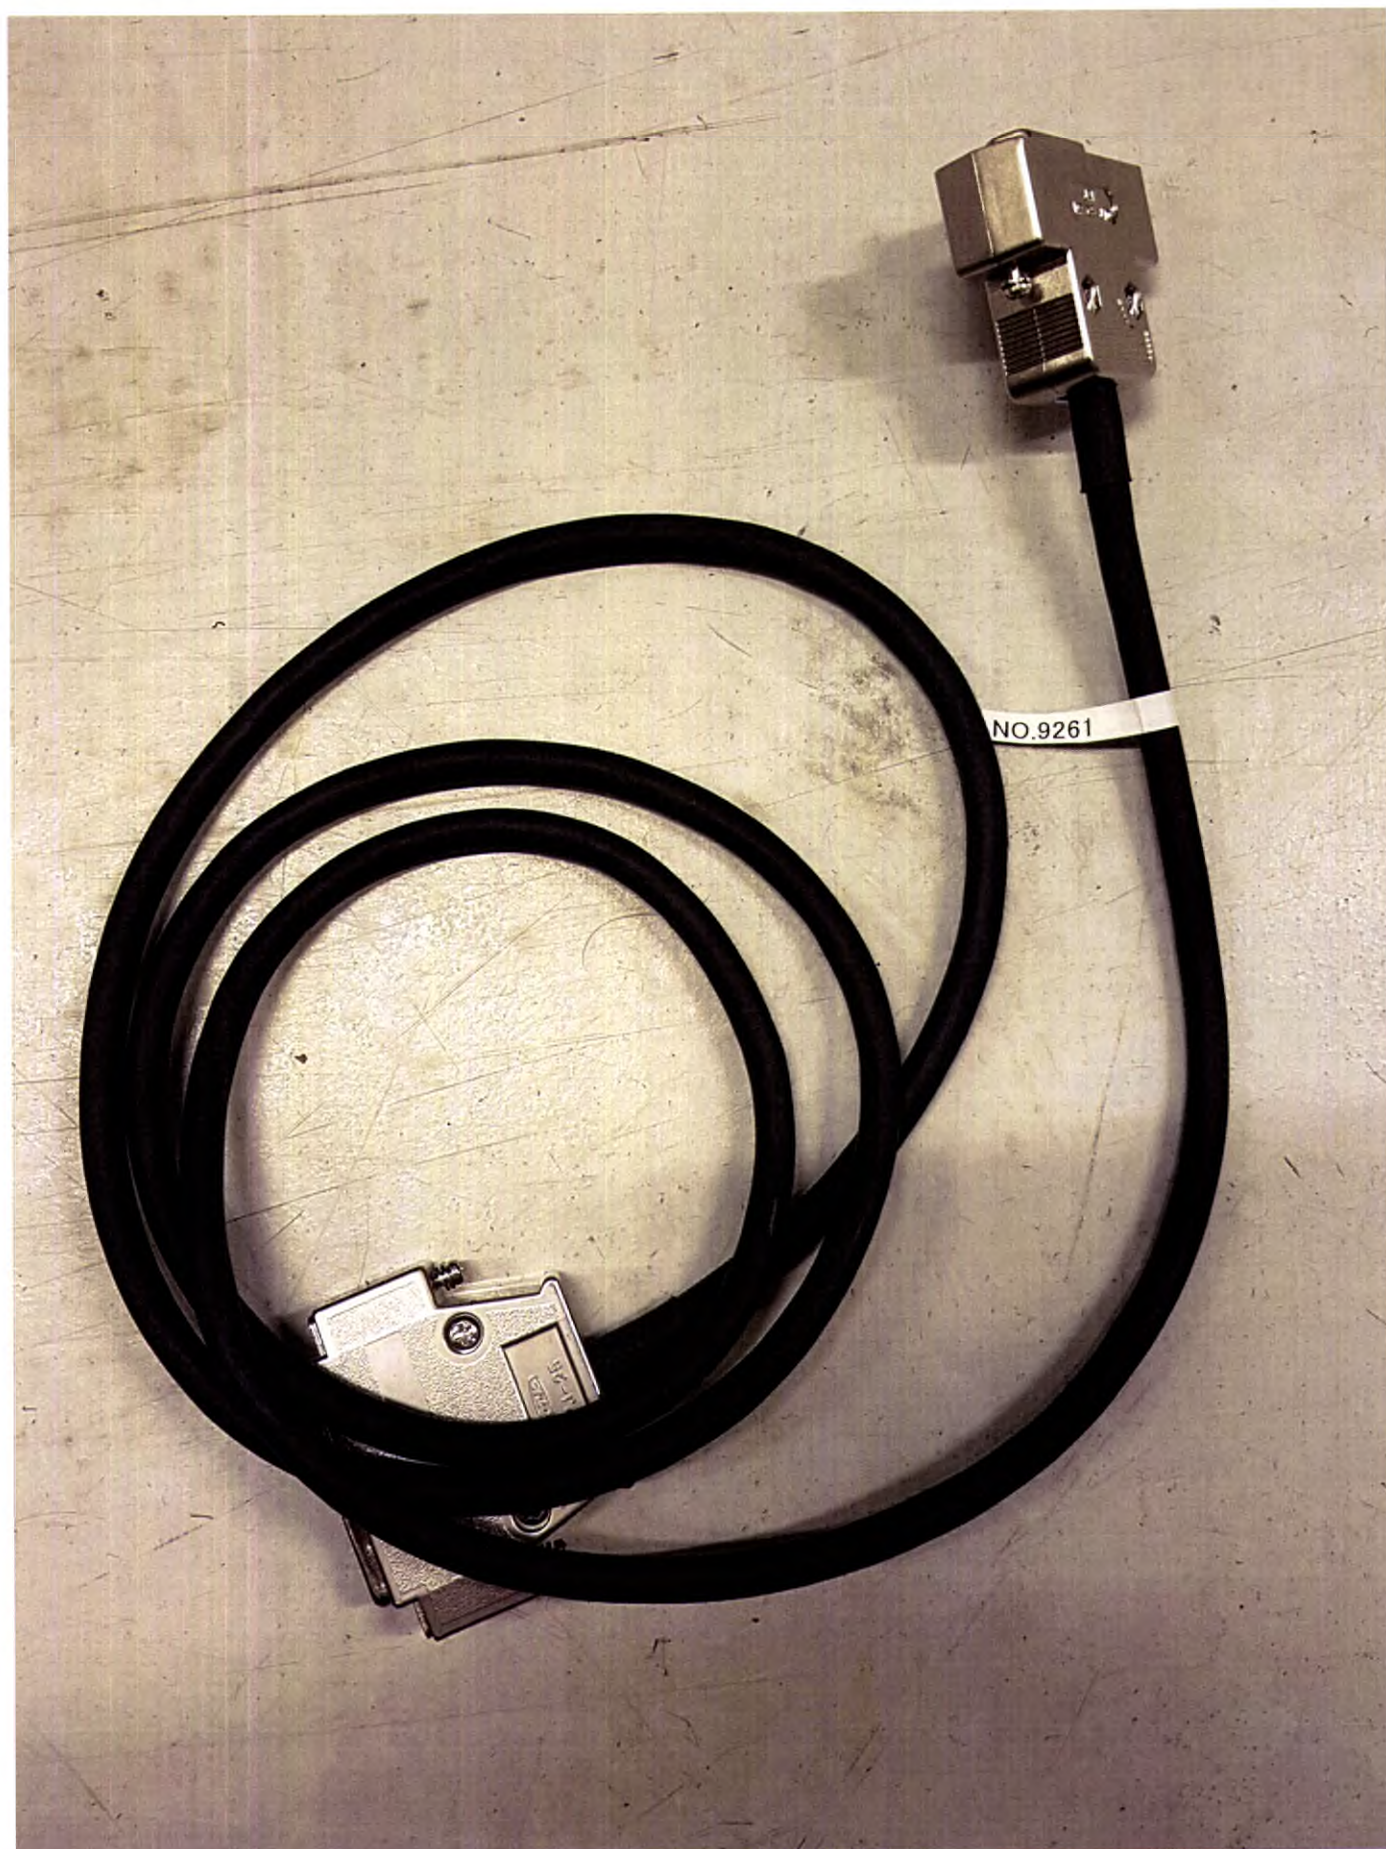

15. Тележка ST-11 (модуль загрузки образцов) в составе:
-Тележка ST-11 (модуль загрузки образцов)



保証書

製造番号
No.

名前 _____

住所 _____

電話 () _____

年 月 日

間 お買い上げ日より1年間

(お客様用)

この保証書は、本書に示す期間における無償修理を行うことを証するものです。本証明期間中に故障が発生した場合、お買い上げいただいた販売店または当社支店・営業所へ修理をお申し付けください。
*本書の記入モレがありますと、無償修理が受けられません。

販売店 _____

住所 _____

電話 _____

シスメックス株式会社
本社 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番11号

名称

Model

UD-10

製品検査合格証

Certificate of Product Inspection

製造番号

Serial No.

11172

この製品は当社の厳密な検査に合格し、
仕様を十分満足しております。

This product has been tested and
passed the inspection requirements.


検査者

Inspector

Hideki Yoshii

SYSMEX CORPORATION

- Метка №182

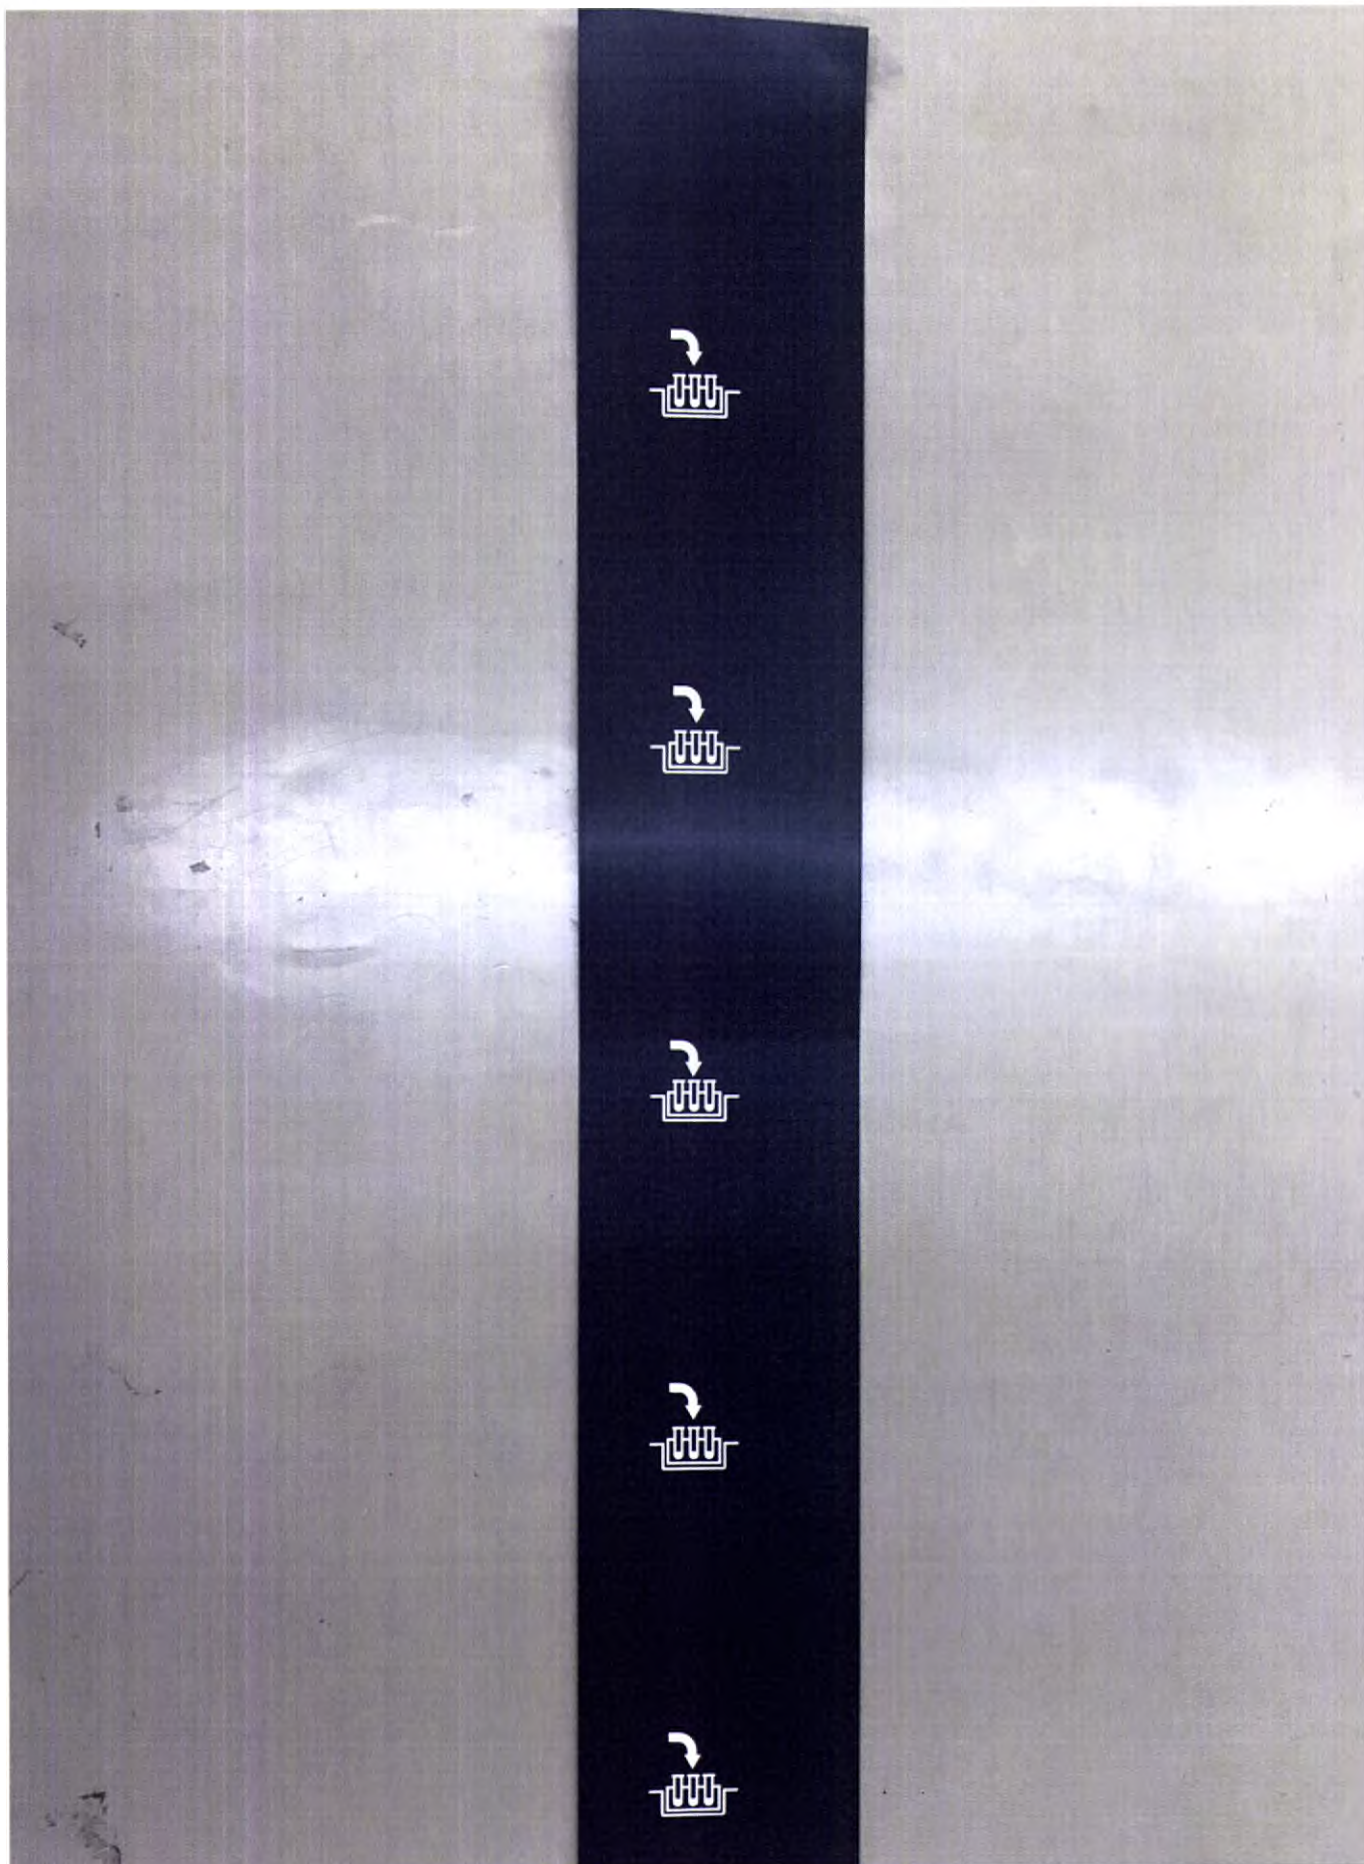

- Кабель электропитания ТА-3(А)+ТА-5(А)SJT




- Кабель электропитания TA-8CH+TA-5(A)



- Диск CD-R №266



- Предохранитель 50T032H – 2 шт.

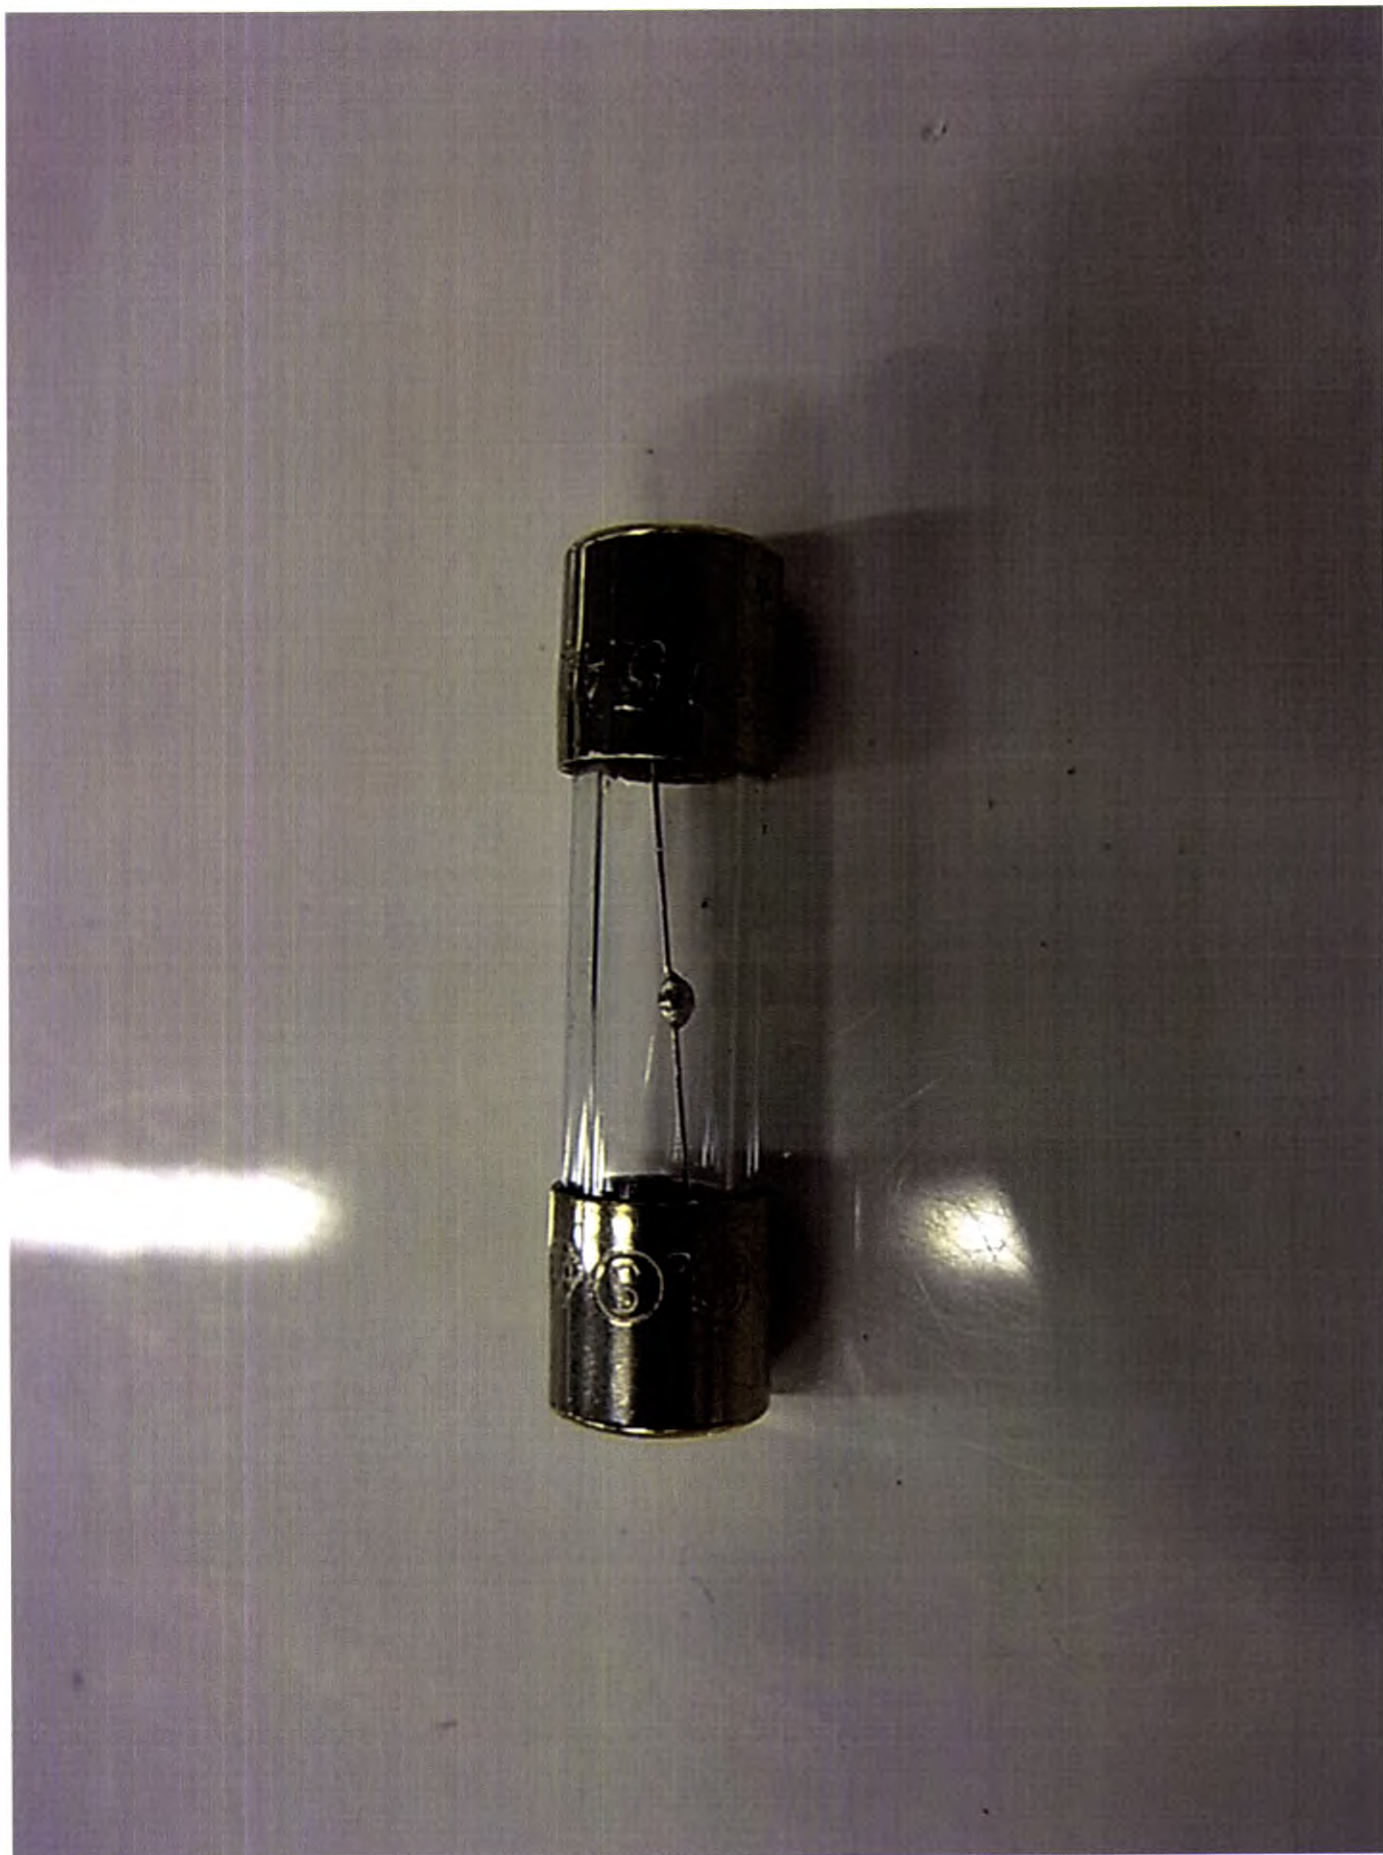

- Кабель S3IO-L20



- Кабель электропитания в сборе №9262



16.Тележка WG-44 в составе с комплектующими:
-Тележка WG-44



-Основание №472 – 3 шт.



-Крышка №4431



- Крепежный винт с шайбой (для тонкого листа толщиной 0,8), М4 х 8 – 4 шт.

3484/08/

M4x8



- Шайба плоская, номинальный диаметр 4 – 2 шт.

3 489 5029

И4



- Шайба квадратная, номинальный диаметр 6 – 2 шт.

34891013

2

Nominal diameter 6
(WASHER SQUARE M6)

8/11

WG-44



- Шайба квадратная, номинальный диаметр 4 – 2 шт.



- Винт с шестигранной головкой, М4 × 12 – 2 шт.

34850204

М4 × 12



- Шайба пружинная, номинальный диаметр 6 – 3 шт.

34895161




- Винт с шестигранной головкой М6 × 30 – 3 шт.

342-5068-2



17. Тележка WG-45 в составе с комплектующими:
-Тележка WG-45

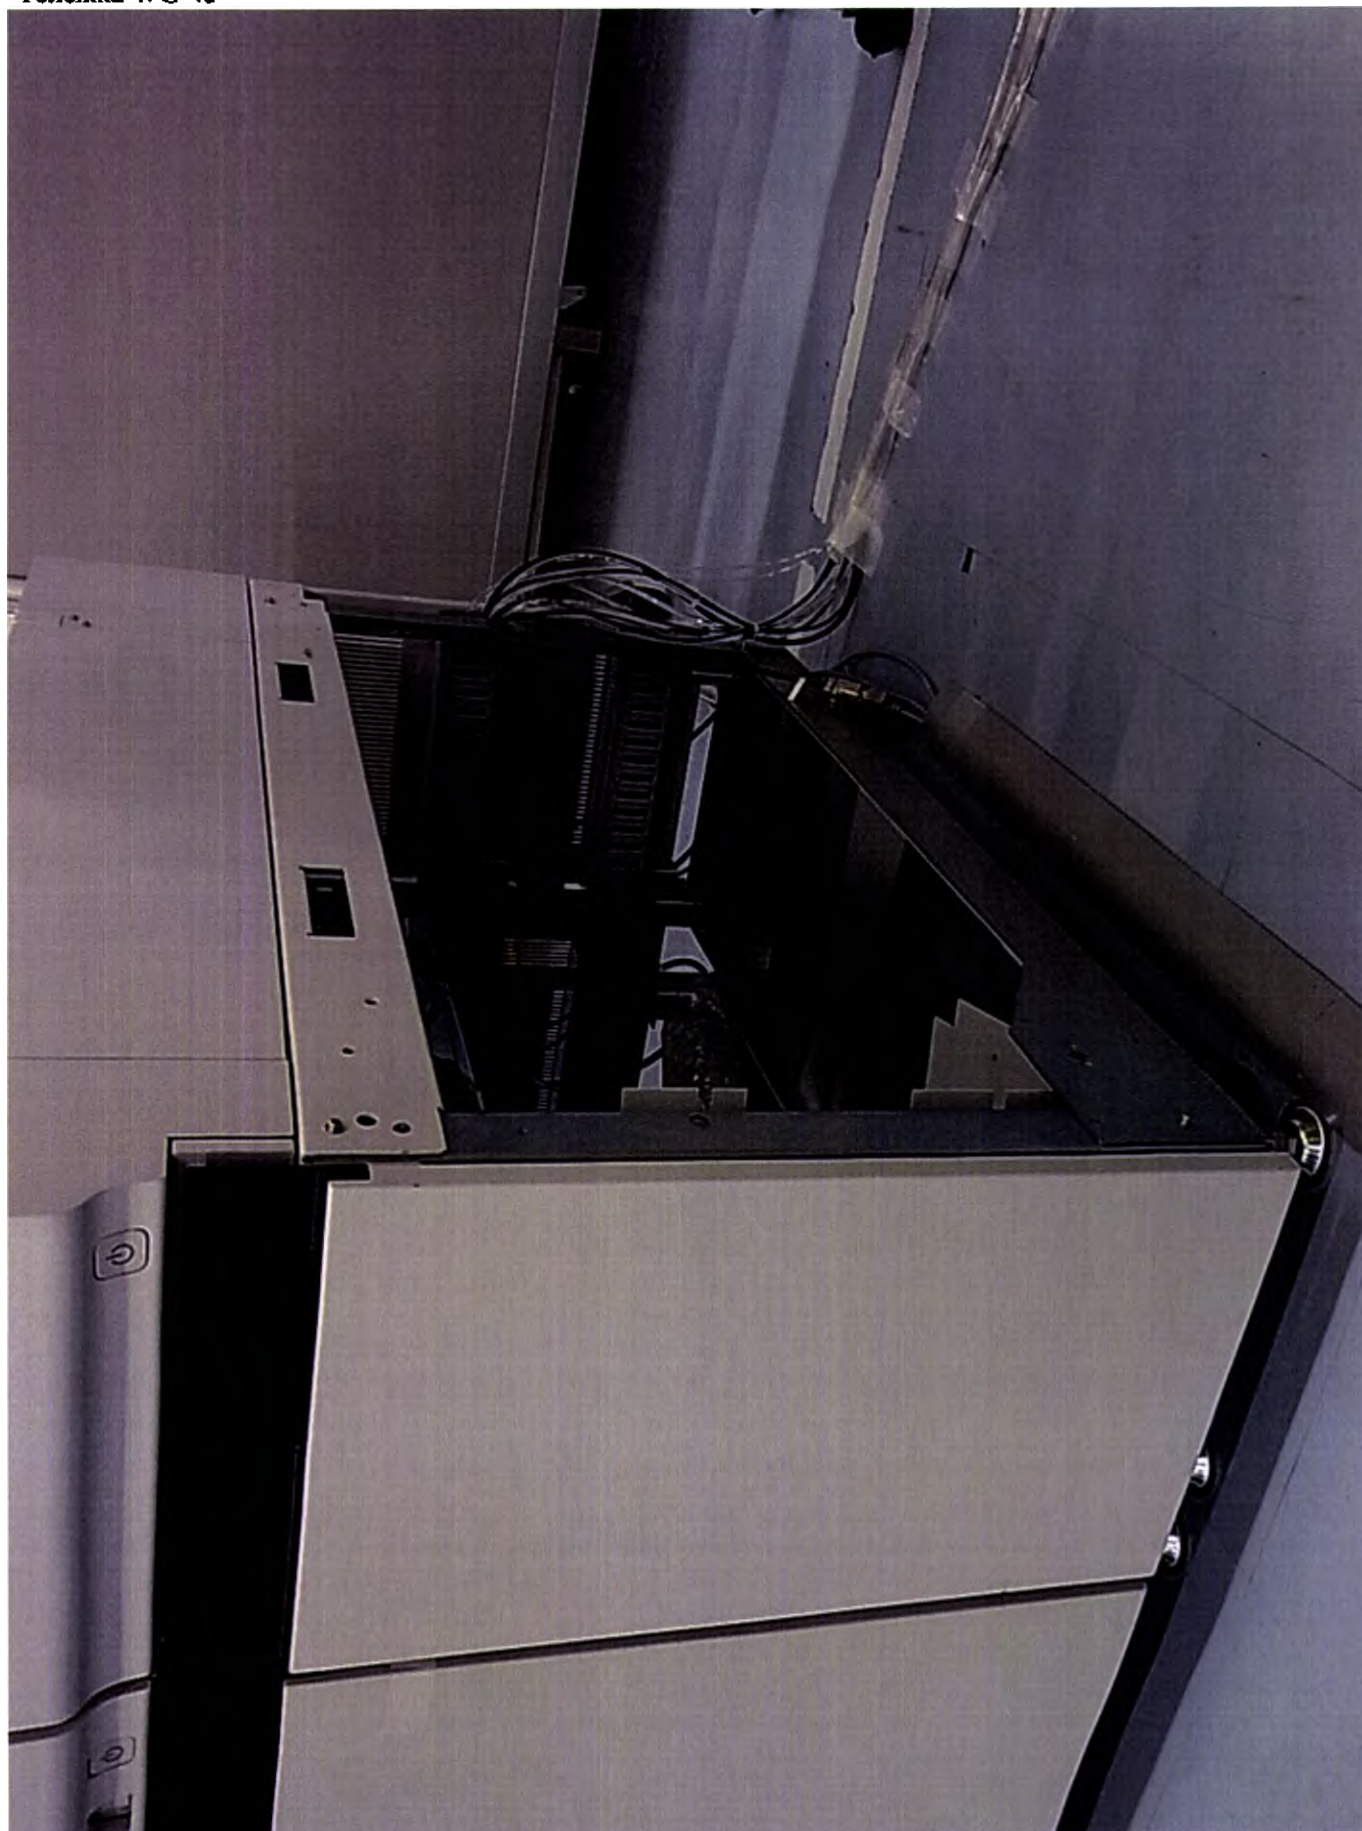

-Основание №472 – 3 шт.



-Крышка №4432



- Крепежный винт с шайбой (для тонкого листа толщиной 0,8), М4 х 8 – 4 шт.

348 4/08/

M4 x 8



- Шайба плоская, номинальный диаметр 4 – 2 шт.

3 489 5029

И4



- Шайба квадратная, номинальный диаметр 6 – 2 шт.



- Шайба пружинная, номинальный диаметр 4 – 2 шт.

34895143 M 4



- Винт с шестигранной головкой, М4 × 12 – 2 шт.

34850204

М4 × 12



- Шайба пружинная, номинальный диаметр 6 – 3 шт.

34895161




- Винт с шестигранной головкой М6 × 30 – 3 шт.

342-5068-2



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 205

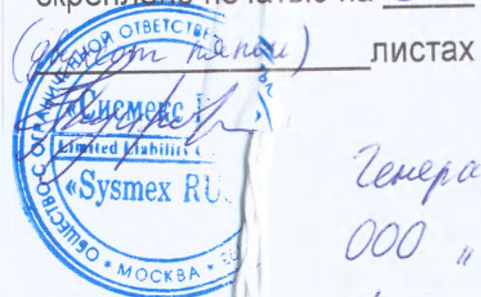

Генеральный директор
ООО «Сисмекс Рус»
Козырева Е.А.