



Фотографии медицинского изделия
«Набор материалов контрольных UC-Control для анализатора автоматического физико-химических свойств
мочи для диагностики In vitro UC-3500»
производства компании SYSMEX CORPORATION, Япония

Набор материалов контрольных UC-Control для анализатора автоматического физико-химических свойств мочи для диагностики In vitro UC-3500 (упаковка, лот UCC01902)

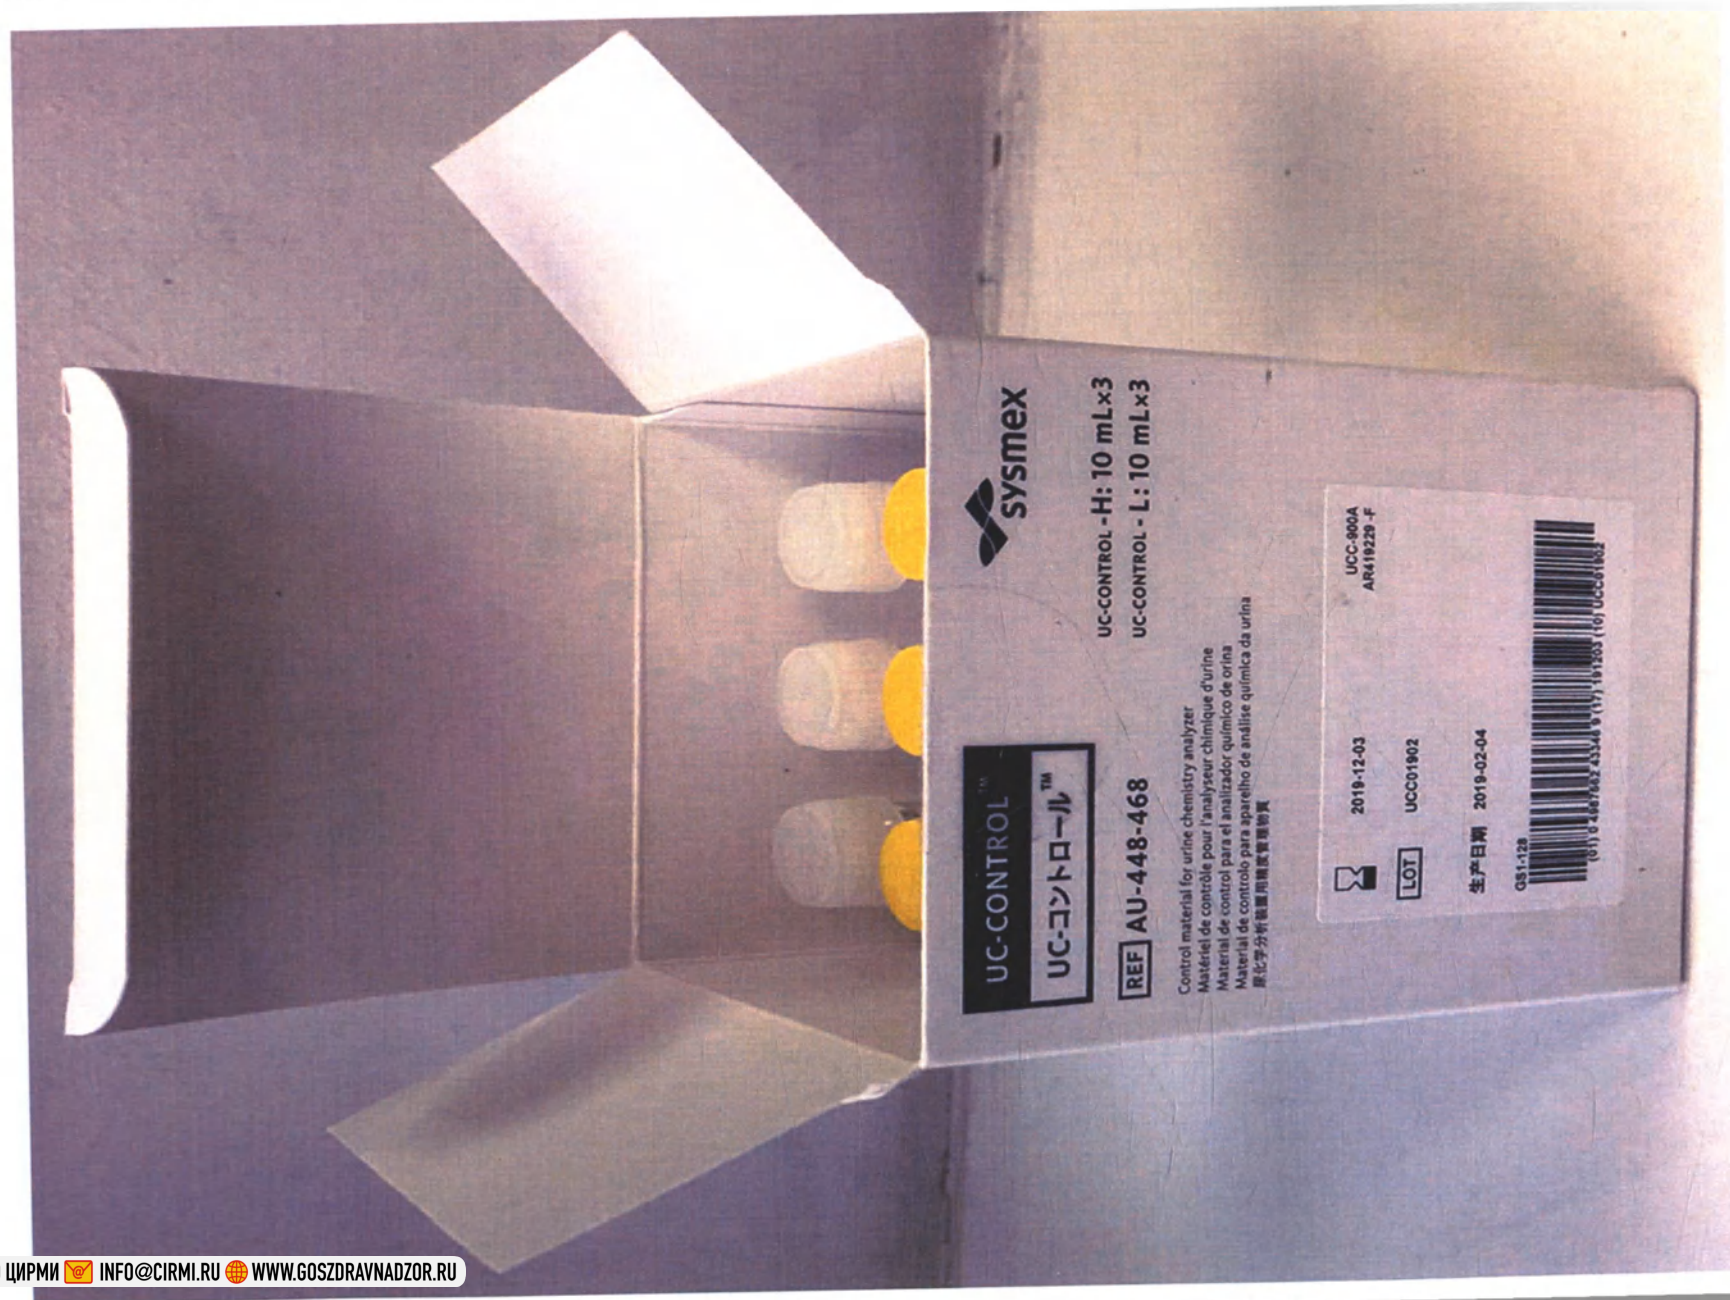

 ООО ЦПМИ **INFO@CPMI.RU** **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

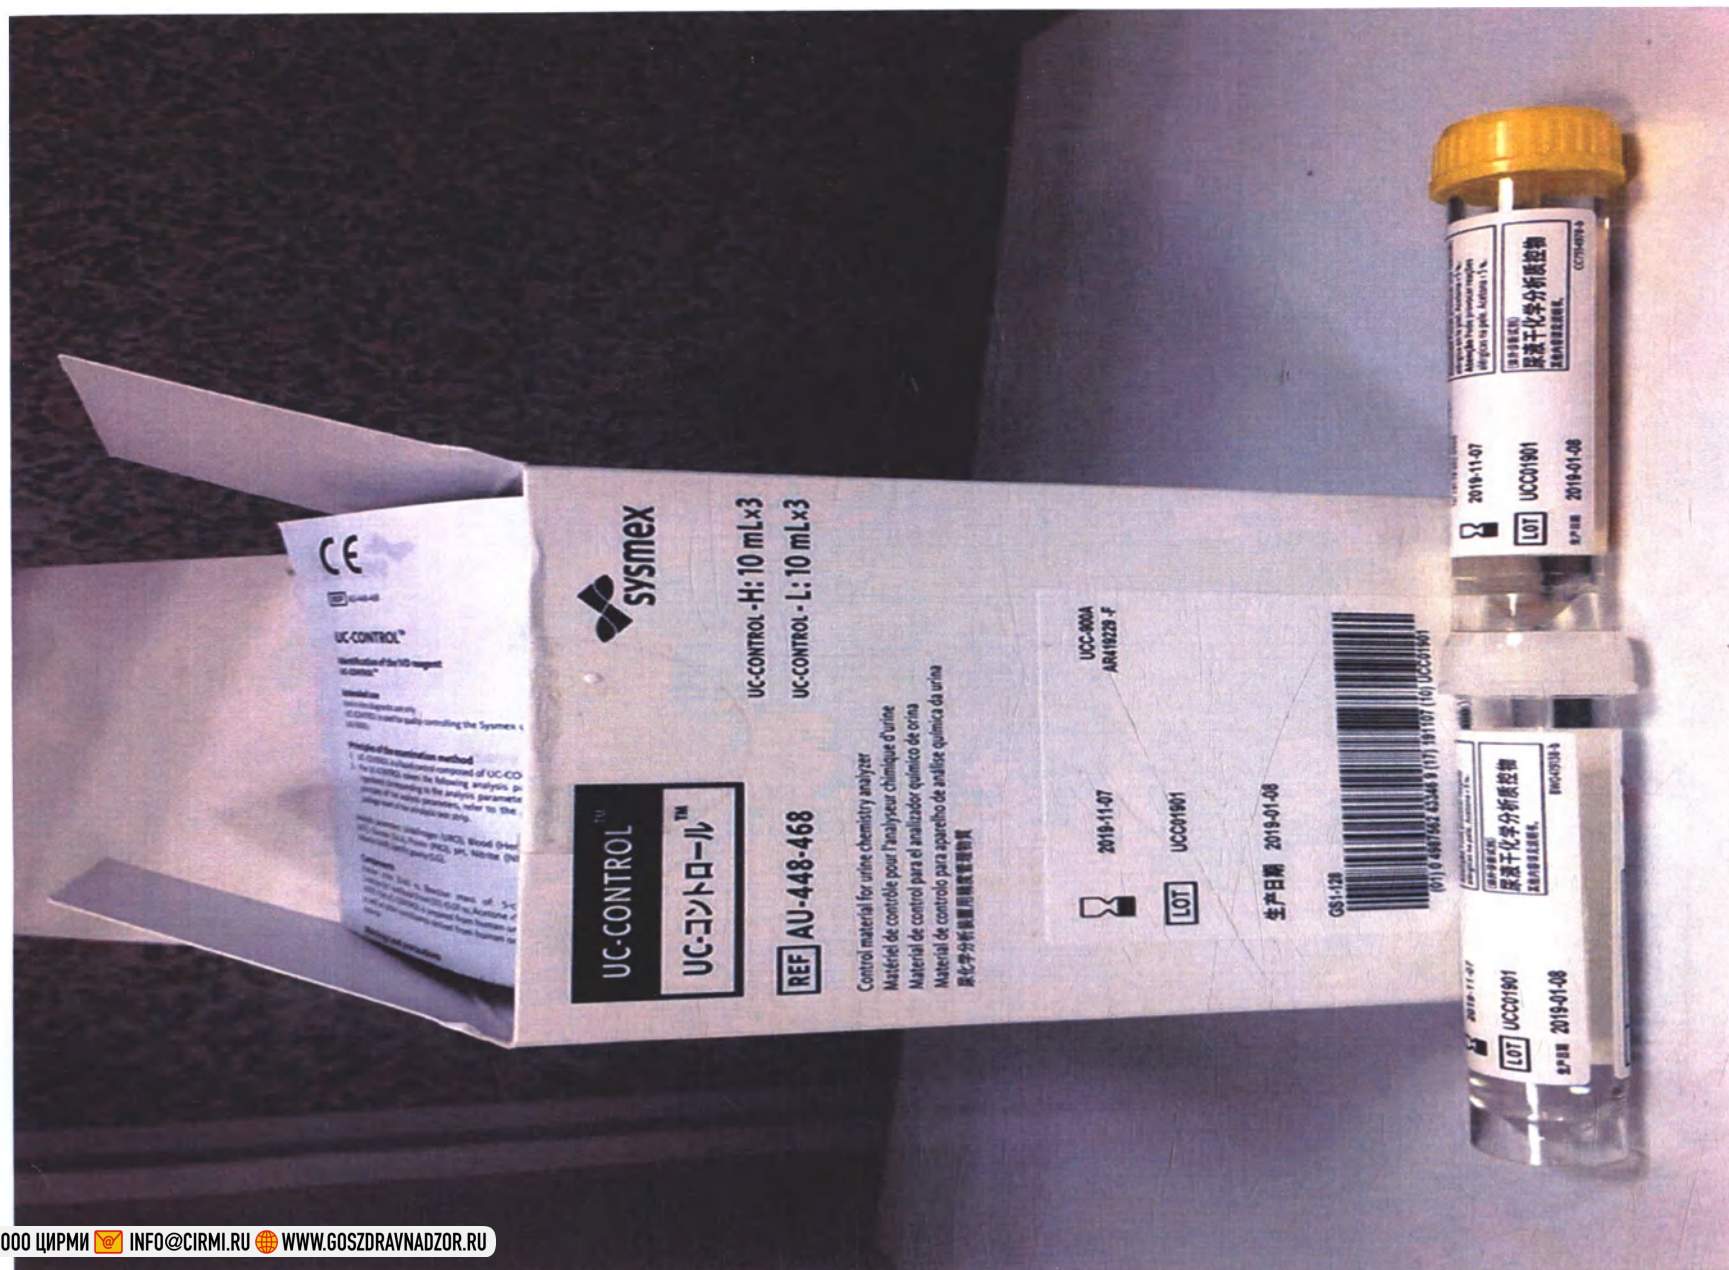

Пронумеровано, прошнуровано, прошито
и скреплено печатью

3 (три)

листов

Руководитель департамента
по регистрации, сертификации
и качеству медицинских изделий
ООО «Сисмекс РУС»

А.О. Виглинская

