



www.npfmiral.ru

Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»

одноразового применения

Тип "Стандарт 1" арт. 20x18 СМСБИУ

ТУ 32.50.50-001-26528997-2019

Рег. удостоверение № 0000-19

Дата изготовления: 03.2019

Партия №: 032019-СМС

Гарантийный срок хранения: 5 лет



НЕСТЕРИЛЬНО

Производитель:

ООО НПФ «МИРАЛ»
Россия, 394036, г. Воронеж,
ул. Фр. Энгельса, 34-33
т. (473) 221-12-12

Место производства:


ООО НПФ «МИРАЛ»
Россия, 394026, г. Воронеж,
ул. Электросигнальная, д. 1

Транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов на данном виде транспорта при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 100% при 25°C . Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25°C до $+40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 98% при 25°C . Утилизация согласно требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10.



1.

Запрокинуть голову
пострадавшего

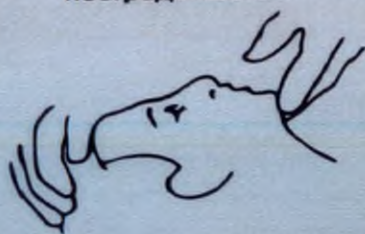

2.

Наложить устройство,
зажать нос



3.

Сделать выдох в рот
пострадавшего



Общий вид Устройства для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот» одноразового применения по ТУ 32.50.50-001-26528997-2019, тип Стандарт 1 арт. 20x18 СМСБИУ



Директор ООО НПФ «МИРАЛ»
Воскресенский А.И.



www.npfmiral.ru

Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»

одноразового применения

Тип "Стандарт 2" арт. 20x18 МБИУ

ТУ 32.50.50-001-26528997-2019

Рег. удостоверение № 0000-19

Дата изготовления: 03.2019

Партия №: 032019-М

Гарантийный срок хранения: 5 лет



НЕСТЕРИЛЬНО

Производитель:

ООО НПФ «МИРАЛ»
Россия, 394036, г. Воронеж,
ул. Фр. Энгельса, 34-33
т. (473) 221-12-12

Место производства:


ООО НПФ «МИРАЛ»
Россия, 394026, г. Воронеж,
ул. Электросигнальная, д. 1

Транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов на данном виде транспорта при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 100% при 25°C . Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25°C до $+40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 98% при 25°C . Утилизация согласно требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10.



1.

Запрокинуть голову
пострадавшего

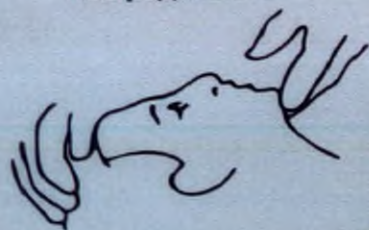

2.

Наложить устройство,
зажать нос



3.

Сделать выдох в рот
пострадавшего



Общий вид Устройства для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот» одноразового применения по ТУ 32.50.50-001-26528997-2019, тип Стандарт 2 арт. 20x18 МБИУ

научно-производственная фирма «МИРАЛ»
Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 1
Директор ООО НПФ «МИРАЛ»
Демурский А.А.



www.npfmiral.ru

**Устройство для проведения
искусственного дыхания
«Рот-устройство-рот»
одноразового применения**

Тип «Стандарт 1» арт. 20х18 СМСНИУ

ТУ 32.50.50-001-26528997-2019

Рег. удостоверение № 00000-19

Дата изготовления: 03.2019

Партия № : 032019-СМС

Гарантийный срок хранения : 5 лет



НЕСТЕРИЛЬНО

Производитель: ООО НПФ «МИРАЛ» Россия,
г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 34-33
т. (473) 221-12-12

Место производства: ООО НПФ «МИРАЛ»
Россия, 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная,
д. 1

Транспортировать всеми видами крытого транспорта
в соответствии с ГОСТ 17768 и правилами перевозки
грузов на данном виде транспорта при температуре
от -50°C до +50°C ± 2°C и относительной влажности 100%
при 25°C. Хранить в закрытых помещениях с естественной
вентиляцией при температуре от -25°C до +40°C ± 2°C
и относительной влажности до 98% при 25°C.

Утилизация согласно требованиям СанПин 2.1.7.2790-10.



1.

Запрокинуть голову
пострадавшего



2.

Наложить устройство,
зажать нос



3.

Сделать выдох в рот
пострадавшего



Директор ООО НПФ «МИРАЛ»
Венгученко А.А.

Общий вид Устройства для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот» одноразового применения по ТУ 32.50.50-001-26528997-2019, тип Стандарт 1 арт. 20х18 СМСНИУ



www.npfmiral.ru

**Устройство для проведения
искусственного дыхания
«Рот-устройство-рот»
одноразового применения**

Тип «Стандарт 2» арт. 20x18 МНИУ

ТУ 32.50.50-001-26528997-2019

Рег. удостоверение № 00000-19

Дата изготовления: 03.2019

Партия № : 032019-М

Гарантийный срок хранения : 5 лет




НЕСТЕРИЛЬНО

Производитель: ООО НПФ «МИРАЛ» Россия,
г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 34-33
т. (473) 221-12-12

Место производства: ООО НПФ «МИРАЛ»
Россия, 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная,
д. 1

Транспортировать всеми видами крытого транспорта
в соответствии с ГОСТ 17768 и правилами перевозки
грузов на данном виде транспорта при температуре
от -50°C до +50°C $\pm$ 2°C и относительной влажности 100%
при 25°C. Хранить в закрытых помещениях с естественной
вентиляцией при температуре от -25°C до +40°C $\pm$ 2°C
и относительной влажности до 98% при 25°C.

Утилизация согласно требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10.

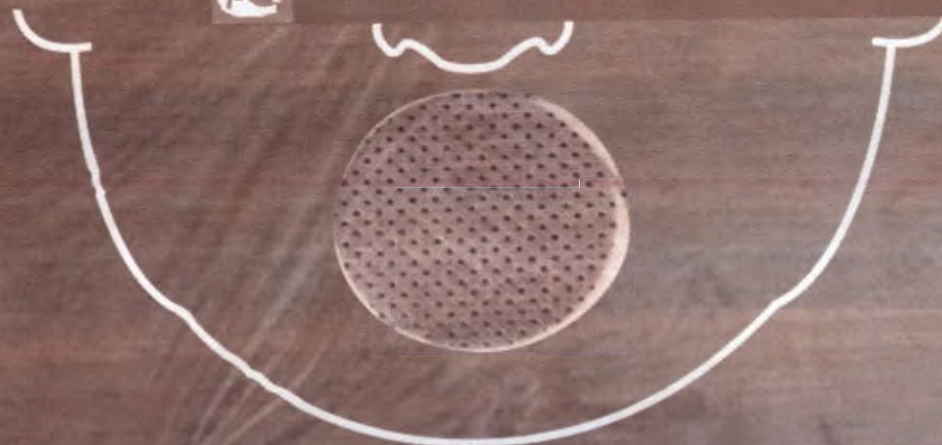


1.

Запрокинуть голову
пострадавшего



2.

Наложить устройство,
зажать нос



3.

Сделать выдох в рот
пострадавшего



*Вручен по доверенности
генеральному директору*

Общий вид Устройства для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот» одноразового применения по ТУ 32.50.50-001-26528997-2019, тип Стандарт 2 арт. 20x18 МНИУ



www.npfmiral.ru

**Устройство
для проведения
искусственного дыхания
"рот-устройство-рот"
одноразового применения**

Тип "Стандарт 2" арт. 20х18 МНИУ
ТУ 32.50.50-001-26528997-2019

Рег. удостоверение № 0000-19

Дата изготовления: 03.2019

Партия № 032019-М

Гарантийный срок хранения : 5 лет



НЕСТЕРИЛЬНО

Производитель:

ООО НПФ "МИРАЛ"
Россия, 394036, г. Воронеж,
ул. Фр.Энгельса, 34-33
т. (473) 221-12-12

Место производства:

ООО НПФ "МИРАЛ"
Россия, 394026, г. Воронеж,
ул. Электросигнальная, д.1

Транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов на данном виде транспорта при температуре от -50 °С до +50 °С $\pm 2^\circ$ С и относительной влажности 100% при 25°С.

Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 °С до +40 °С $\pm 2^\circ$ С и относительной влажности до 98% при 25°С.

Утилизация согласно требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10.



Директор ООО НПФ "МИРАЛ"
Решетников С.И.

Общий вид Устройства для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот» одноразового применения по ТУ 32.50.50-001-26528997-2019 в индивидуальной упаковке с маркировкой



1000 шт.

Партия № 032019-СМС

НЕТОКСИЧНО
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО
ДЫХАНИЯ «РОТ-УСТРОЙСТВО-РОТ»
ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТУ 32.50.50-001-26528997-2019

НЕСТЕРИЛЬНО

Тип «Стандарт 1» арт. 20x18 СМСБИУ
РУ №.....

Дата изготовления: 03.2019

Гарантийный срок хранения: 5 лет

Упаковщик

ОТК

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО НПФ «МИРАЛ»

Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 34-33 т. (473) 221-12-12

Утилизация согласно требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10.

Устройства хранят в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 °С до +40 °С $\pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 98% при 25 °С



Директор ООО НПФ «МИРАЛ»
Резурнев С.И.