




Базовая комплектация (основной комплект поставки):

Блок основной с дисплеем в сборе (вид спереди)




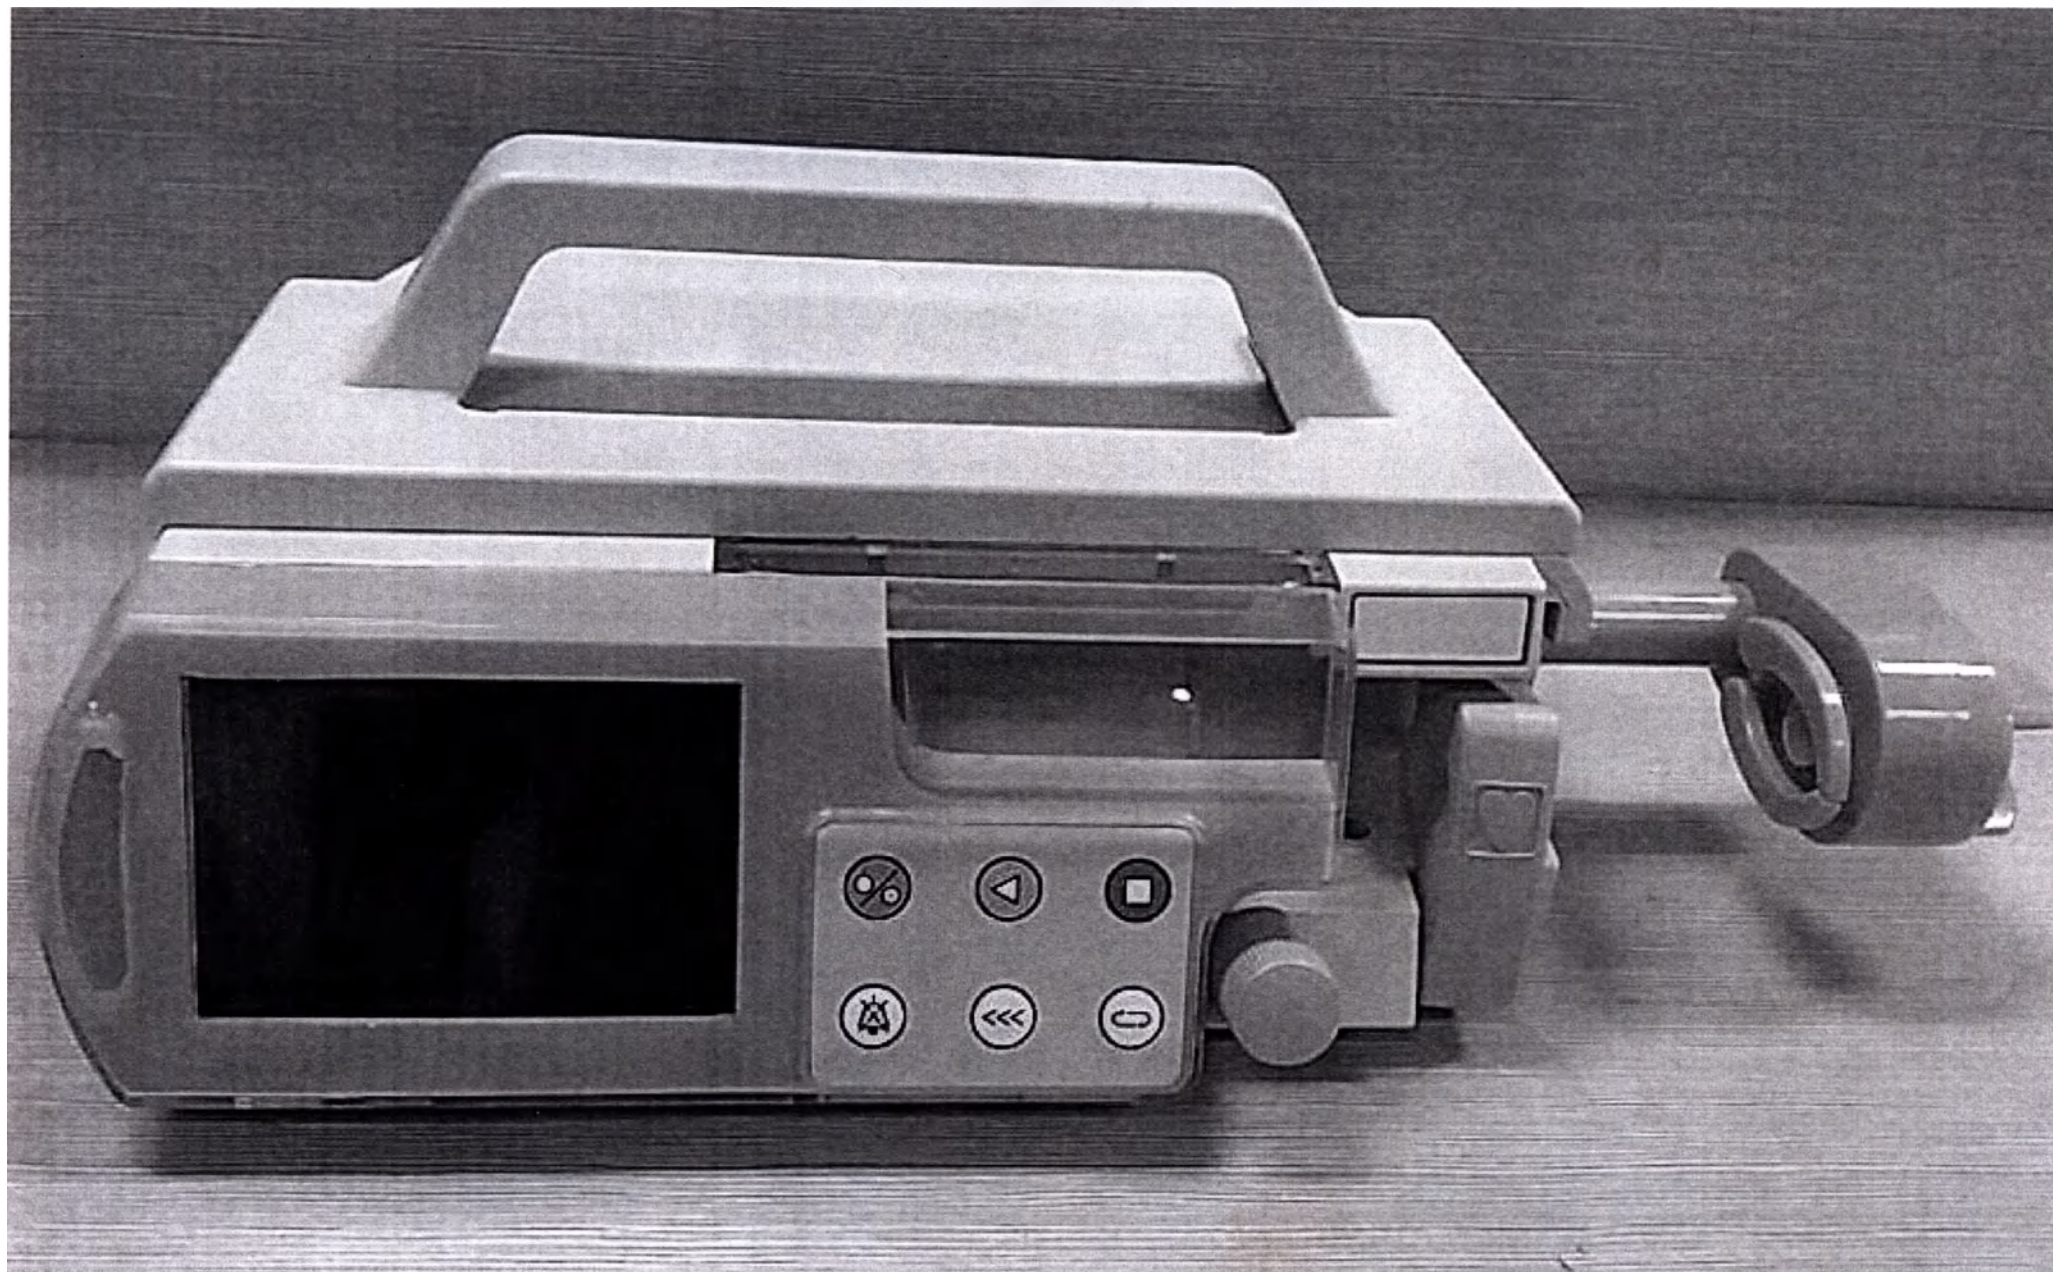

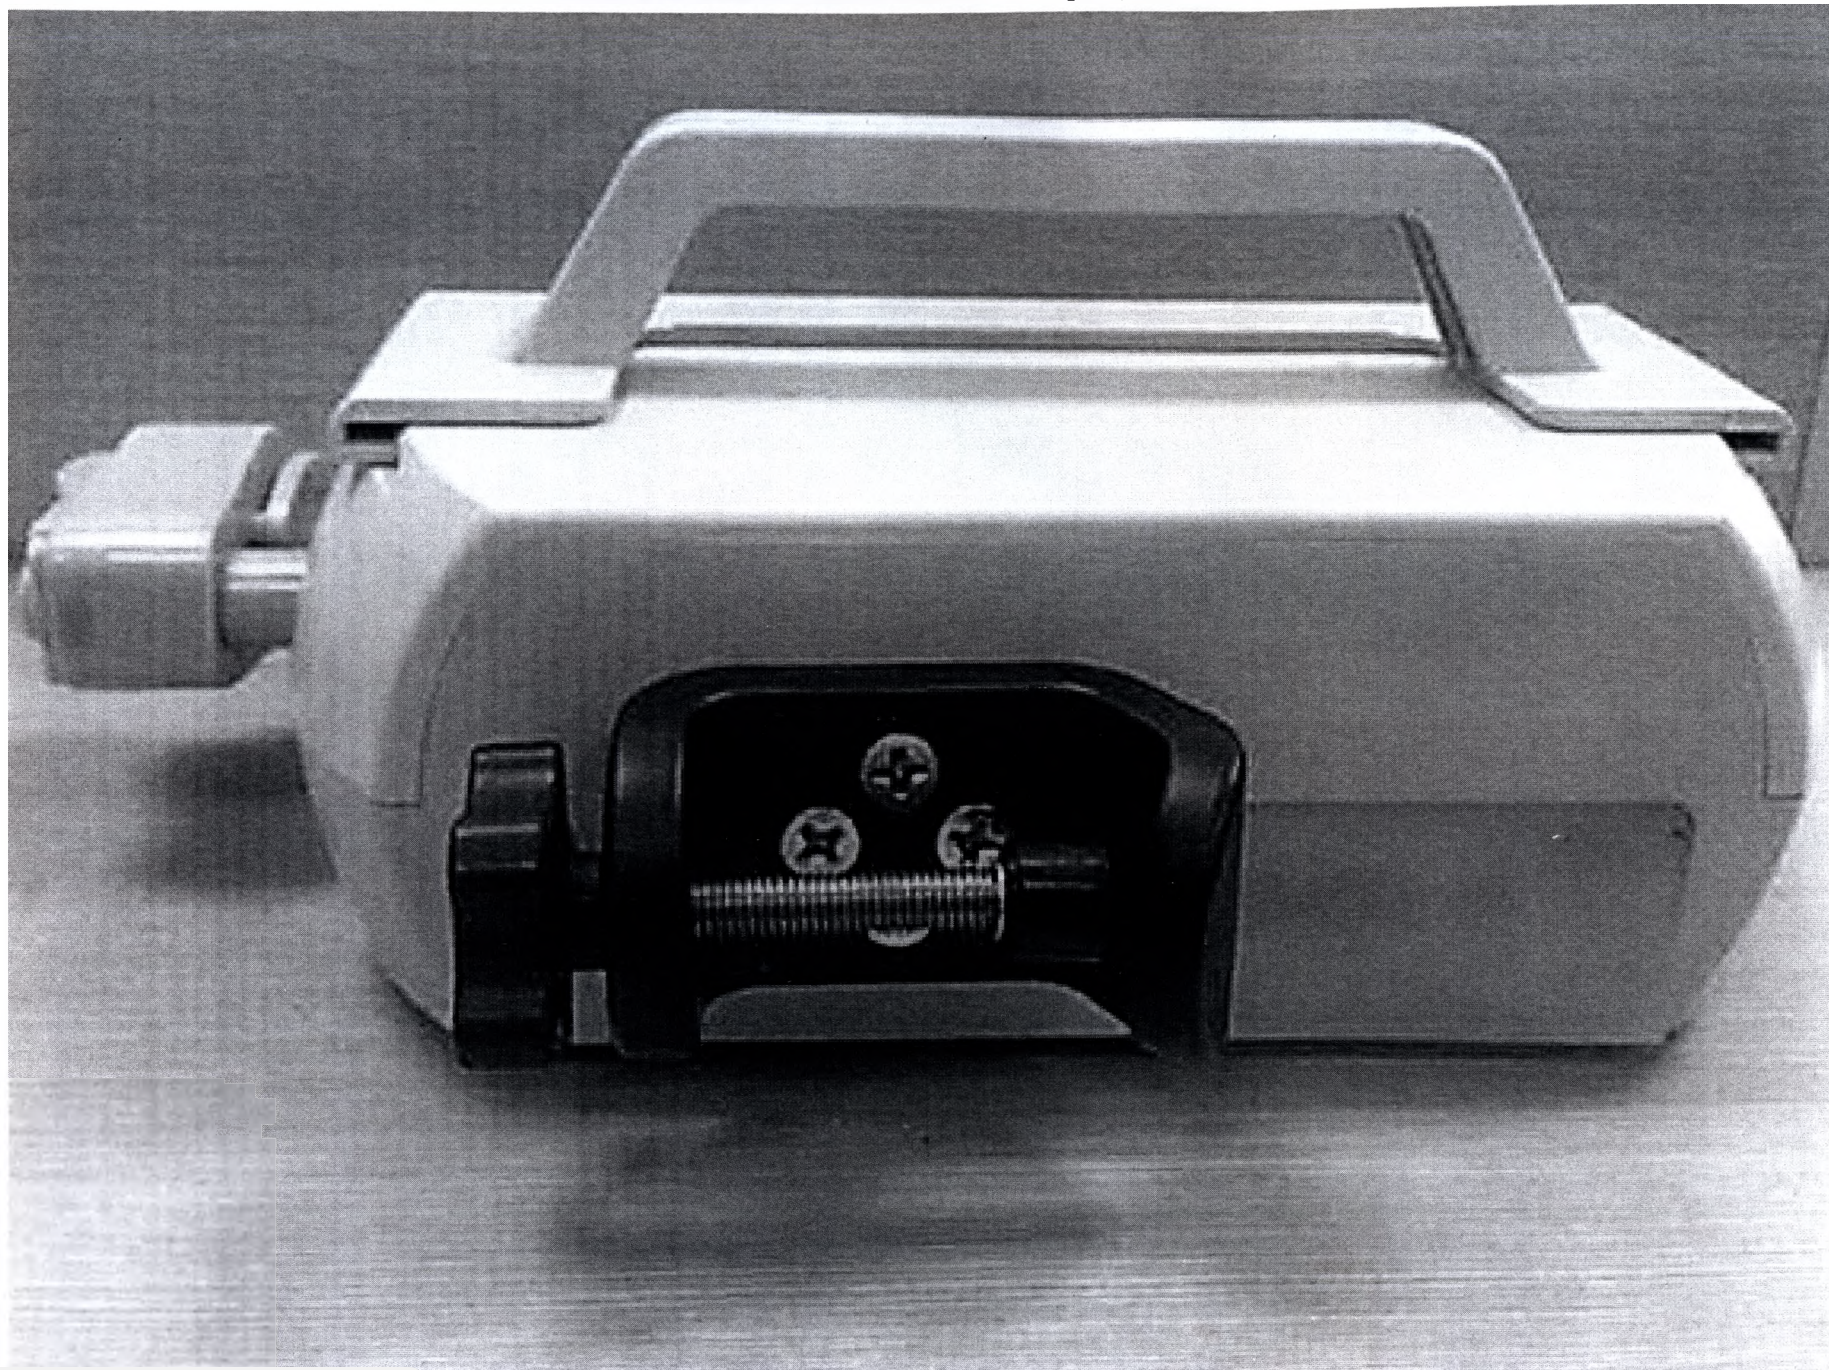

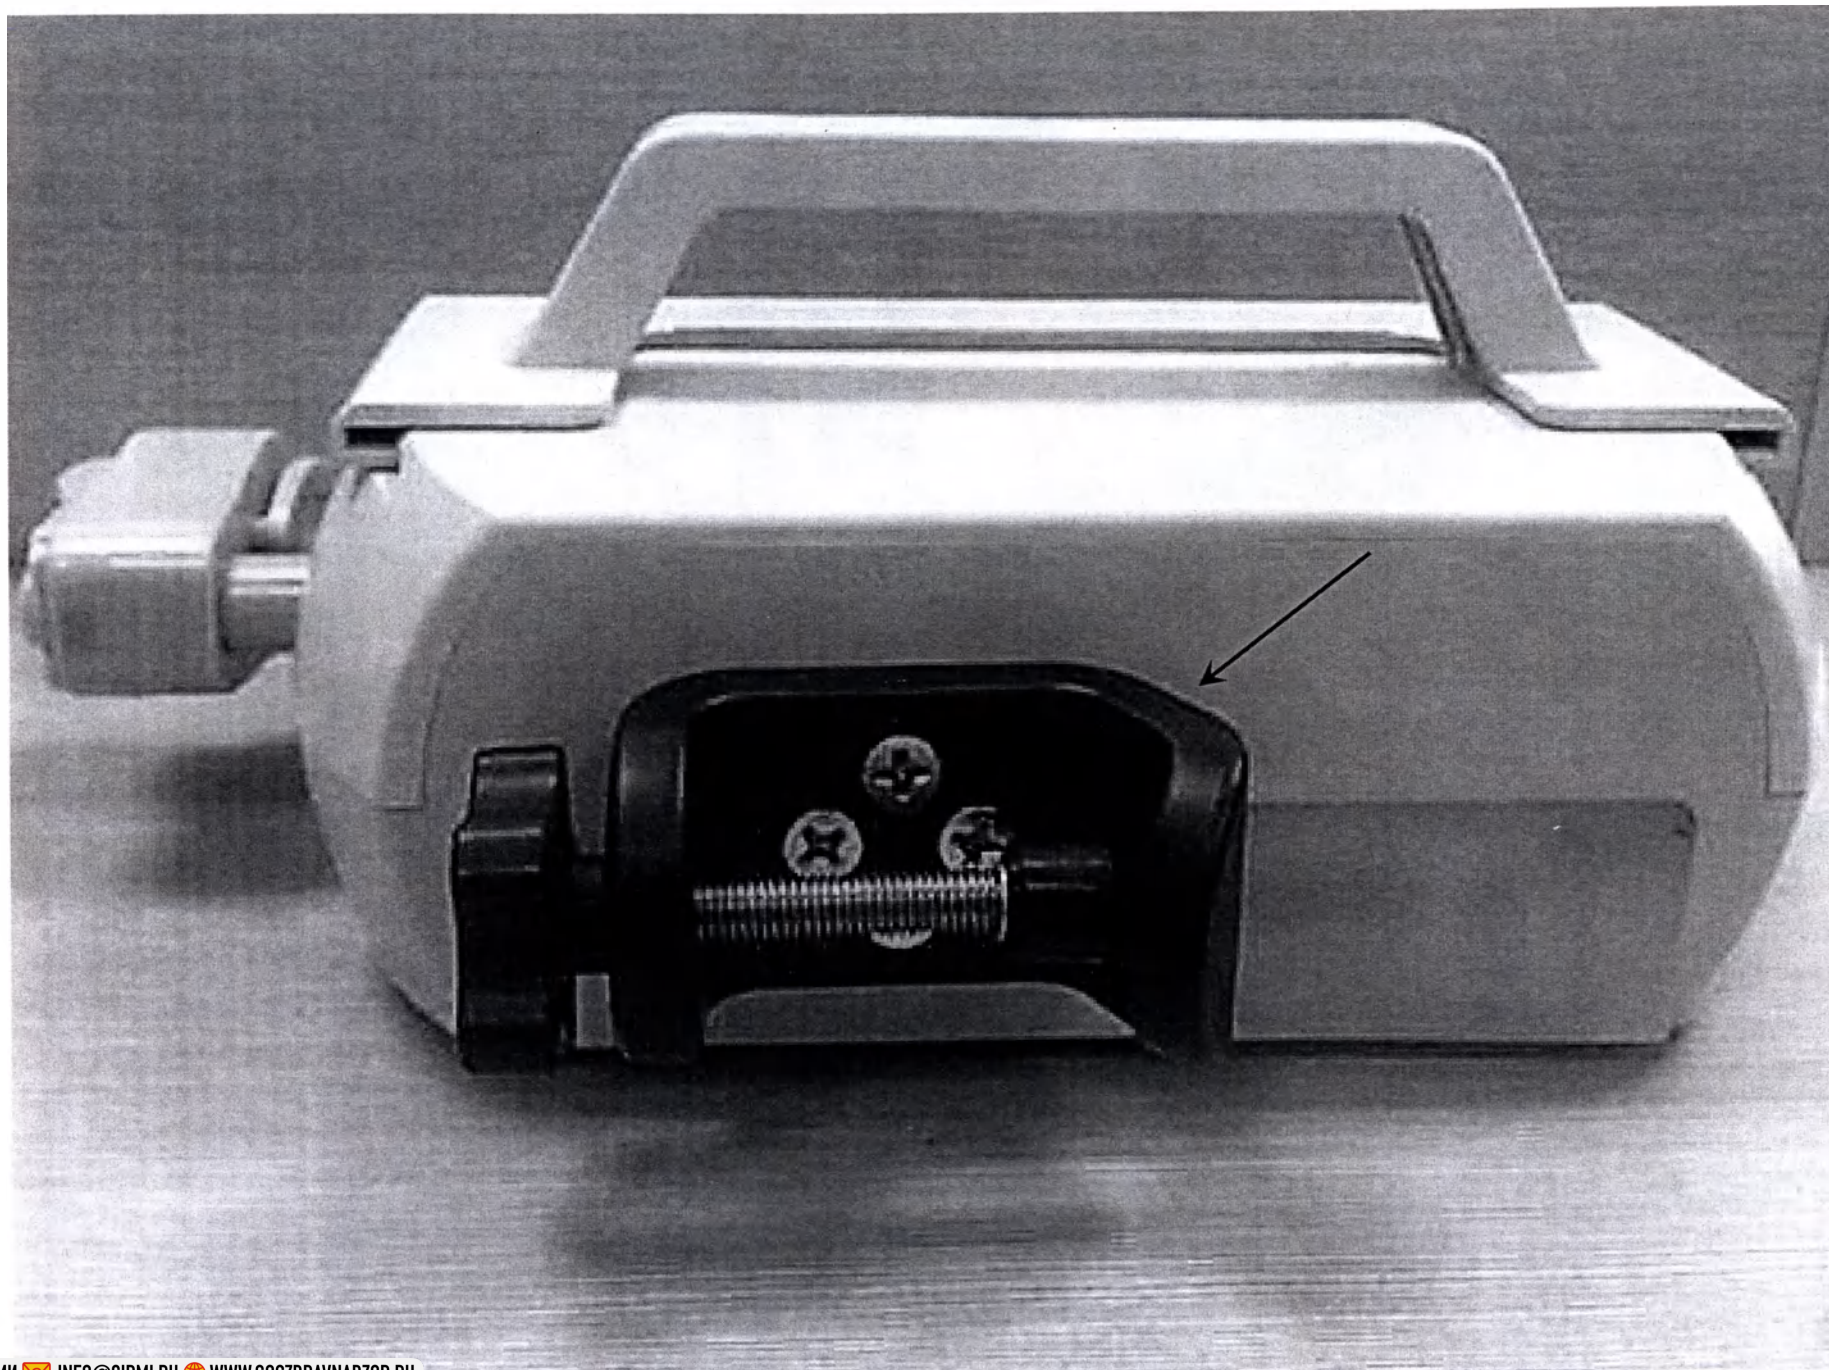

Кабель питания

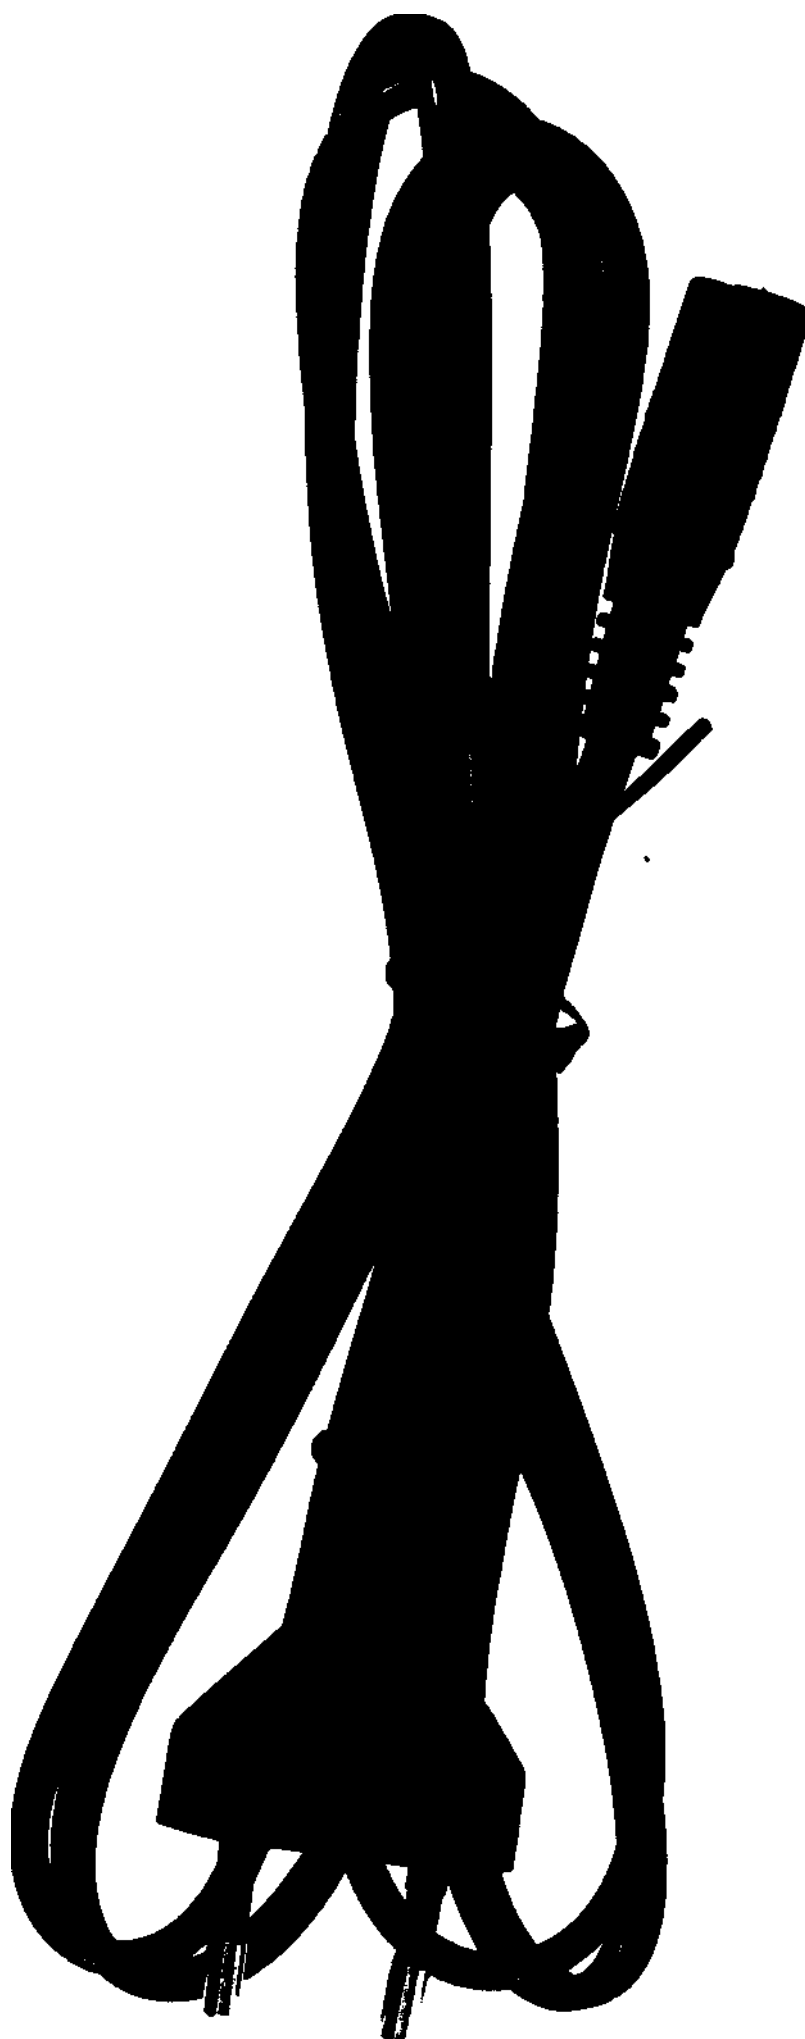



УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
«ООО» ДИКСИОН

(Дата)

(Подпись) (Расшифровка подписи)



Руководство по эксплуатации
Насосы инфузионные шприцевые «ИНСТИЛАР»
«ИНСТИЛАР-1418»
по ТУ 9444-015-74487176-2008

Паспорт

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
«ООО» ДИКСИОН

(Дата)


(Подпись) (Расшифровка подписи)


DIXION

Паспорт


Насос инфузионный шприцевой «ИНСТИЛАР»
«ИНСТИЛАР-1418»

по ТУ 9444-015-74487176-2008

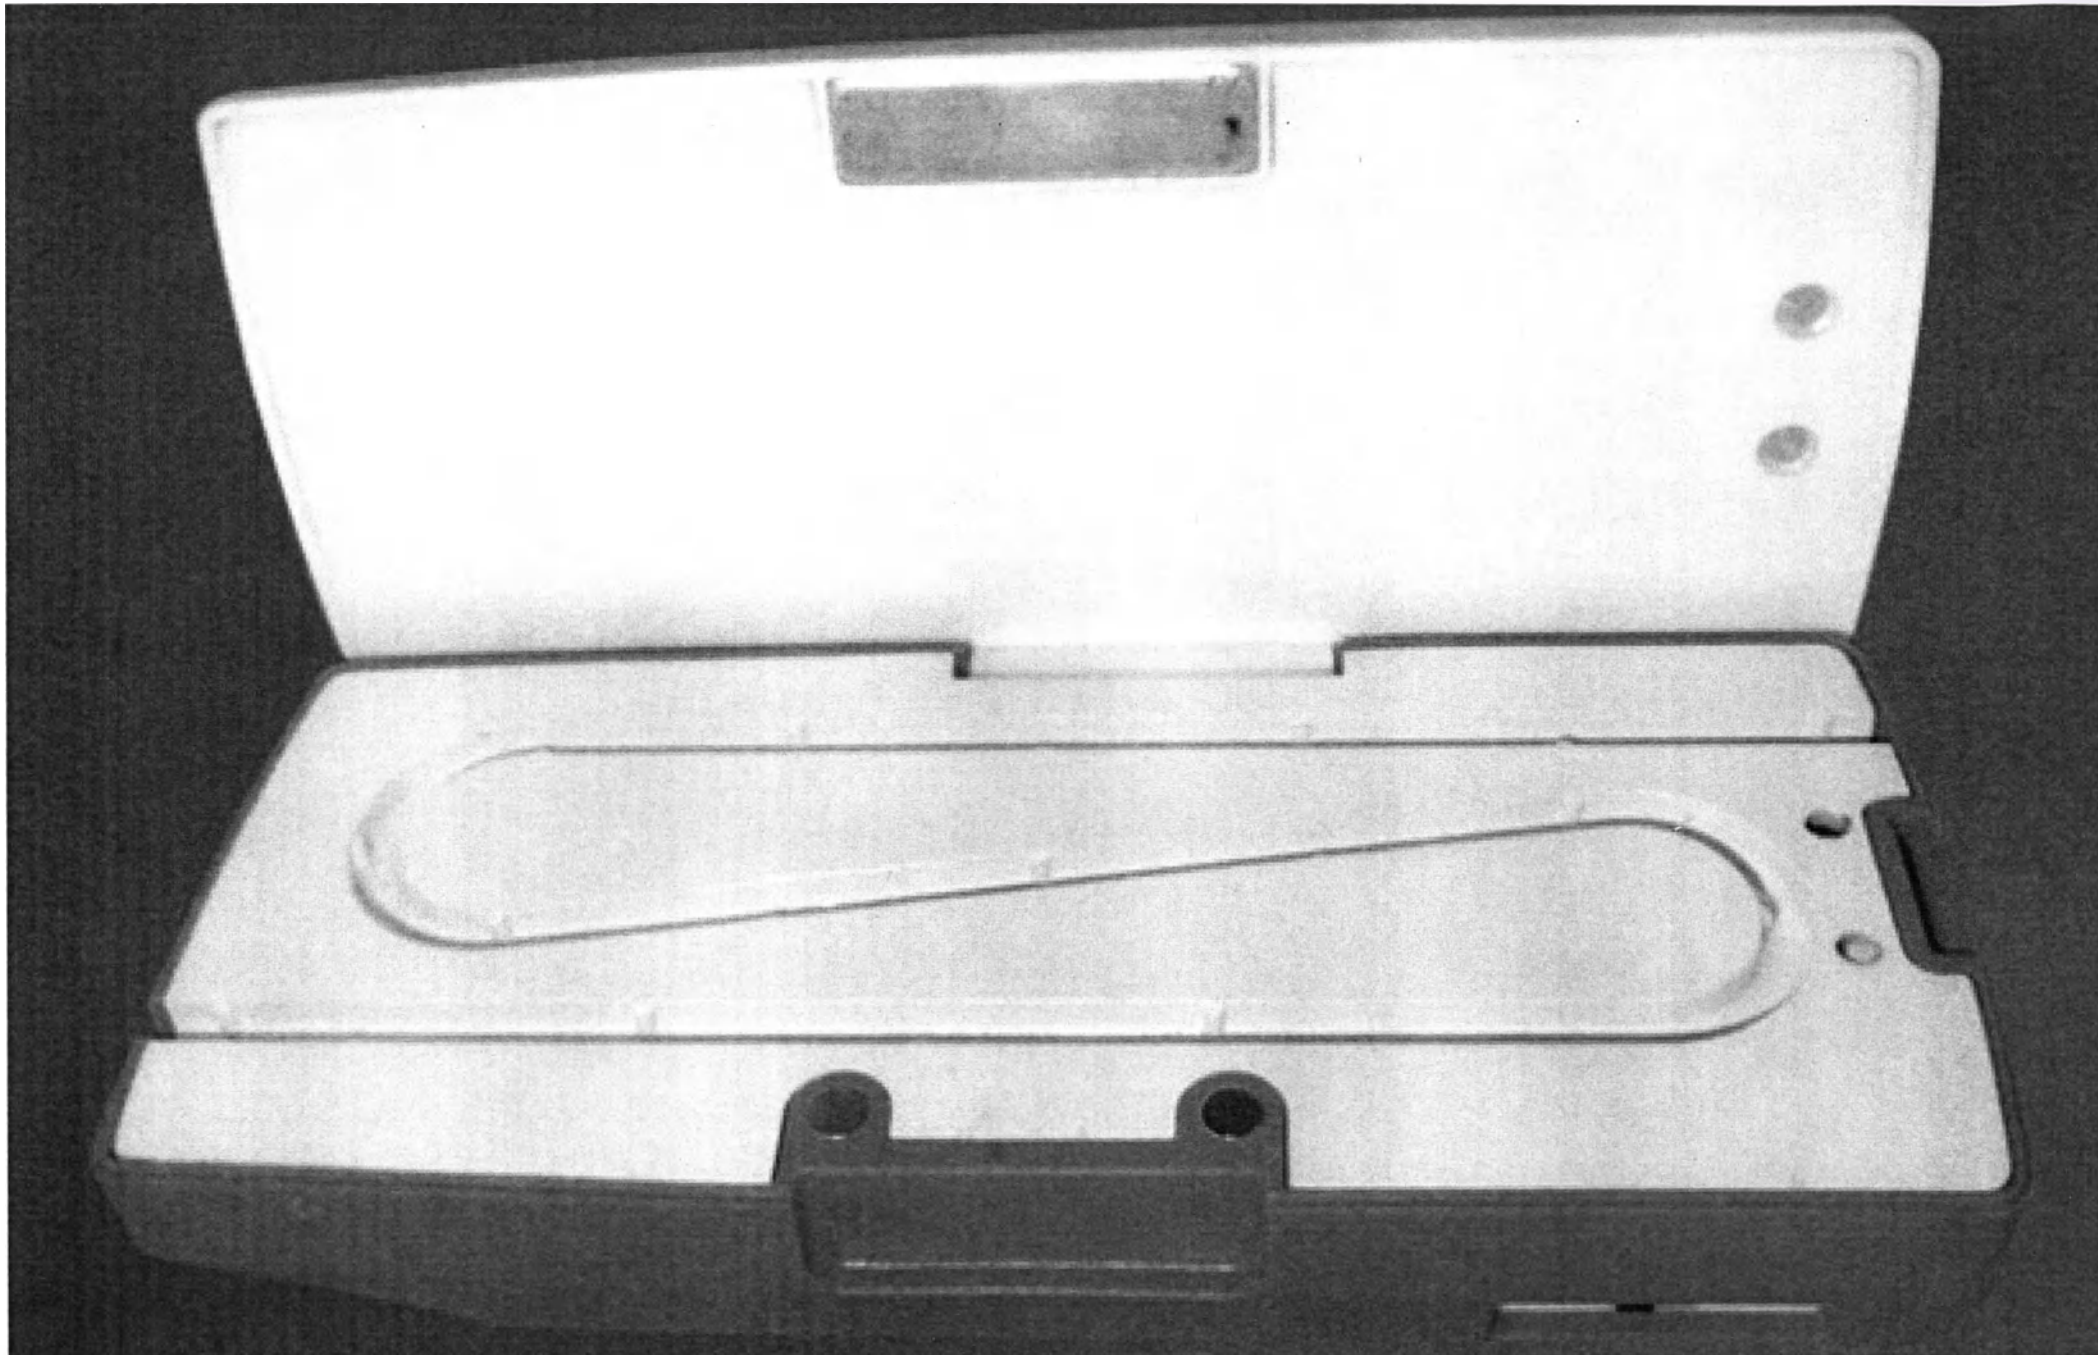

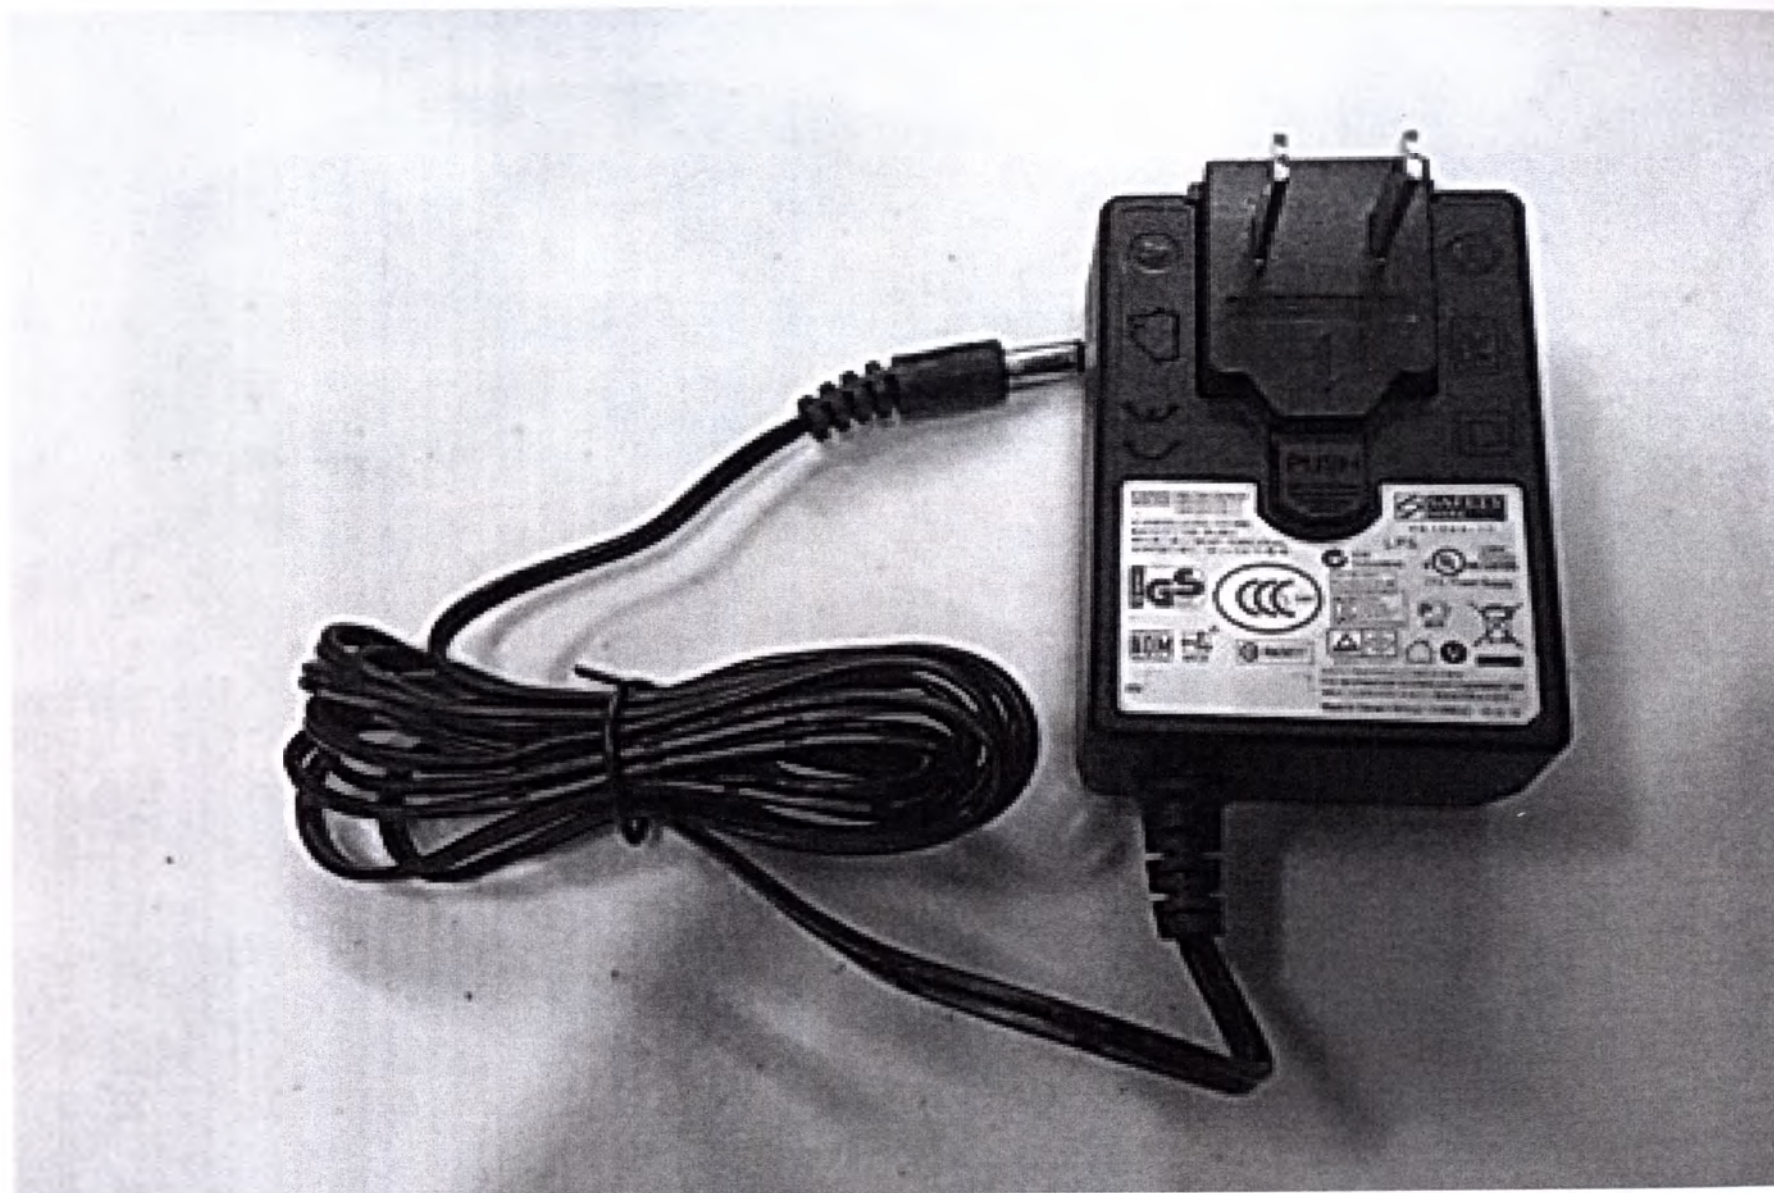

Диск с программным обеспечением для центральной станции мониторинга

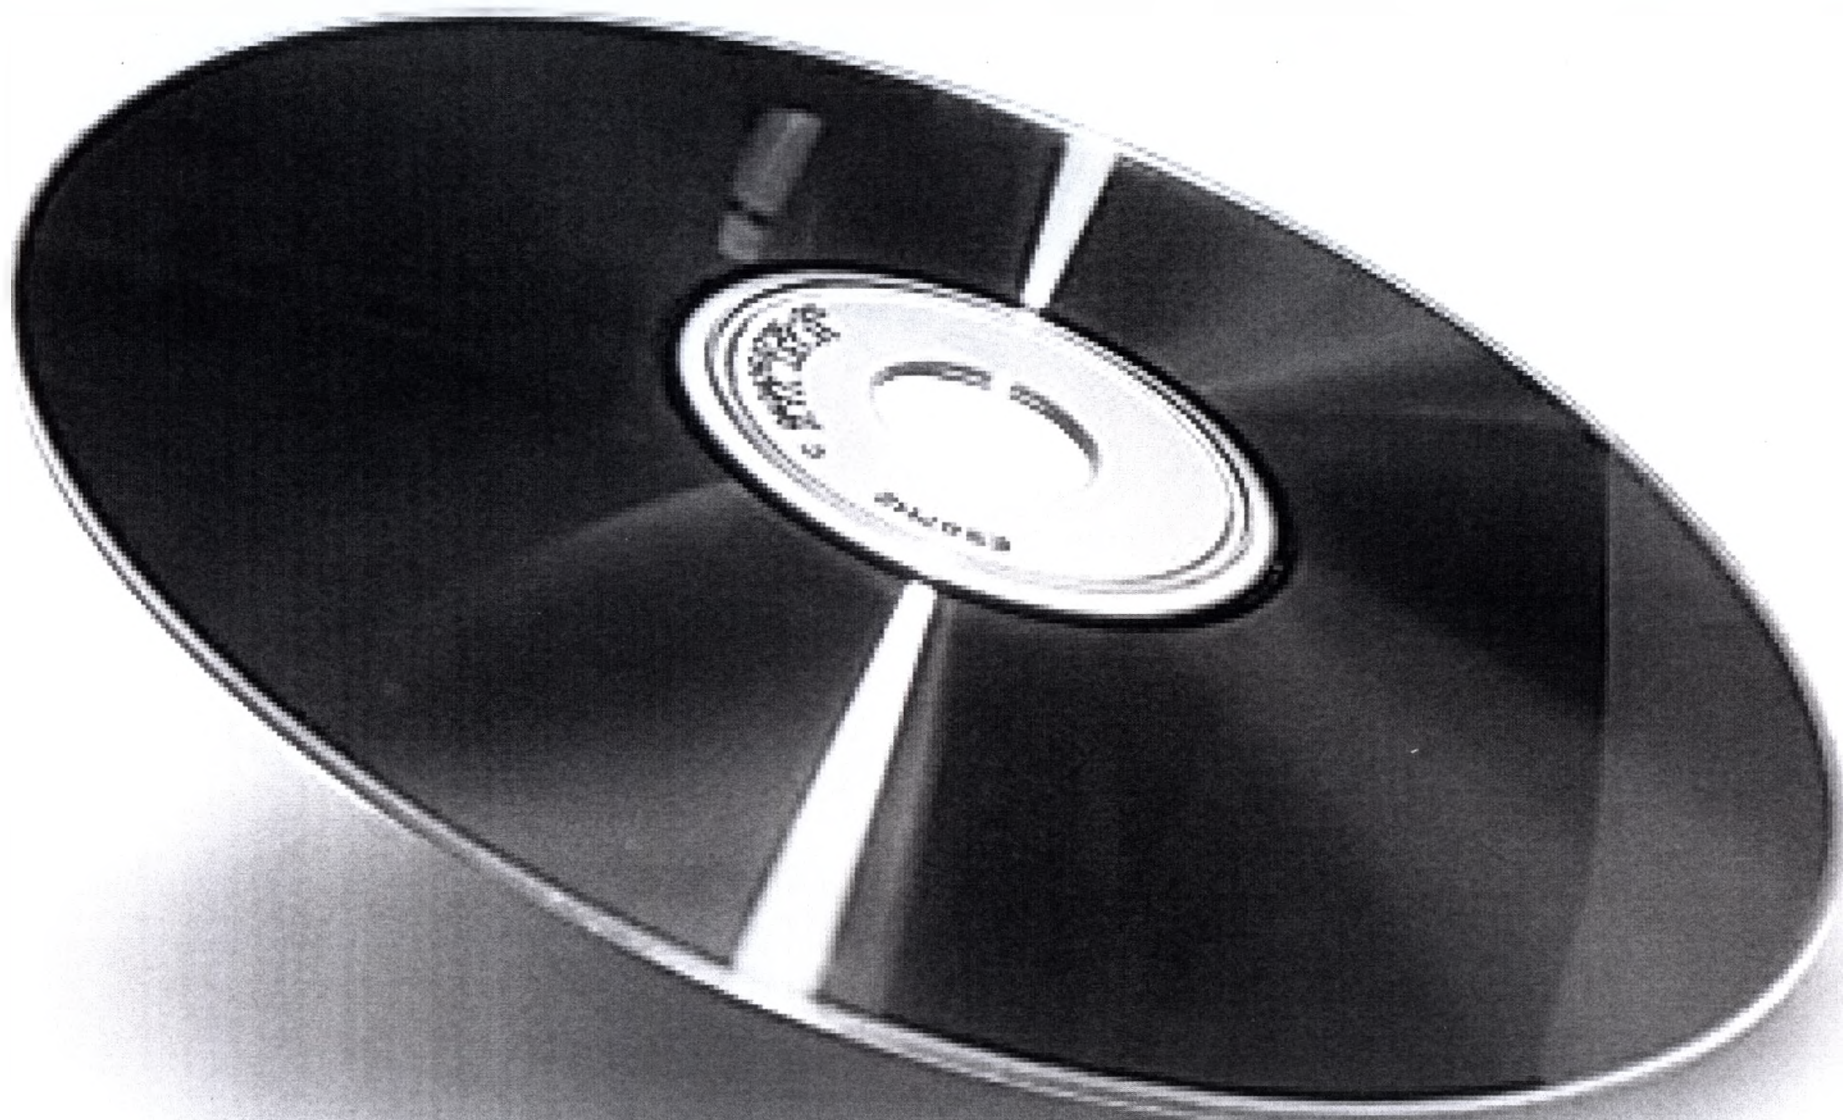




Стойка инфузионная передвижная




Консоль для инфузионных насосов




Станция для инфузионных насосов

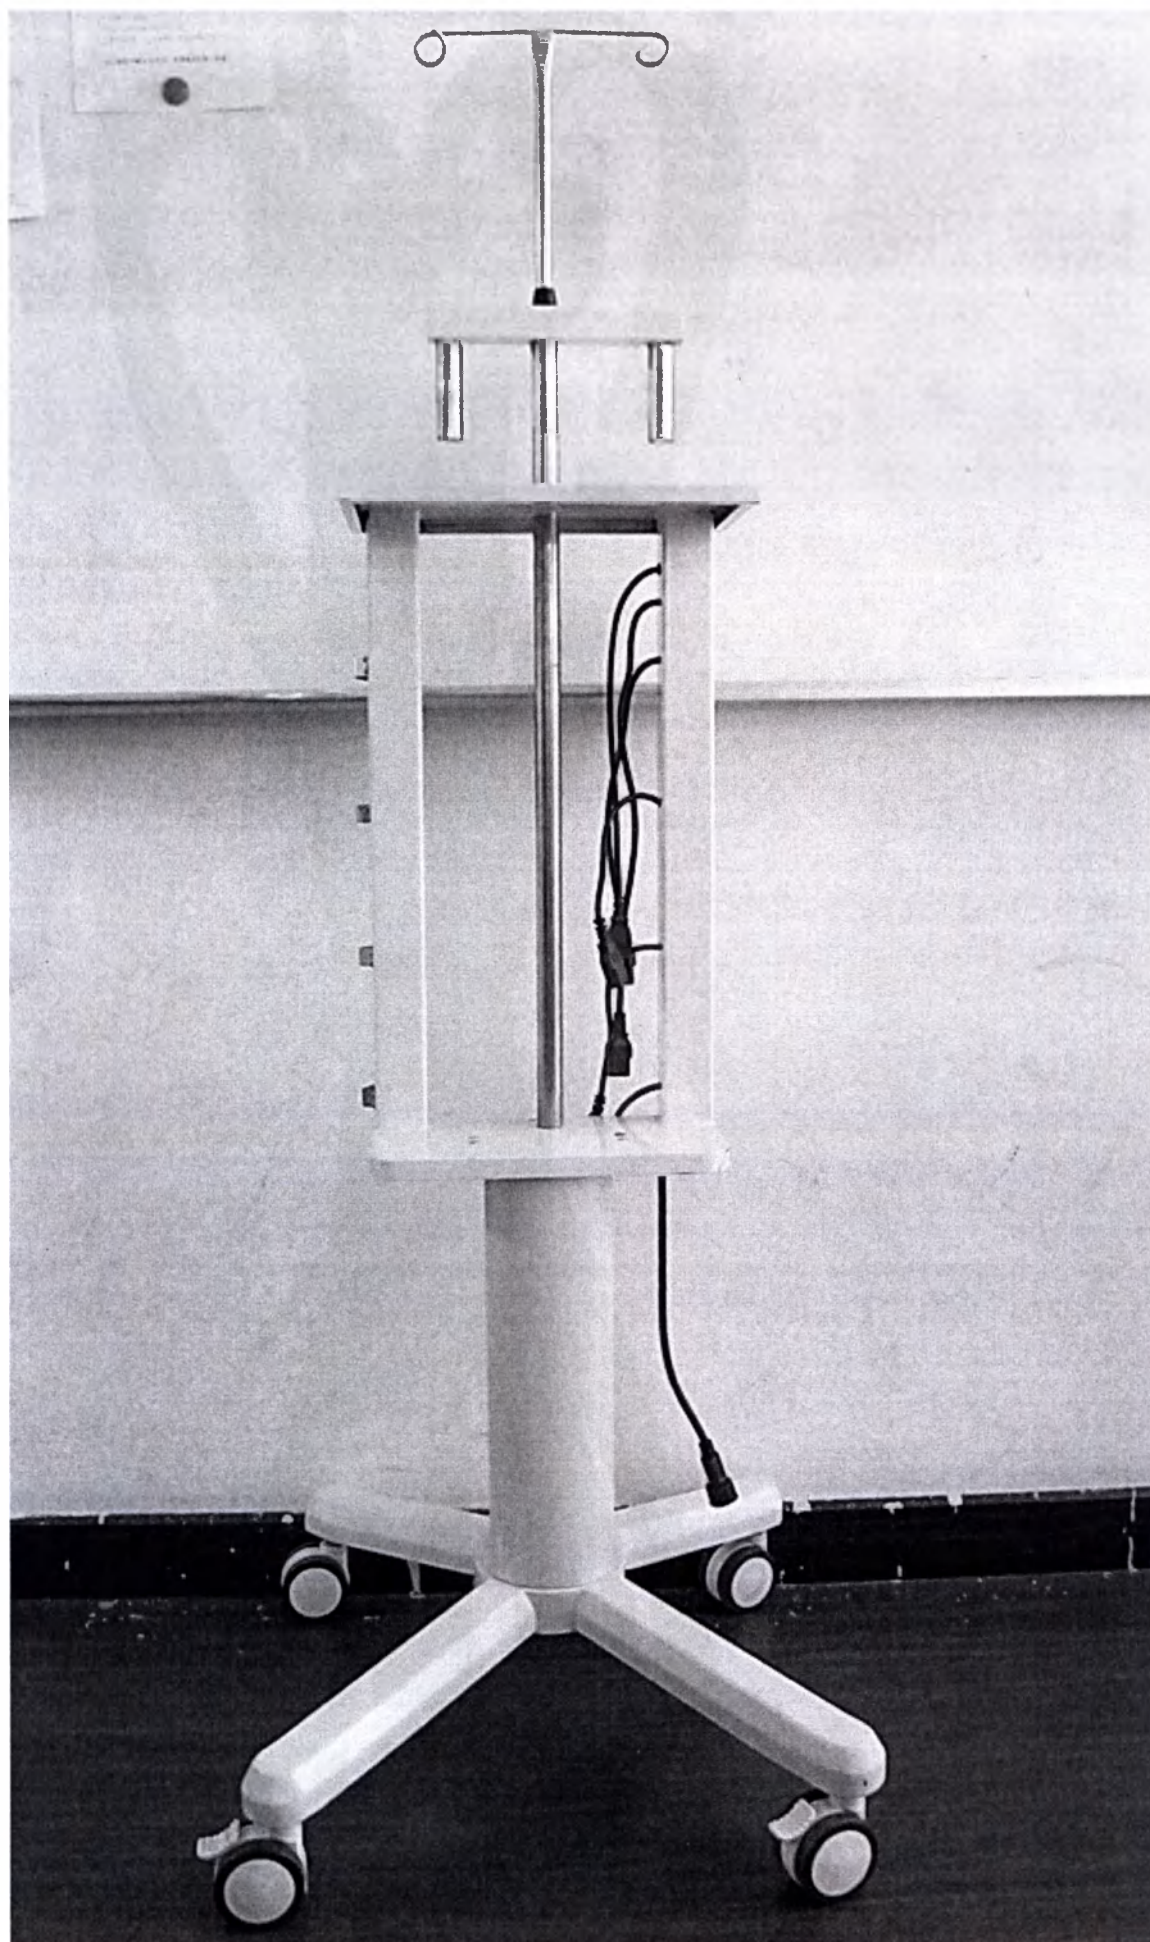

Кабель питания дополнительный

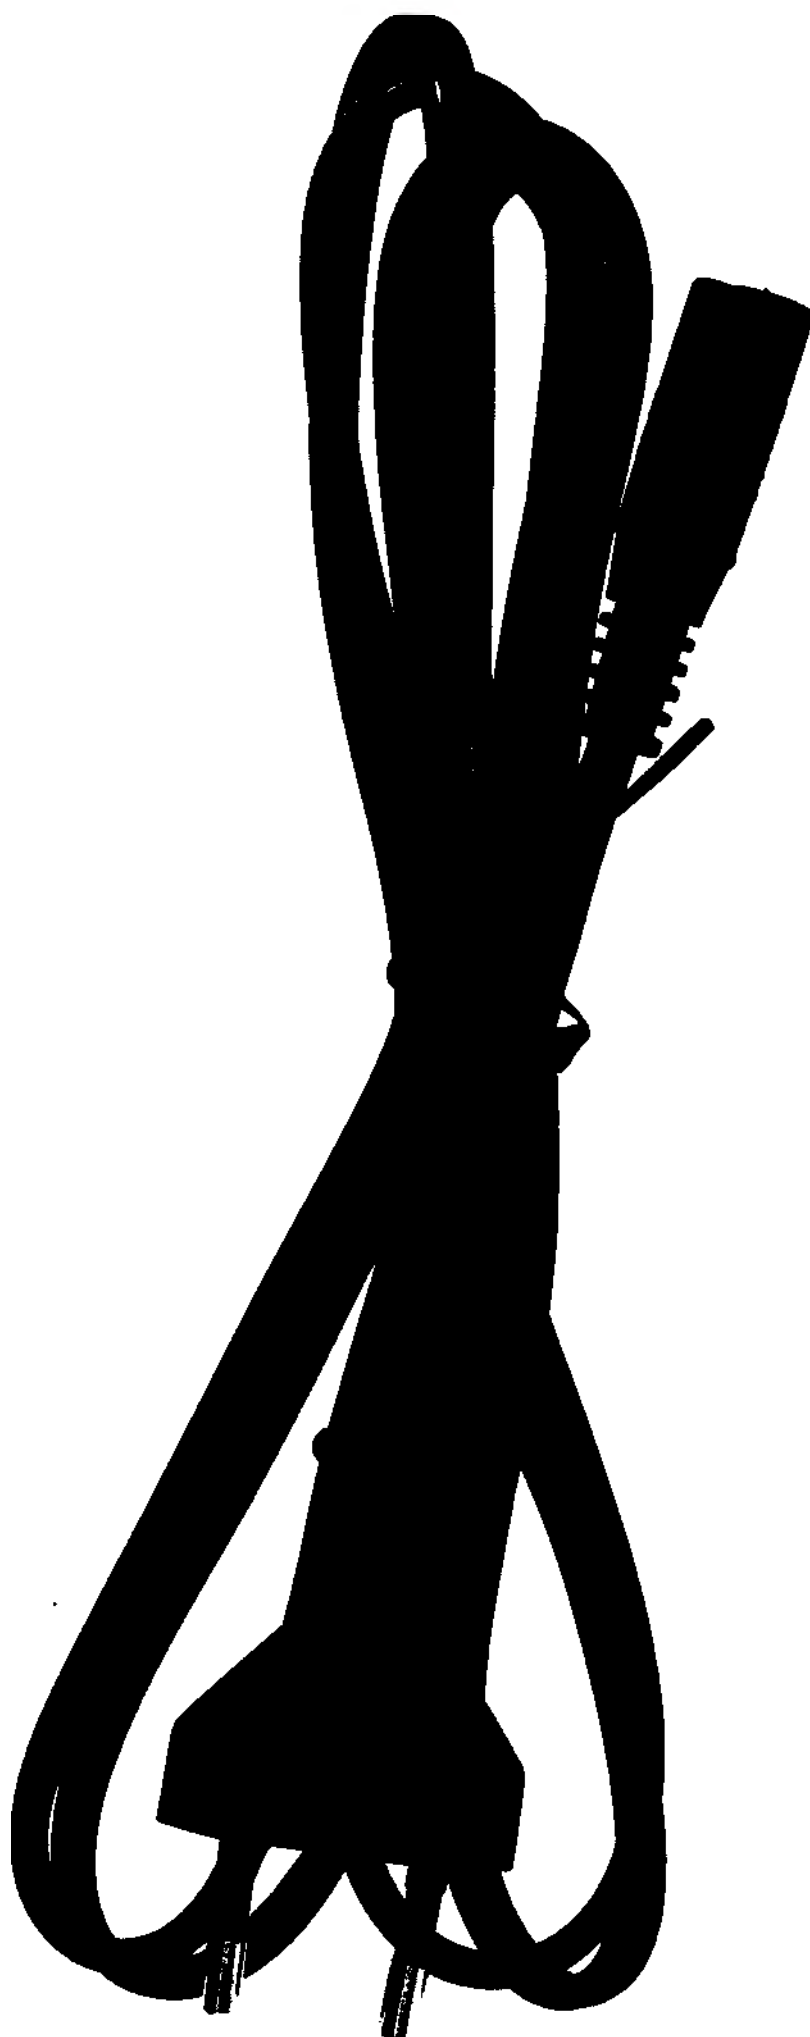

Адаптер сетевой дополнительный

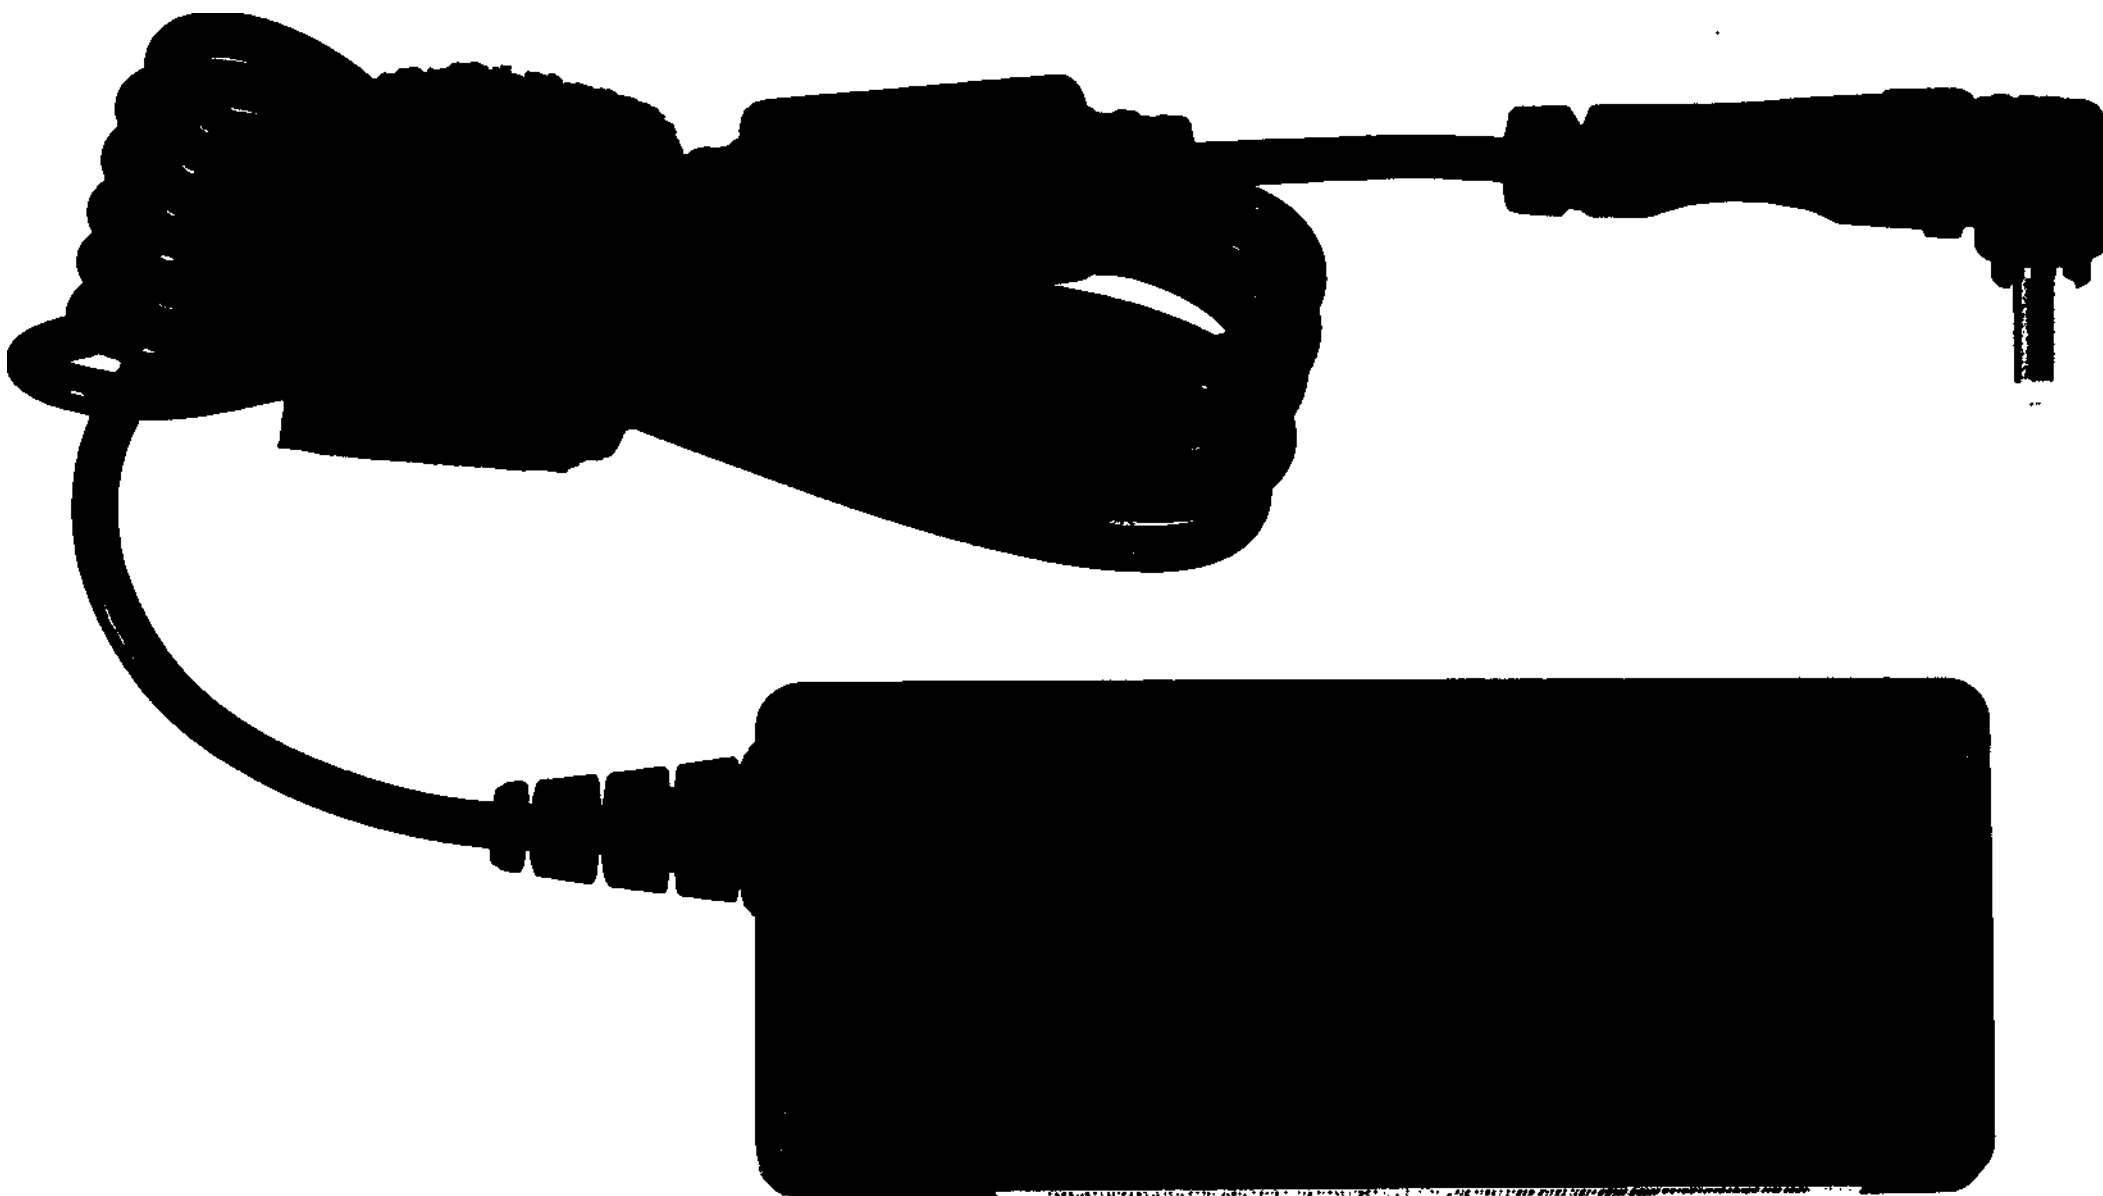

ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО
17 ЛИСТОВ


Генеральный директор
ООО «ДИКСИОН» Яковлев



Базовая комплектация (основной комплект поставки):


Блок основной с дисплеем в сборе (вид спереди)



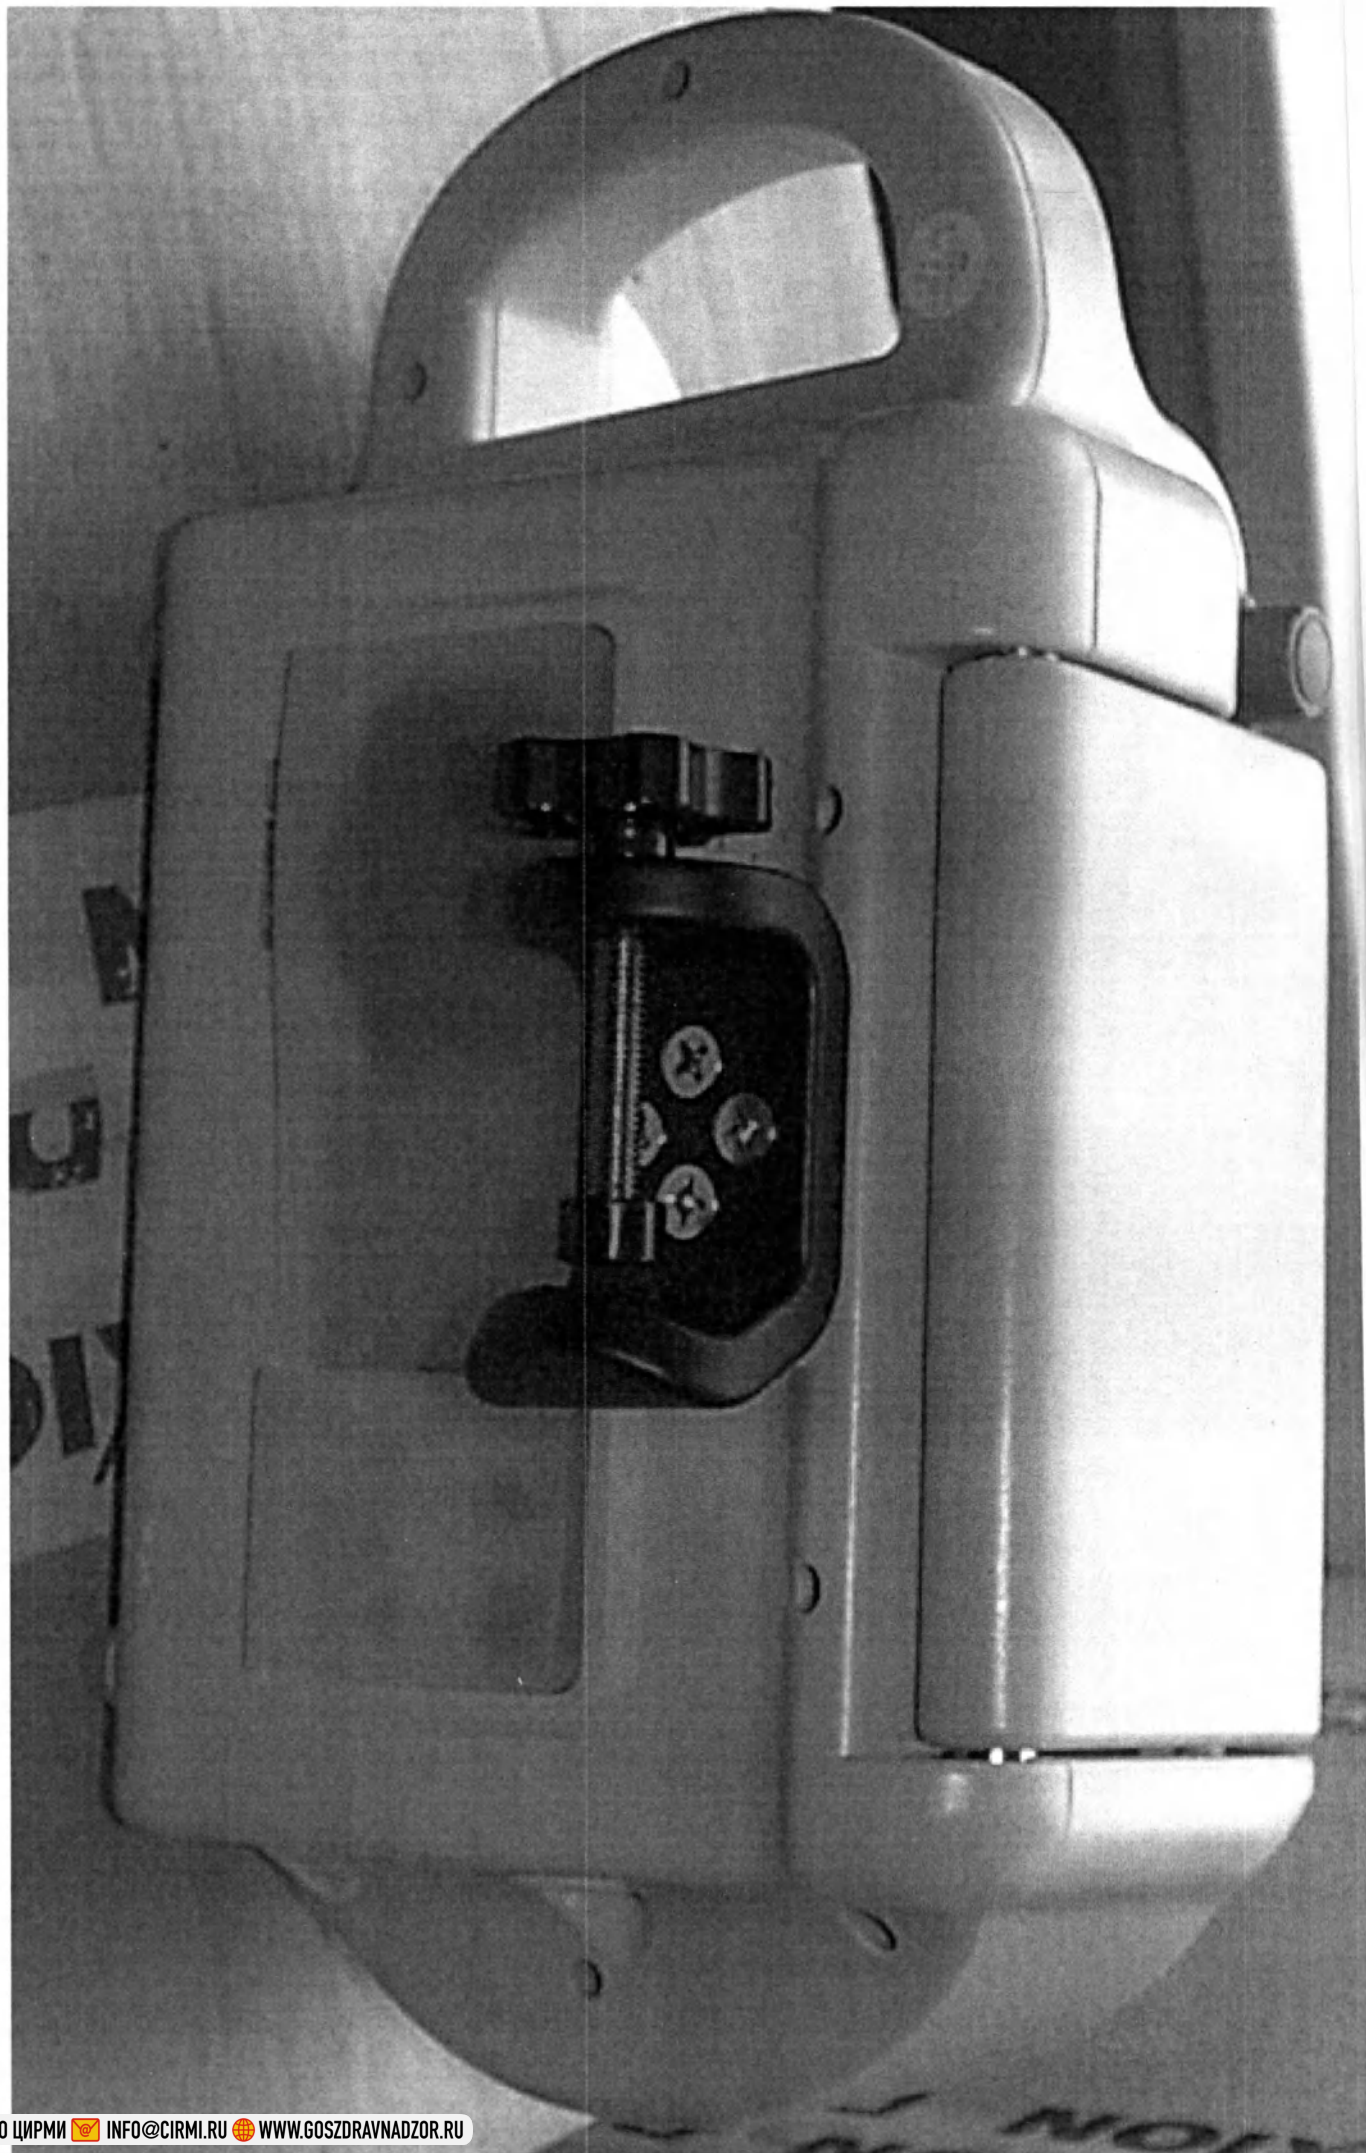

Батарея перезаряжаемая встроенная



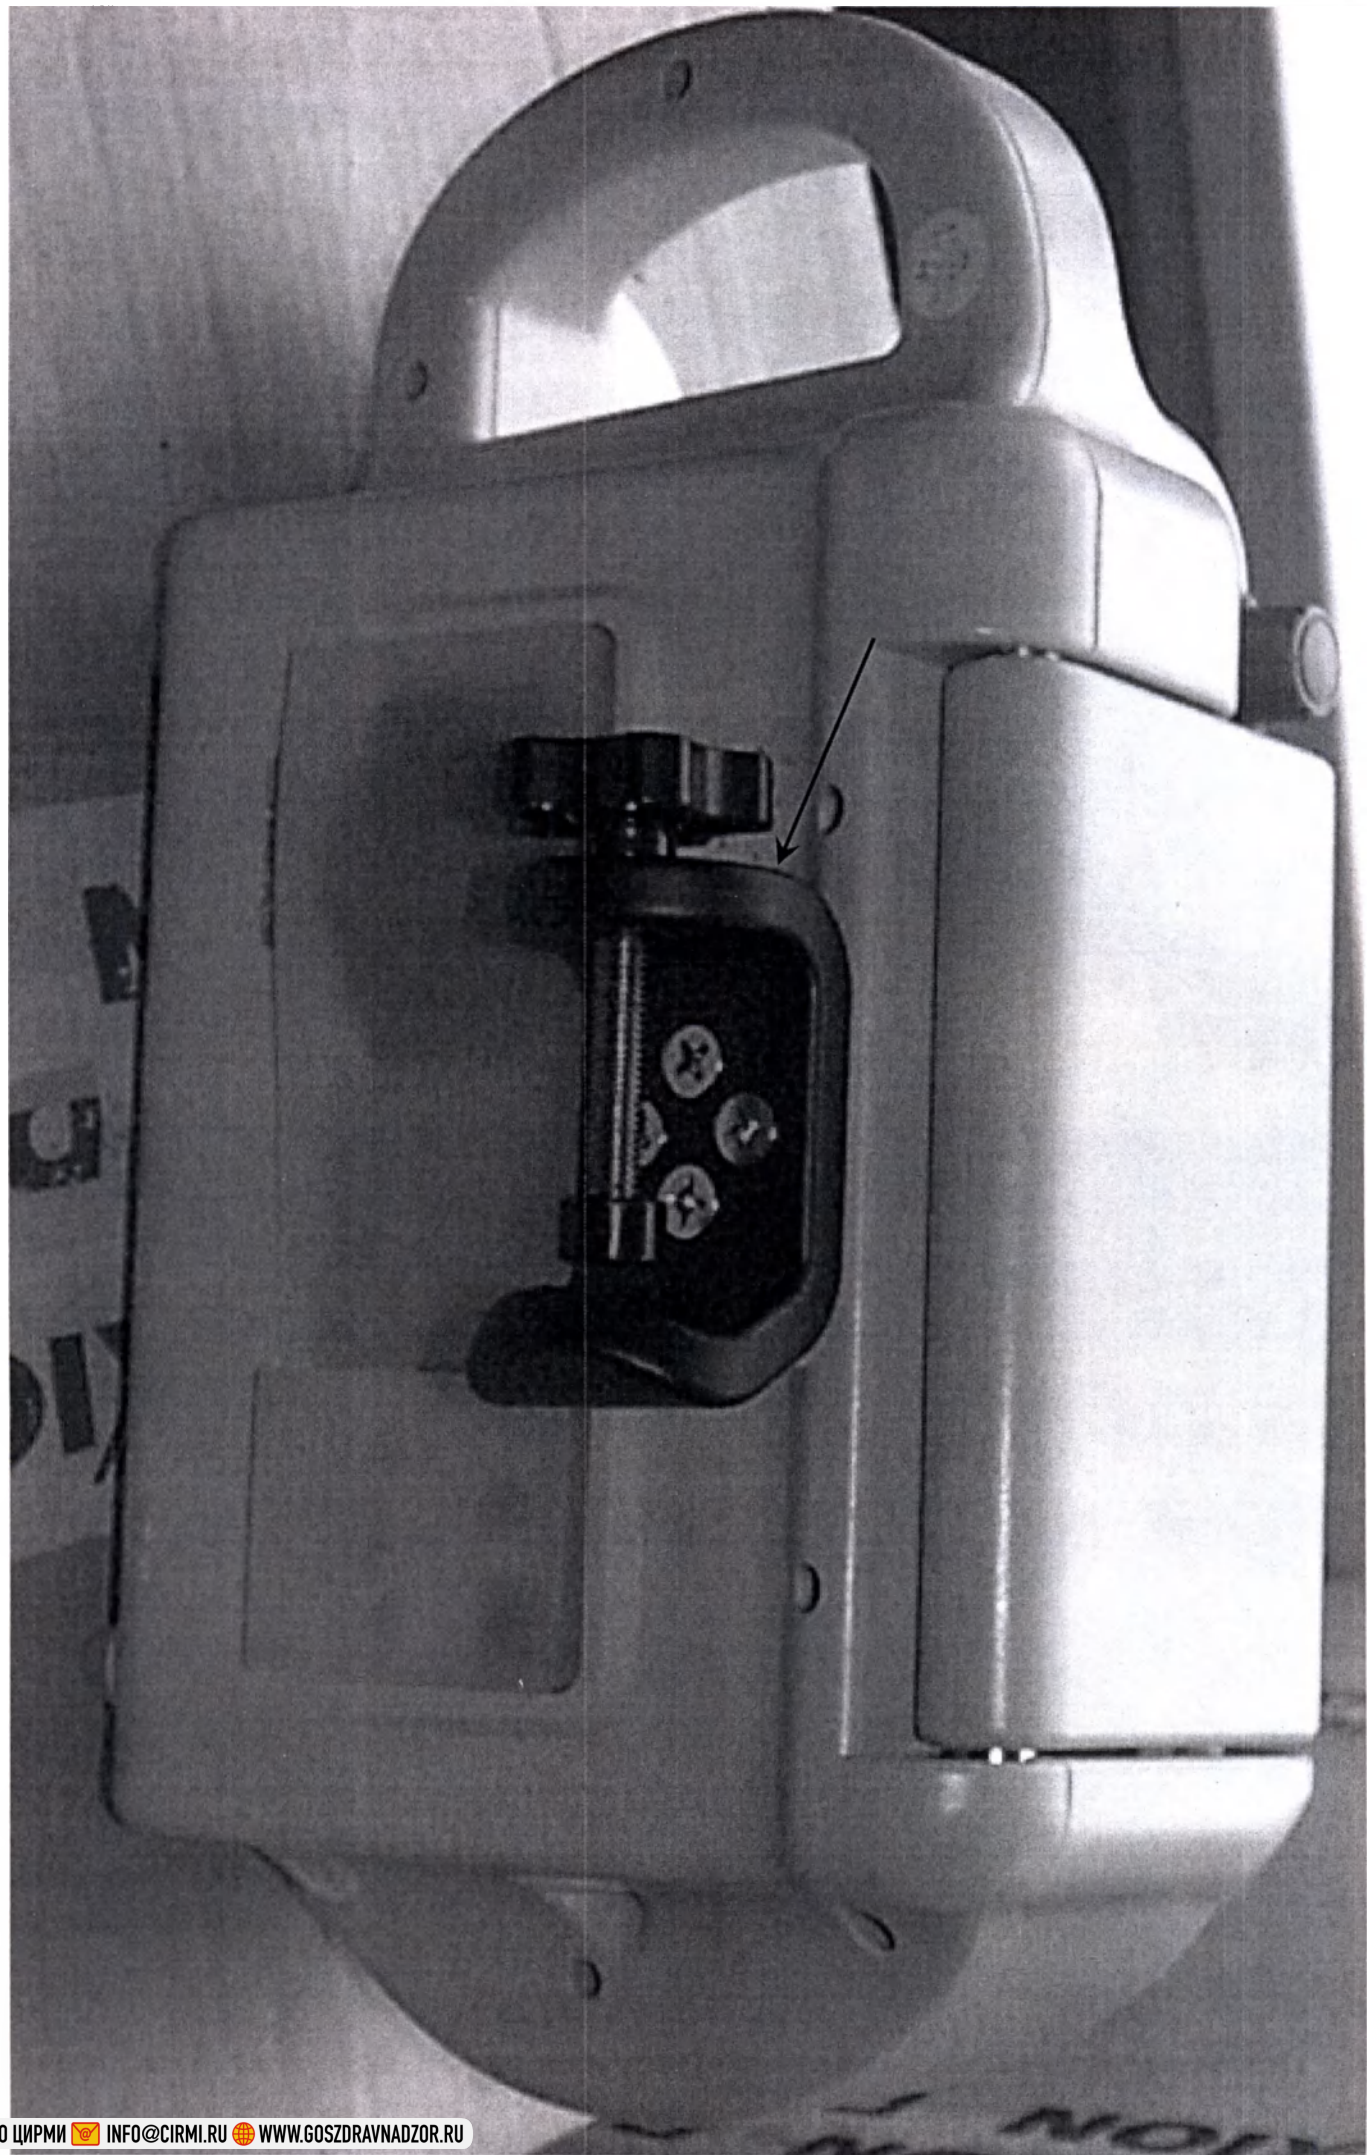



УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
«ООО» ДИКСИОН

(Дата)

(Подпись) (Расшифровка подписи)

DIXION

Руководство по эксплуатации

Насосы инфузионные шприцевые «ИНСТИЛАР»
«ИНСТИЛАР-1428»
по ТУ 9444-015-74487176-2008

Паспорт

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
«ООО» ДИКСИОН

_____ /
(Дата)


_____ /
(Подпись) (Расшифровка подписи)

DIXION


Паспорт

Насос инфузионный шприцевой «ИНСТИЛАР»
«ИНСТИЛАР-1428»


по ТУ 9444-015-74487176-2008

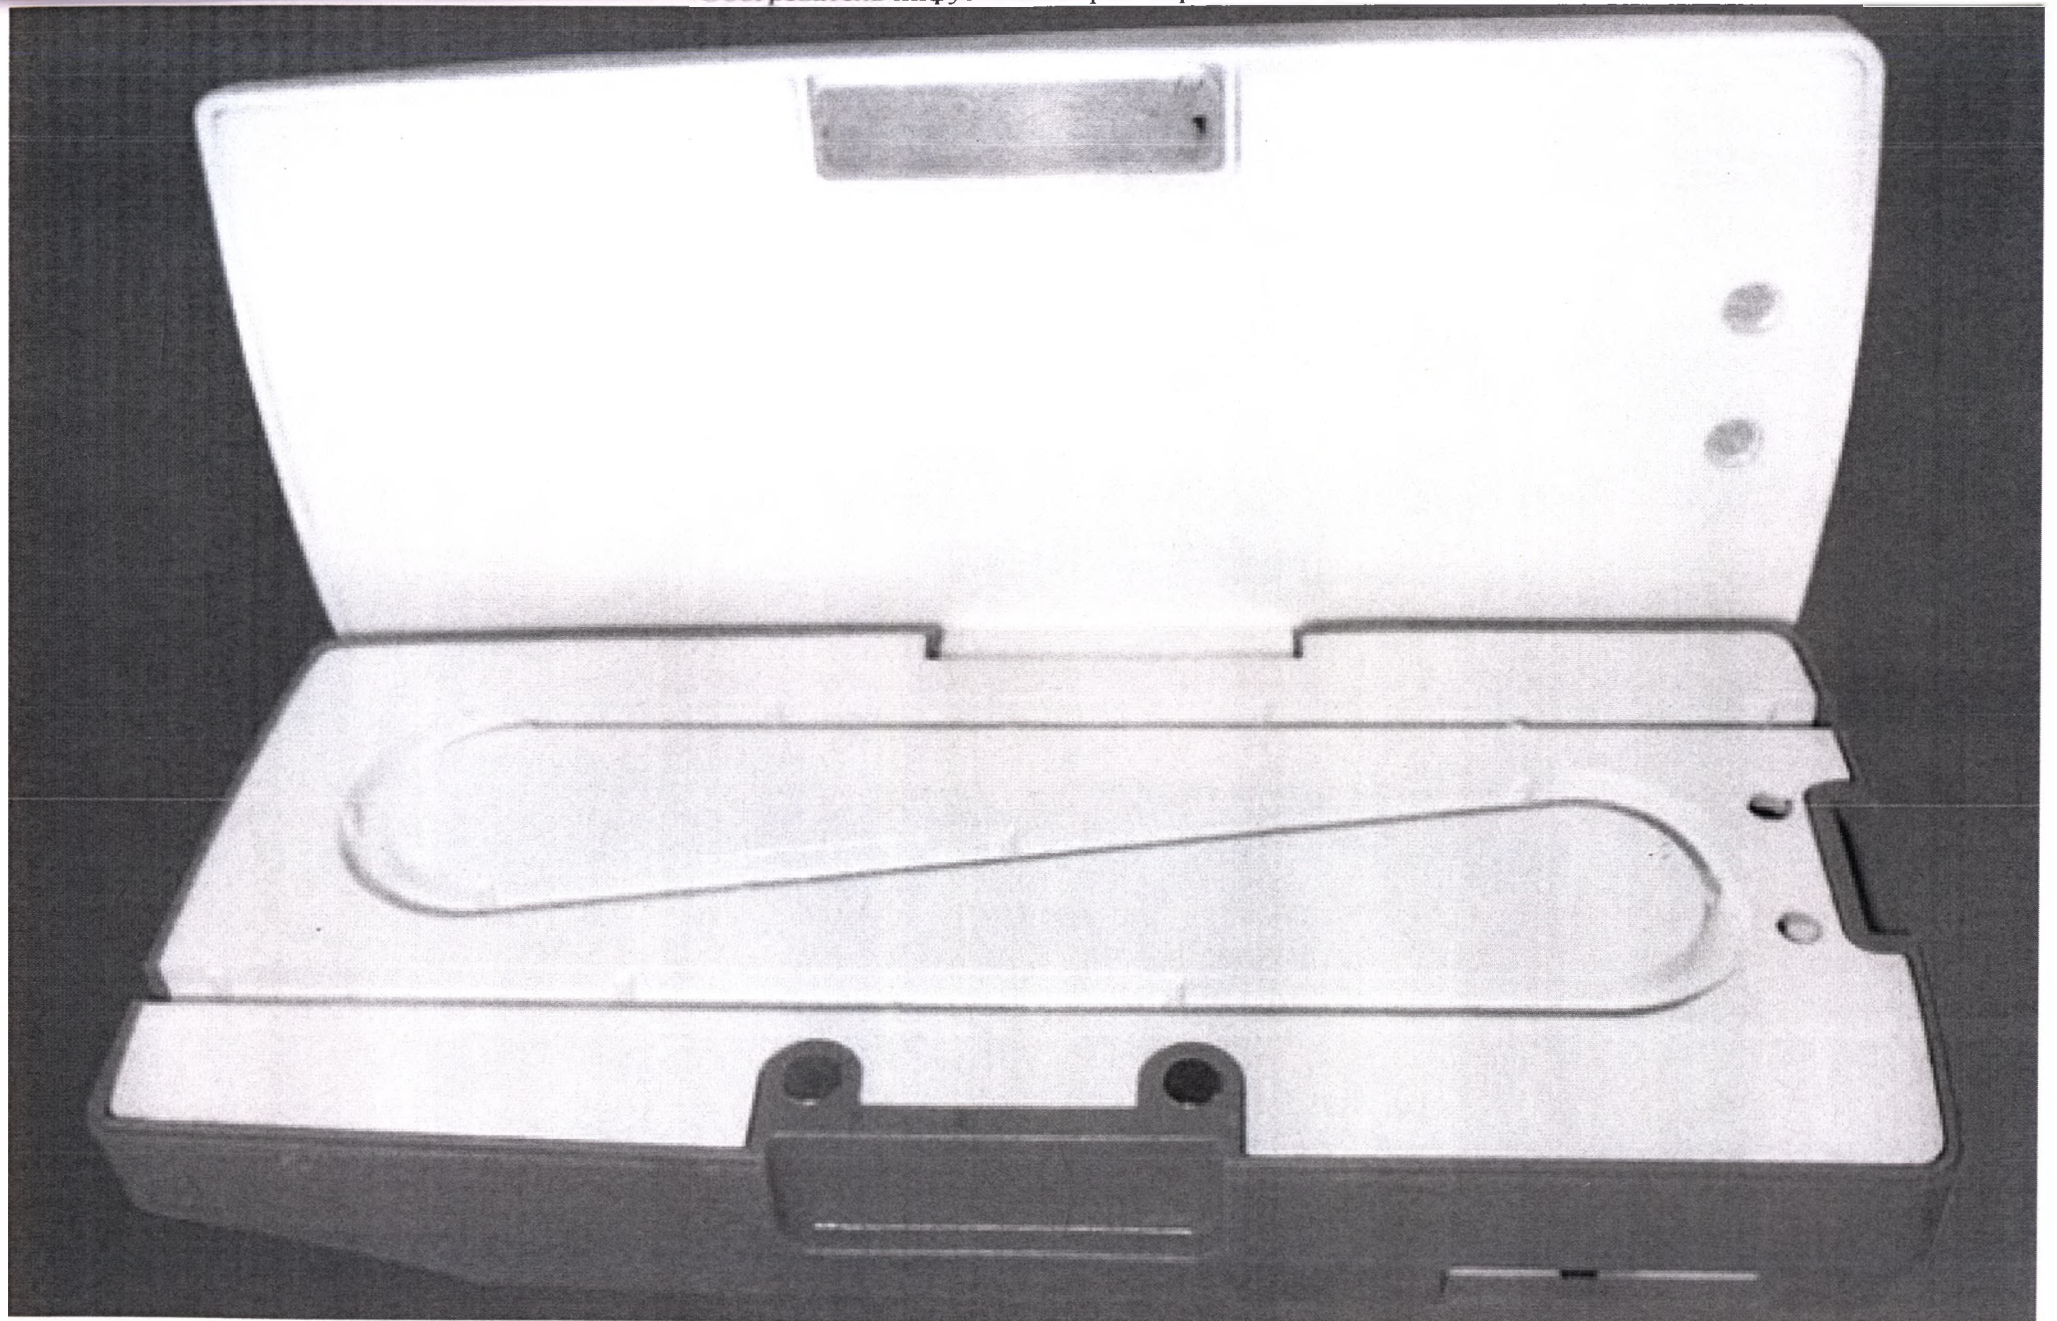


Адаптер сетевой для обогревателя инфузионных растворов

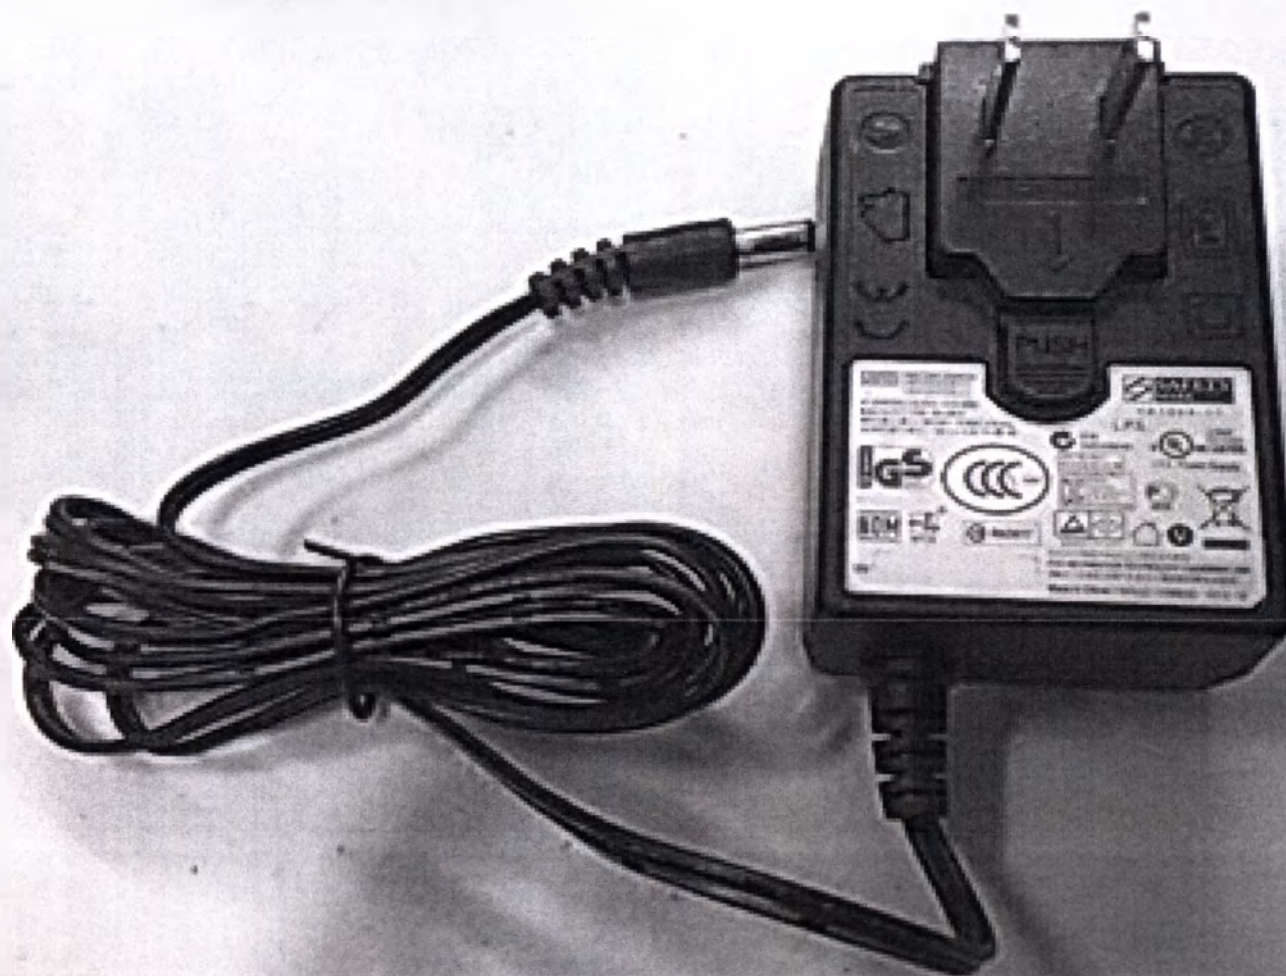

Диск с программным обеспечением для центральной станции мониторинга

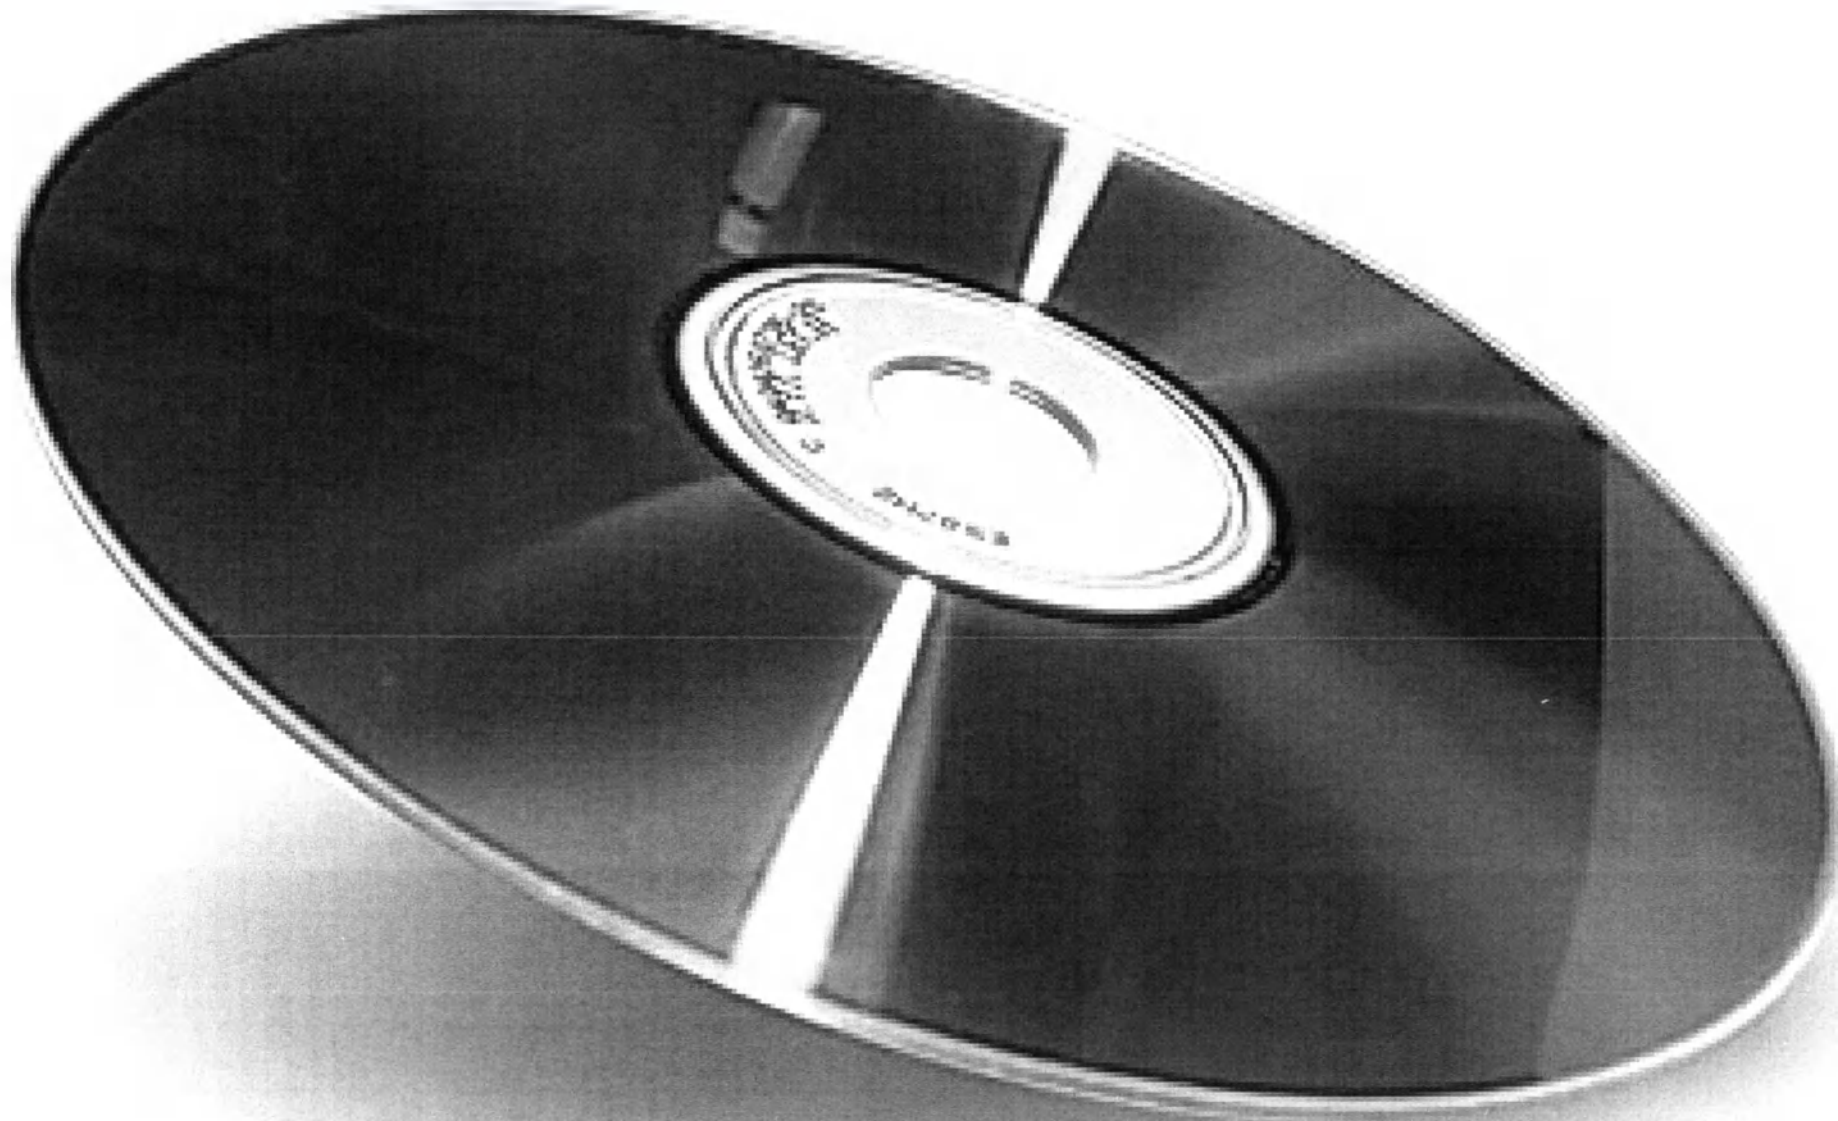

Диск с программным обеспечением для подключения к ПК для хранения, просмотра и распечатки данных

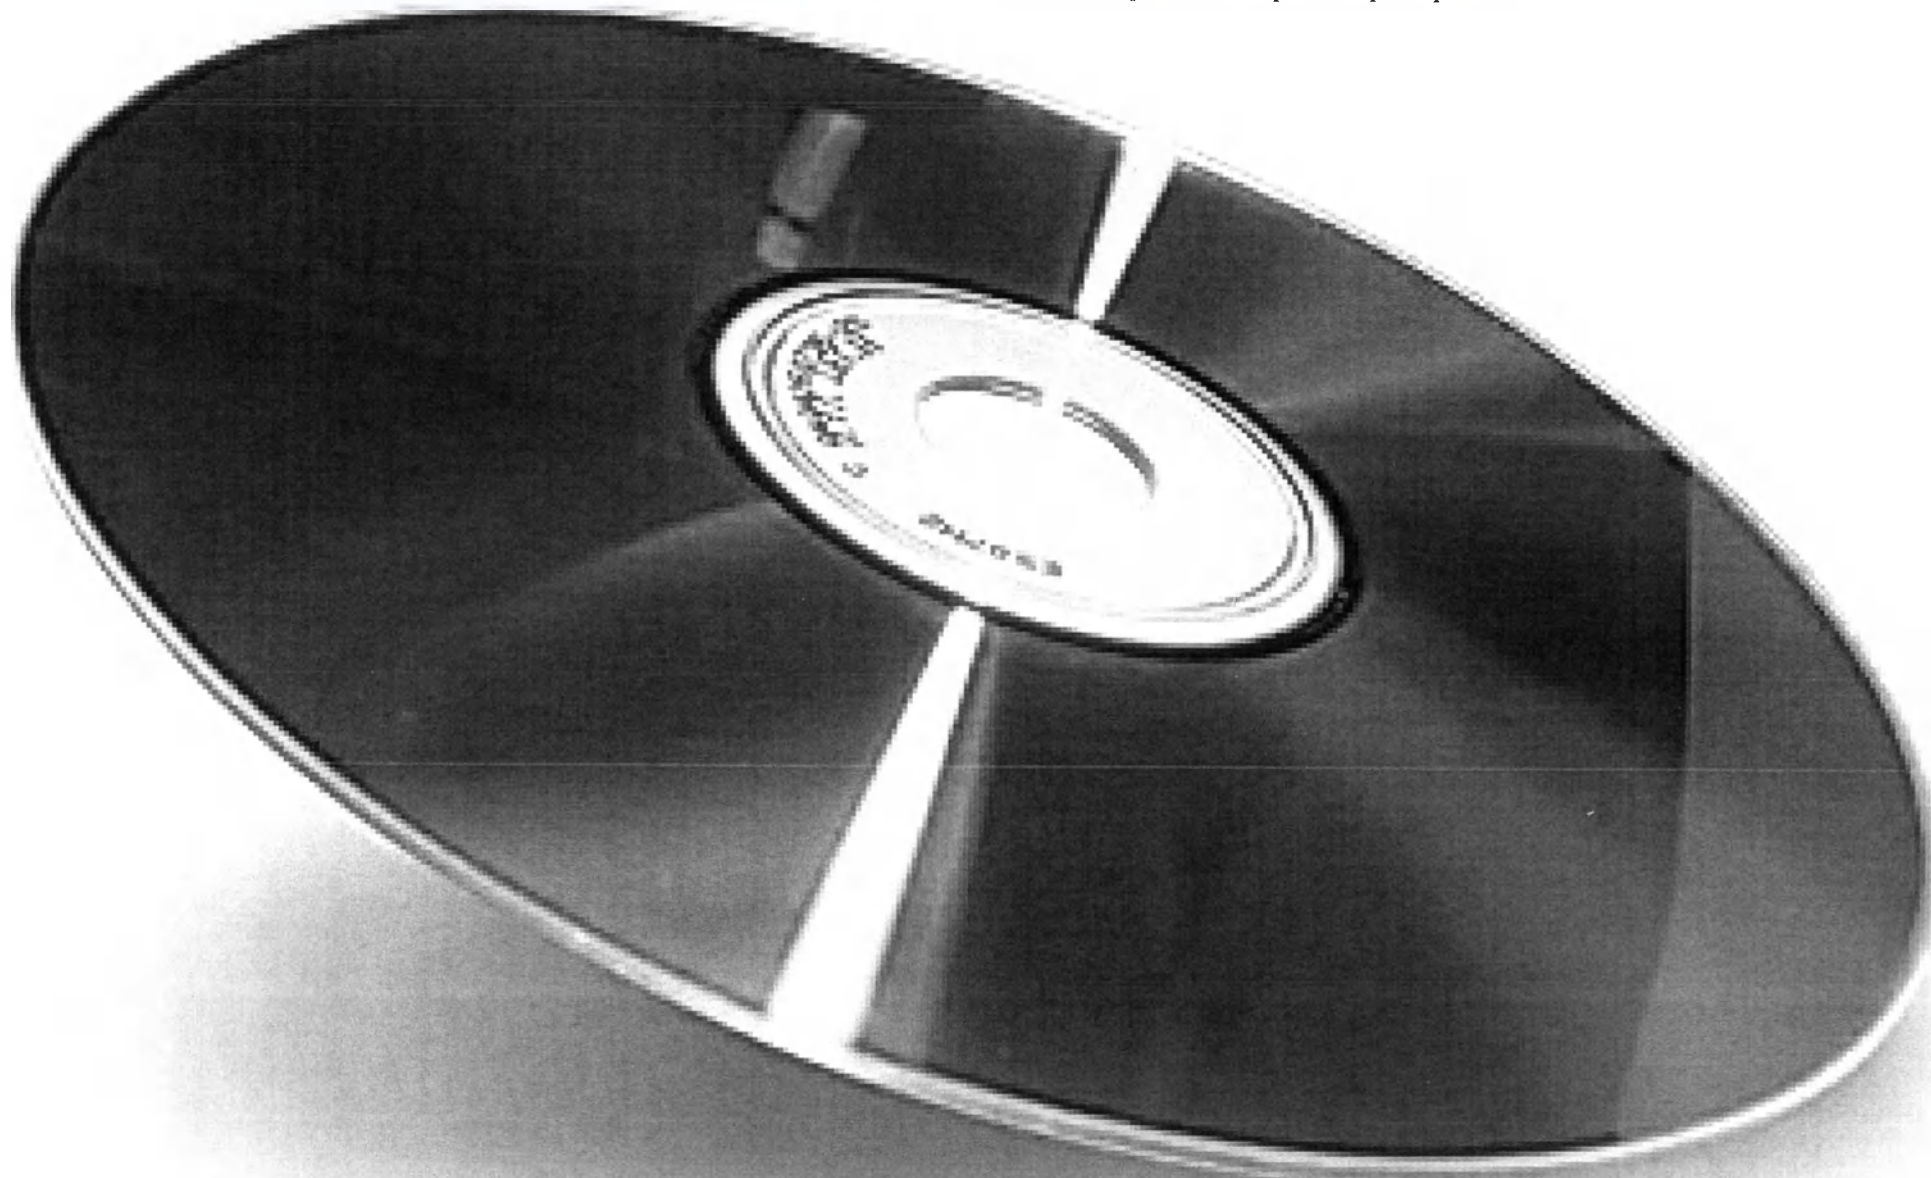


Стойка инфузионная передвижная



Консоль для инфузионных насосов



Станция для инфузионных насосов

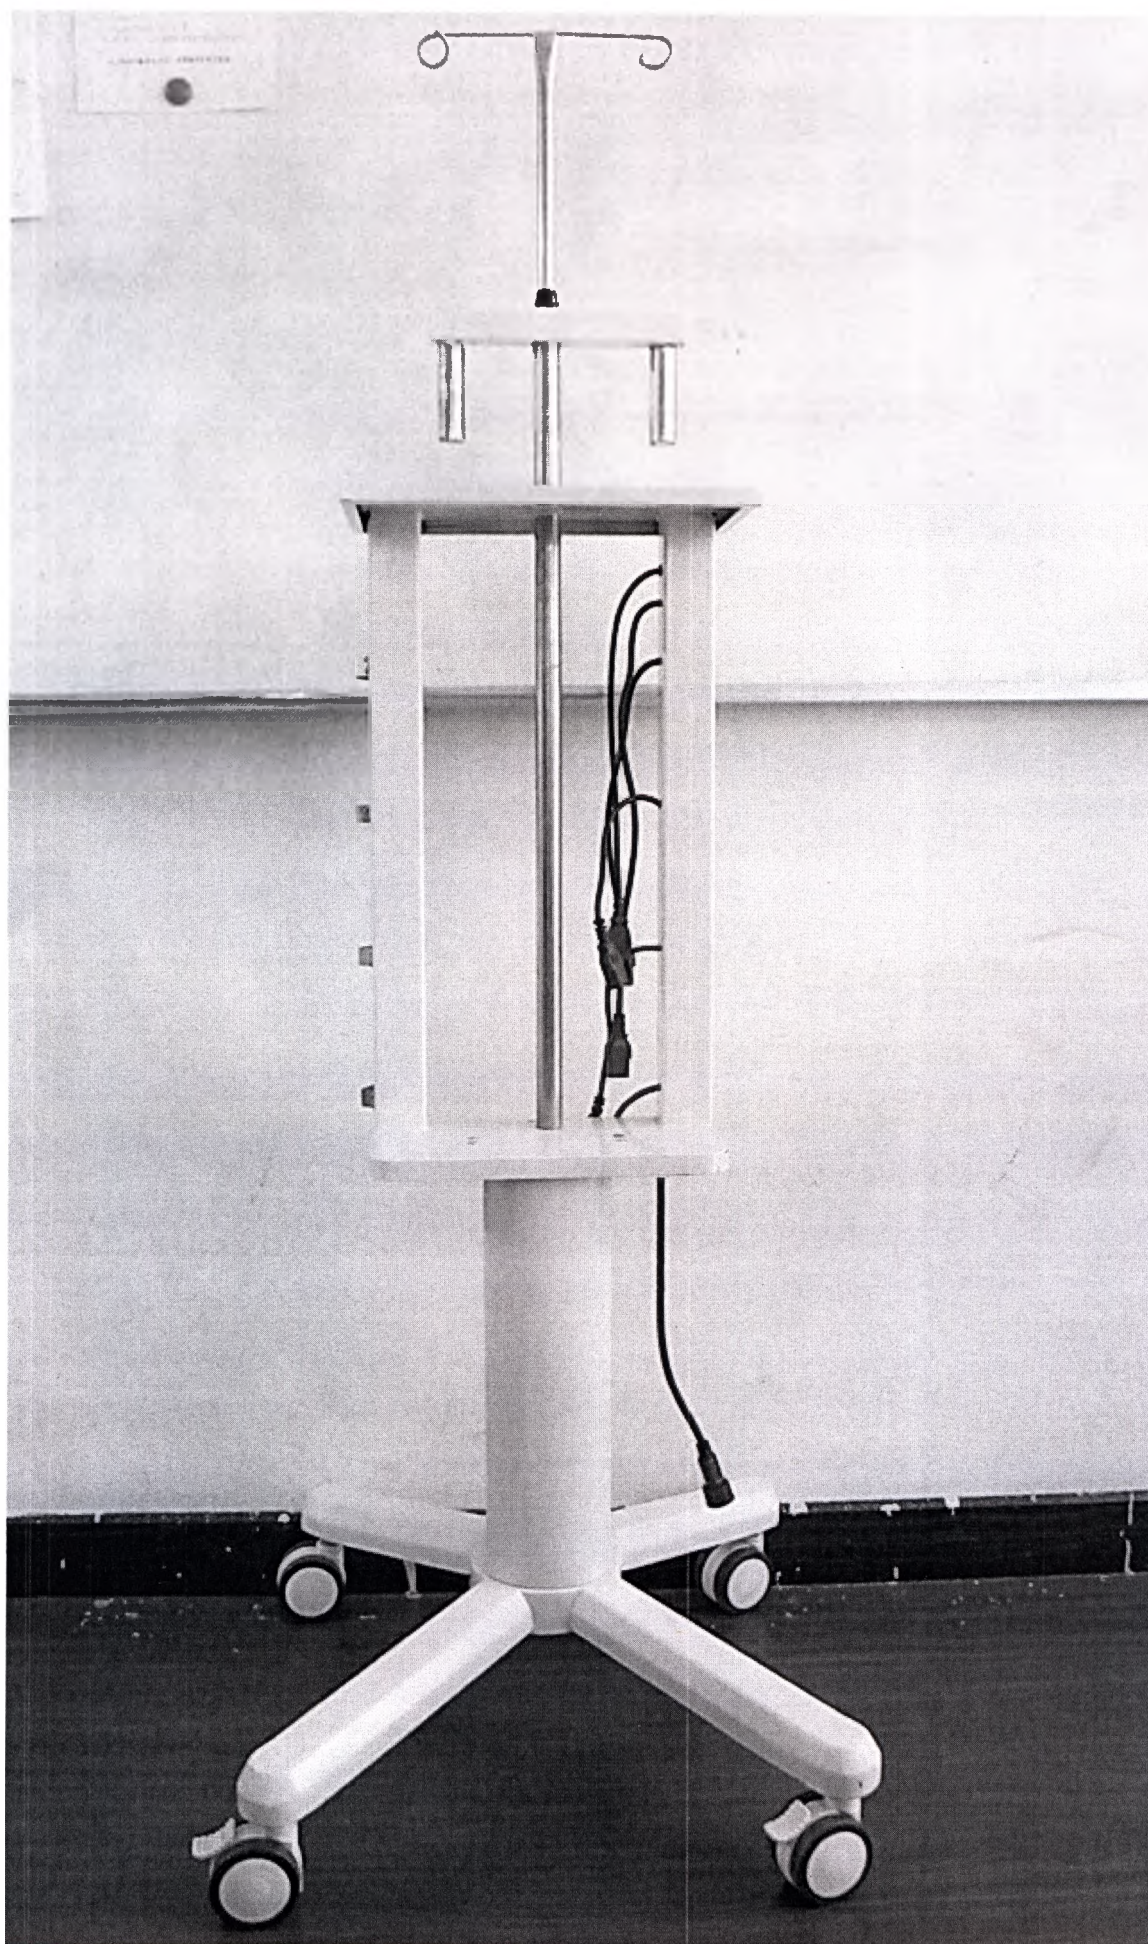

Кабель питания дополнительный



ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО
15 ЛИСТОВ


Генеральный директор
ООО «ДИКСИОН» Яковлев А.А.




Насос инфузионный периферийной «ИНСТИЛАР» «ИНСТИЛАР-1438»

Базовая комплектация (основной комплект поставки):

Блок основной с дисплеем в сборе (вид спереди)

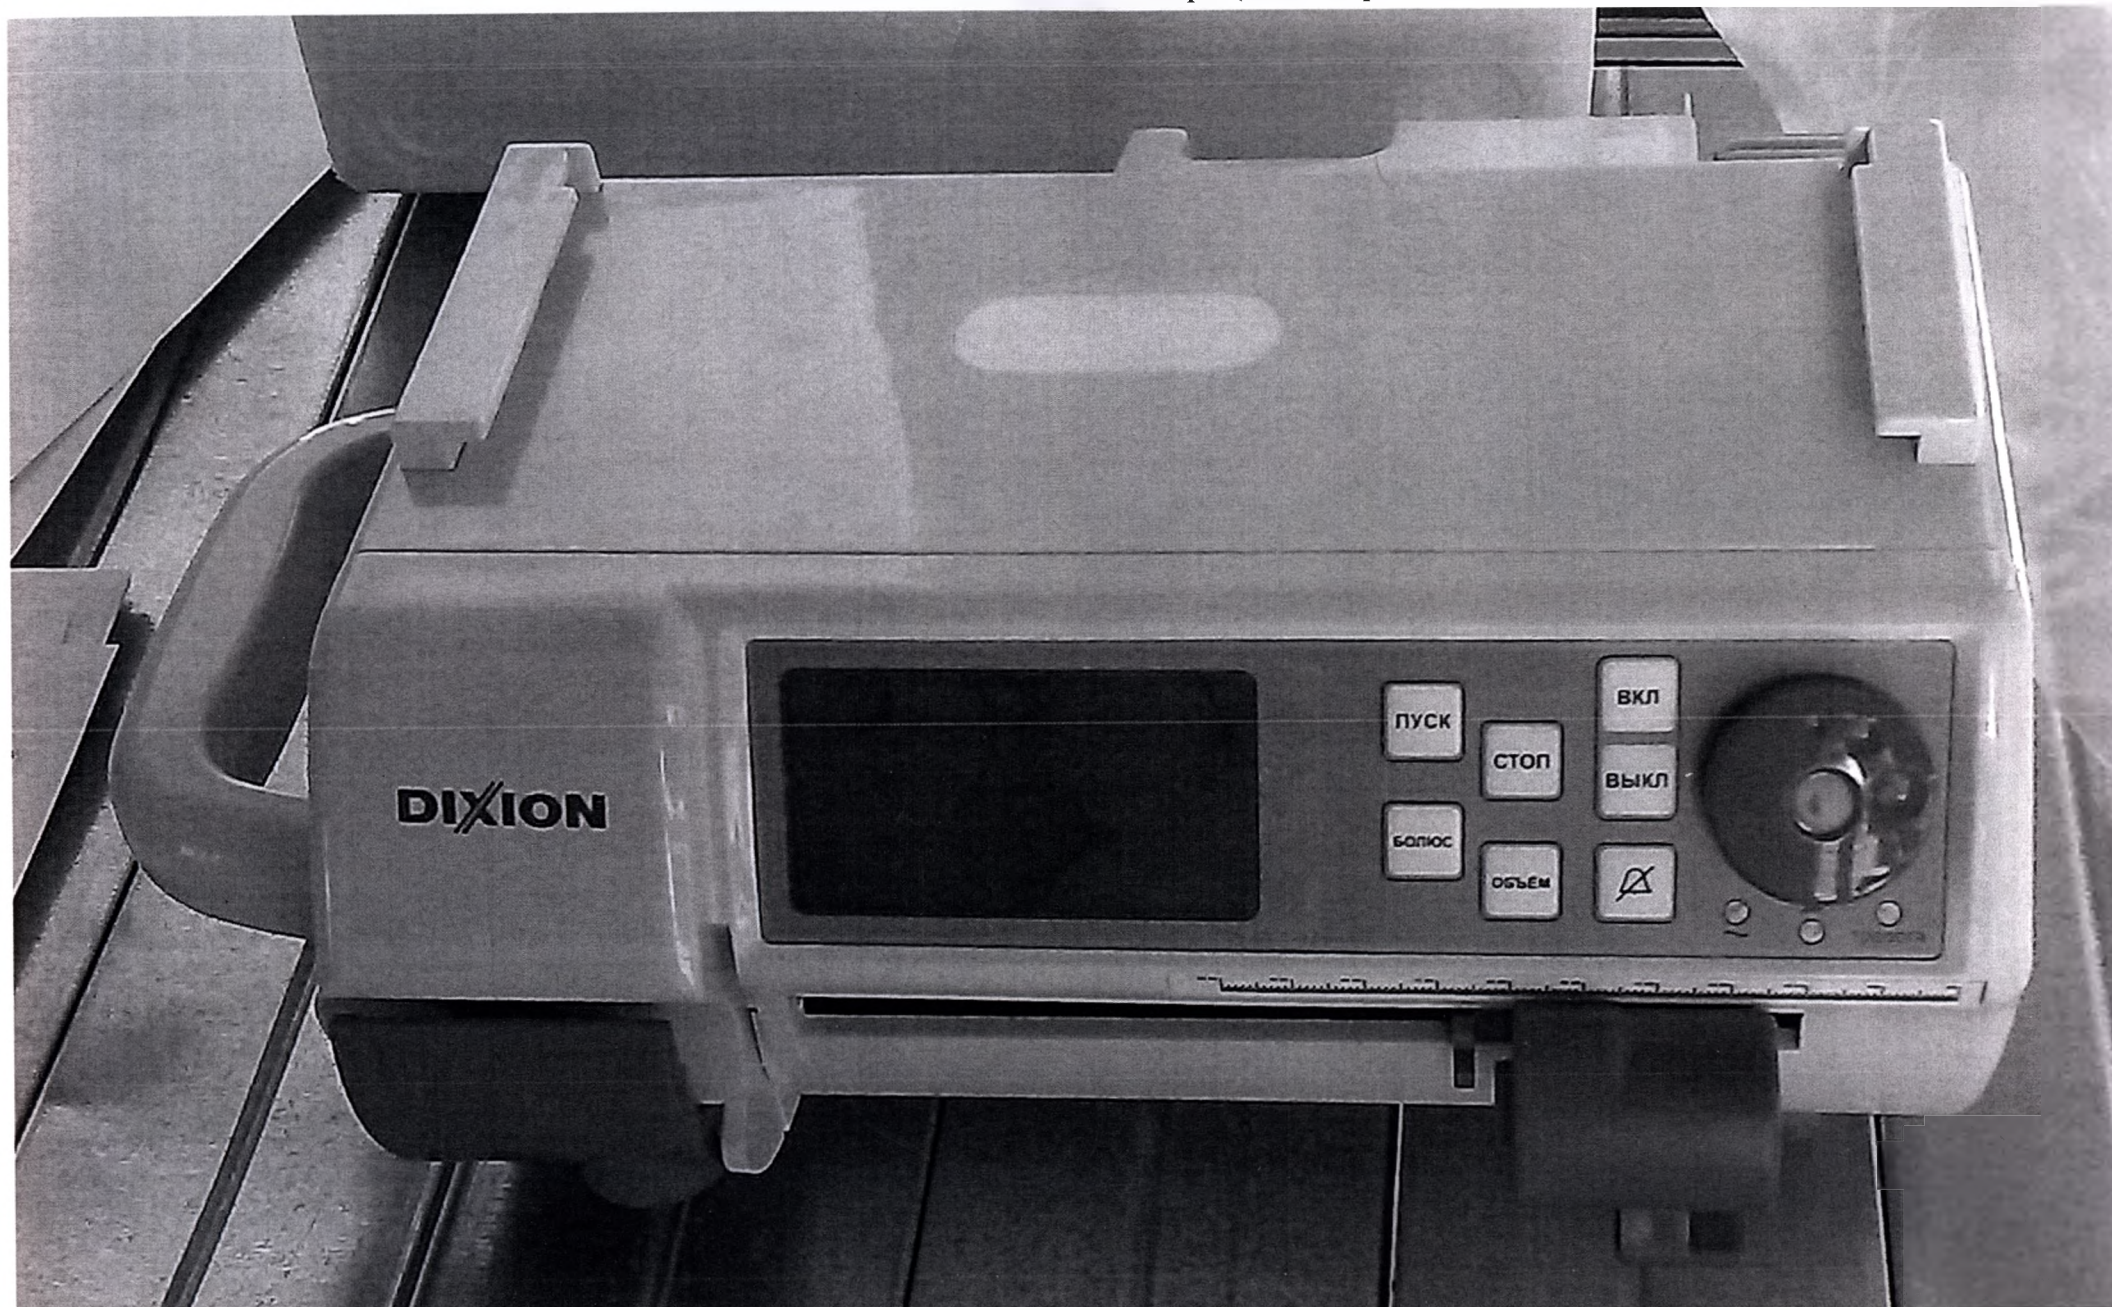

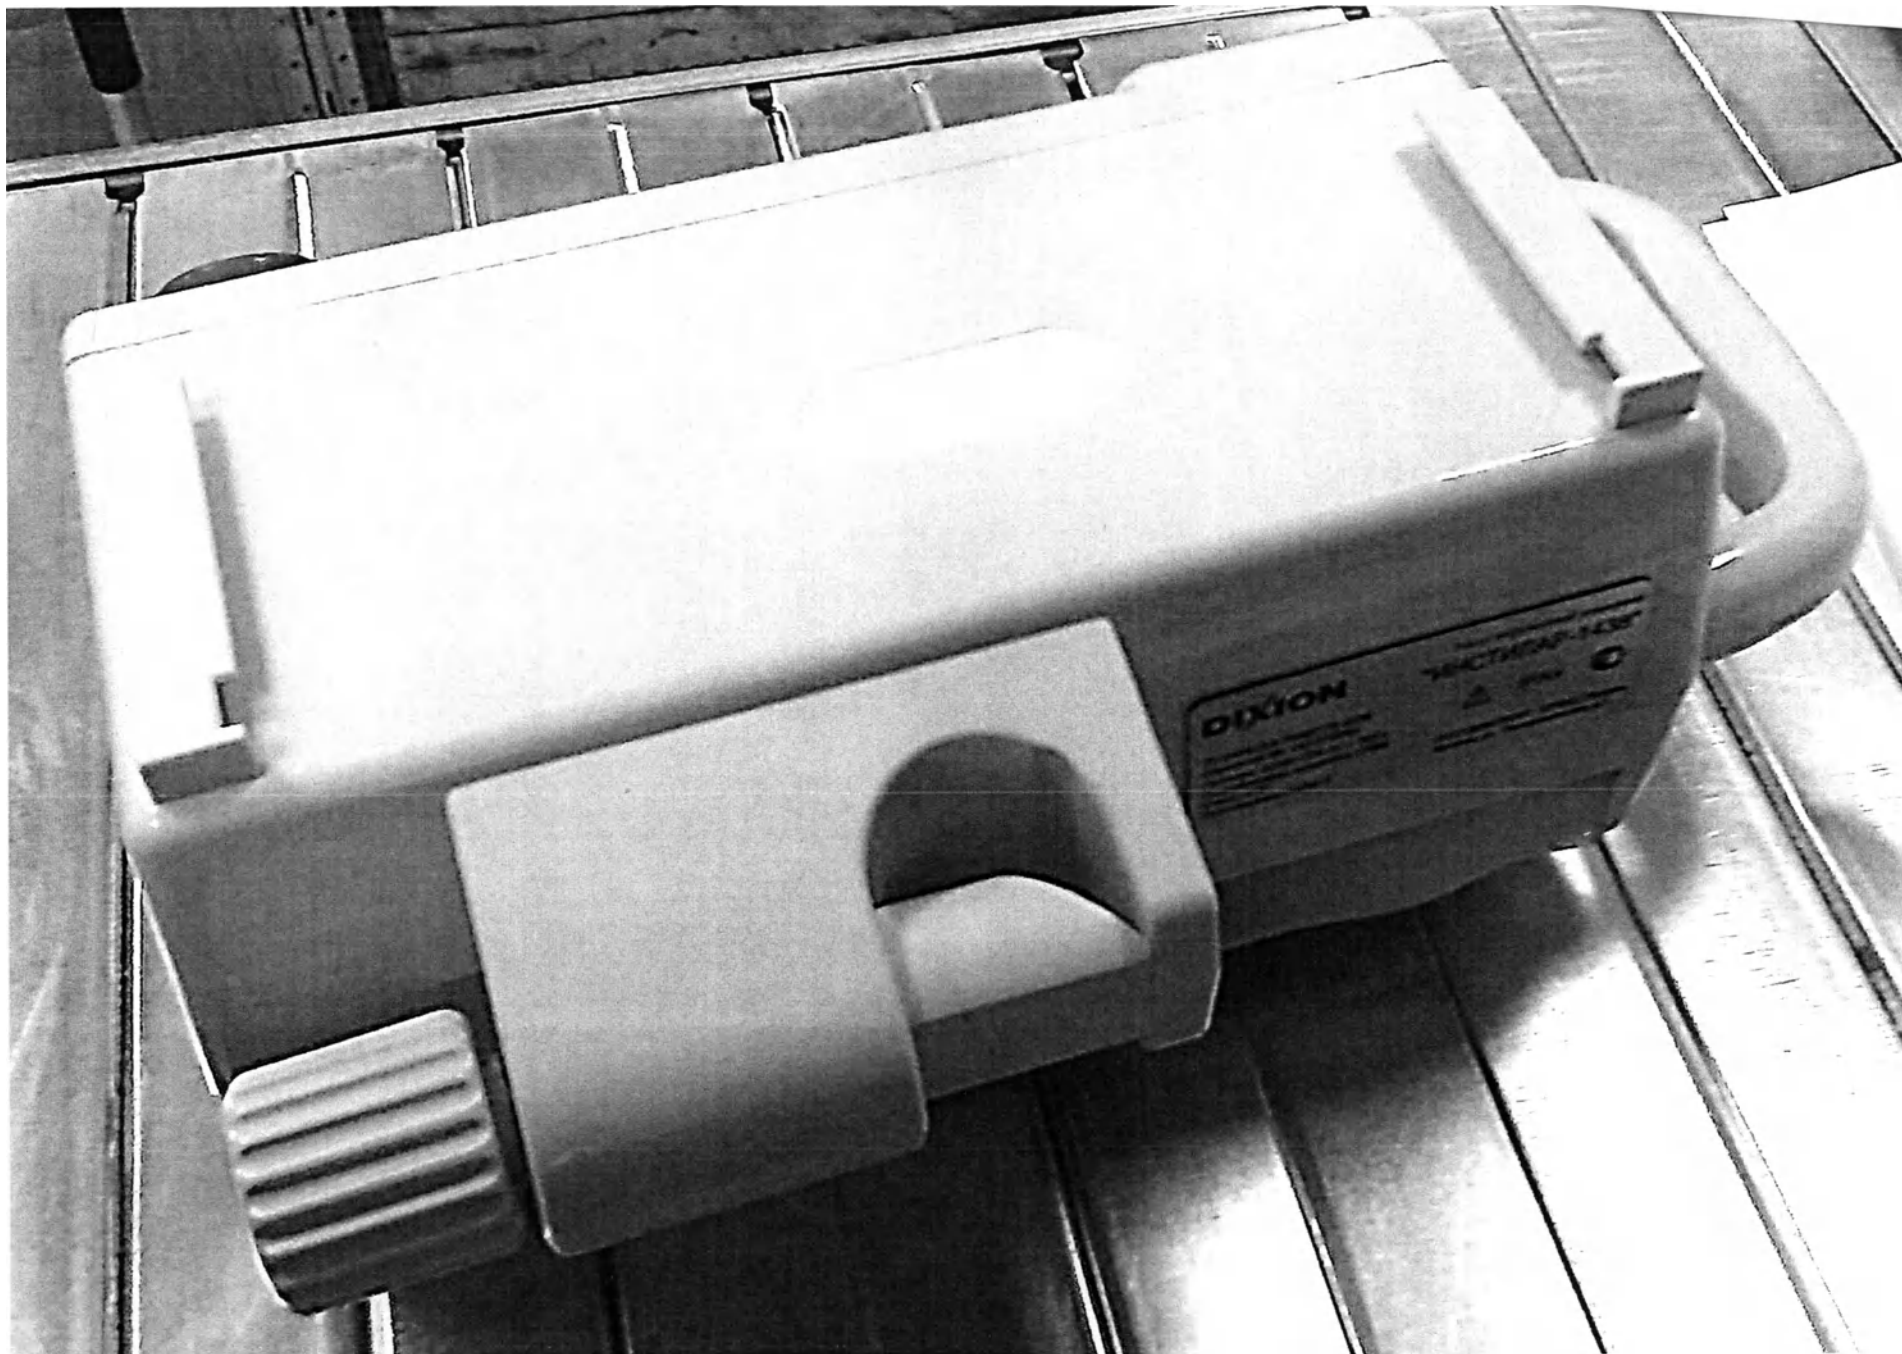

锂电池

型号:HYLB-1212

电压:11.1V 容量:2200mAh

环境温度:-20℃~+60℃充电上限电压:12.6V

最大瓦特小时率:24.42Wh


序列号:WDA15040302047



注意:

- 请用配套专用充电器充电
- 切勿将电池投入火中或加热
- 切勿自行拆装电池
- 切勿将电池两极短路



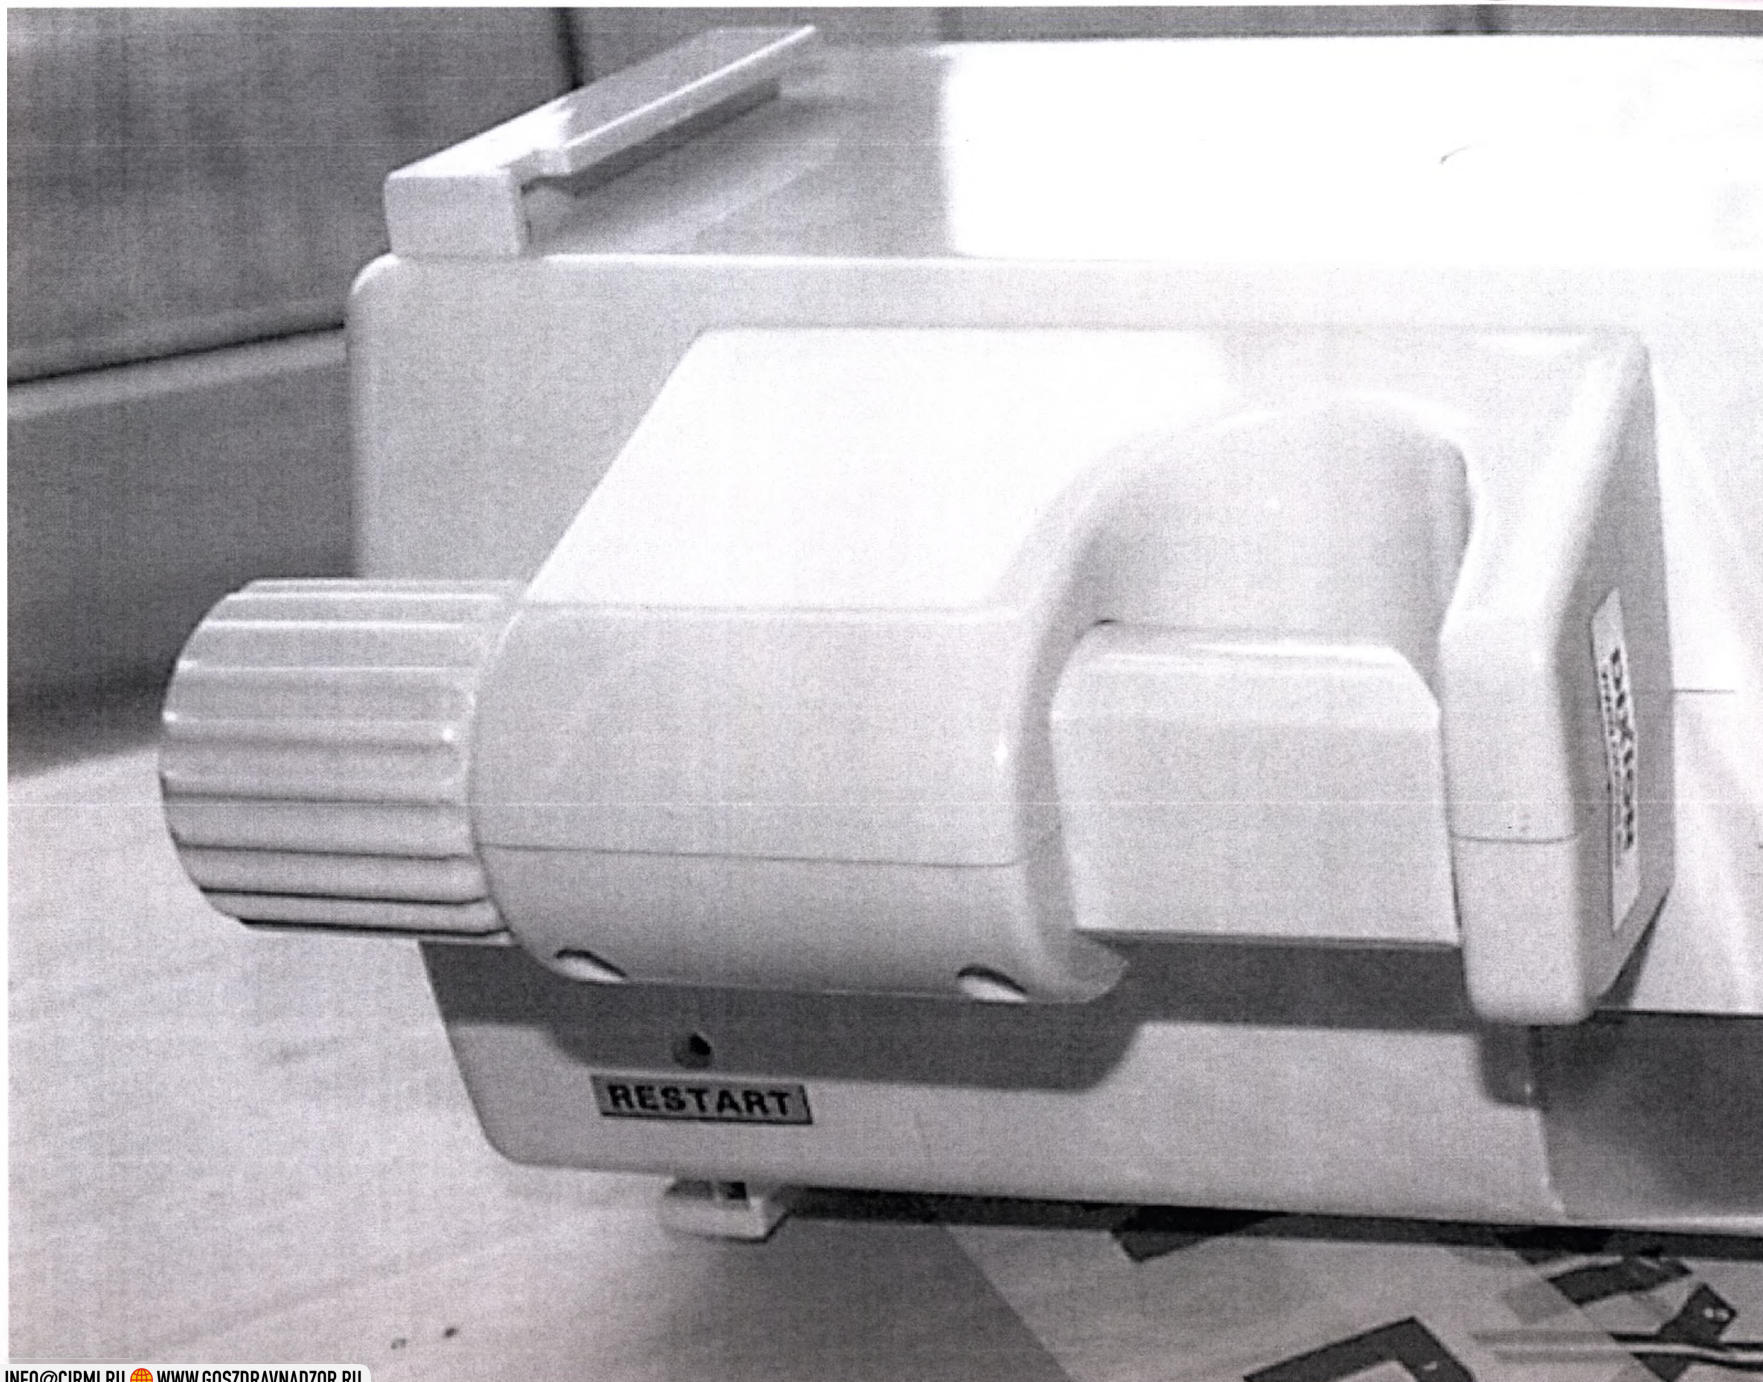



Руководство по эксплуатации

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
«ООО» ДИКСИОН

(Дата)

(Подпись) (Расшифровка подписи)

DIXION

Руководство по эксплуатации

Насосы инфузионные шприцевые «ИНСТИЛАР»

«ИНСТИЛАР-1438»

по ТУ 9444-015-74487176-2008

Паспорт

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
«ООО» ДИКСИОН

(Дата)

(Подпись) / (Расшифровка подписи)


DIXION

Паспорт


Насос инфузионный шприцевой «ИНСТИЛАР»
«ИНСТИЛАР-1438»

по ТУ 9444-015-74487176-2008

Обогреватель инфузионных растворов внешний

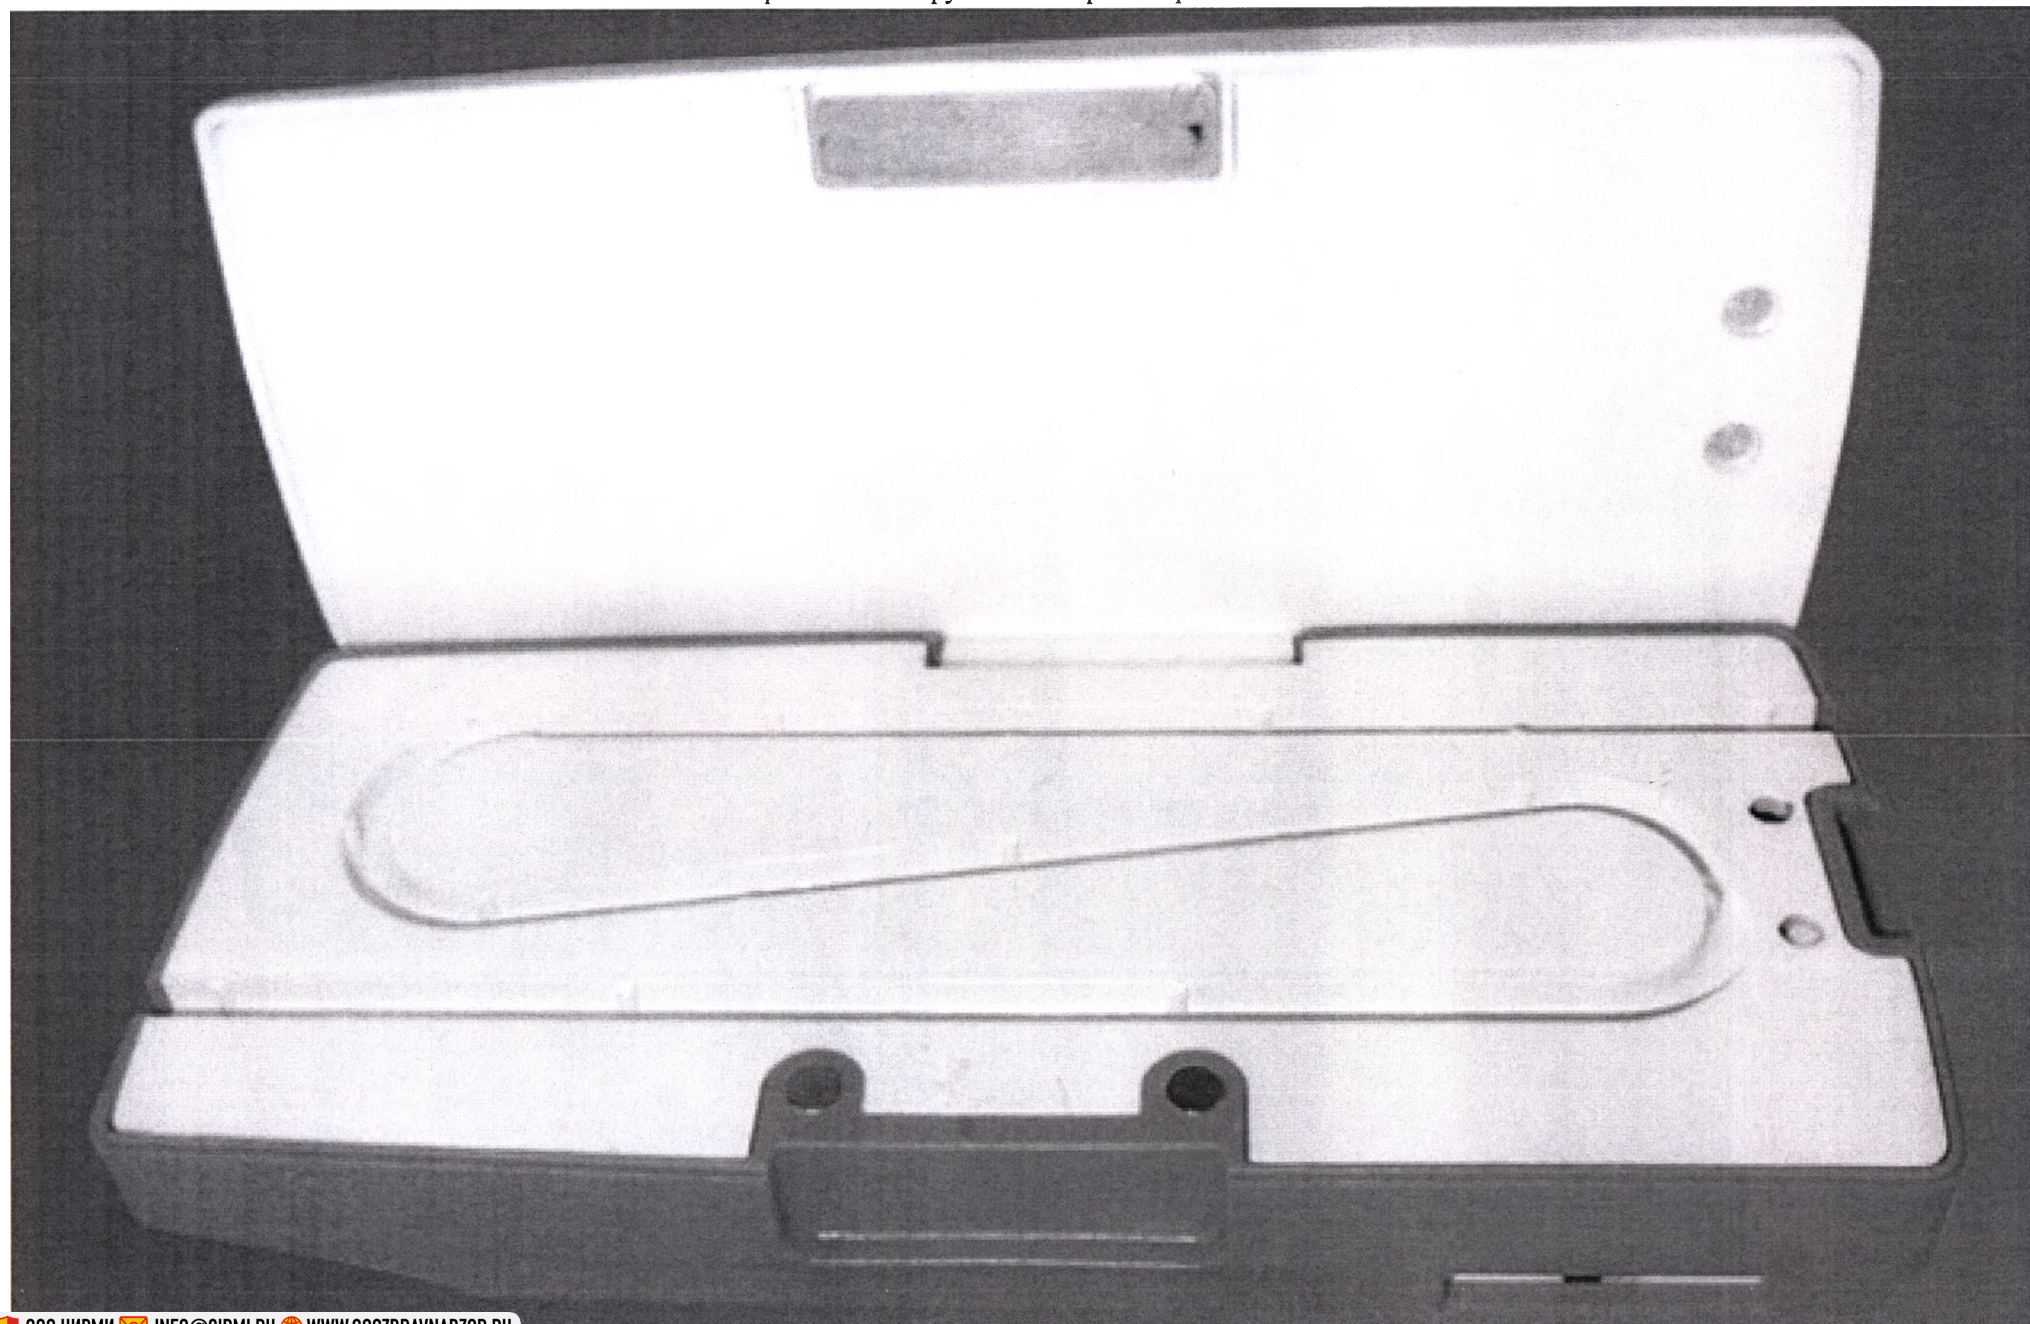

Адаптер сетевой для обогревателя инфузионных растворов

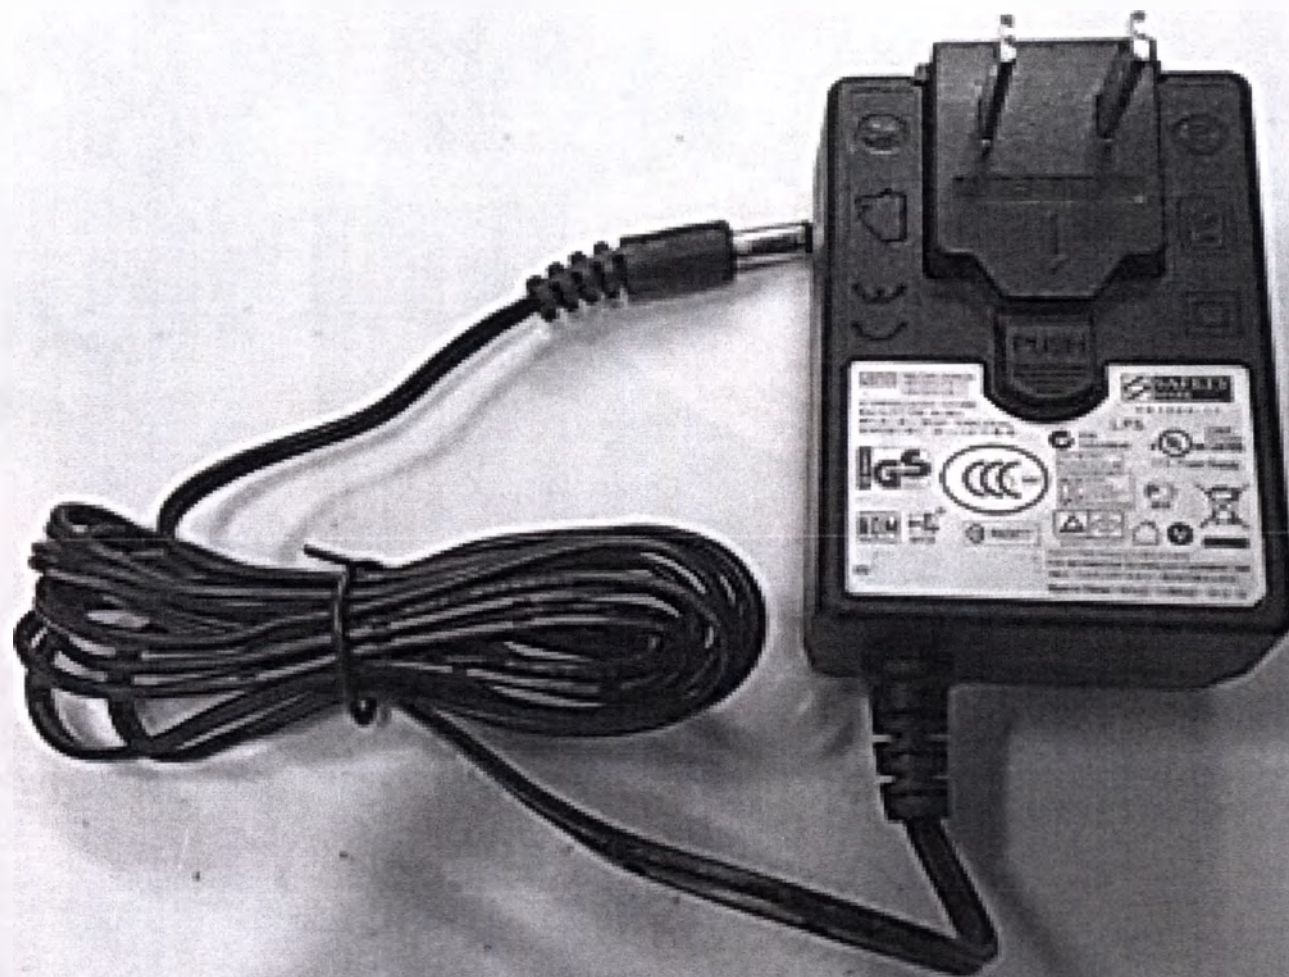

Диск с программным обеспечением для центральной станции мониторинга



Диск с программным обеспечением для подключения к ПК для хранения, просмотра и распечатки данных




Стойка инфузионная передвижная



Консоль для инфузионных насосов



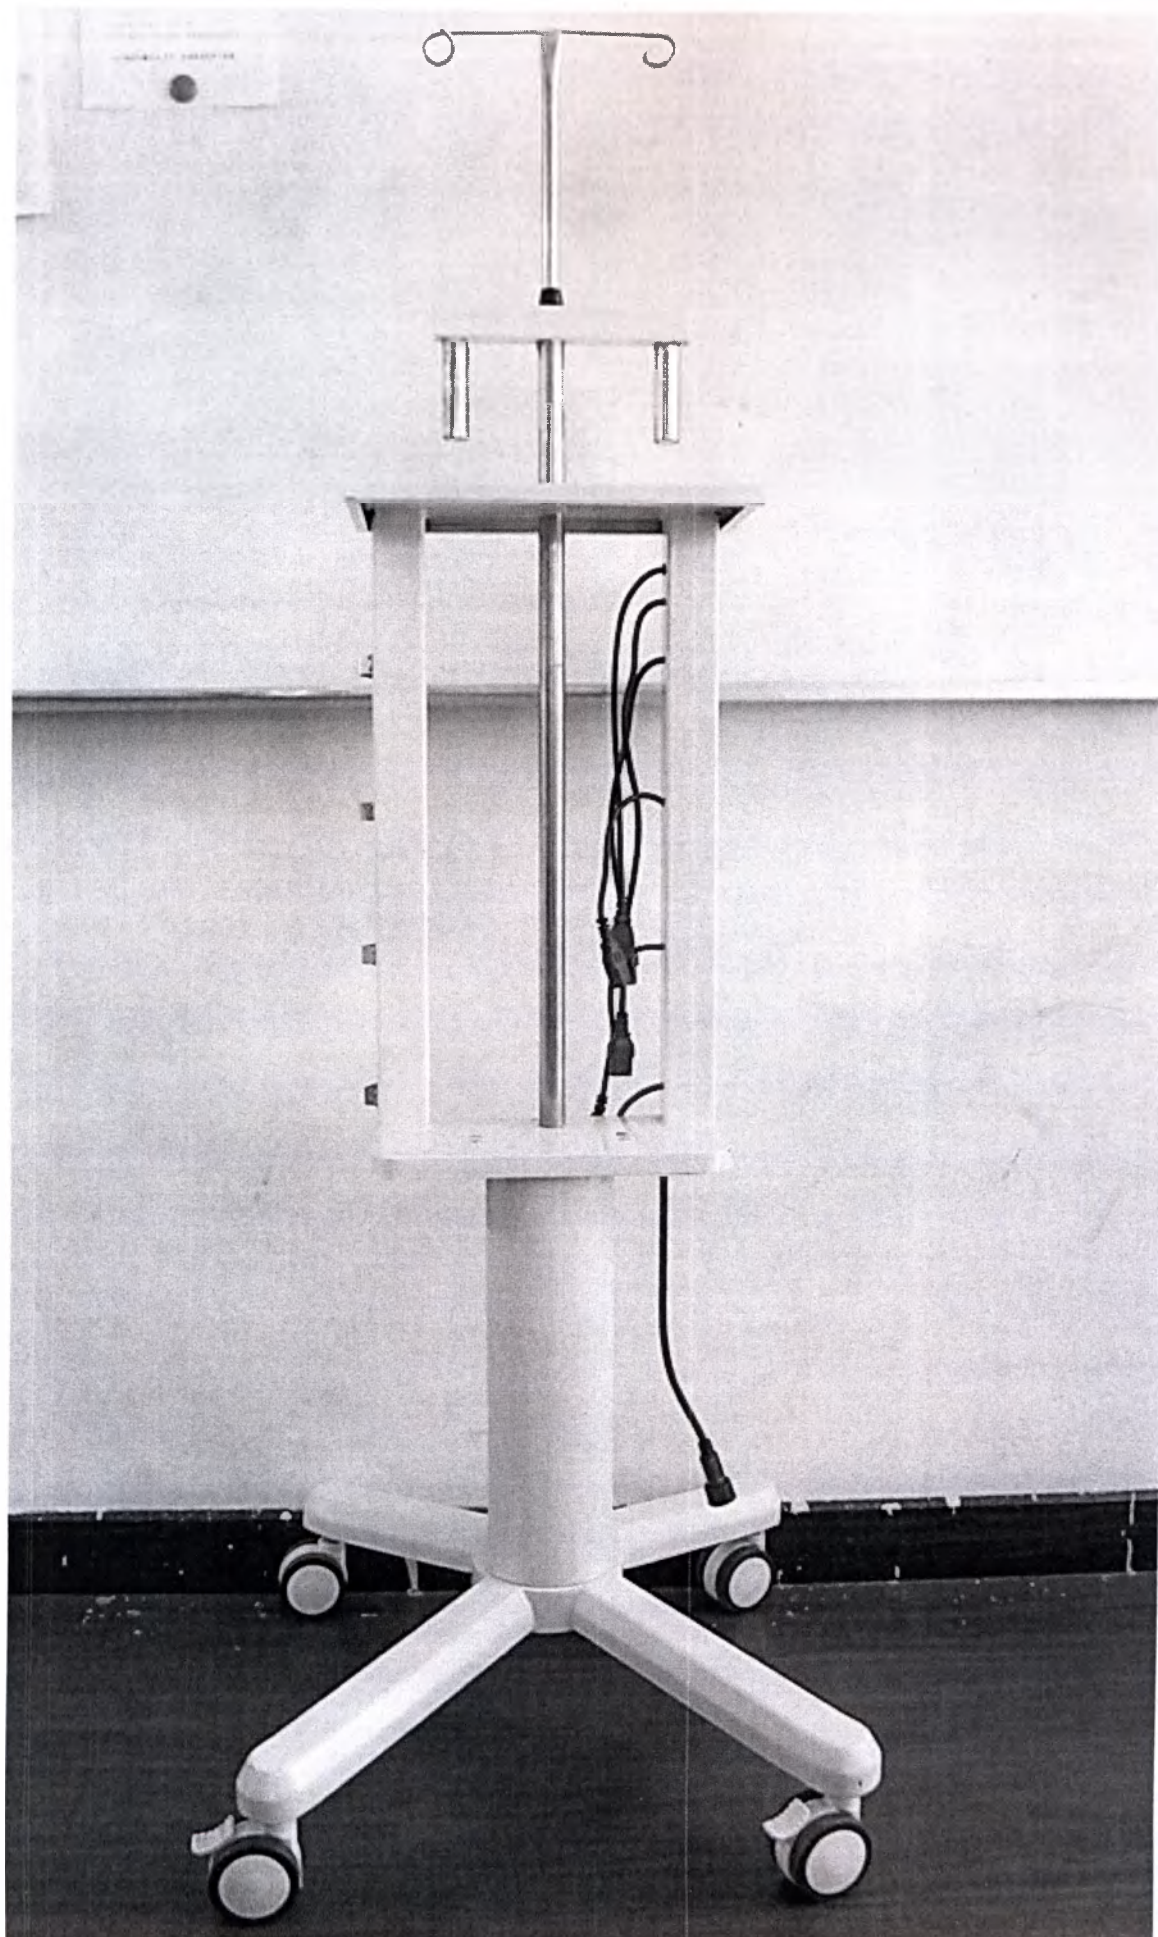

Кабель питания дополнительный



ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО

75 ЛИСТОВ

Генеральный директор
ООО «ДИКСИОН» Яковлев

