







Кронштейн для крепления насоса (показан стрелкой)

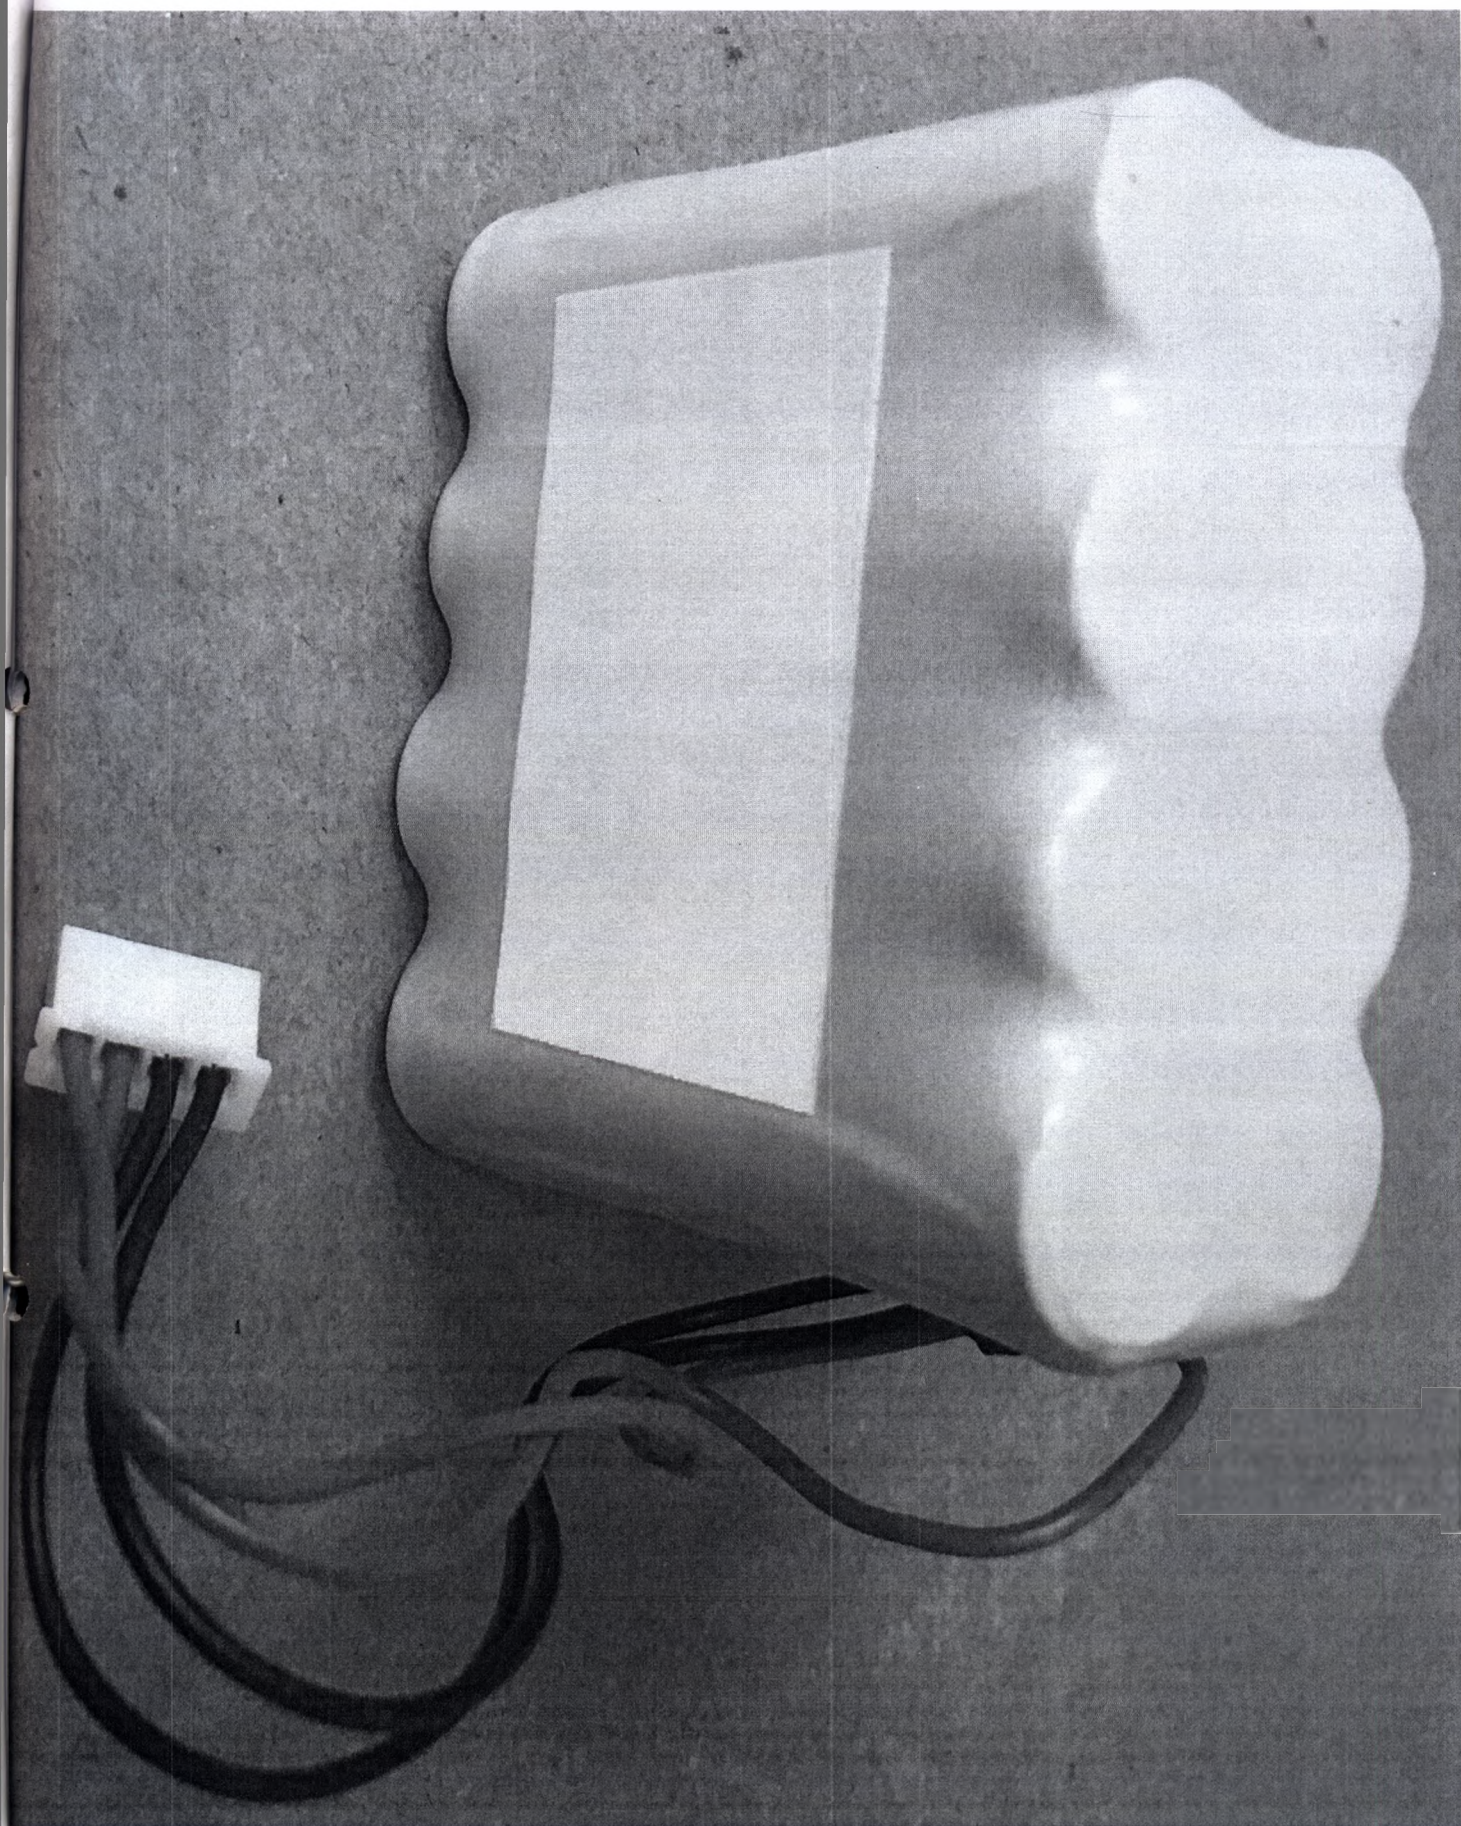

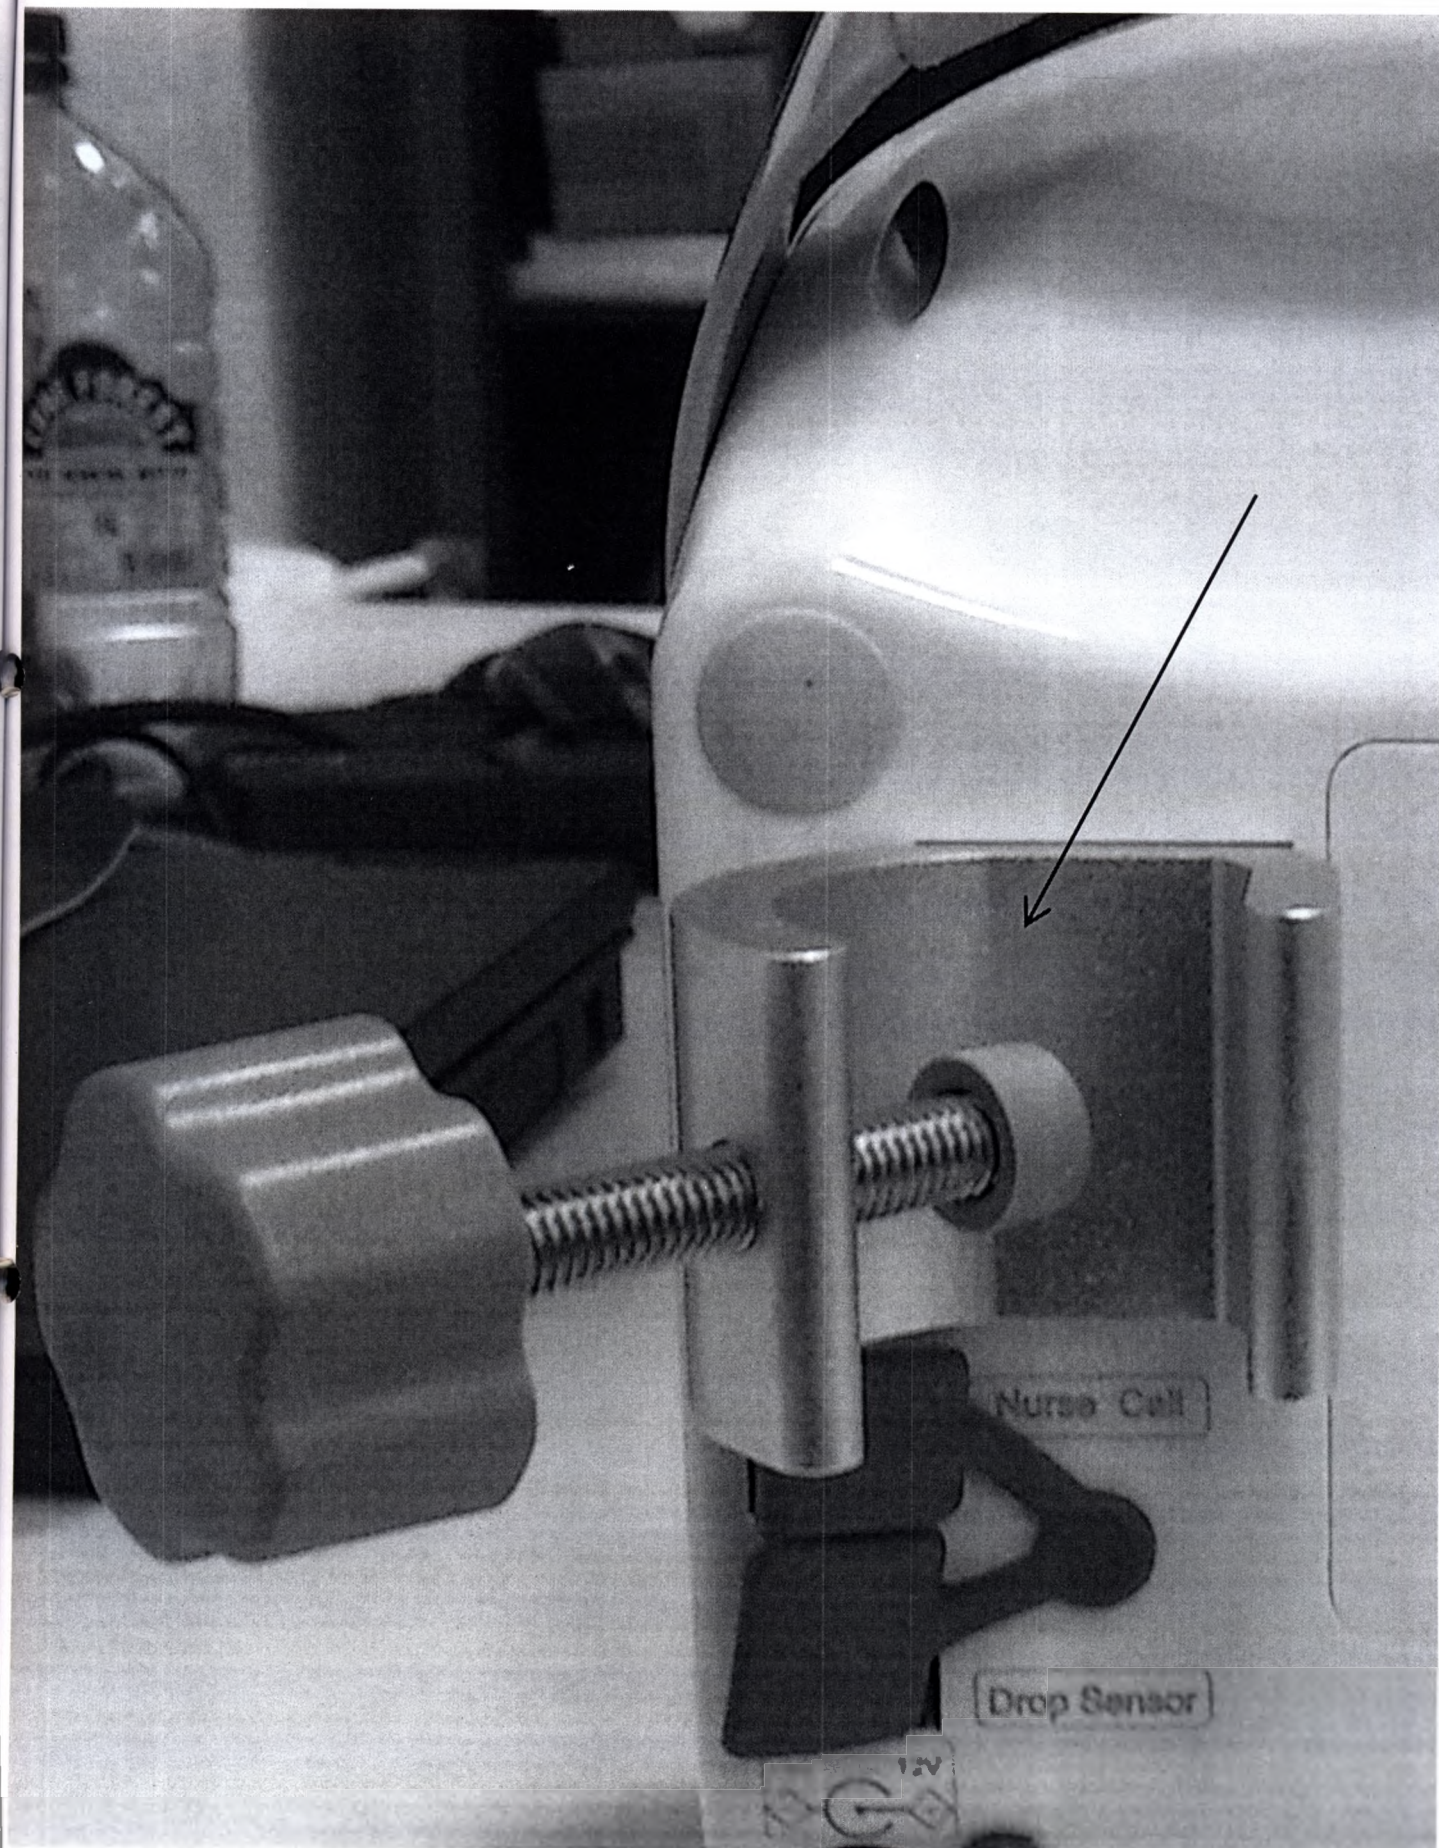

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
«ООО» ДИКСИОН

(Дата)

(Подпись) (Расшифровка подписи)

DIXION

Руководство по эксплуатации
Насосы инфузионные воллюметрические «ИНСТИЛАР»
«ИНСТИЛАР -1486»

по ТУ 9444-014-74487176-2008

Паспорт

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
«ООО» ДИКСИОН

(Дата)

(Подпись) (Расшифровка подписи)


DIXION


Паспорт

Насосы инфузионные волюметрические «ИНСТИЛАР»
«ИНСТИЛАР -1486»

по ТУ 9444-014-74487176-2008

Датчик капель

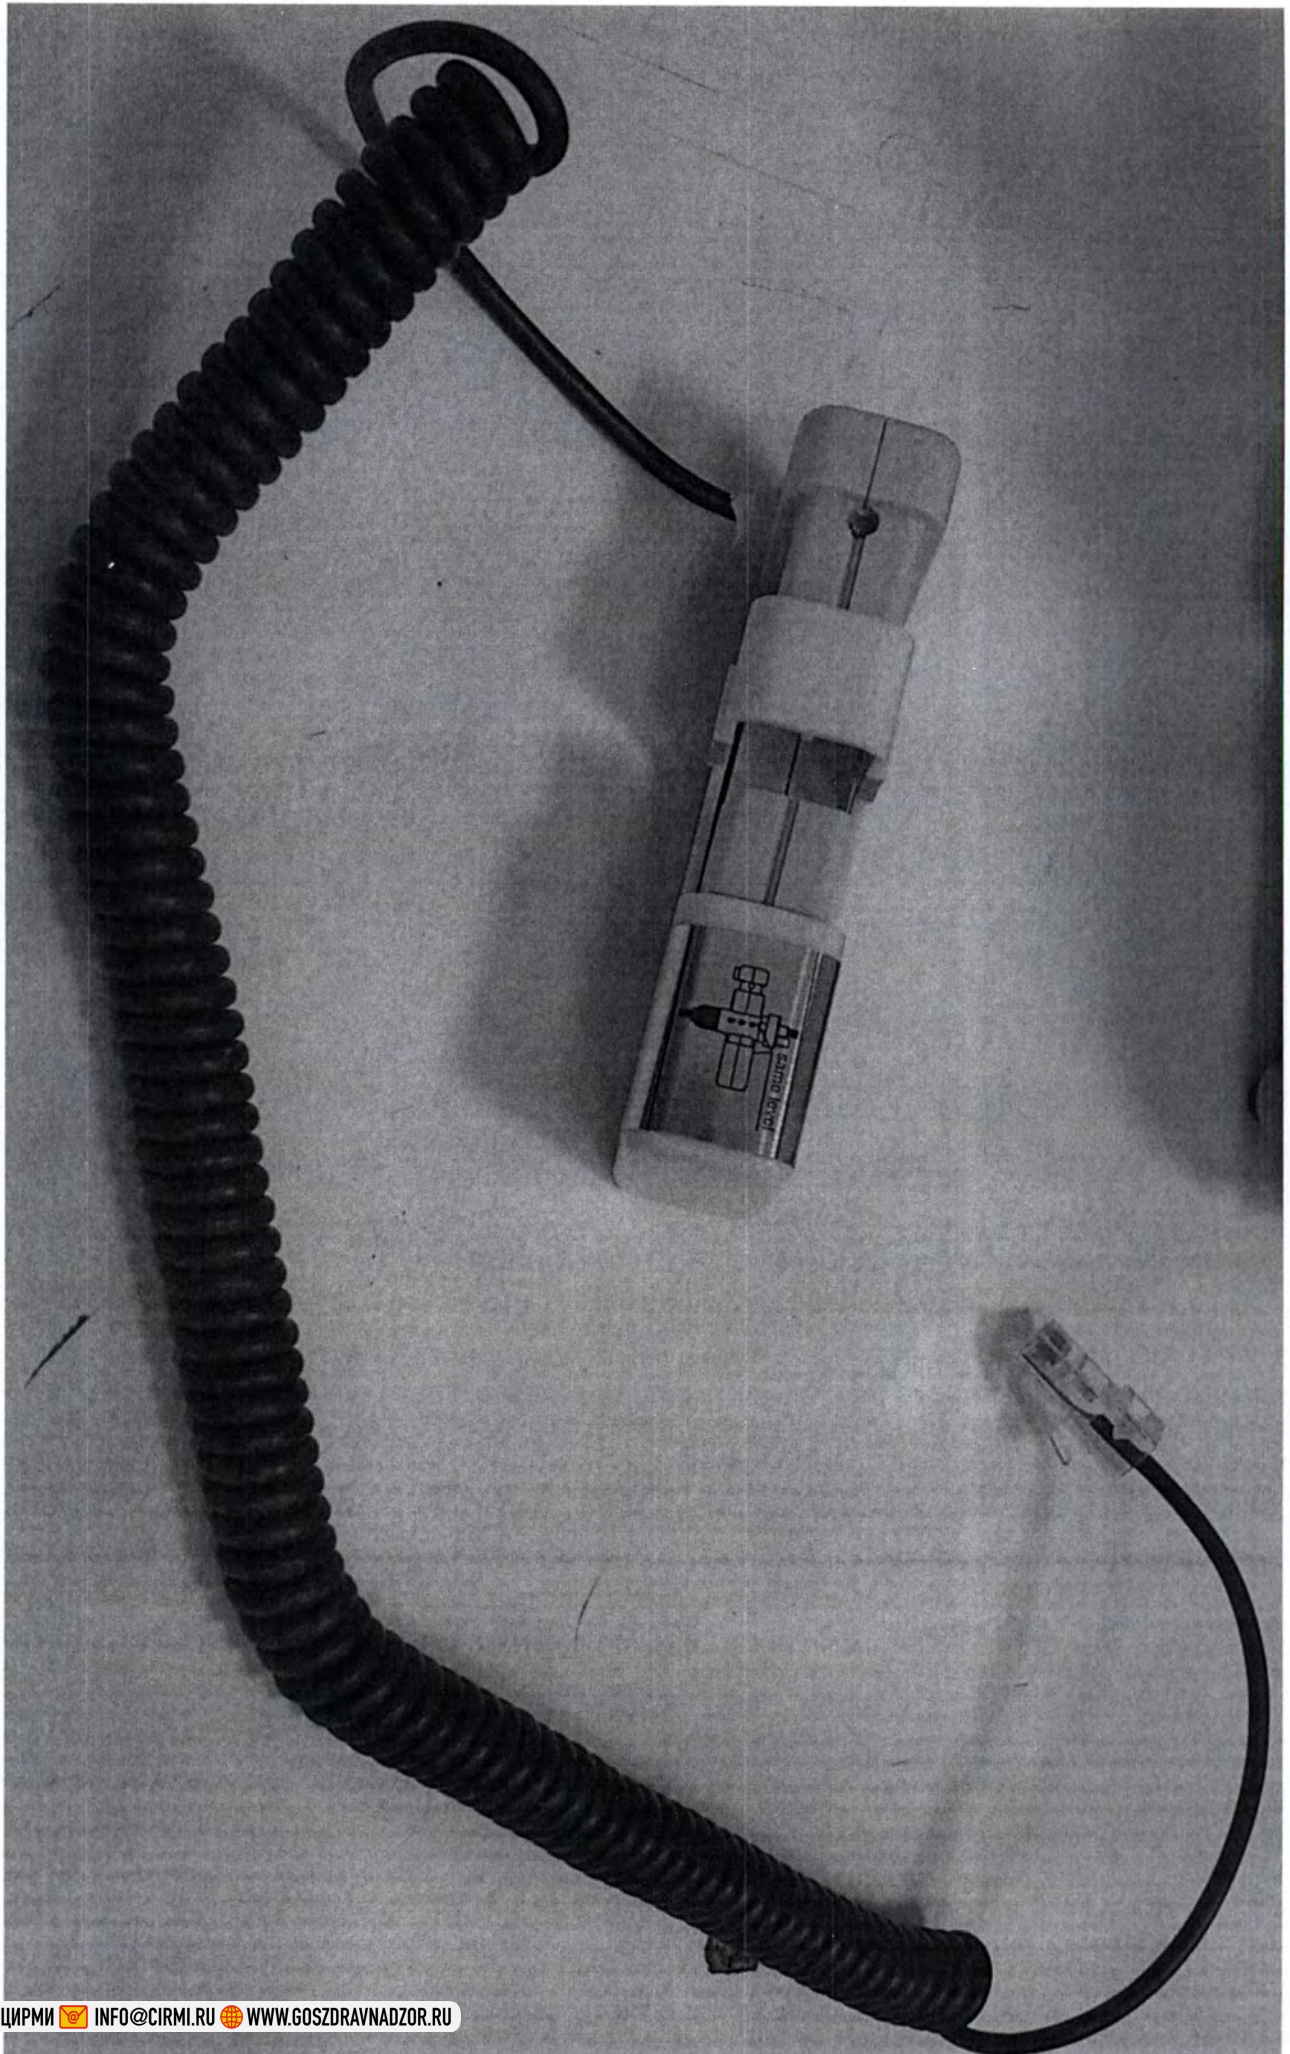

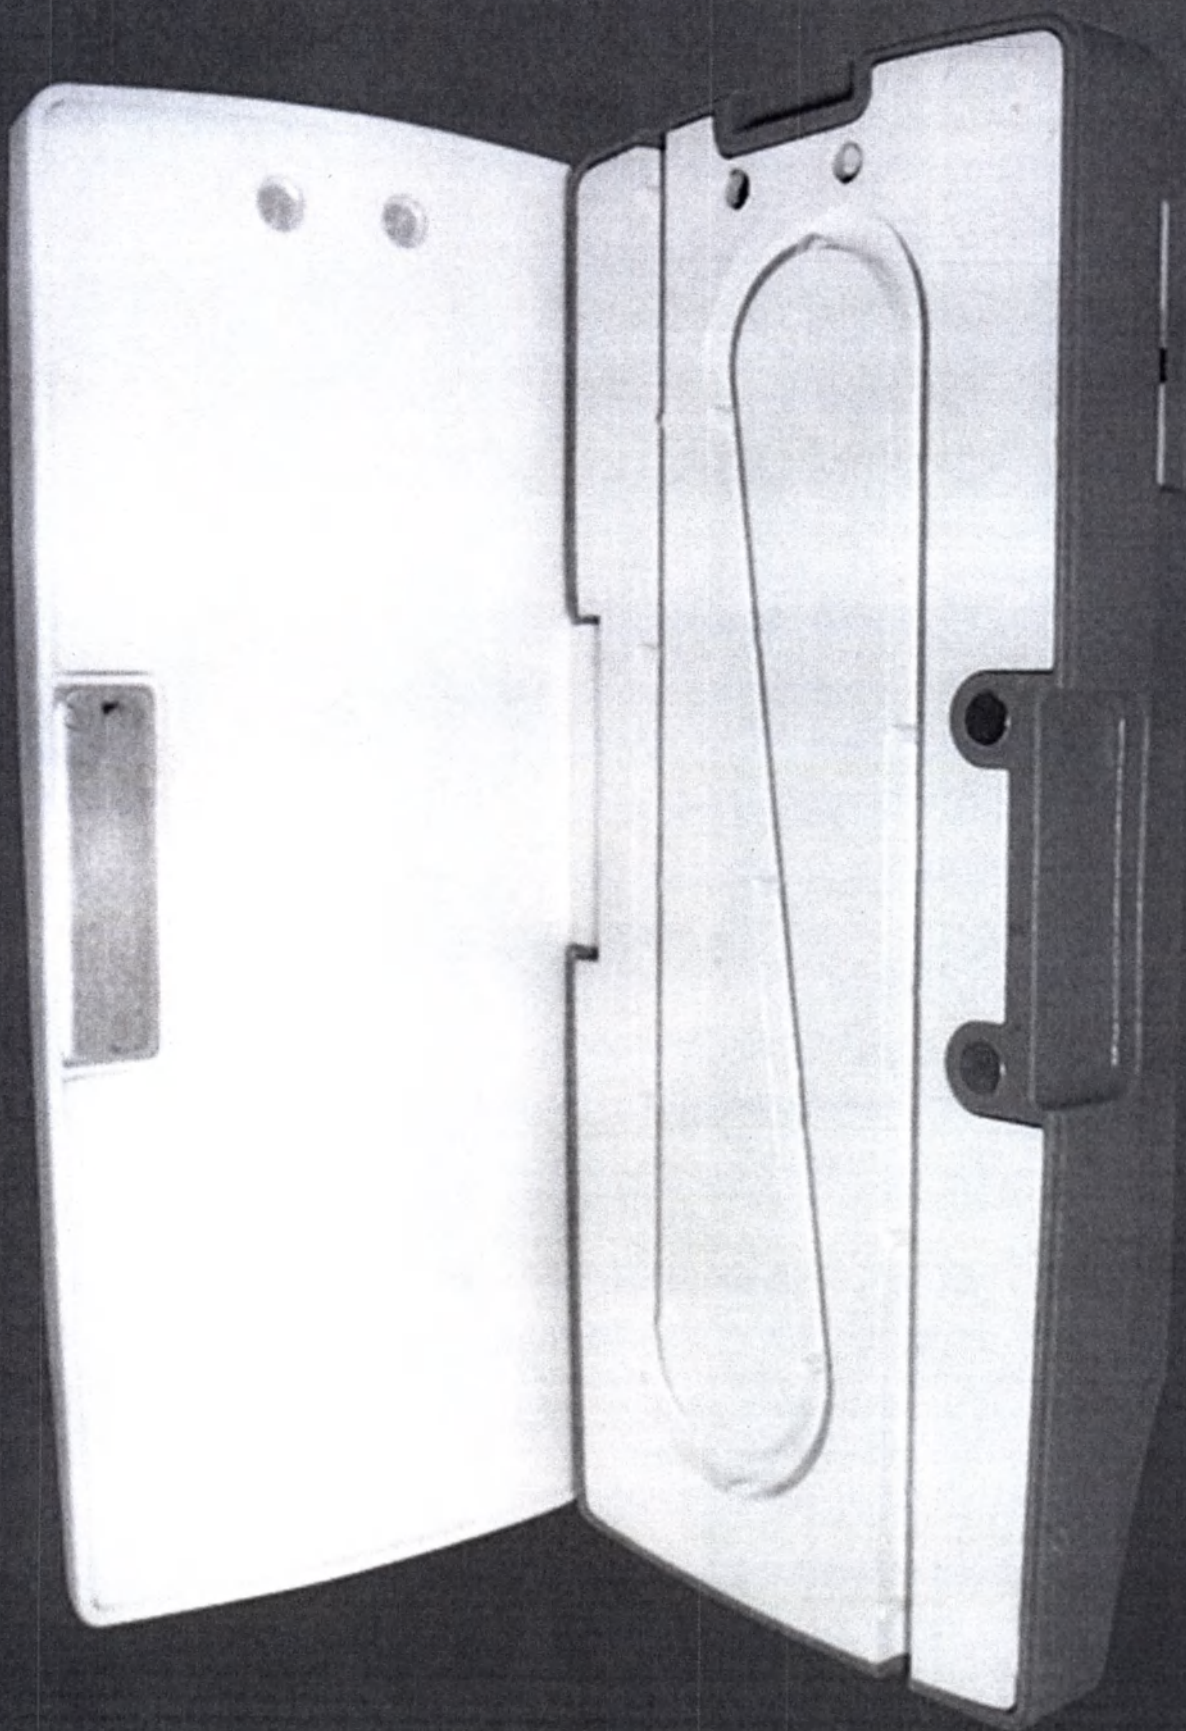

Адаптер сетевой для обогревателя инфузионных растворов








Стойка инфузионная передвижная



Консоль для инфузионных насосов



Станция для инфузионных насосов

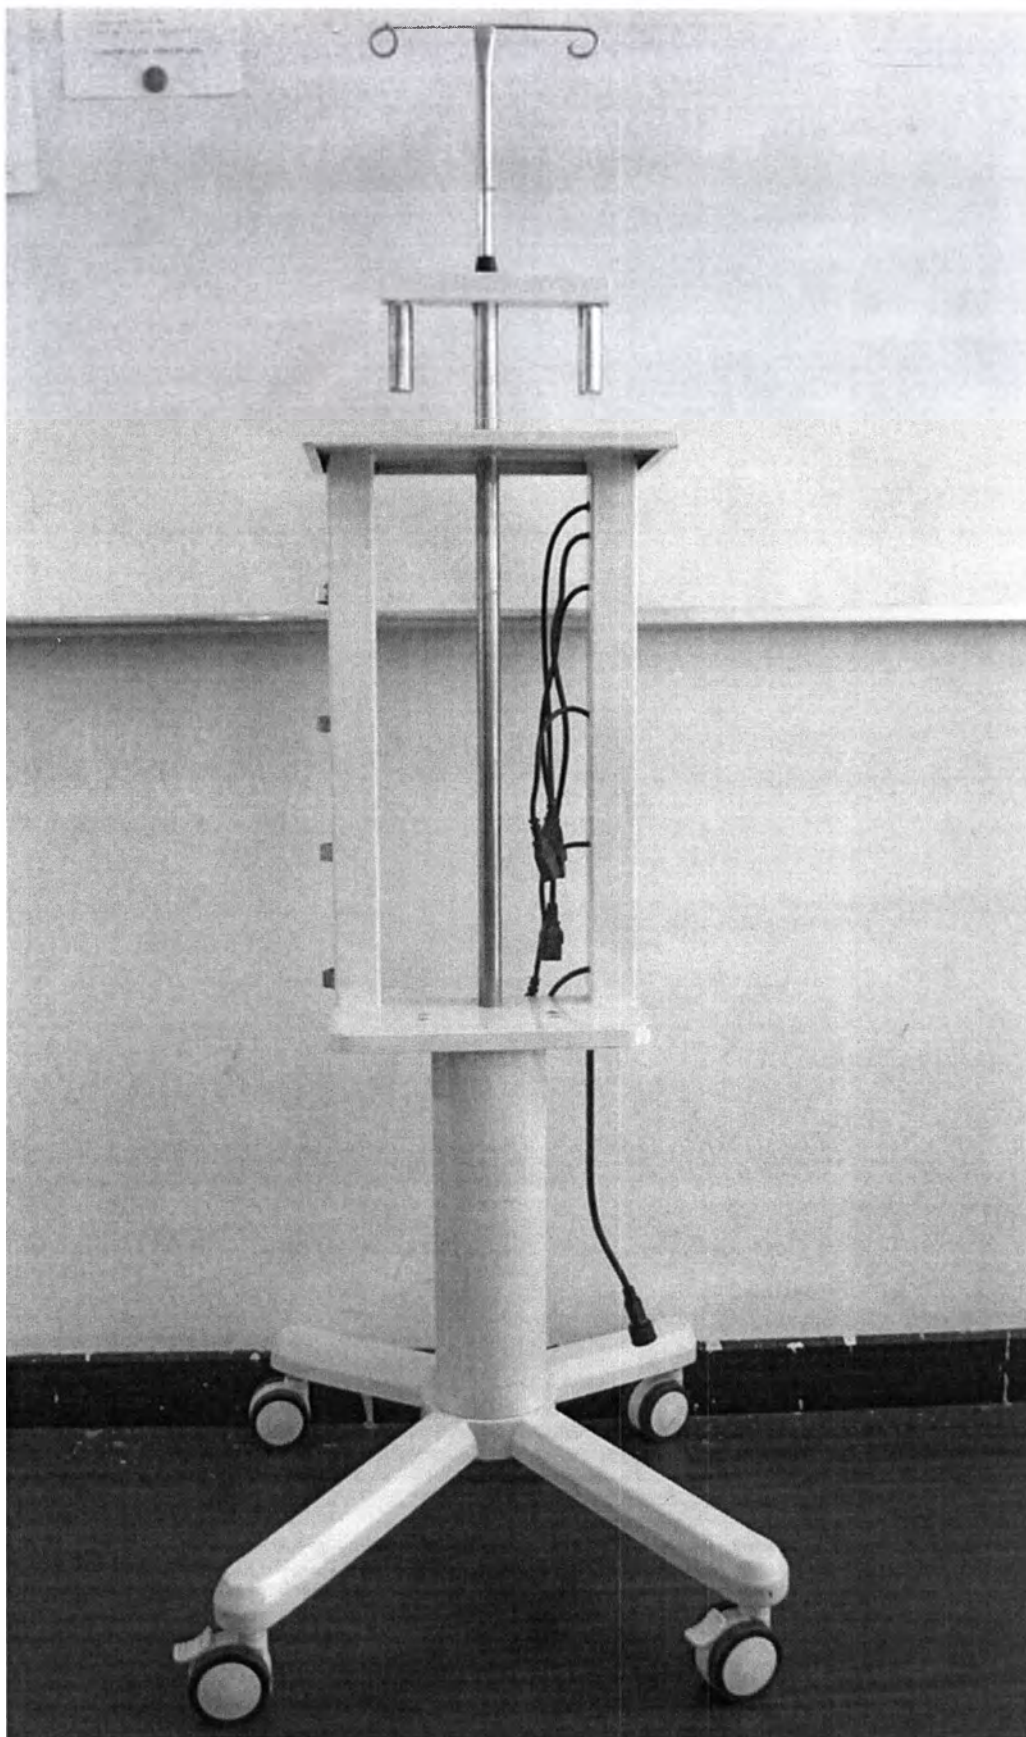

Кабель питания дополнительный



ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО
15 ЛИСТОВ

Генеральный директор
ООО «ДИКСИОН» Яковлев А.А.



Насос инфузионный волуметрический «ИНСТИЛАР» исполнение «ИНСТИЛАР-1488»
Блок основной с дисплеем в сборе





NI-MH Battery Pack

Model:TMK-AA200E


Specification:NI-MH AA2000mAh 12V


Date:2014/02/28

CAUTION!

- ❌ Do not dispose of in fire or put into water
- ❌ Do not disassemble or short circuit
- ⚠ Do not use in high temperature or near a heat source

Кронштейн для крепления насоса

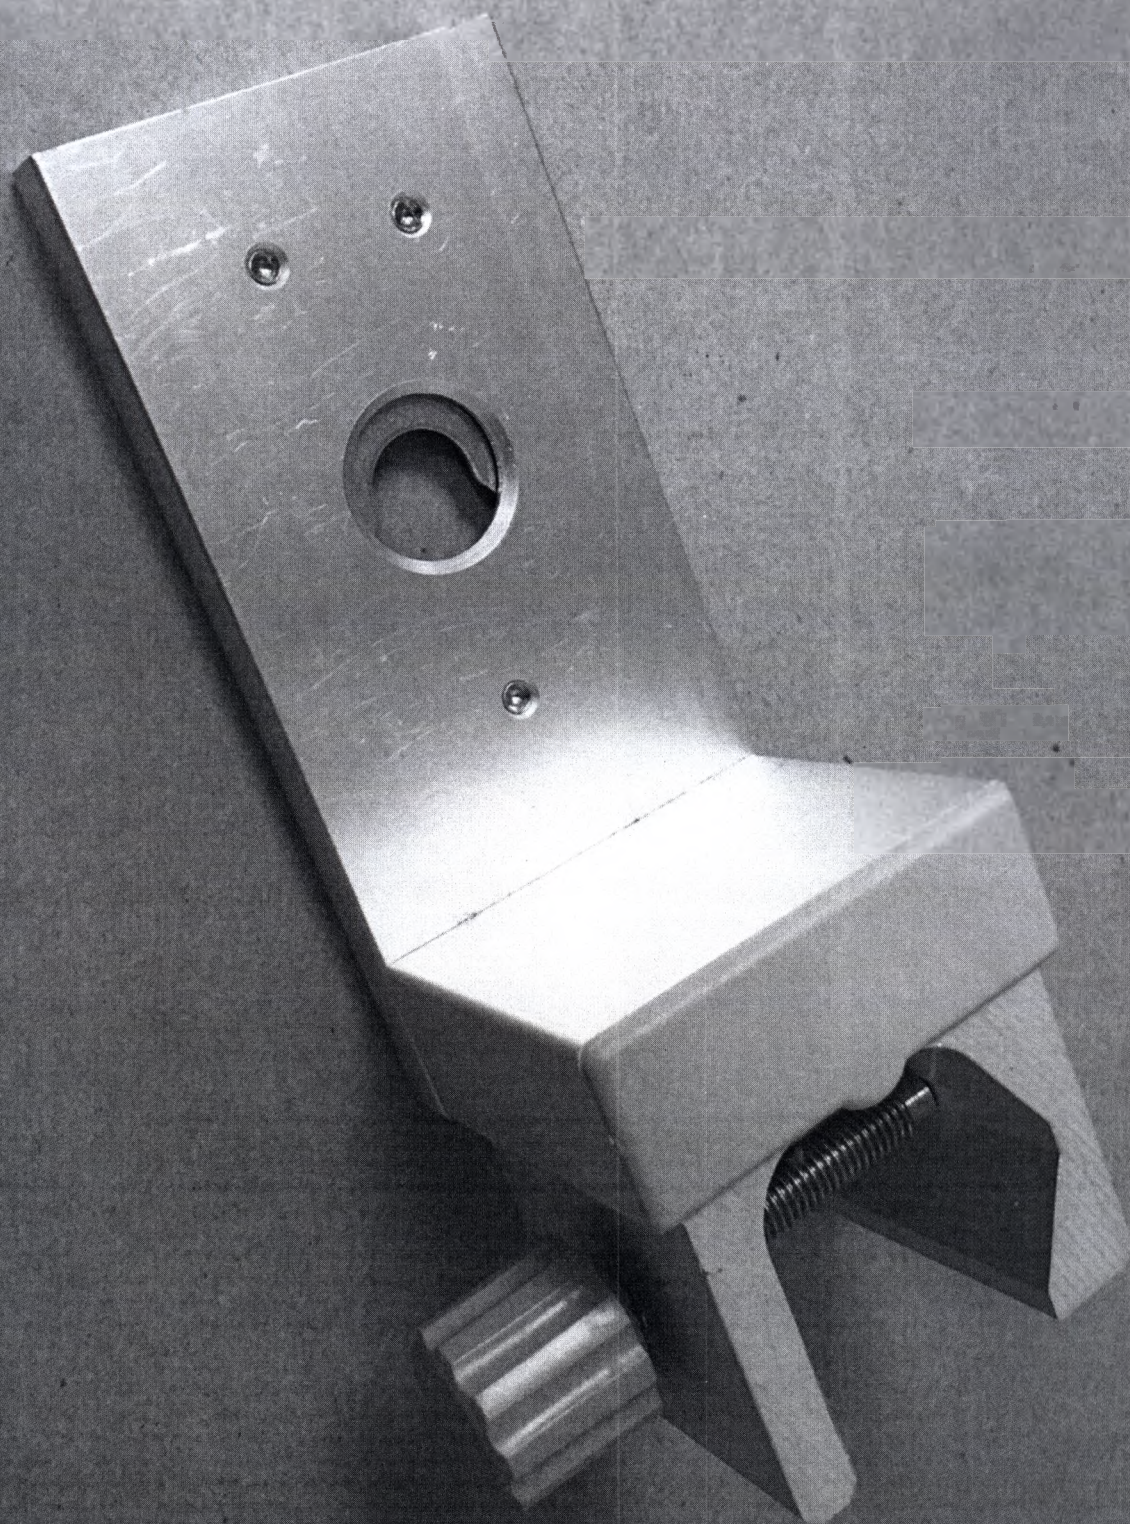

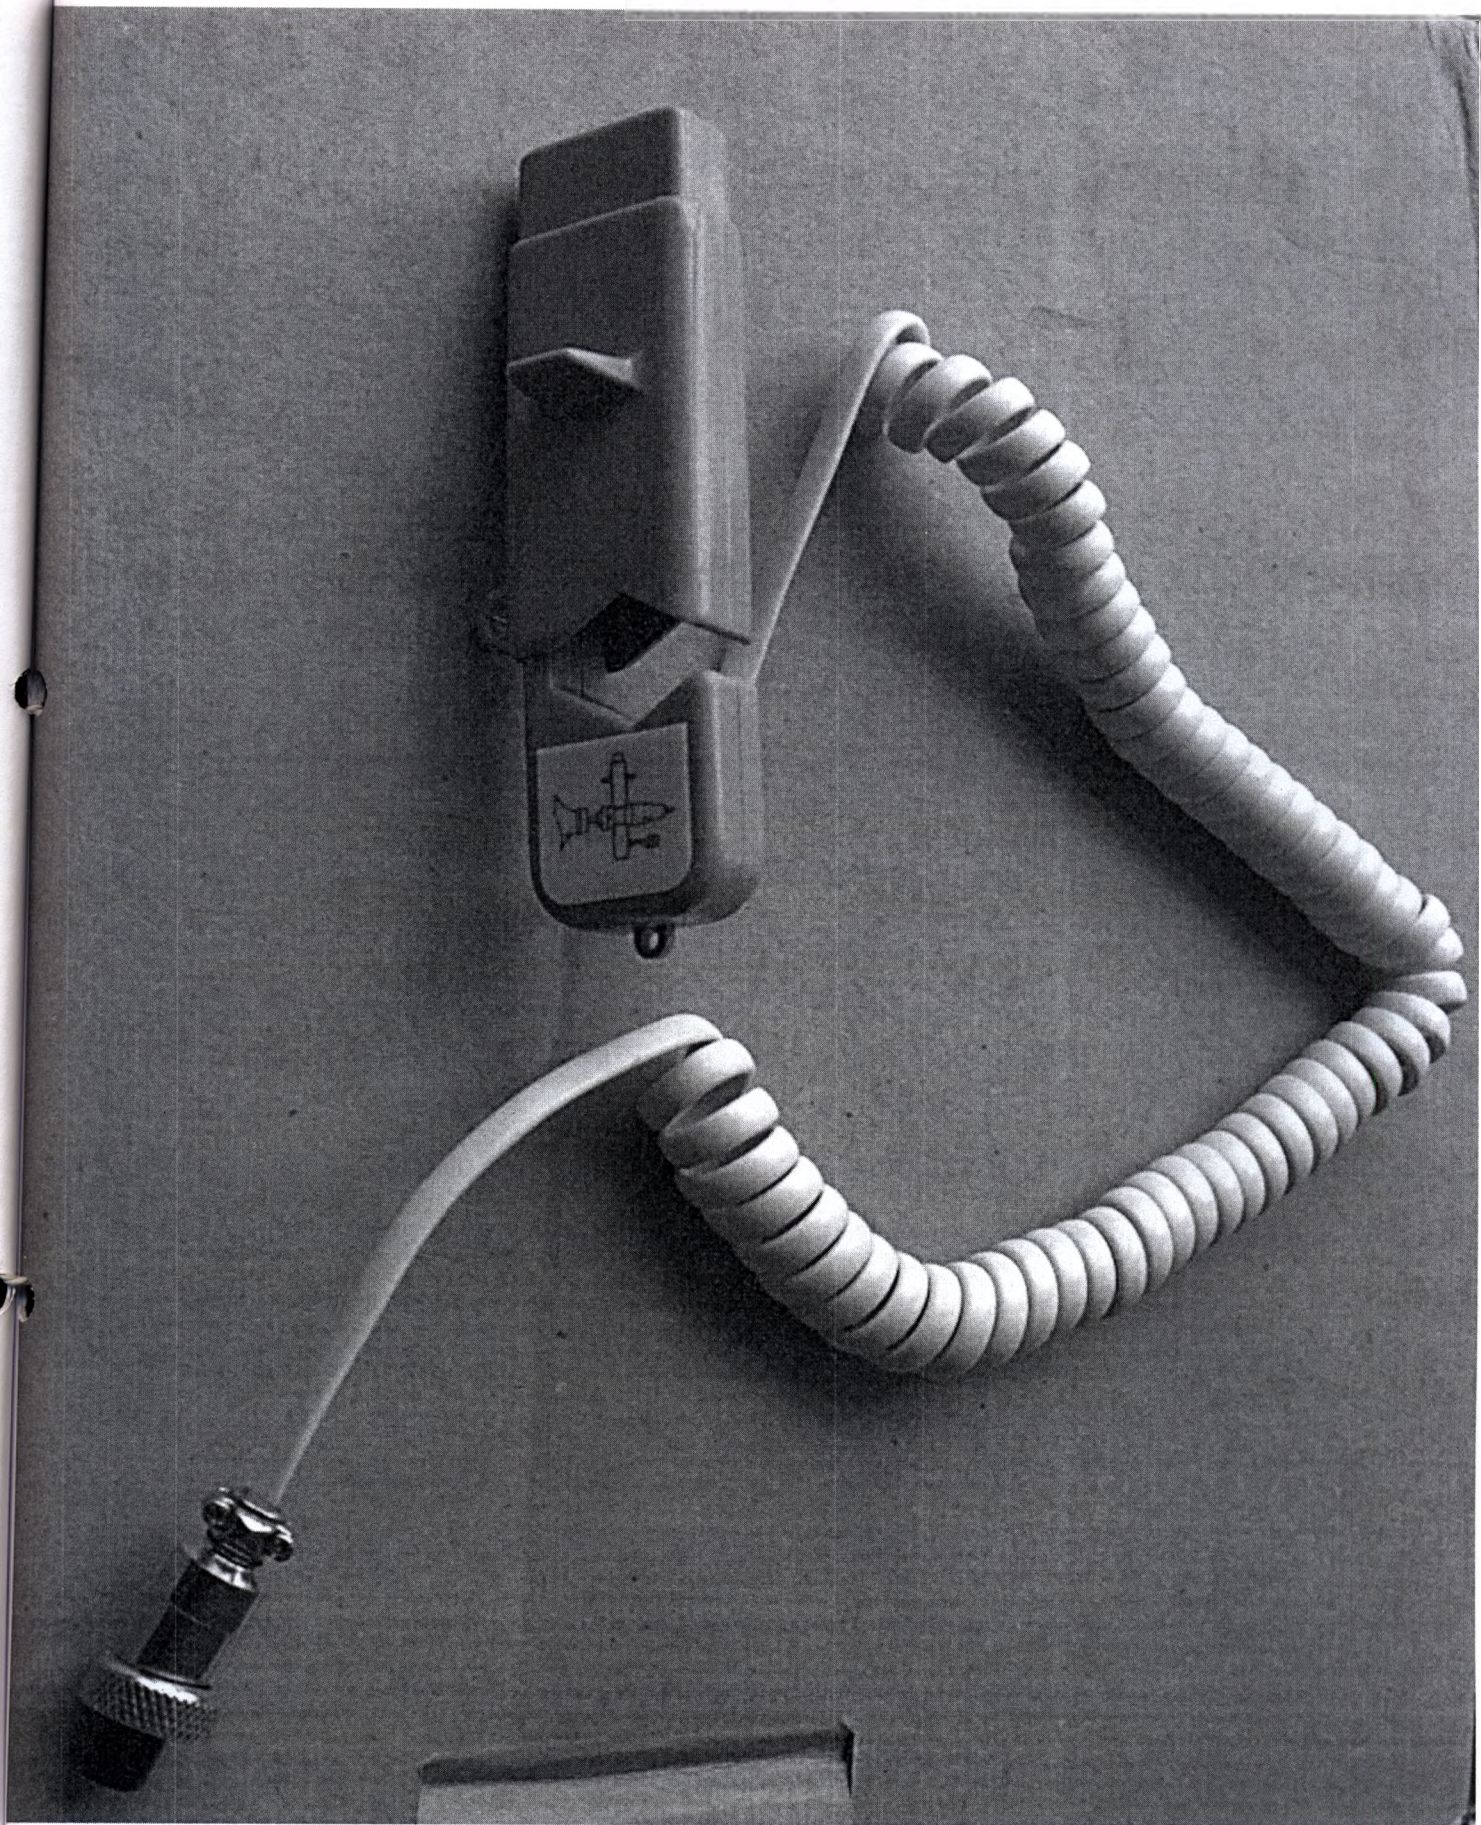



УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
«ООО» ДИКСИОН

(Дата)

(Подпись) (Расшифровка подписи)



Руководство по эксплуатации
Насосы инфузионные волуметрические «ИНСТИЛАР»
«ИНСТИЛАР -1488»

по ТУ 9444-014-74487176-2008

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
«ООО» ДИКСИОН


(Дата)


(Подпись) (Регистрация подписи)


DIXION

Паспорт
Насосы инфузионные волюметрические «ИНСТИЛАР»
«ИНСТИЛАР -1488»

по ТУ 9444-014-74487176-2008

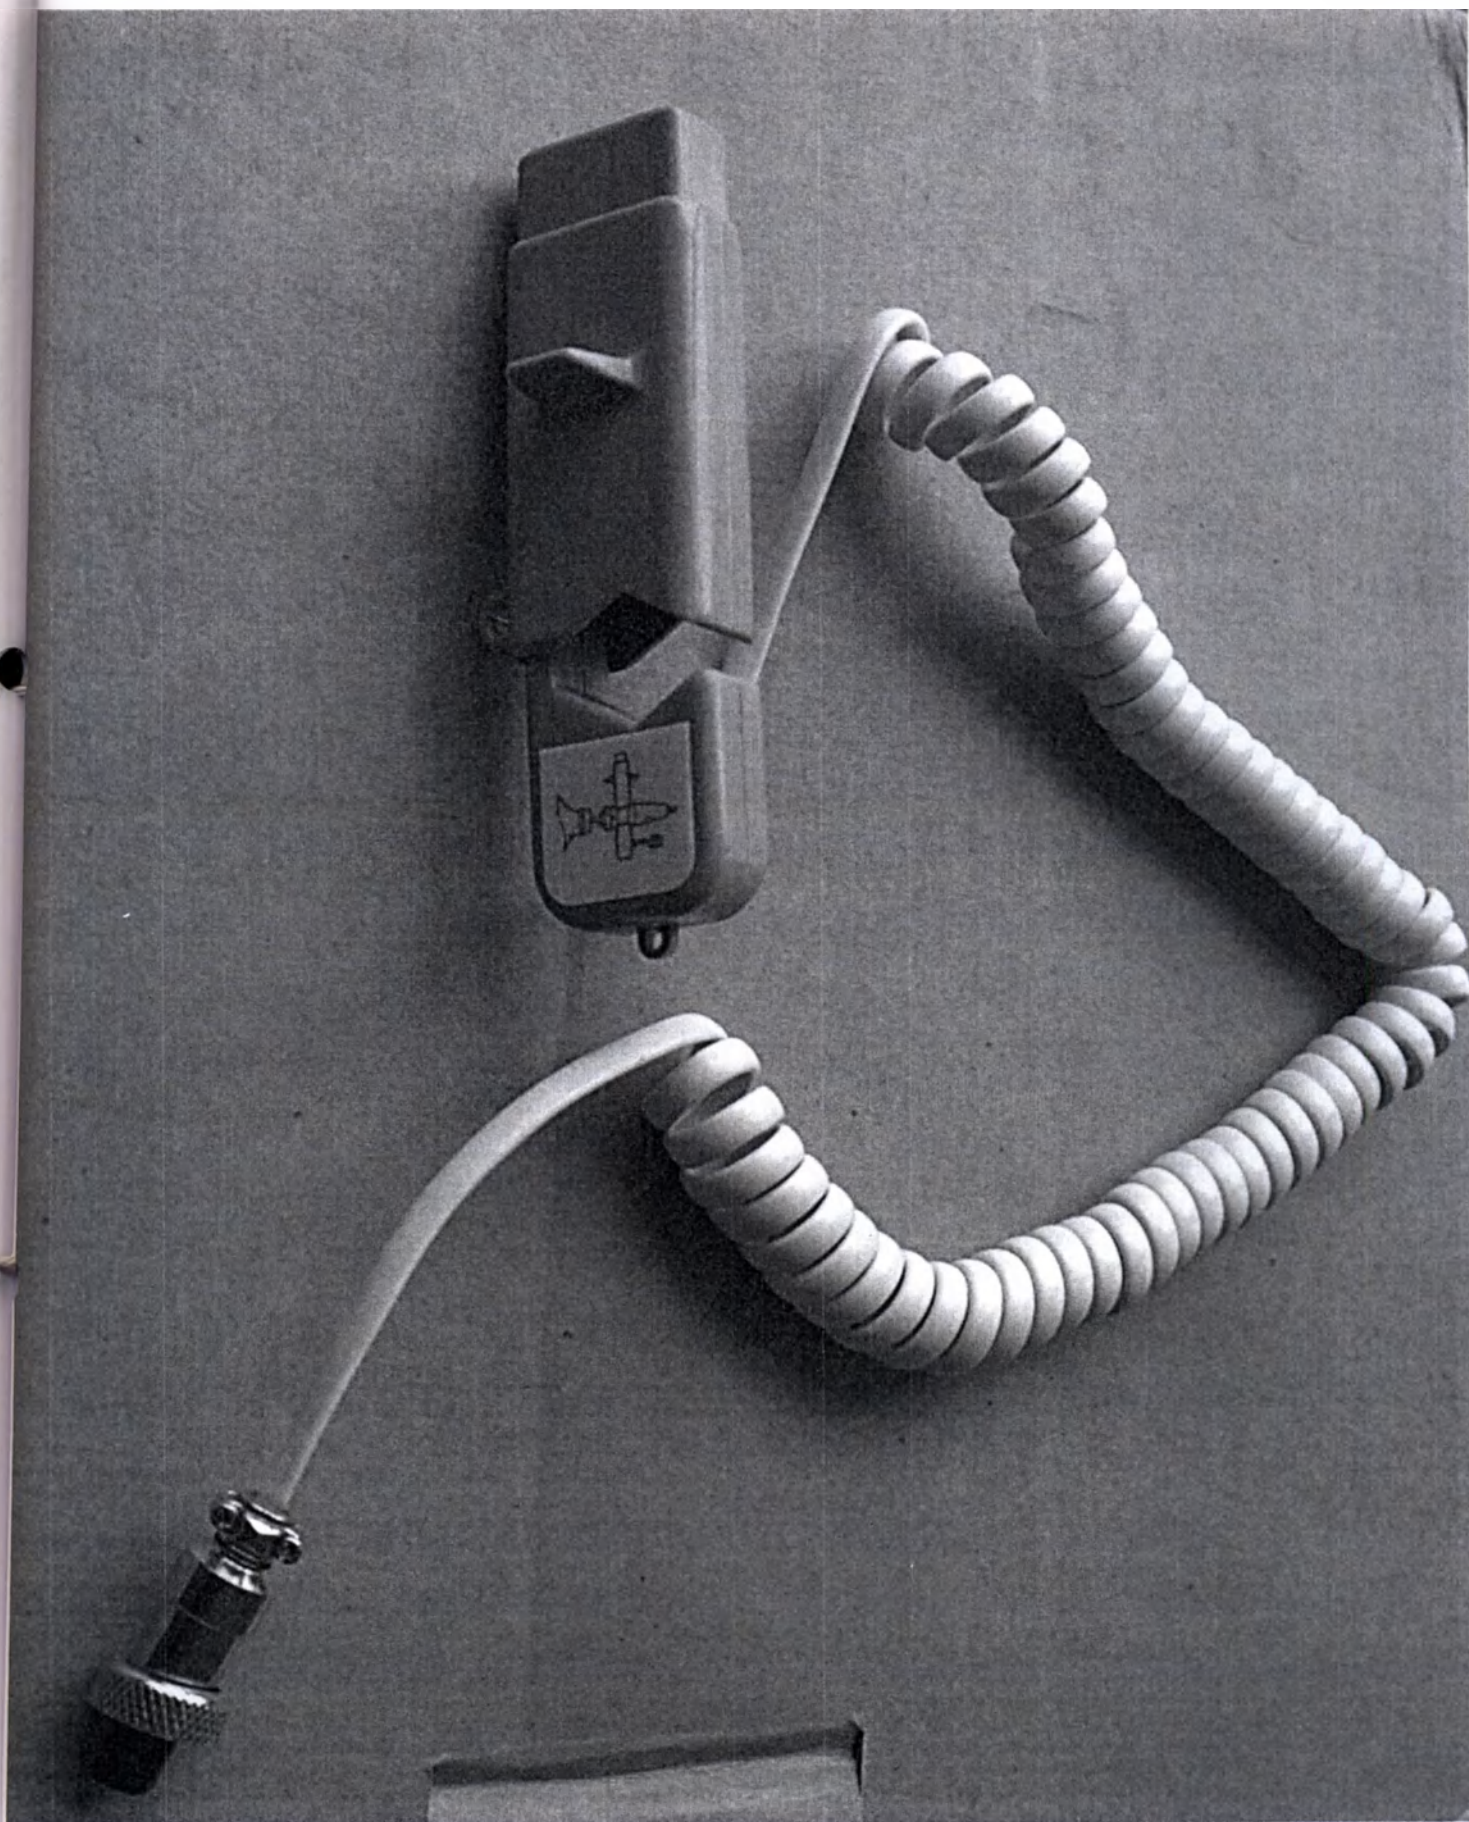

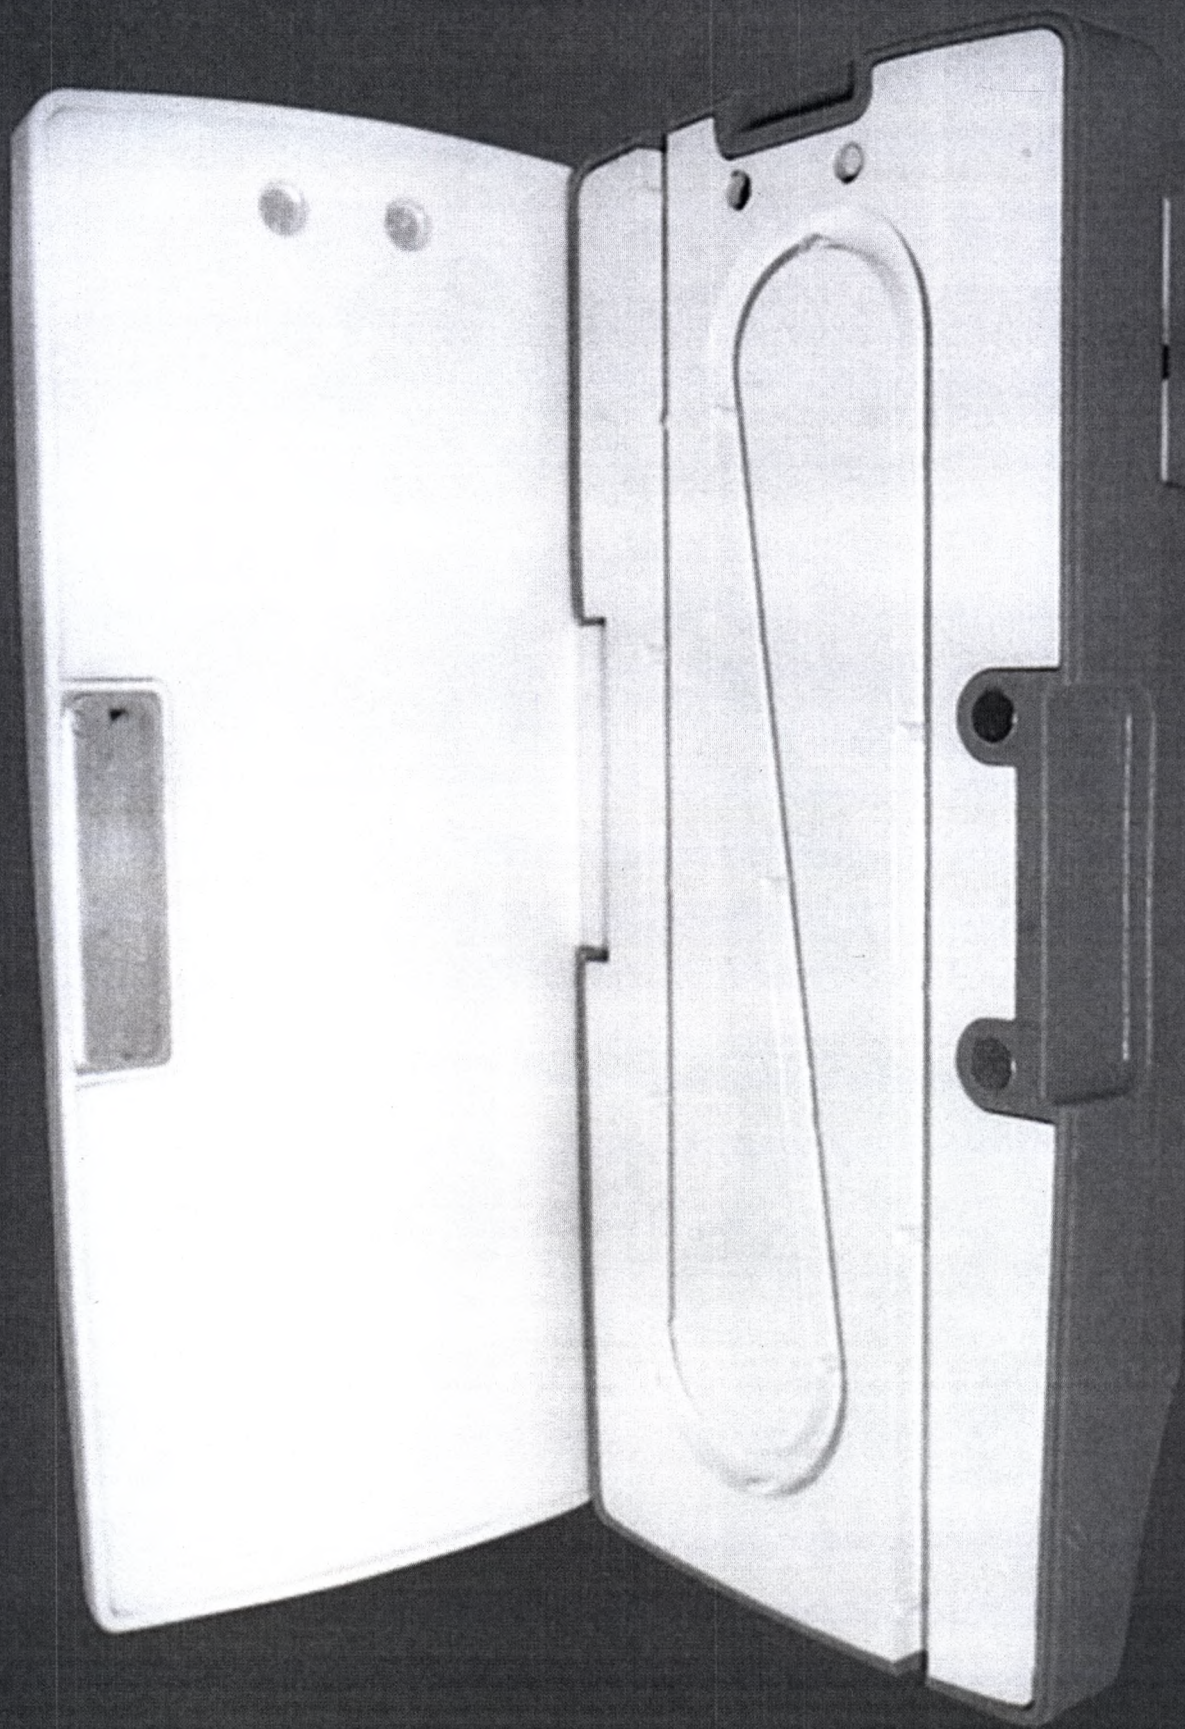

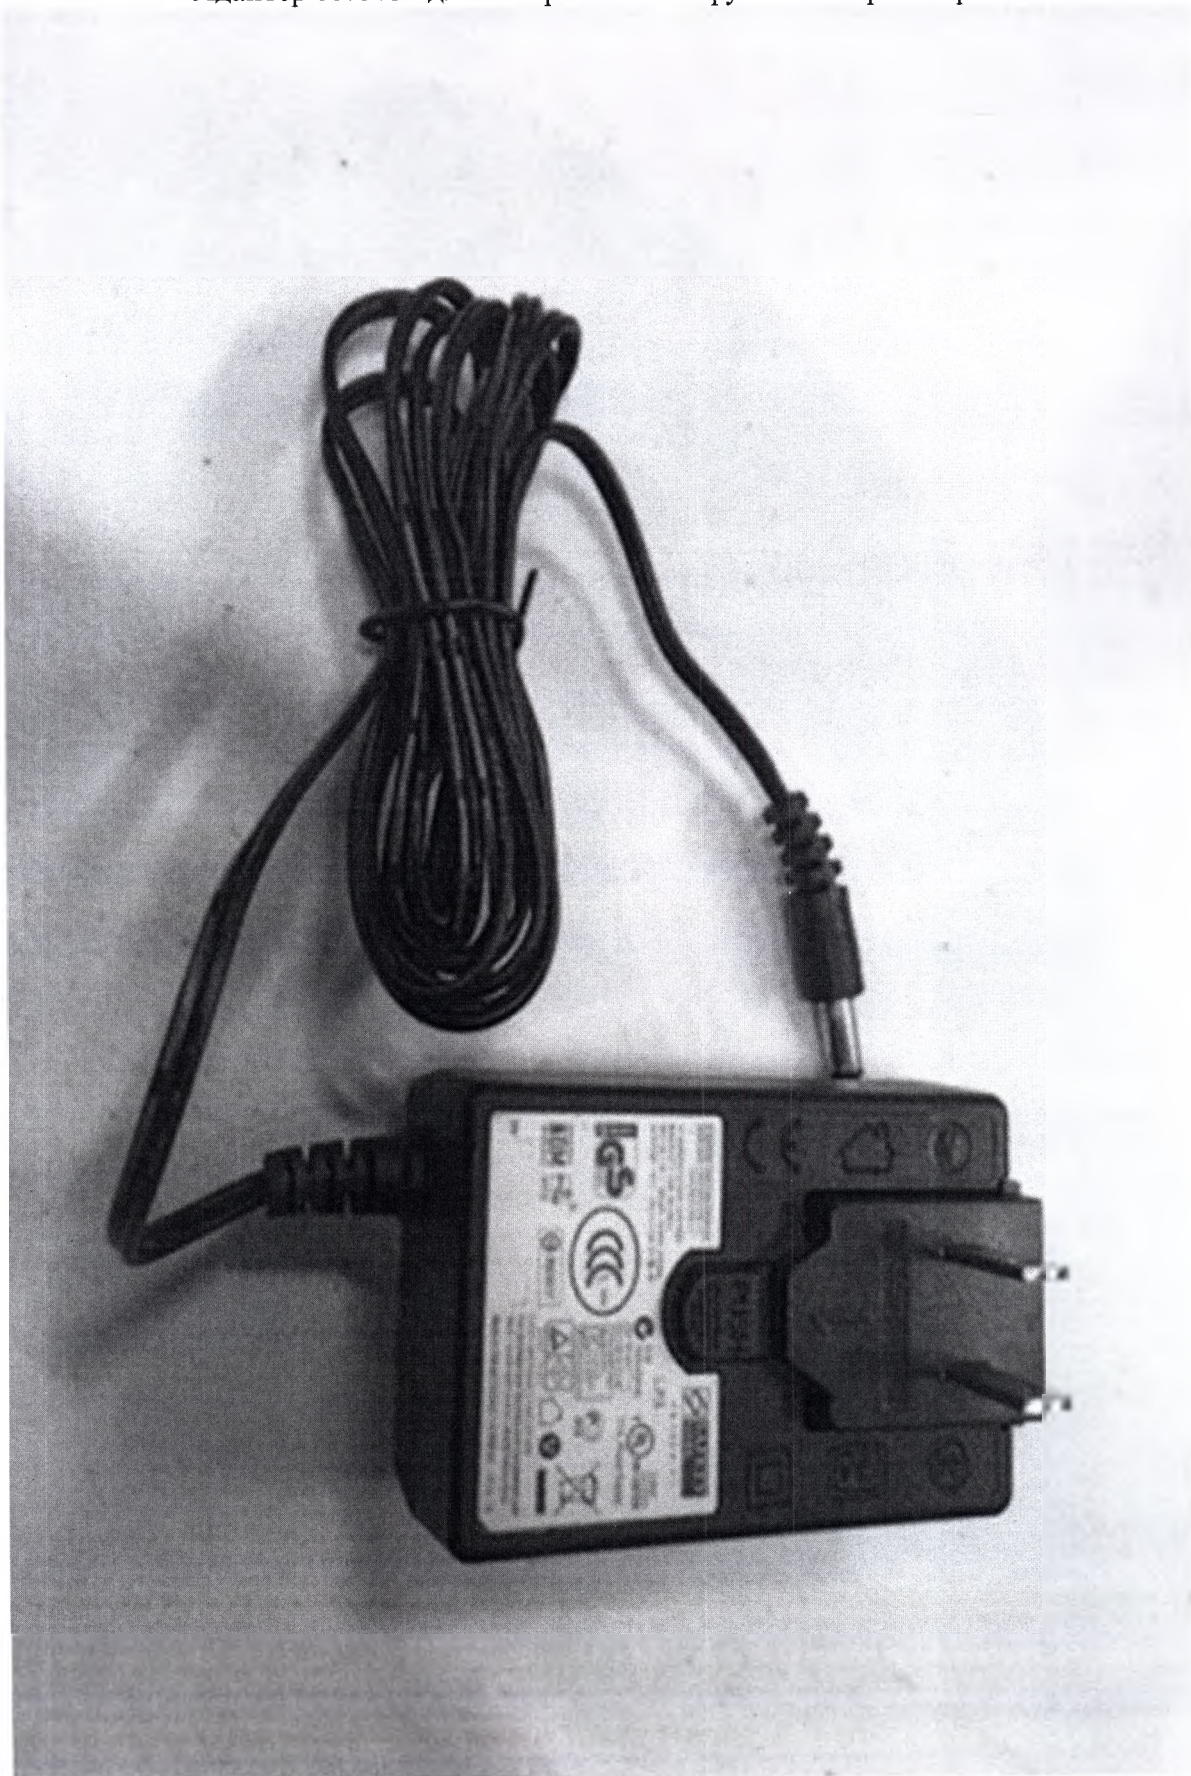

Диск с программным обеспечением для центральной станции мониторинга



Диск с программным обеспечением для подключения к ПК для хранения, просмотра и распечатки данных




Стойка инфузионная передвижная




Консоль для инфузионных насосов



Станция для инфузионных насосов

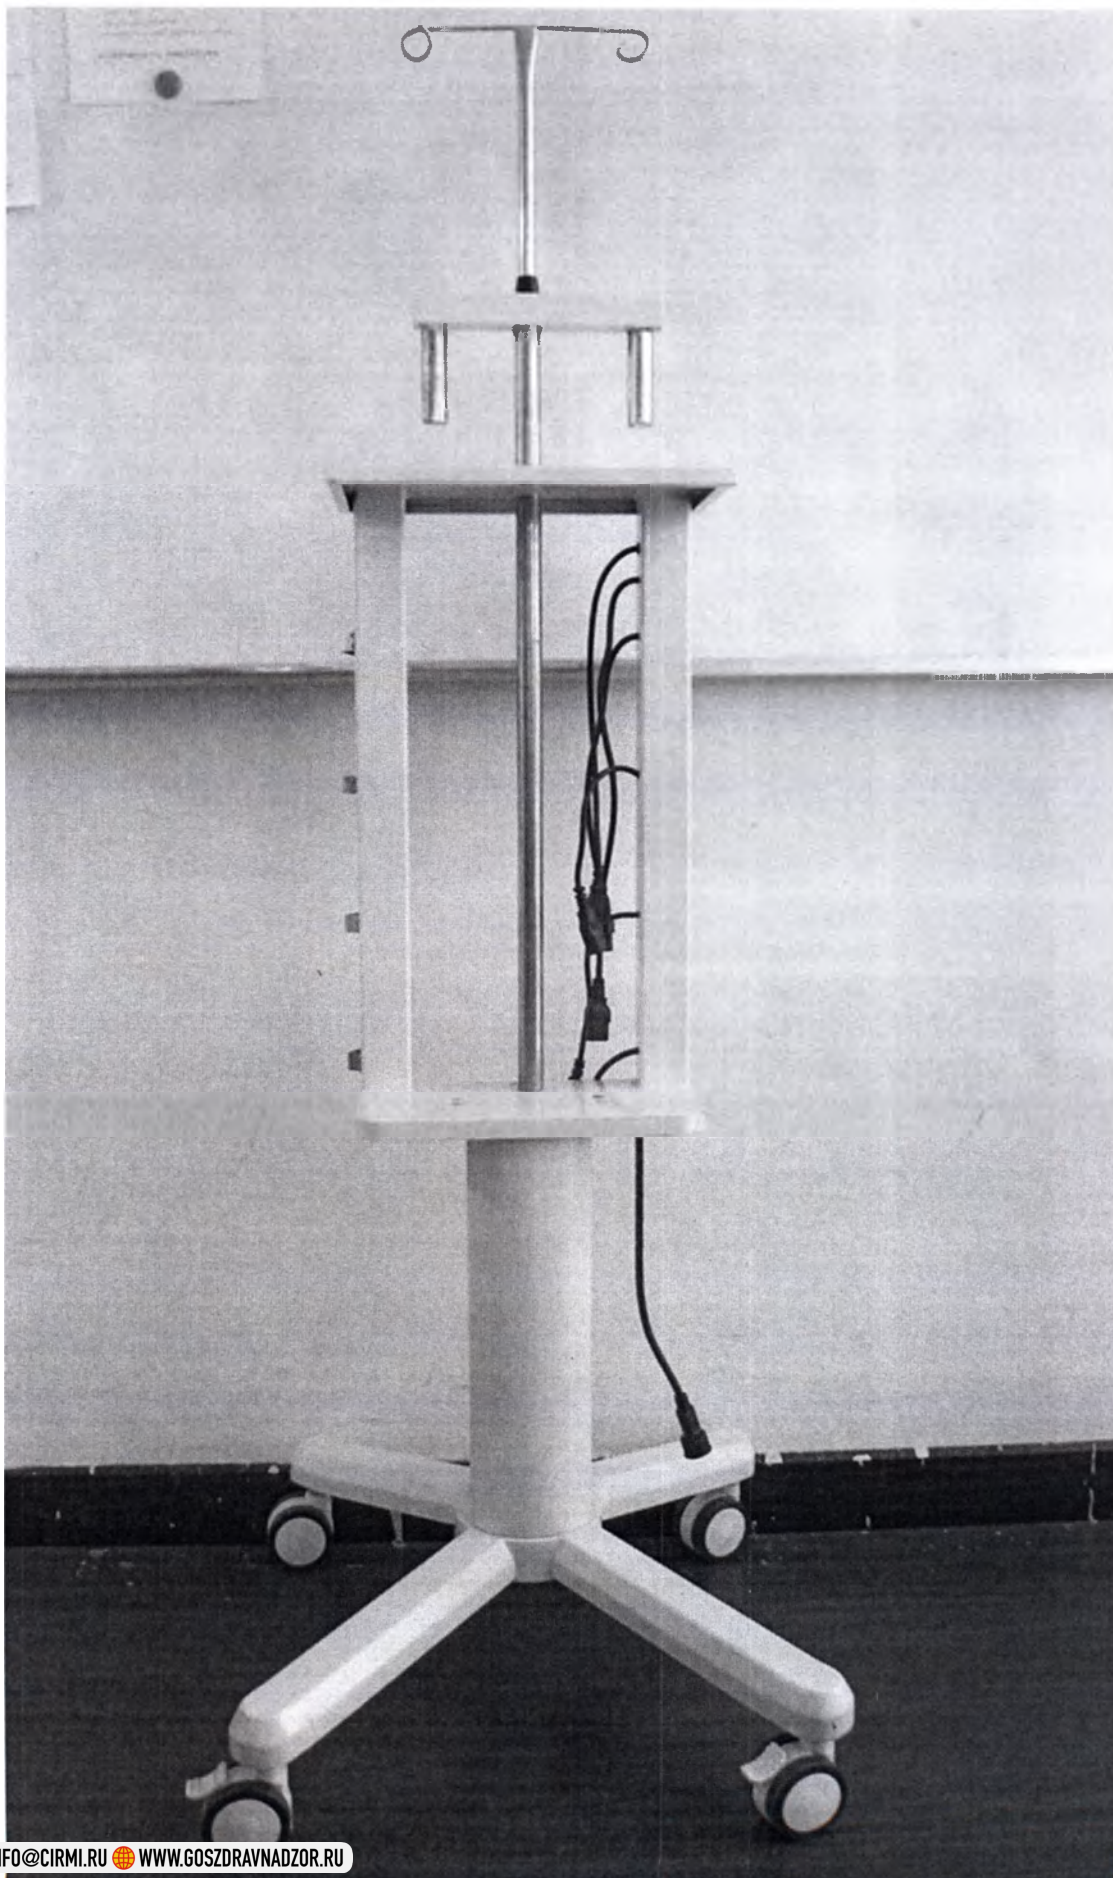



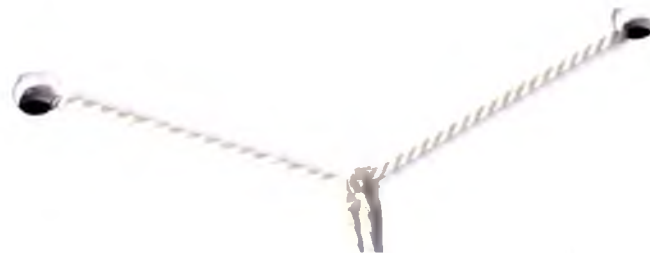

ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО
6 ЛИСТОВ

Генеральный директор
ООО «ДИКСИОН» Яковлев А.А.

