


УТВЕРЖДАЮ

Директор Калужского филиала

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

 Каляцкая Н.В.



« 26 » июля 20 19 г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

**«Система информационная «ЦАМИ. Телерадиологическая информационная система»
по ТУ 58.29.32-001-17514186-2019»**

Система информационная «ЦАМИ. Телерадиологическая информационная система» (скриншот окна загрузки):



Авторизация

Имя

Пароль

Забыли пароль?



50 © 1 Copyright © 2019 by RTC
All Rights Reserved
Версия: 2.0

Система информационная «ЦАМИ. Телерадиологическая информационная система» (скриншот стартового окна с указанной версией ПО и интерфейса - основного меню программы):

Система ЦАМИ ver. 2.0

democamiis-mis.ru/cami/#/dashboard/studies

ЦАМИ kadmin

Главная Список исследований

Исследования

Отчеты

Логи

Телерадиология

Паспорт оборудования

Мониторинг оборудования

СОЗДАТЬ ЗАЯВКУ ОТКРЫТЬ В ТЕЛЕРАДИОЛОГИИ ПОДРОБНЕЕ

Просмотр изображений

ПОСМОТРЕТЬ В RVIMM ПОСМОТРЕТЬ В WEBIS ПОСМОТРЕТЬ В ROMETA ПОСМОТРЕТЬ В VITAL IMAGES 2D ПОСМОТРЕТЬ В VITAL IMAGES 3D

СБРОСИТЬ ФИЛЬТРЫ БЕЗ ФИЛЬТРОВ КТ - ИЗ АРХИВА

Дата исследования	Имя	ID пациента	Дата рождения	Пол	Модальность	Описание	Организация	Источник	Дата сохранения в РА	Серийный номер
25.01.2019	SOROKIN D.E.	trp173482	18.03.1994	M	CT	THORAX THORAXROUTINE (ADULT)	BM64	CMO01	25.01.2019	54251
12.07.2018	SIBGATULLINA GUL'SHAT FARGATOVNA	trp173469	06.05.1958	F	CT	CARDIAC	GKB 7	ConsCenter	12.07.2018	
12.07.2018	TEST	trp173468	01.01.1979	F	MR	HEAD BARSMED STANDART	BARSMED ZELENODOL	ConsCenter	12.07.2018	22322
26.04.2018	PETROF P.P.	trp15	01.12.1996	M	CT		DRKB KAZAN	CMO01	12.07.2018	GCB0652615
25.01.2018	STEPINA L.I.	trp173468	13.08.1948	F	DX	LUCHEZAPYASTNAY 2 PROEKCII	SVATOGOLUKI	BudZdorov	25.01.2018	001652
25.01.2018	MAKAROVA E.N.	trp173468	13.08.1971	F	DX	KIST - 2 PROEKCII	SVATOGOLUKI	BudZdorov	25.01.2018	001652
19.09.2017	USHKOVA E.I.	0137450	07.05.1970	F	MG			ARCHIVE	19.09.2017	24845
18.09.2017	BAKINA A.A. TER 1 26565	2571	10.02.1949	F	MR	HEAD BRAIN R.V.	NMKHTS IM PIROGOVA	ARCHIVE	19.09.2017	45833
15.09.2017		trp173022	20.10.1988	F	DX	CHESTERECT AP	KPTD G. OMSK	BudZdorov	15.09.2017	A4C1-11997
08.09.2017	MUSAKHANYAN R.E.	A0019565	01.10.1971	M	CT	ABD 3 PHASES	KDC ARBATSKIY	ARCHIVE	20.09.2017	*
08.09.2017	SHAKHMURZAEV E.SH.	500-3678	06.06.1977	M	CT	CHEST	KDC ARBATSKIY	ARCHIVE	20.09.2017	*
06.09.2017	NEVSKAYA E.A.	500-1815	16.11.1962	F	CT	CHEST	KDC ARBATSKIY	ARCHIVE	20.09.2017	*
31.08.2017	EGOROVA E.N. 40 TER1 - 24289	1686	01.04.1977	F	CT	THORAX	NMHC PIROGOVA	ARCHIVE	31.08.2017	*
30.08.2017	GREBENNIKOVA	A0009292	06.06.1980	F	CT	HEAD	KDC ARBATSKIY	ARCHIVE	31.08.2017	*
30.08.2017	ROSTOVTSSEV A.V.	500-862	14.08.1956	M	CT	ABD 3 PHASES	KDC ARBATSKIY	ARCHIVE	20.09.2017	*
28.08.2017	KHABIBULLIN R.R.	A0003858	25.03.1965	M	CT	NECK ANGIO	KDC ARBATSKIY	ARCHIVE	20.09.2017	*
24.08.2017	CAJE	PVW4YWUJU	18.11.1937	F	MR	HEAD OWN	REGIONAL HOSPITAL	KBSMP	16.01.2018	35309

1 2 3 40 элементов на странице

Отображены записи 1 - 40 из 106

51.0.0 Copyright © 2019 by RTC. All Rights Reserved. Версия 2.0

Система информационная «ЦАМИ. Телерадиологическая информационная система» (скриншот окна Отчеты):

Система ЦАМИ ver. 2.0

democami.is-mis.ru/cami/#/dashboard/reports

kadmin Выйти

ЦАМИ

Главная | Отчеты

Исследования

Отчеты

Логи

Телерадиология

Паспорт оборудования

Мониторинг оборудования

Тип	Действие
Кол-во исследований за период	HTML XLS
Кол-во дней с момента последнего исследования	HTML XLS
Исследования в разрезе модальности за период	HTML XLS
Исследования в разрезе модальностей детальный	HTML XLS
Проведенные исследования в разрезе ЛПУ, аппарата	HTML XLS

51 0.0 Copyright © 2019 by RTC. All Rights Reserved. Версия: 2.0

Система информационная «ЦАМИ. Телерадиологическая информационная система» (скриншот окна Логи):

Система ЦАМИ ver. 2.0							
democamiis-mis.ru/cami/#/dashboard/logging							
ЦАМИ							
kadmin Build							
Исследования	Главная	Логи					
Отчеты	Дата просмотра исследования	UID исследования	ID пациента	Имя пациента	ID пользователя	Имя пользователя	
Логи	03.09.2019	1 2 840 113704 1 111 2264 1504164915 125	1866	EGOROVA E N 40 TER1 - 24289	29	Контрольный Петр МО	
Телерадиология	01.09.2019	1 2 392 200036 9116 2 6 1 48 1221408767 1501120555 590084	1648930886	DUBOGRAEVAVV	10	Фадеев Иван Васильевич	
Паспорт оборудования	01.09.2019	1 2 392 200036 9116 2 6 1 48 1221408767 1501120555 590084	1648930886	DUBOGRAEVAVV	10	Фадеев Иван Васильевич	
Мониторинг оборудования	01.09.2019	1 3 12 2 1107 5 1 4 78993 30000016011805461459300000052	trp173474	FOMINA VERA IVANOVNA	10	Фадеев Иван Васильевич	
	01.09.2019	1 2 840 113619 2 327 3 2265595235 506 1473827808 123	trp173427	TOMO_TEST	10	Фадеев Иван Васильевич	
	01.09.2019	1 3 12 2 1107 5 99 1 22241 30000017022106310835900000100	6803945229	BESSONOV OLEG VASILEVICH 552 NIK	10	Фадеев Иван Васильевич	
	01.09.2019	1 2 840 113619 2 16 1 1004 1315222560 2 2280	0350420836	LCA-STENOSIS DEMO	10	Фадеев Иван Васильевич	
	01.09.2019	1 2 392 200036 9116 2 6 1 48 1221399501 1322014509 565699	9297068400	CT-VERTEBRO-TUMOR	10	Фадеев Иван Васильевич	
	01.09.2019	1 2 276 0 7230010 3 1 2 313262648 35 1502780549 75847	1159	KARLOV IAN	10	Фадеев Иван Васильевич	
	01.09.2019	1 2 276 0 7230010 3 1 2 313262648 35 1502529876 901743	1208	AYDAROVA FA	10	Фадеев Иван Васильевич	
	01.09.2019	1 3 12 2 1107 5 6 1 69063 30000017020905210979600000067	14038766	ZARTDINOVA ELENA	10	Фадеев Иван Васильевич	
	01.09.2019	1 2 392 200036 9116 4 1 5985 45804	hc_patient_23	GARAeva R.G.	10	Фадеев Иван Васильевич	
	01.09.2019	2 16 840 1 113669 632 25 1 24845 20170919170716 1	0137450	USHKOVA E I	10	Фадеев Иван Васильевич	
	01.09.2019	1 2 392 200036 9107 307 11997 111199717091503733	trp173022	BELEN'KAYA A. SOOT	10	Фадеев Иван Васильевич	
	01.09.2019	1 2 826 0 1 3680043 2 634 30 1 77538 20170210094118	URI-SRV1_ID56	КАРИМОВА ГУЛИЯ ИЛЬЯСОВНА	10	Фадеев Иван Васильевич	
	01.09.2019	1 2 826 0 1 3680043 2 634 30 1 77552 20170210113614	URI-SRV1_ID56	ХАБИБУЛЛИНА ЛЕЙСАН ИЛЬДАРОВНА	10	Фадеев Иван Васильевич	
	01.09.2019	1 2 826 0 1 3680043 8 537 2 6 194917760	194917760	NURULLINA ELMIRA ALMAZOVNA	10	Фадеев Иван Васильевич	
	01.09.2019	1 3 12 2 1107 5 1 4 78652 30000017011203512454600000037	6654310895	ZHURAVLEVA	10	Фадеев Иван Васильевич	
	01.09.2019	1 2 826 0 1 3680043 2 634 30 1 63051 20170404115012	trp173469	ШИШКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА	10	Фадеев Иван Васильевич	
	01.09.2019	1 3 46 670589 30 1 3 1 206915885271608 1486566144625 1	20170208-01-0058	VEREMEENKO O.YU.	10	Фадеев Иван Васильевич	
	01.09.2019	1 3 46 670589 30 1 3 1 206915885271608 1484135723640 1	hc_patient_	ESHTOKINA E I	10	Фадеев Иван Васильевич	
	01.09.2019	1 3 46 670589 30 1 3 1 206915885271608 1484135723640 1	hc_patient_	ESHTOKINA E I	10	Фадеев Иван Васильевич	
	01.09.2019	1 2 826 0 1 3680043 2 634 30 1 77538 20170210094118	URI-SRV1_ID56	КАРИМОВА ГУЛИЯ ИЛЬЯСОВНА	10	Фадеев Иван Васильевич	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 элементов на странице							
510.0 Copyright © 2019 by RTC. All Rights Reserved. Версия 2.0							
Отображены записи 1 - 40 из 2238							

Система информационная «ЦАМИ. Телерадиологическая информационная система» (скриншот окна подсистемы организации телерадиологических консультаций):

Система ЦАМИ ver. 2.0

Расписание

democami-is-mis.ru/teleradiology/timetable/timetable/index

Контрольная МО

Контрольный Петр МО

Управление пользователями

Роли и группы

Интеграция

Загрузка снимков

Импорт исследований

Снимки исследований

Логирование данных

Справочники

Структура клиники

Настройки клиники

Список организаций

Прайс

Пациенты

Услуги

Записи услуг

Ресурсы

Расписание

Шаблоны протоколов

Настройка печатных форм

Договоры

Профили договоров

Программы прикрепления

Калькулятор стоимости услуг

Счета

MPT-1 по Модернизации

Вторник, 3 Сен

07:00

07:10

08:00

08:10

09:00

09:10

10:00

10:10

11:00

11:10

12:00

12:10

13:00

13:10

14:00

14:10

15:00

15:10

16:00

16:10

17:00

17:10

18:00

18:10

19:00

19:10

20:00

20:10

21:00

21:10

22:00

22:10

23:00

23:10

24:00

24:10

Siemens Somatom

Вторник, 3 Сен

07:00

07:10

08:00

08:10

09:00

09:10

10:00

10:10

11:00

11:10

12:00

12:10

13:00

13:10

14:00

14:10

15:00

15:10

16:00

16:10

17:00

17:10

18:00

18:10

19:00

19:10

20:00

20:10

21:00

21:10

22:00

22:10

23:00

23:10

24:00

24:10

Рентген цифровой №1

Вторник, 3 Сен

07:00

07:10

08:00

08:10

09:00

09:10

10:00

10:10

11:00

11:10

12:00

12:10

13:00

13:10

14:00

14:10

15:00

15:10

16:00

16:10

17:00

17:10

18:00

18:10

19:00

19:10

20:00

20:10

21:00

21:10

22:00

22:10

23:00

23:10

24:00

24:10

Дата расписания

03.09.2019

Сбросить фильтры

Филиал

Выберите значение

Специализация

Медицинские специальности

Отделение

Модальность оборудования

Выберите значение

Услуга

Начните ввод

Ресурс

Фильтр ресурсов

☒ Siemens Somatom

☐ Диагност-Петров

☐ Консультация Монгуш

☐ Лаборант-Радиолог Иванов Петр Иванович

☒ MPT-1 по Модернизации

☐ Новый КТ

☒ Рентген цифровой №1

☐ Рентгенография, Донгак

☐ кабинет рентген

☐ консультант Донгак

☐ рентген

Легенда

БОРУДОВАНИЕ

DC_AUMIN (Вывод)

Оборудование	Добавить	Просмотр	Удалить							
Модели	Производитель	Тип	Модель	Модальность	Наименование	Организация	AET	AET шлюза	Worklist AET	Серийный номер
Справочники	Dcm4chee	ПАКС	DICOM-шлюз		DICOM-шлюз ООО "БарсМед"	ООО "БарсМед"	BARSMED			
Пользователи	Siemens	Диагностическое	Avanto 1.5T	MR	MPT-3	ООО "БарсМед"		BARSMED		23641
Роли	Siemens	Диагностическое	Avanto 1.5T	MR	MPT-Siemens 1.5T	ООО "БарсМед"		BARSMED		23486
	Siemens	Диагностическое	Avanto 1.5T	MR	MPT-Avanto 1.5T	ООО "БарсМед"		BARSMED		163031
	Dcm4chee	ПАКС	Центральный PACS		DICOM-шлюз Альметьевской ЦРБ	ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	DCM_ACRB			
	General Electric	Диагностическое	BrightSpeed Elite 16	CT	PKT-1	ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	aw01	DCM_ACRB		
	Dcm4chee	ПАКС	Центральный PACS		DICOM-шлюз Арской ЦРБ	ГАУЗ "Арская центральная районная больница"	DCM_GATE_ARCRB			
	Toshiba	Диагностическое	Aquilion 64	CT	PKT-1	ГАУЗ "Арская центральная районная больница"	TOSCT_ARCRB	DCM_GATE_ARCRB		GCD0893340
	Dcm4chee	ПАКС	Центральный PACS		DICOM-шлюз Бугульминской ЦРБ	ГАУЗ "Бугульминская центральная районная больница"	DCM_BUGCRB			
	Toshiba	Диагностическое	Aquilion 16	CT	PKT-1	ГАУЗ "Бугульминская центральная районная больница"	TM_CT_CMW_V3.00	DCM_BUGCRB		GME1073648
	Dcm4chee	ПАКС	Центральный PACS		DICOM-шлюз Буинской ЦРБ	ГАУЗ "Буинская центральная районная больница"	DCM_GATE_BUACRB			
	Toshiba	Диагностическое	Aquilion 16	CT	PKT-1	ГАУЗ "Буинская центральная районная больница"	TOSCT_BUACRB	DCM_GATE_BUACRB		GCD08X3351
	Toshiba	Диагностическое	Alexion 16	CT	PKT-1	ГАУЗ "Городская больница №2", г. Набережные Челны				
	Dcm4chee	ПАКС	Центральный PACS		PACS	ГАУЗ "Городская больница №5" г. Набережные Челны	DCM_CHELS			
	Philips	Диагностическое	Brilliance CT 6 slice	CT	PKT-1	ГАУЗ "Городская больница №5" г. Набережные Челны	PC2	DCM_CHELS		
	Dcm4chee	ПАКС	DICOM-шлюз		DICOM-шлюз ГКБ-7	ГАУЗ "Городская клиническая больница №7" г. Казани	DCM_GKB7			10.14.69.99
	Philips	Диагностическое	Allura Xper FD 20	XA	Ангио 10 этаж Allura Xper	ГАУЗ "Городская клиническая больница №7" г. Казани	SEND_SCU	DCM_GKB7		722012-1517
	Philips	Диагностическое	Brilliance CT64 slice	CT	КТ 1 этаж Brilliance 64	ГАУЗ "Городская клиническая больница №7" г. Казани	MXV	DCM_GKB7		
	Philips	Диагностическое	Brilliance CT64 slice	CT	КТ 2 этаж eCT	ГАУЗ "Городская клиническая больница №7" г. Казани	MXV2	DCM_GKB7		
	Philips	Диагностическое	Achieva 1.5T	MR	MPT 2 этаж Achieva	ГАУЗ "Городская клиническая больница №7" г. Казани	PHILIPSMRI	DCM_GKB7		33306

МОНИТОРИНГ

ПАРК ОБОРУДОВАНИЯ - РЕГИОН

МОНИТОРИНГ ЗАГРУЗКИ - РЕГИОН

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ КВОТ

МОНИТОРИНГ ЗАГРУЗКИ - АППАРАТ

МОНИТОРИНГ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ





КОНТРОЛЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

ОТЧЕТЫ

Парк диагностического оборудования



ВОЗРАСТ ОБОРУДОВАНИЯ

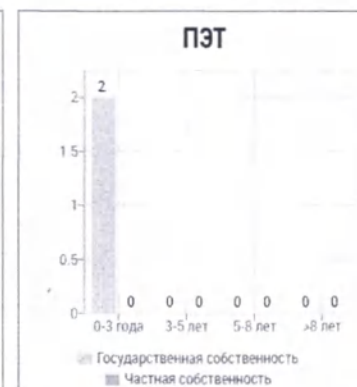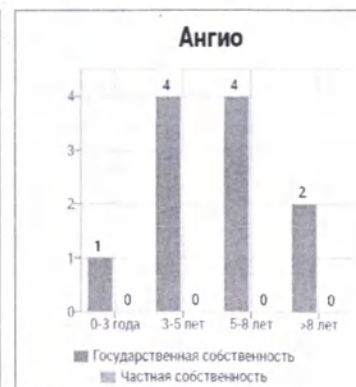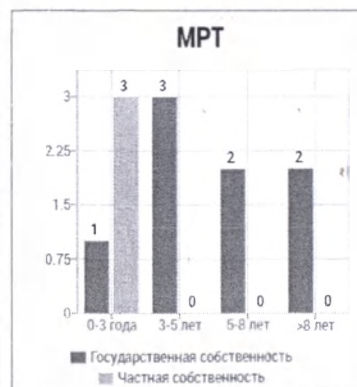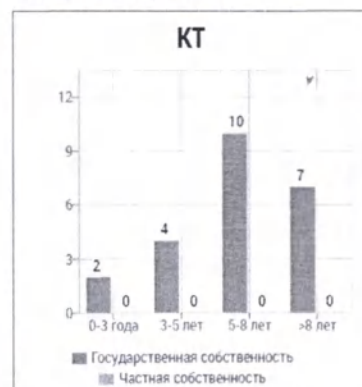

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 8 (восемь)

листо

Директор Калужского филиала
ПАО «Ростелеком»

 Н.В. Каляцкая

