


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»
Носова Т.А.


2019 г.




Фотографические изображения изделия:

Набор калибраторов для количественного определения лютеинизирующего гормона (Luteinizing Hormone (LH CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd («Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд. »), Китай



Общий вид медицинского изделия (Набор калибраторов для количественного определения лютеинизирующего гормона (Luteinizing Hormone (LH CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro)), в варианте исполнения LH211

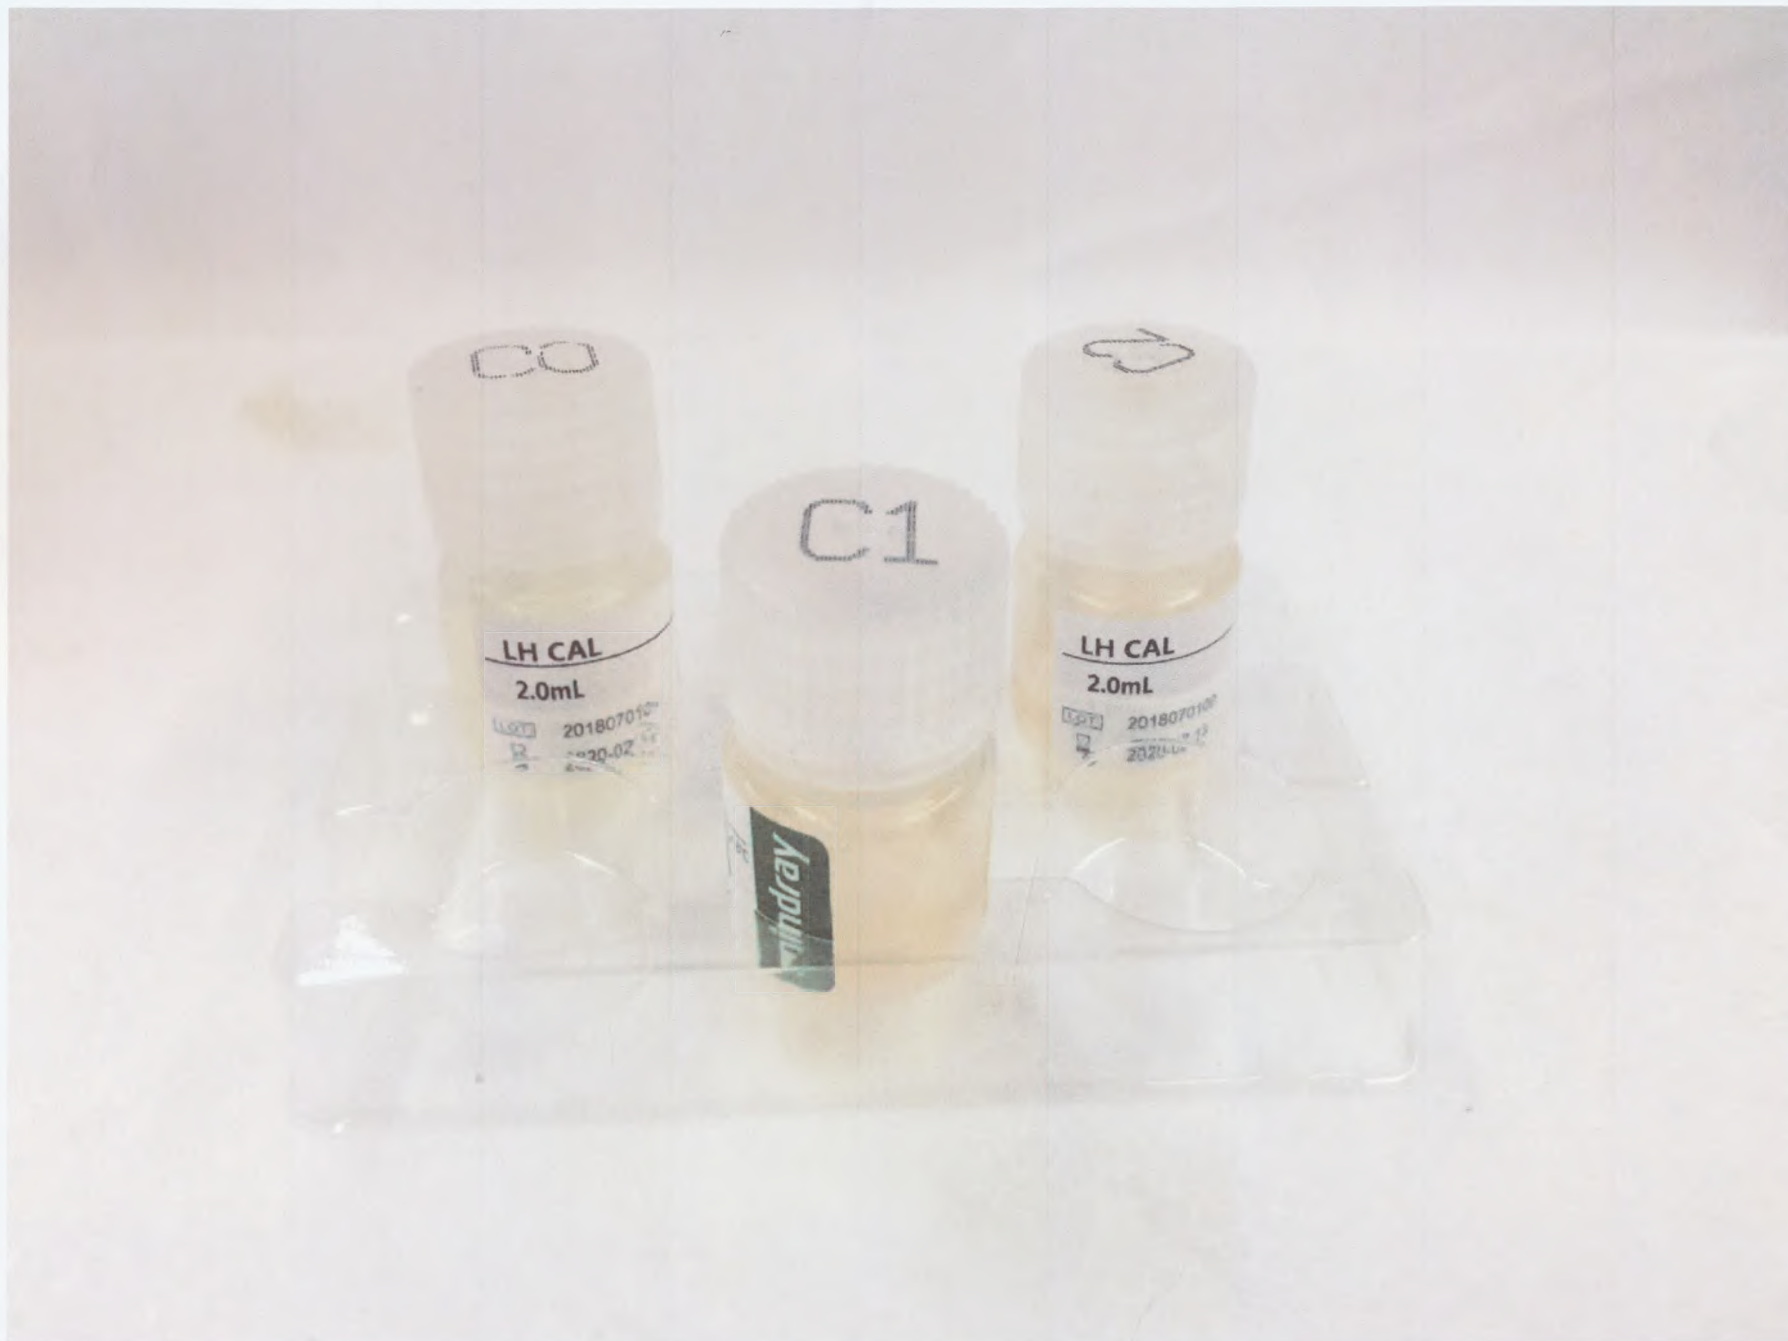

Фотографическое изображение флаконов

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 3 листа (-ов)

Генеральный Директор Носова / Носова Т.А.
М.П.

