

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ТАГЛЕР»



А.Н. Ляпин
2019 г.

**Фотографии
медицинского изделия**


**Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская
по ТУ 28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями**



Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ 28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями ПЛАЗМА-КОМПАКТ: Общий вид центрифуги



Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ 28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями ПЛАЗМА-КОМПАКТ: Панель управления

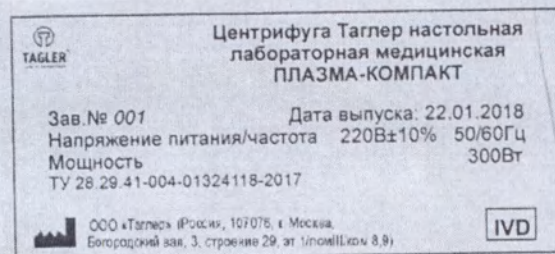

Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ 28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями ПЛАЗМА-КОМПАКТ: Маркировка



Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ 28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями ПЛАЗМА-КОМПАКТ: Сетевой шнур



Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ 28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями ПЛАЗМА-КОМПАКТ: Блок питания



Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ 28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями CM-12: Общий вид центрифуги



Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ 28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями CM-12: Панель управления



Центрифуга Таглер настольная
лабораторная медицинская
СМ-12

Зав. № 001

Дата выпуска: 22.01.2018

Напряжение питания/частота 220В±10% 50/60Гц

Мощность 250Вт


ТУ 28.29.41-004-01324118-2017




ООО «Таглер» (Россия, 107076, г. Москва,
Богородский вал, 3, строение 29, эт 1/помIII/ком 8,9)

IVD


Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ 28.29.41-004-01324118-2017 с
принадлежностями СМ-12: Маркировка

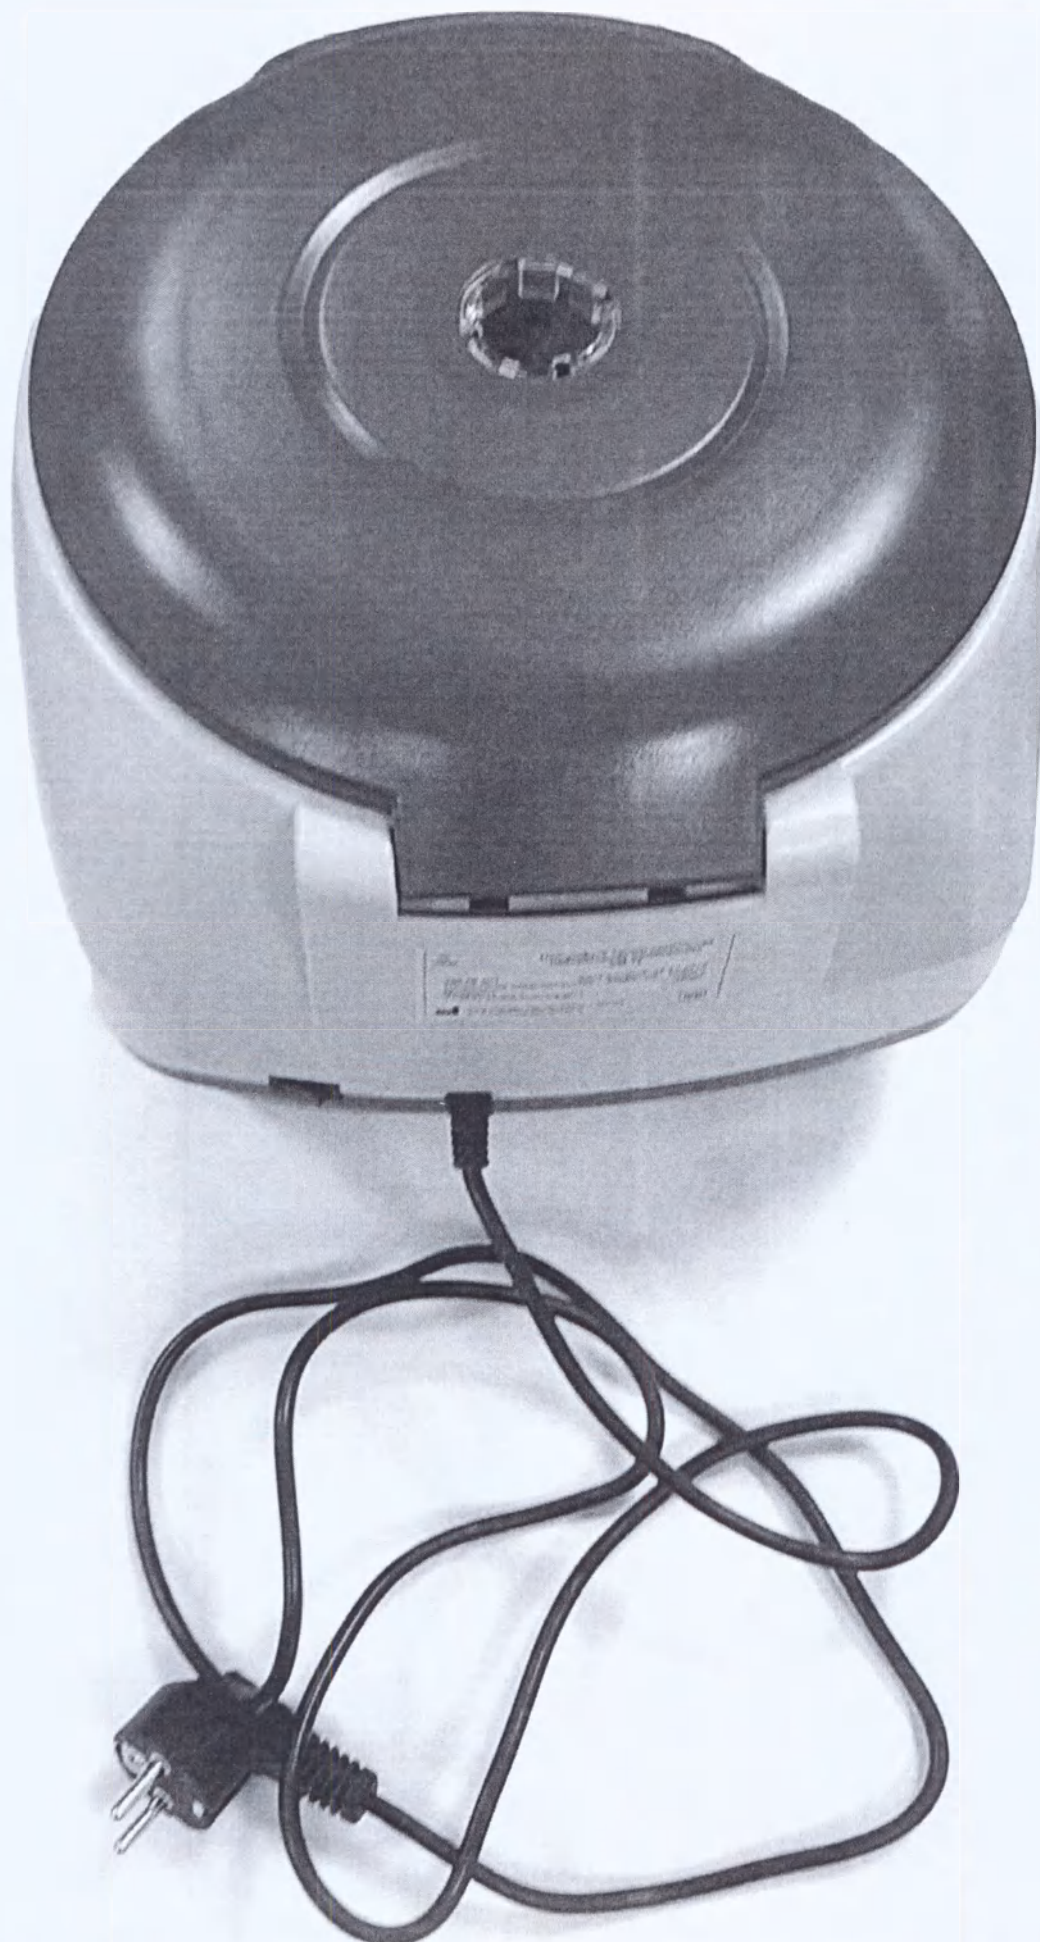


Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ 28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями СМ-12: Встроенный сетевой шнур

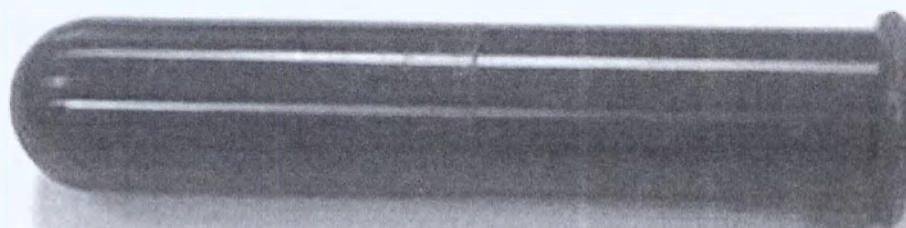

Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ 28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями СМ-12: Адаптер под пробирку

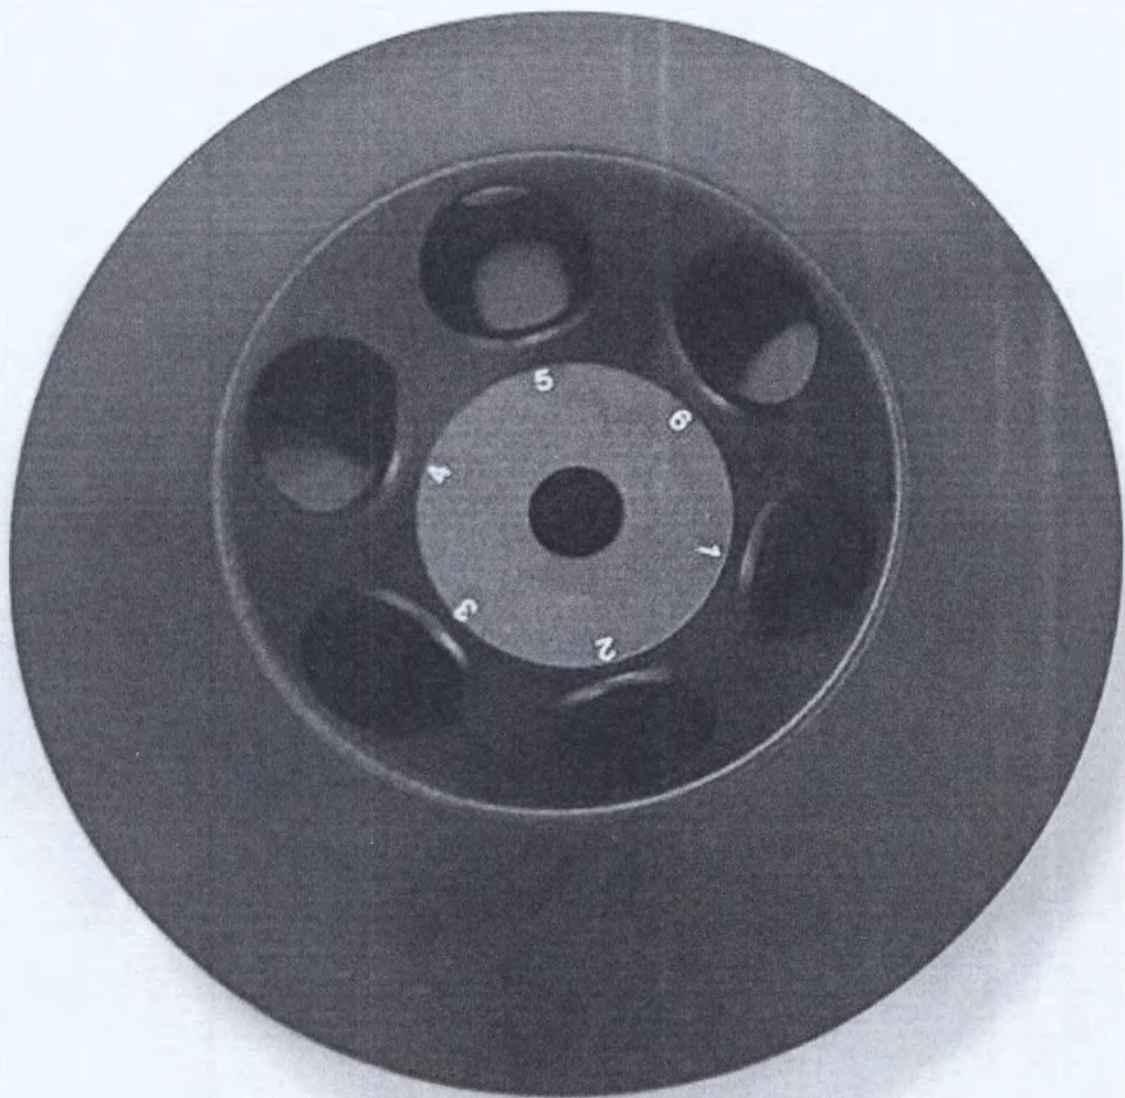


Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ 28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями СМ-12: Сменный ротор РУ-06

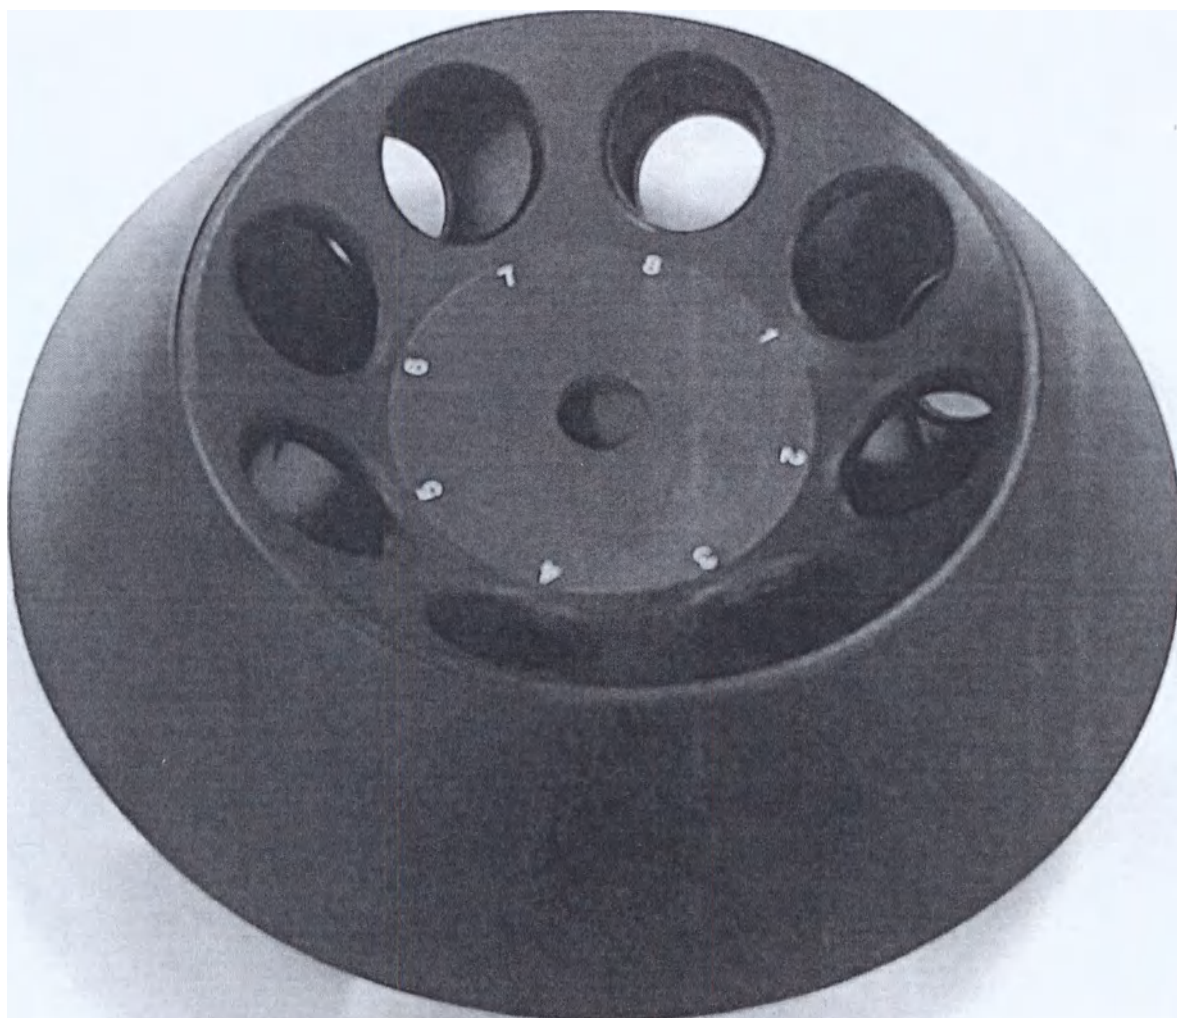


Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ 28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями СМ-12: Сменный ротор РУ-08



Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ 28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями CM-12M: Общий вид центрифуги

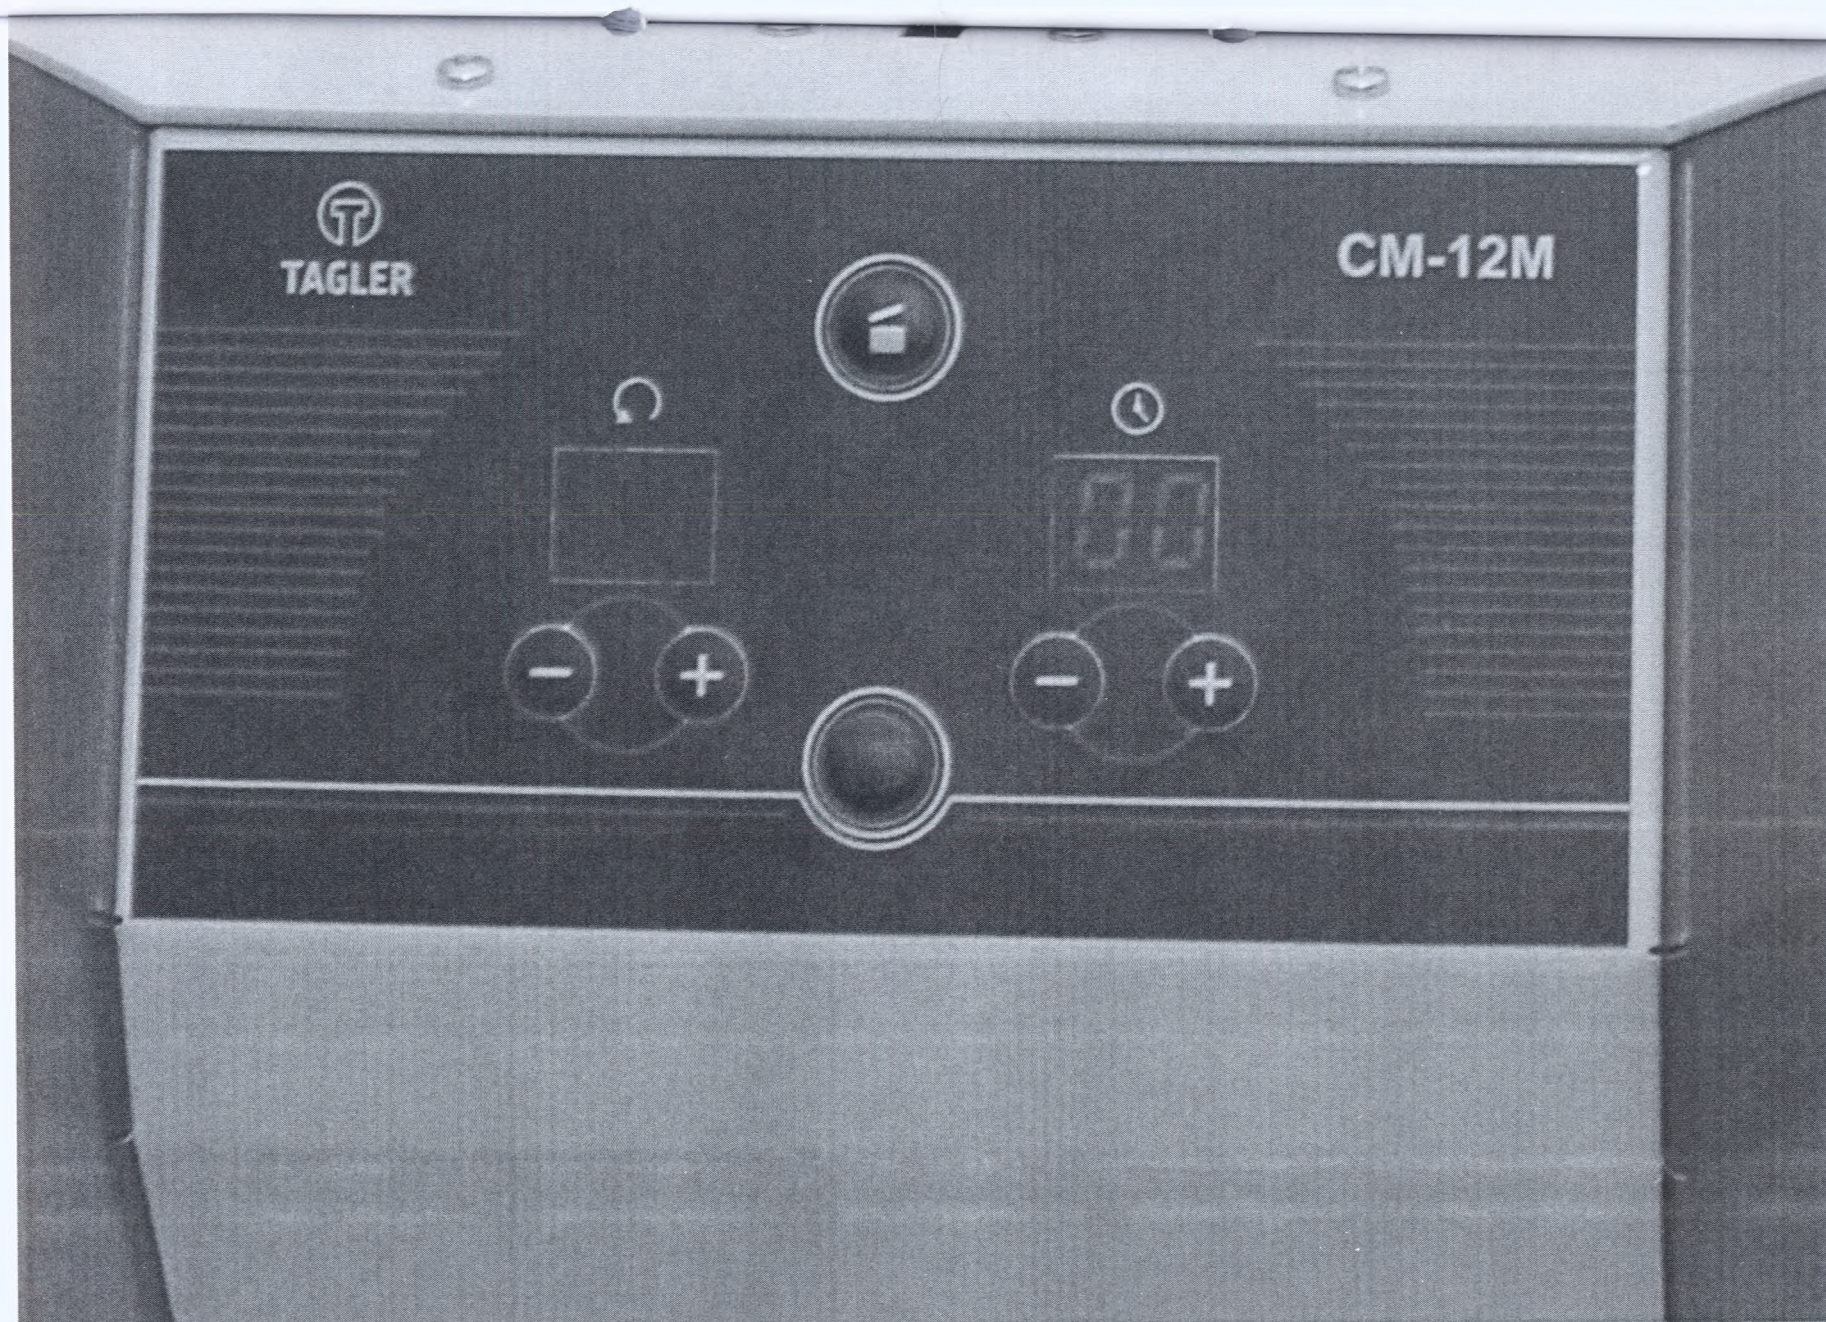

Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ 28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями CM-12M: Панель управления

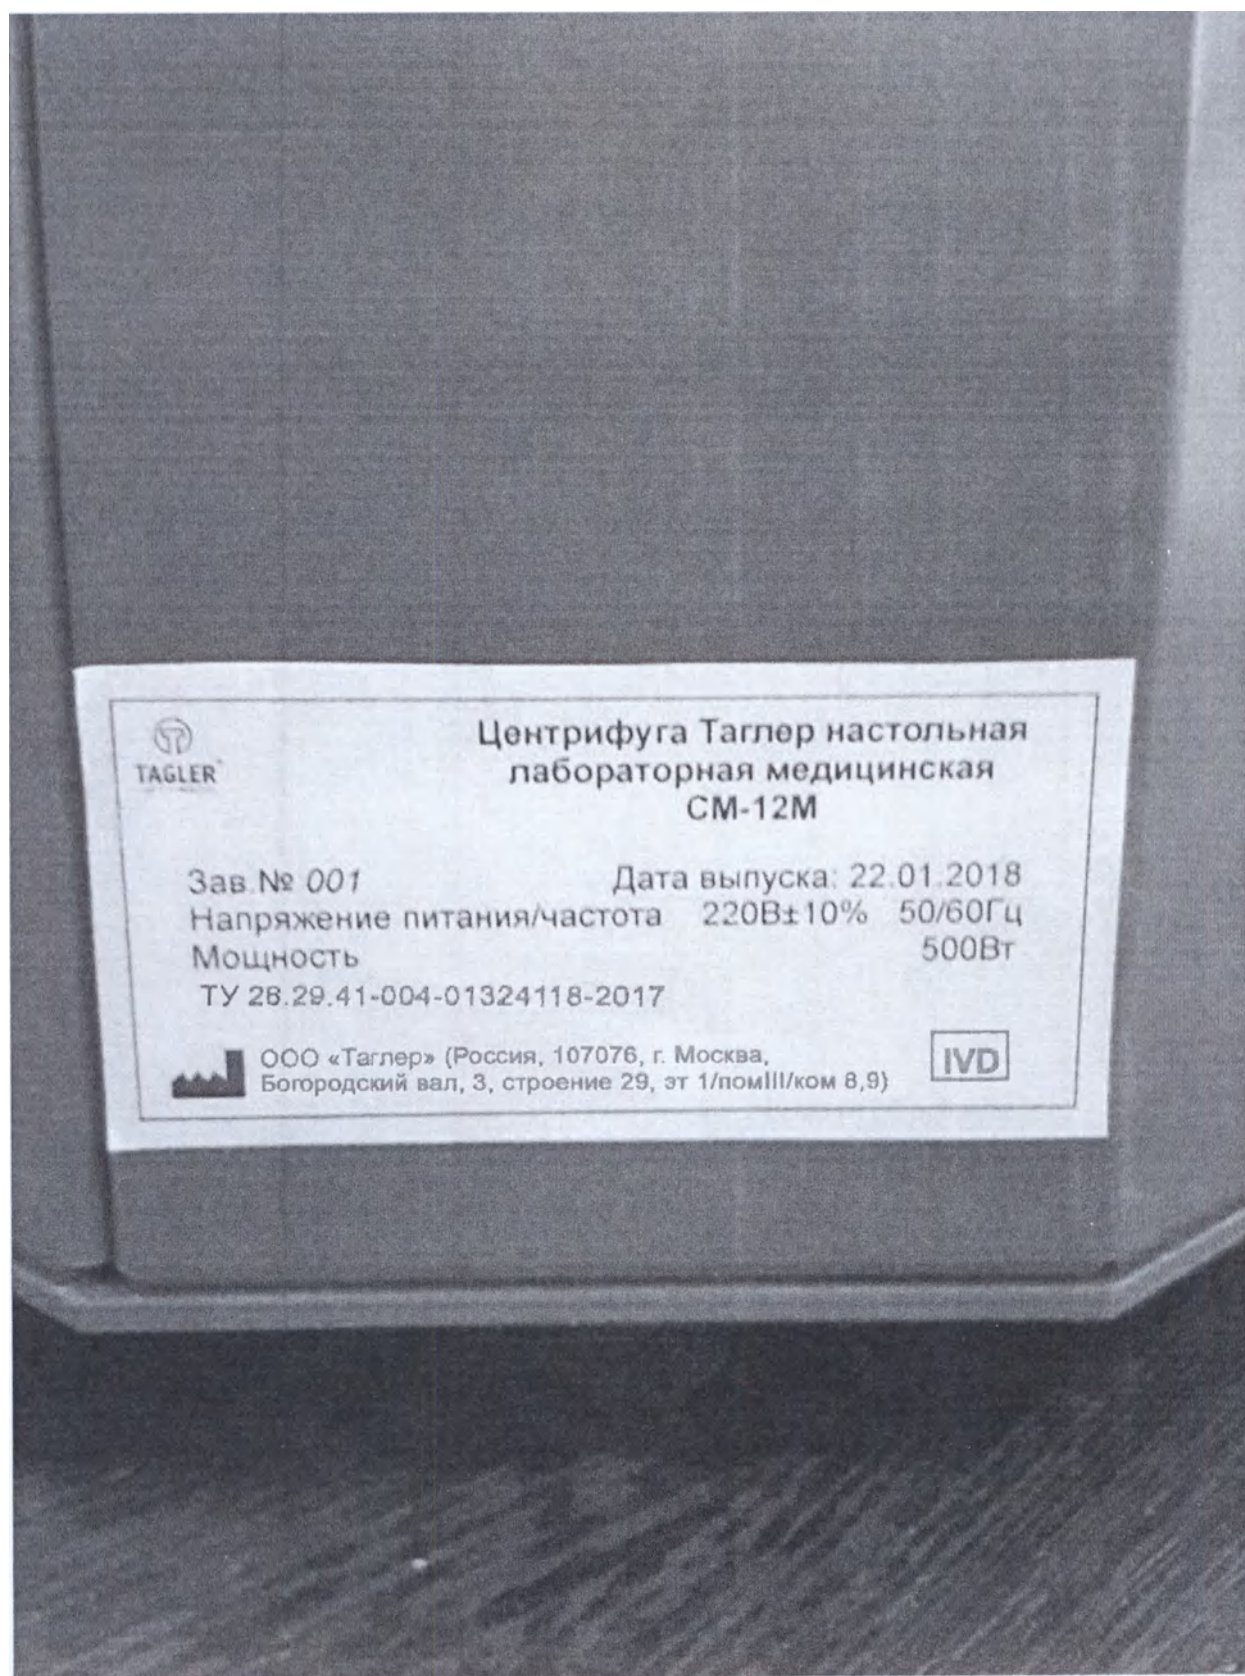

Центрифуга Таглер настольная
лабораторная медицинская
СМ-12М

Зав. № 001

Дата выпуска: 22.01.2018

Напряжение питания/частота 220В±10% 50/60Гц

Мощность 500Вт


ТУ 28.29.41-004-01324118-2017




ООО «Таглер» (Россия, 107076, г. Москва,
Богородский вал, 3, строение 29, эт 1/помIII/ком 8,9)




Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ 28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями СМ-12М: Маркировка

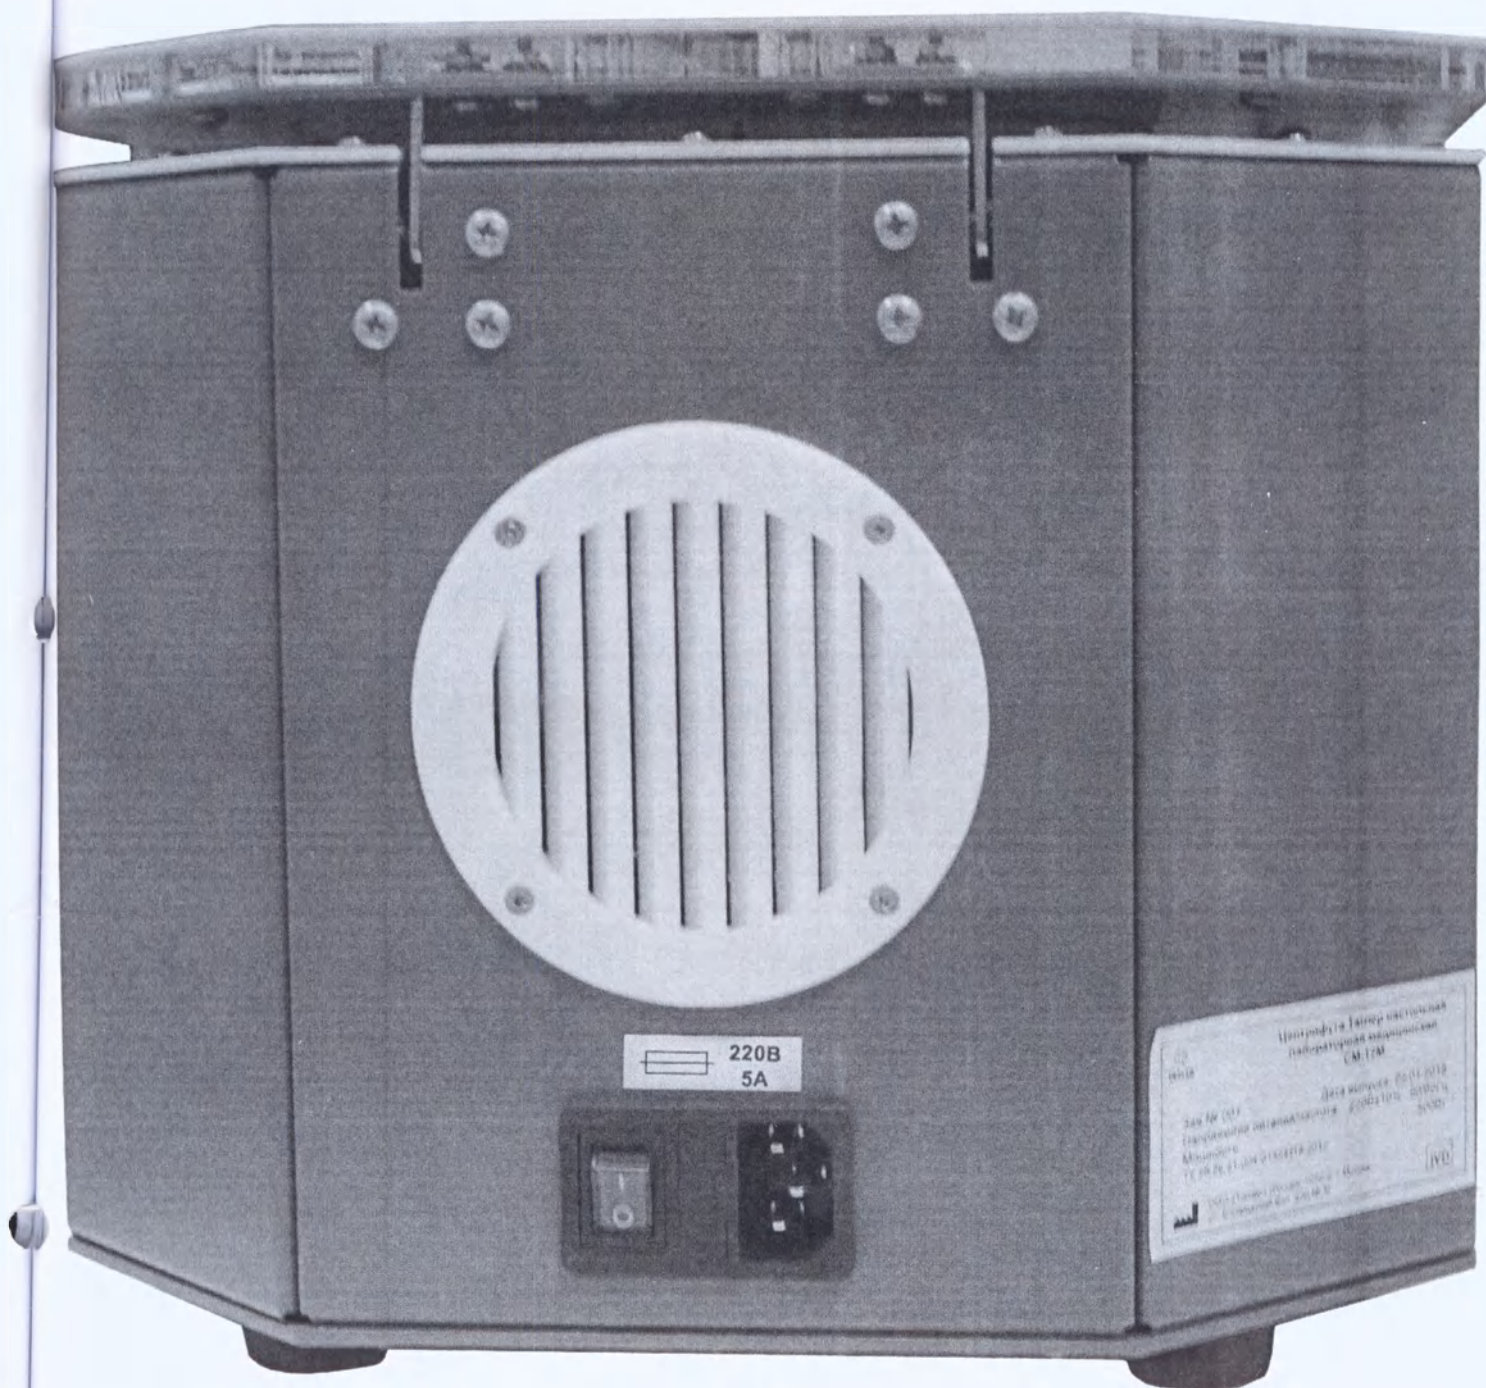


Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ 28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями CM-12M: Маркировка

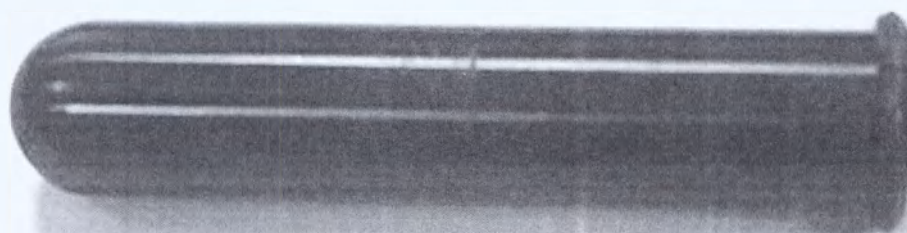

Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ 28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями СМ-12М: Адаптер под пробирку

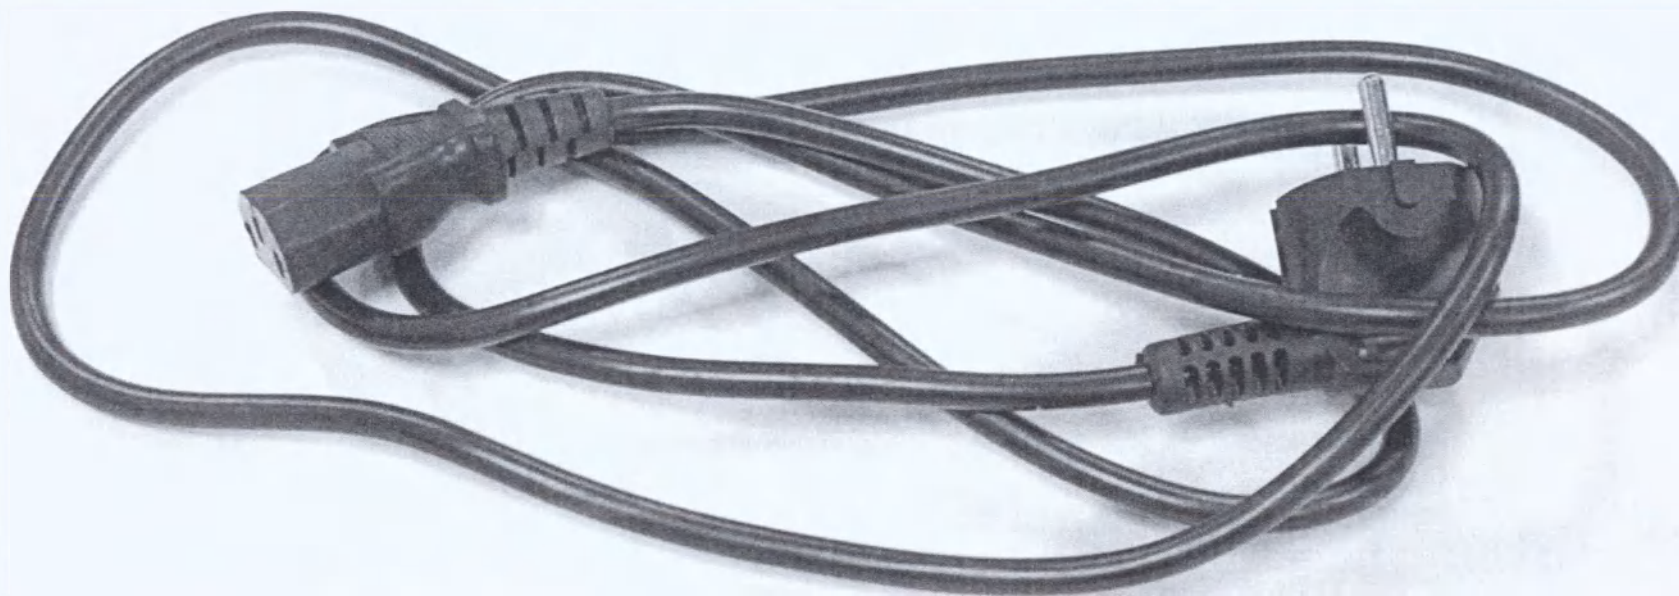

Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ 28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями СМ-12М: Сетевой шнур

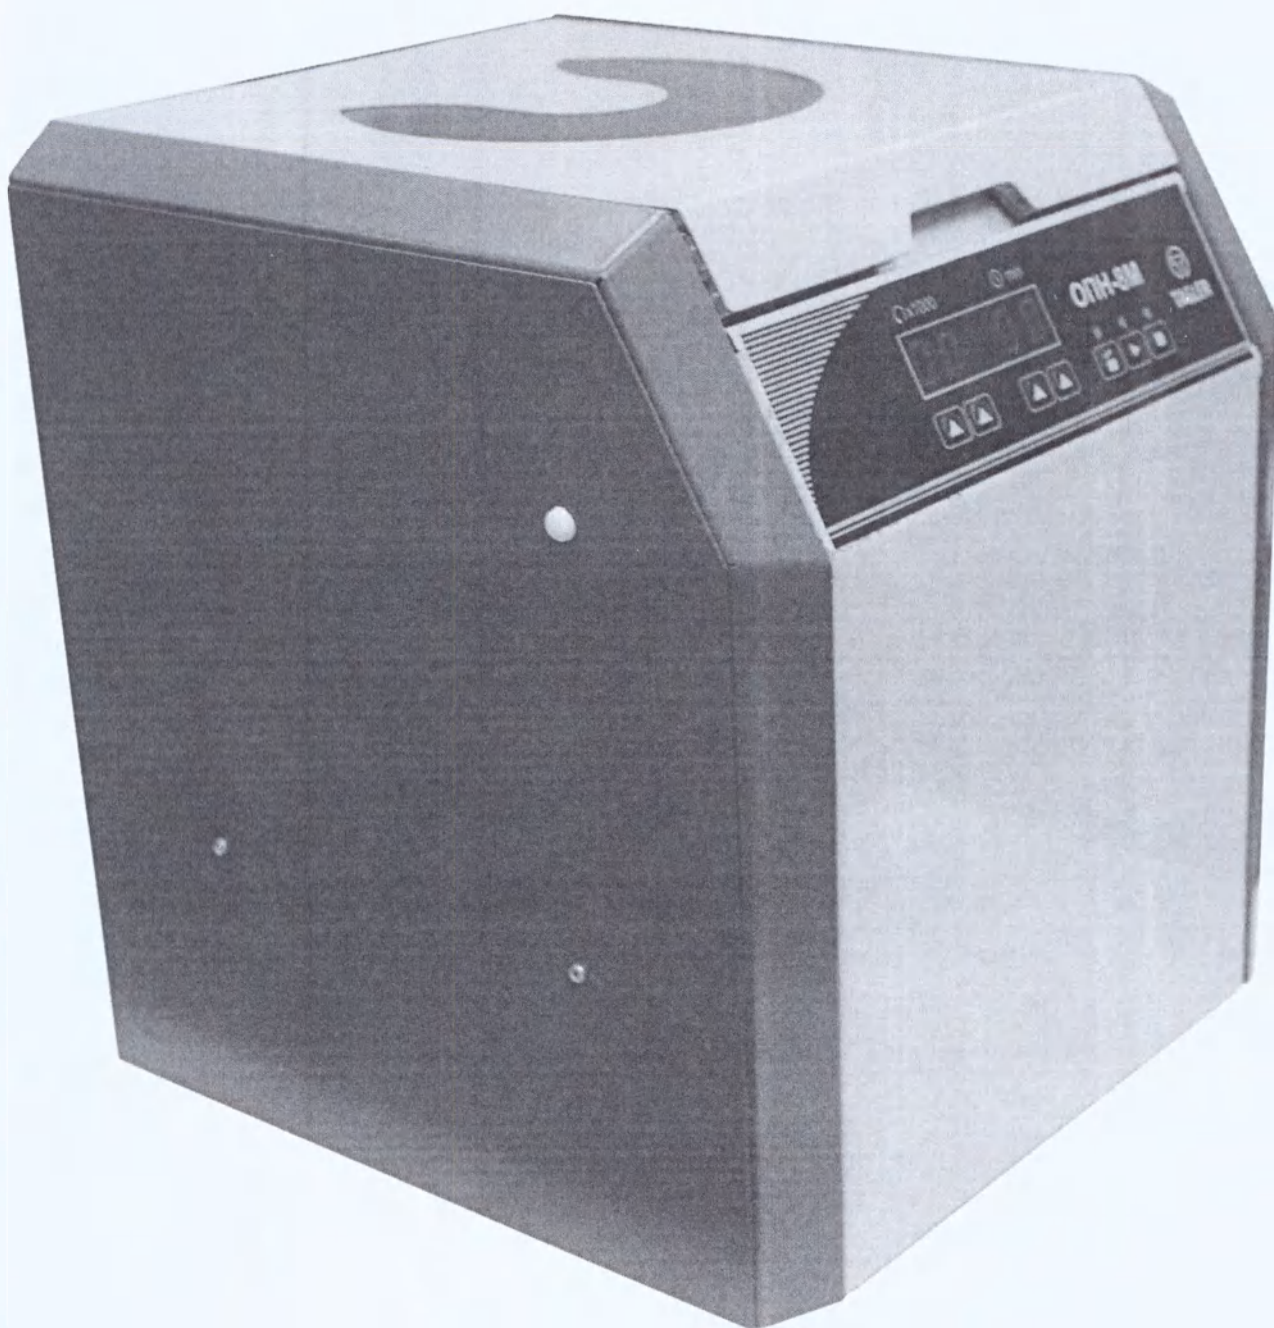

Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ 28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями ОПН-8М: Общий вид центрифуги



Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ 28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями ОПН-8М:
Панель управления



Центрифуга Таглер настольная
лабораторная медицинская
ОПН-8М

Зав.№ 001

Дата выпуска: 22.01.2018

Напряжение питания/частота 220В±10% 50/60Гц

Мощность

350Вт

ТУ 28.29.41-004-01324118-2017



ООО «Таглер» (Россия, 107076, г. Москва,
Богородский вал, 3, строение 29, эт 1/помIII/ком 8,9)


IVD



Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ 28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями ОПН-8М: Маркировка




Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ 28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями ОПН-8М: Маркировка

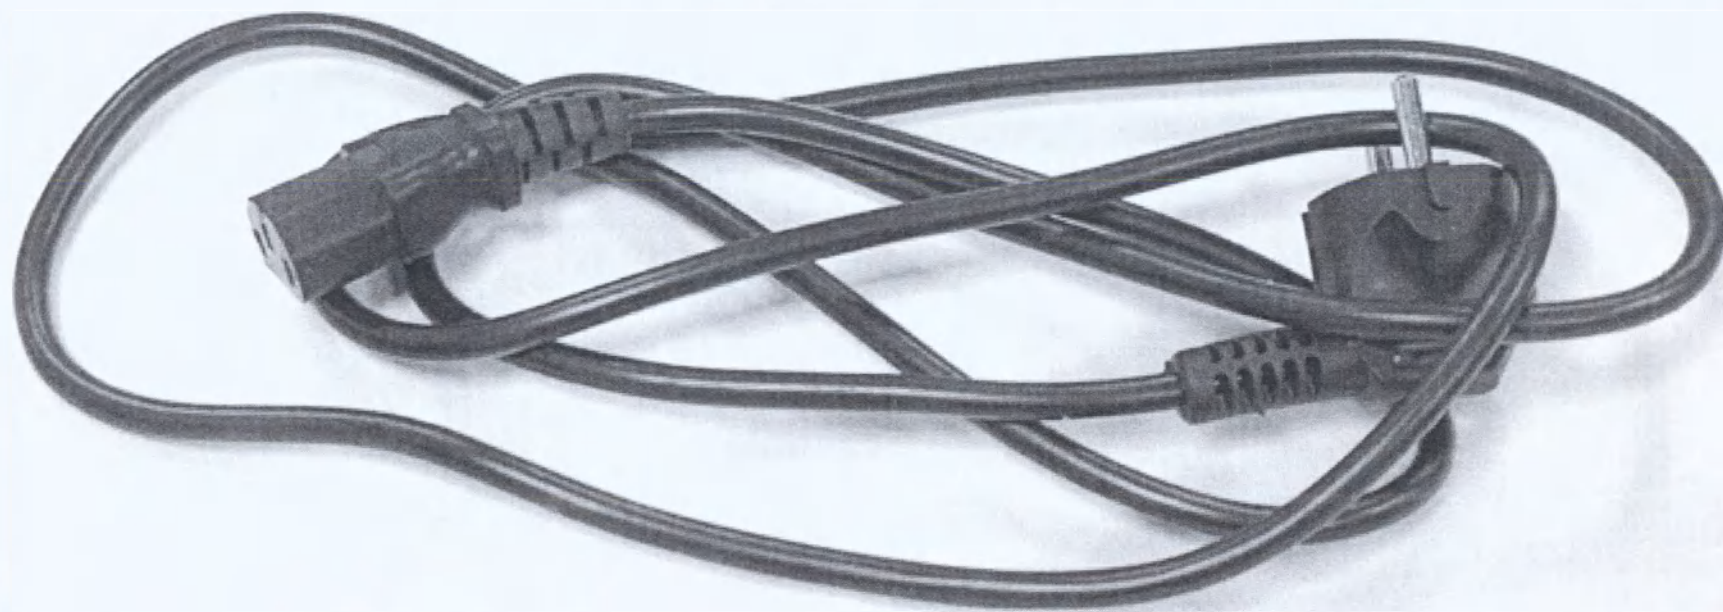


Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ 28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями ОПН-8М: Сетевой шнур



Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ 28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями ОПН-8М: Запасной предохранитель

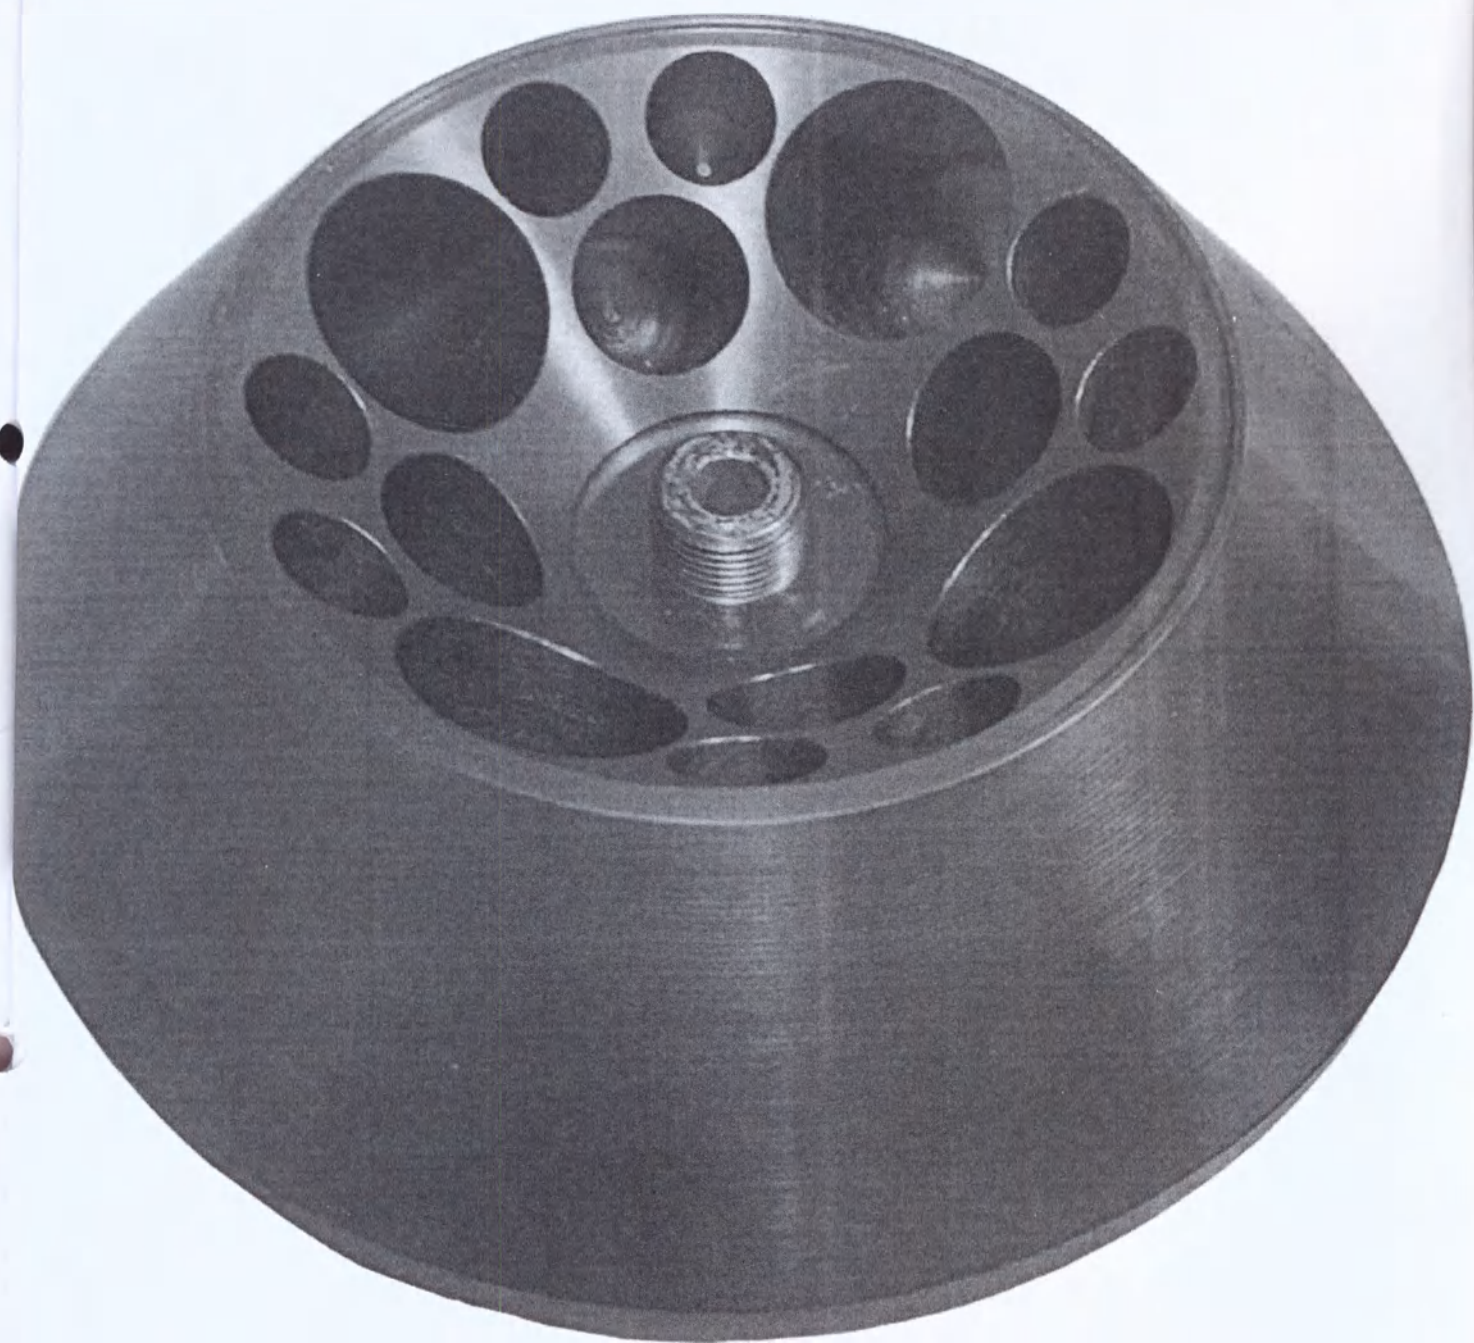

Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ 28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями ОПН-8М: Сменный ротор РУ-180Л

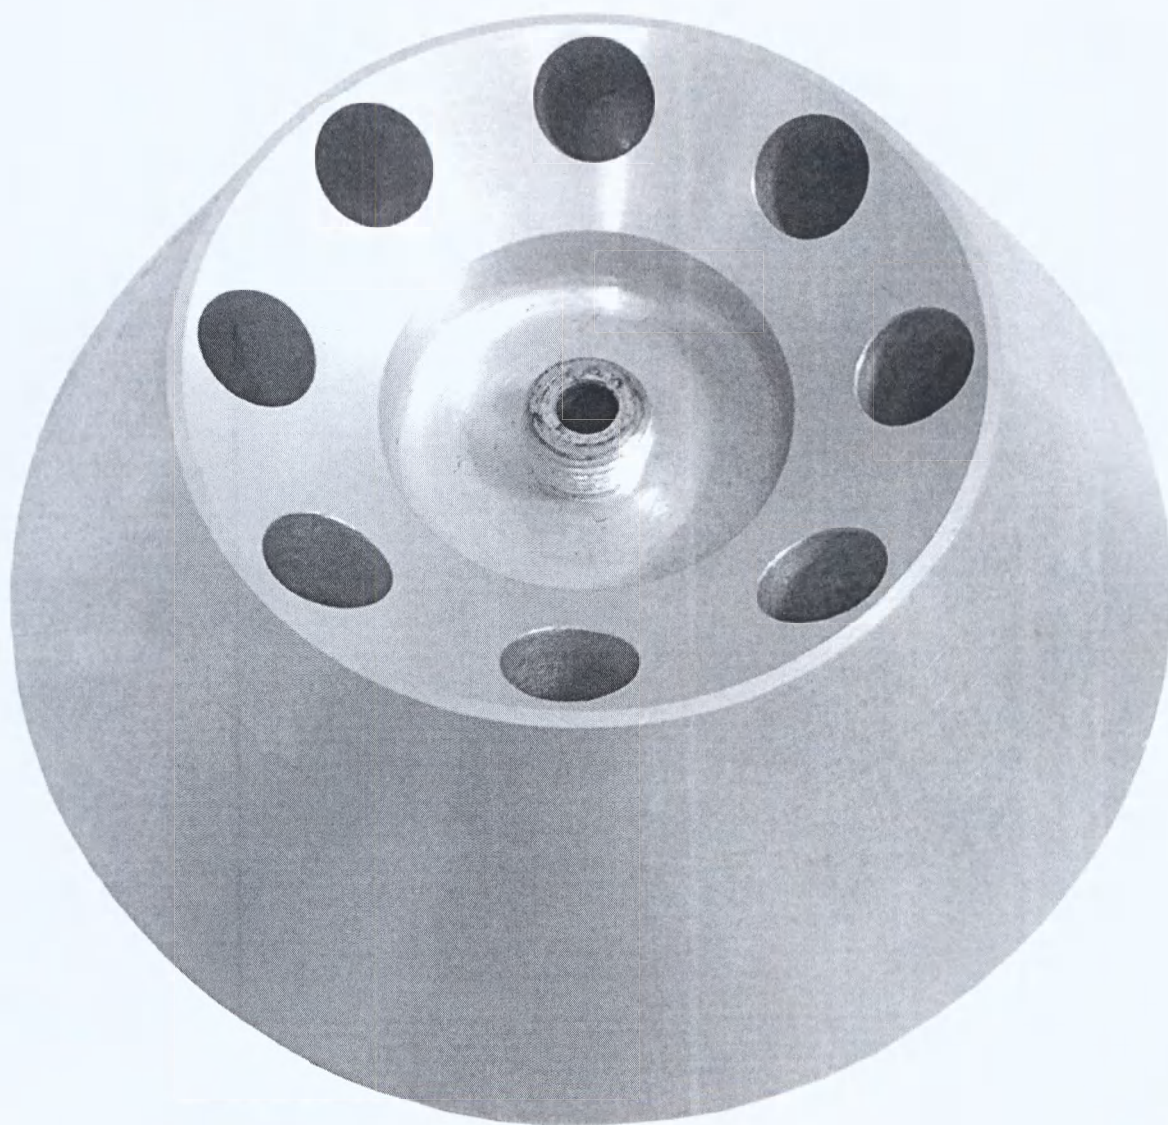

Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ 28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями ОПН-8М: Сменный ротор РУ 8х10

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 27 листа(ов).

Должность, ФИО _____

Ген. директор
М.Н. Якимов

(подпись)

« 19 » 09



Место печати
2019 года