

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Стоматорг»







Э.Х. Девлетбаева

« 13 » января 2020 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

«Материал оттискный силиконовый стоматологический в вариантах исполнения: Aqium, topas, kristall, betasil, SILECT, с принадлежностями»

производства Müller-Omicron GmbH & Co. KG, Germany / Мюллер-Омикрон ГмбХ и Ко. КГ», Германия

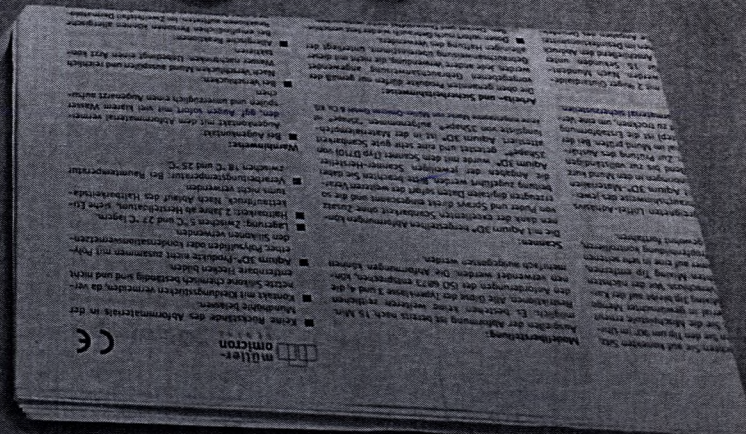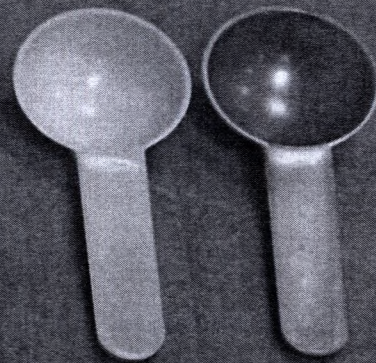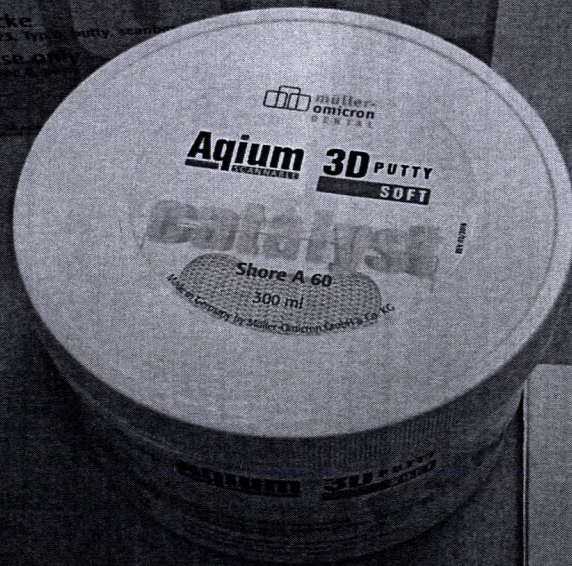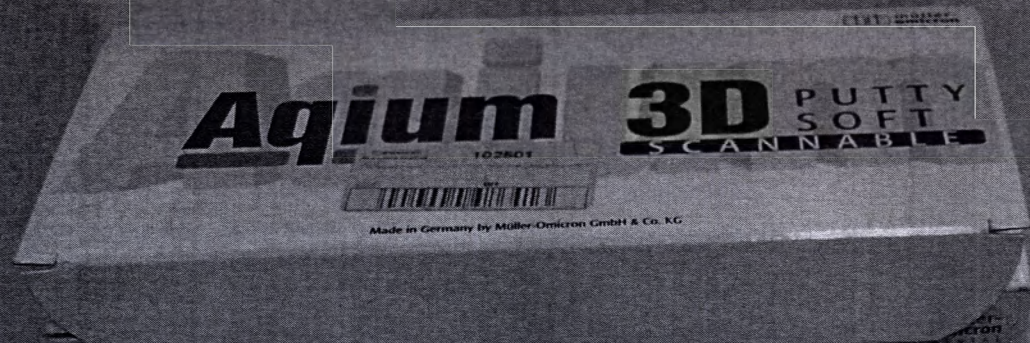

Aqium

3D PUTTY SOFT SCANNABLE 5:1

müller-
omicon
DENTAL

Abformmaterial
für dentale Zwecke
additionsvernetzendes Polyvinylsiloxan,
EN ISO 4823, Typ 0, putty,
zur Anwendung in Mischgeräten
für 5:1 Kartuschensysteme, scanbar

Impression material
for dental use only
addition curing Polyvinylsiloxane,
EN ISO 4823, Type 0, putty,
for only use in mixing devices for 5:1
cartridge systems, scanable

REF. 25131

Made in Germany



Special note before use!
Bleed the cartridge before installing a new mixing tip.


Material	Color	Viscosity (cP)	Flow (mm/s)	Shrinkage (%)	Dimensional Accuracy (%)	Scanning Accuracy (mm)
Aqium 3D Putty Soft Scannable 5:1	White	~1000	~1.5	~0.2	~0.1	~0.05
Aqium 3D Putty Soft Scannable 5:1	White	~1000	~1.5	~0.2	~0.1	~0.05

Additional information: The material is suitable for use in mixing devices for 5:1 cartridge systems. It is also suitable for use in scanning devices. The material is white and has a viscosity of approximately 1000 cP. The flow is approximately 1.5 mm/s. The shrinkage is approximately 0.2%. The dimensional accuracy is approximately 0.1%. The scanning accuracy is approximately 0.05 mm.

Aqium 3D HEAVY

SCANNABLE

müller-
omicon
DENTAL



**Abformmaterial
für dentale Zwecke**
Addition-curing Polymethylsilikon, Typ 1,
schwer-lindevd, EN ISO 4823, scannbar

**Impression material
for dental use only**
addition-curing Polymethylsilikon, Type 1,
heavy-body consistency, EN ISO 4823,
scannable

REF 82533

Made in Germany

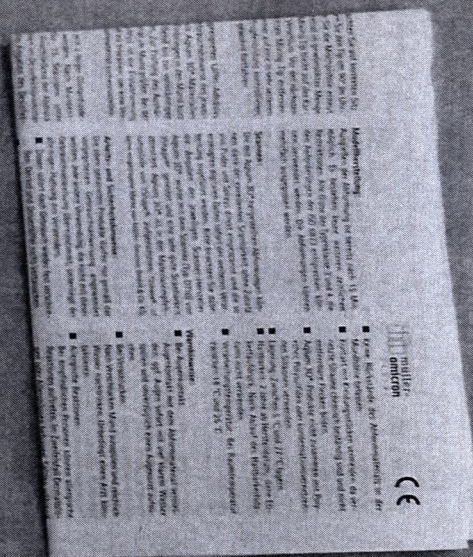
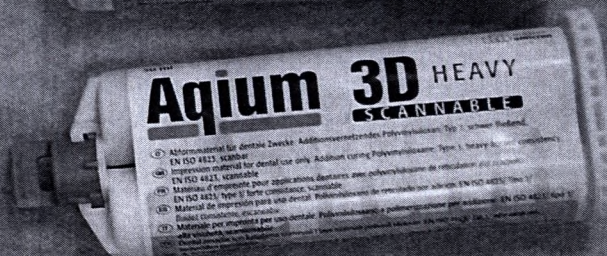
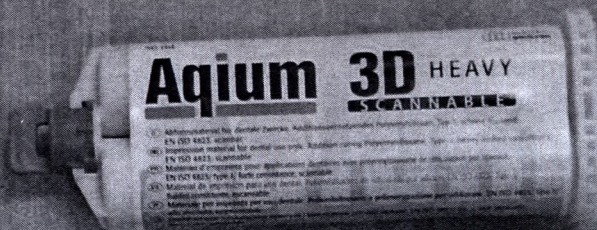


ФОТО 3.

Aqium

3D HEAVY

SCANNABLE 5:1

müller-omicon

**Abformmaterial
für dentale Zwecke**
additionsvernetzendes Polyvinylsiloxan
EN ISO 4823, Typ 1, schwerfließend,
zur Anwendung in Mischgeräten
für 5:1 Kartuschensysteme, scannbar

**Impression material
for dental use only**
addition curing Polyvinylsiloxane
EN ISO 4823, Type 1, heavy-bodied
consistency, for only use in mixing
devices for 5:1 cartridge-systems, scannable

REF 85133

Made in Germany

CE

Hinweis zum Gebrauch!
Vor Aufsetzen eines neuen Mixing Tips immer etwas
Material ausbringen, bis es gleichmäßig fließt.
Special note before use!
Bleed the cartridge before installing a new mixing tip.

Aqium 3D HEAVY

SCANNABLE 5:1

Abformmaterial für dentale Zwecke
additionsvernetzendes Polyvinylsiloxan
EN ISO 4823, Typ 1, schwerfließend, zur Anwendung in Mischgeräten
für 5:1 Kartuschensysteme, scannbar

Impression material for dental use only
addition curing Polyvinylsiloxane
EN ISO 4823, Type 1, heavy-bodied consistency, for only use in mixing
devices for 5:1 cartridge-systems, scannable

Abformmaterial für dentale Zwecke
additionsvernetzendes Polyvinylsiloxan
EN ISO 4823, Typ 1, schwerfließend, zur Anwendung in Mischgeräten
für 5:1 Kartuschensysteme, scannbar

Impression material for dental use only
addition curing Polyvinylsiloxane
EN ISO 4823, Type 1, heavy-bodied consistency, for only use in mixing
devices for 5:1 cartridge-systems, scannable

Hinweis zum Gebrauch!
Vor Aufsetzen eines neuen Mixing Tips immer etwas
Material ausbringen, bis es gleichmäßig fließt.
Special note before use!
Bleed the cartridge before installing a new mixing tip.

Aqium 3D HEAVY

SCANNABLE 5:1

Abformmaterial für dentale Zwecke
additionsvernetzendes Polyvinylsiloxan
EN ISO 4823, Typ 1, schwerfließend, zur Anwendung in Mischgeräten
für 5:1 Kartuschensysteme, scannbar

Impression material for dental use only
addition curing Polyvinylsiloxane
EN ISO 4823, Type 1, heavy-bodied consistency, for only use in mixing
devices for 5:1 cartridge-systems, scannable

Abformmaterial für dentale Zwecke
additionsvernetzendes Polyvinylsiloxan
EN ISO 4823, Typ 1, schwerfließend, zur Anwendung in Mischgeräten
für 5:1 Kartuschensysteme, scannbar

Impression material for dental use only
addition curing Polyvinylsiloxane
EN ISO 4823, Type 1, heavy-bodied consistency, for only use in mixing
devices for 5:1 cartridge-systems, scannable





Abformmaterial für dentale Zwecke
additionsvernetzendes Polyvinylsiloxan
EN ISO 4823, Typ 1, schwerfließend, zur Anwendung in Mischgeräten
für 5:1 Kartuschensysteme, scannbar




Impression material for dental use only
addition curing Polyvinylsiloxane
EN ISO 4823, Type 1, heavy-bodied consistency, for only use in mixing
devices for 5:1 cartridge-systems, scannable

Abformmaterial für dentale Zwecke
additionsvernetzendes Polyvinylsiloxan
EN ISO 4823, Typ 1, schwerfließend, zur Anwendung in Mischgeräten
für 5:1 Kartuschensysteme, scannbar

Impression material for dental use only
addition curing Polyvinylsiloxane
EN ISO 4823, Type 1, heavy-bodied consistency, for only use in mixing
devices for 5:1 cartridge-systems, scannable

CE

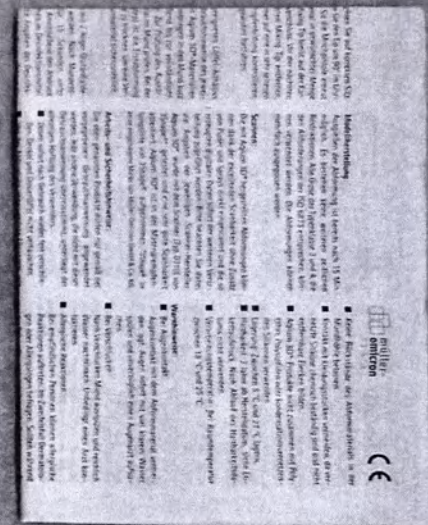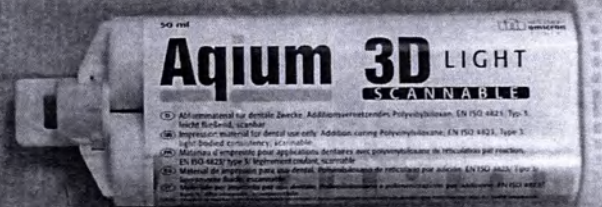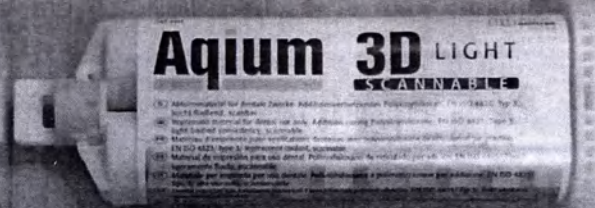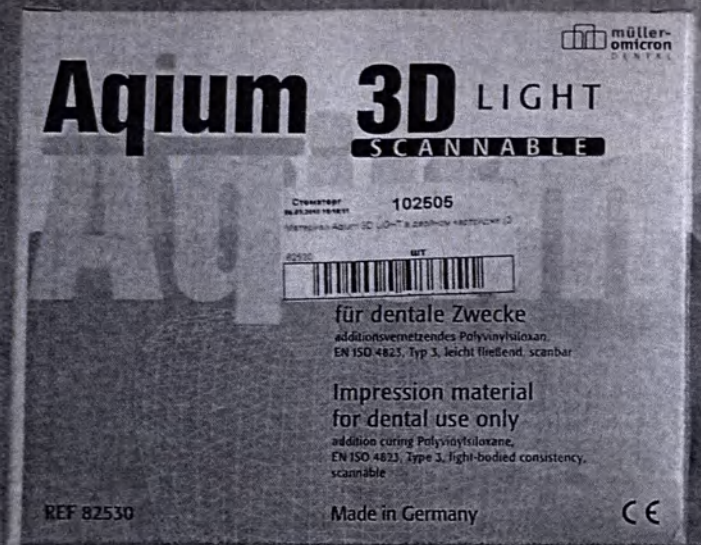

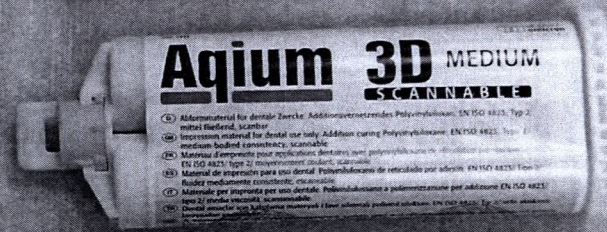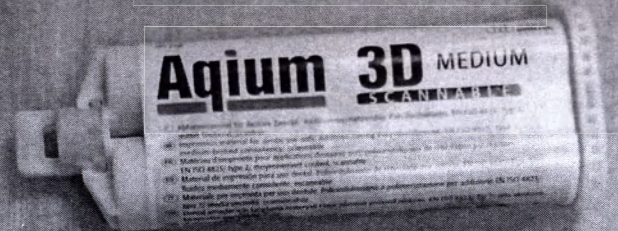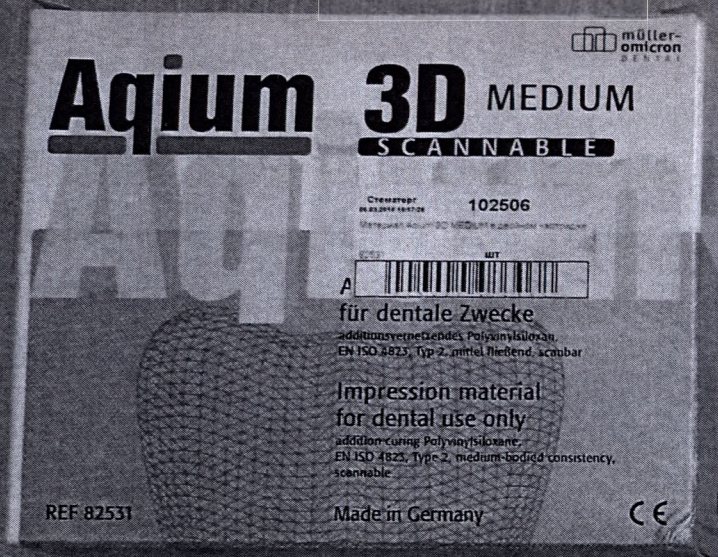


Technical data table for Aqium 3D MEDIUM SCANNABLE. The table lists various properties and values for different syringe sizes and mixing ratios.

Property	Aqium 3D MEDIUM SCANNABLE 100 ml	Aqium 3D MEDIUM SCANNABLE 50 ml	Aqium 3D MEDIUM SCANNABLE 25 ml	Aqium 3D MEDIUM SCANNABLE 12.5 ml
Viscosity (mPa·s)	100	100	100	100
Flowability (mm/s)	100	100	100	100
Shrinkage (%)	0.1	0.1	0.1	0.1
Modulus (N/mm²)	100	100	100	100
Hardness (Shore D)	100	100	100	100
Storage time (h)	100	100	100	100
Working time (h)	100	100	100	100
Curing time (h)	100	100	100	100
Temperature (°C)	100	100	100	100



ФОТО 6.

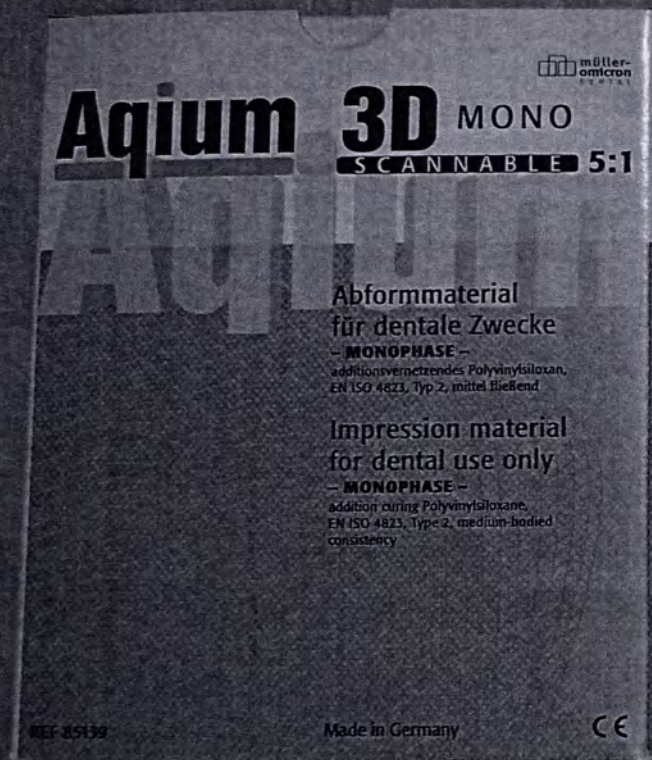







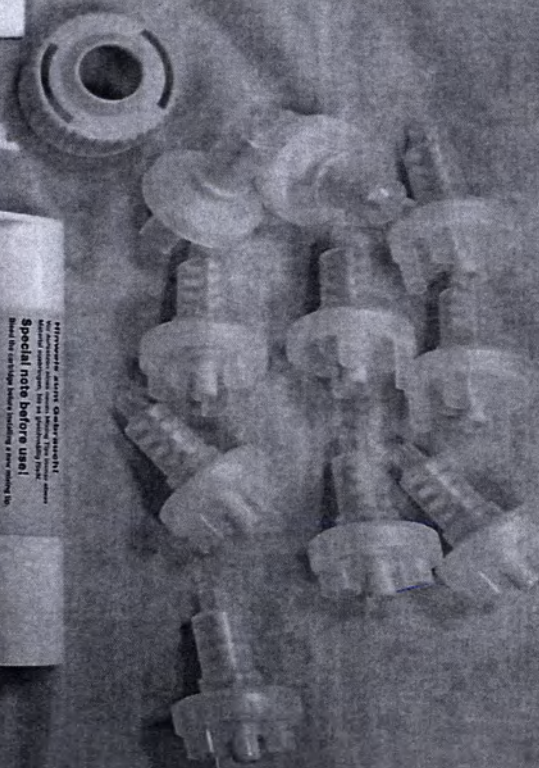


ФОТО 8.

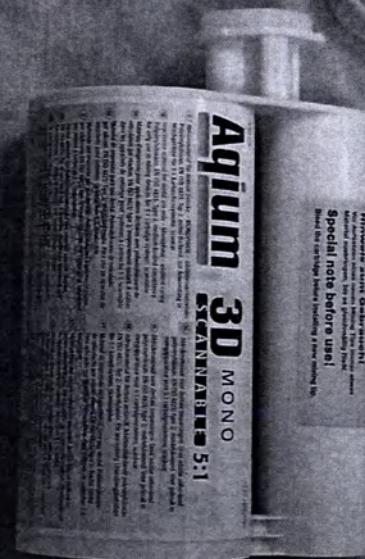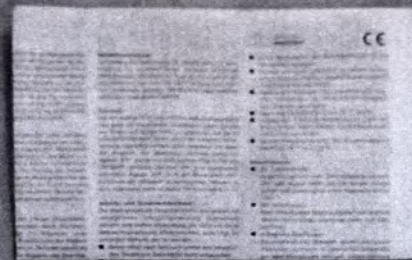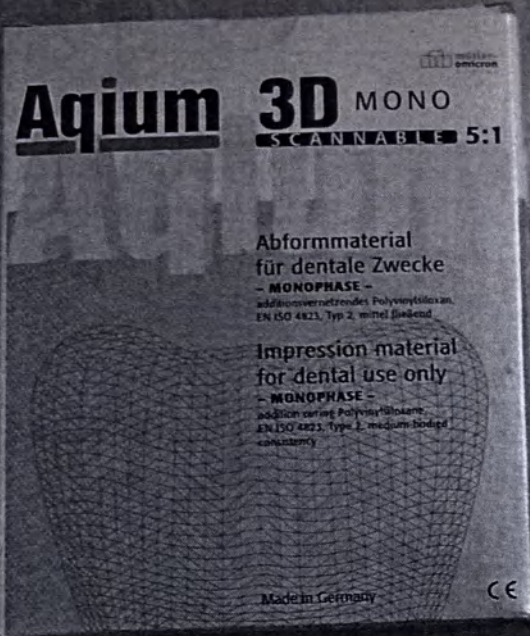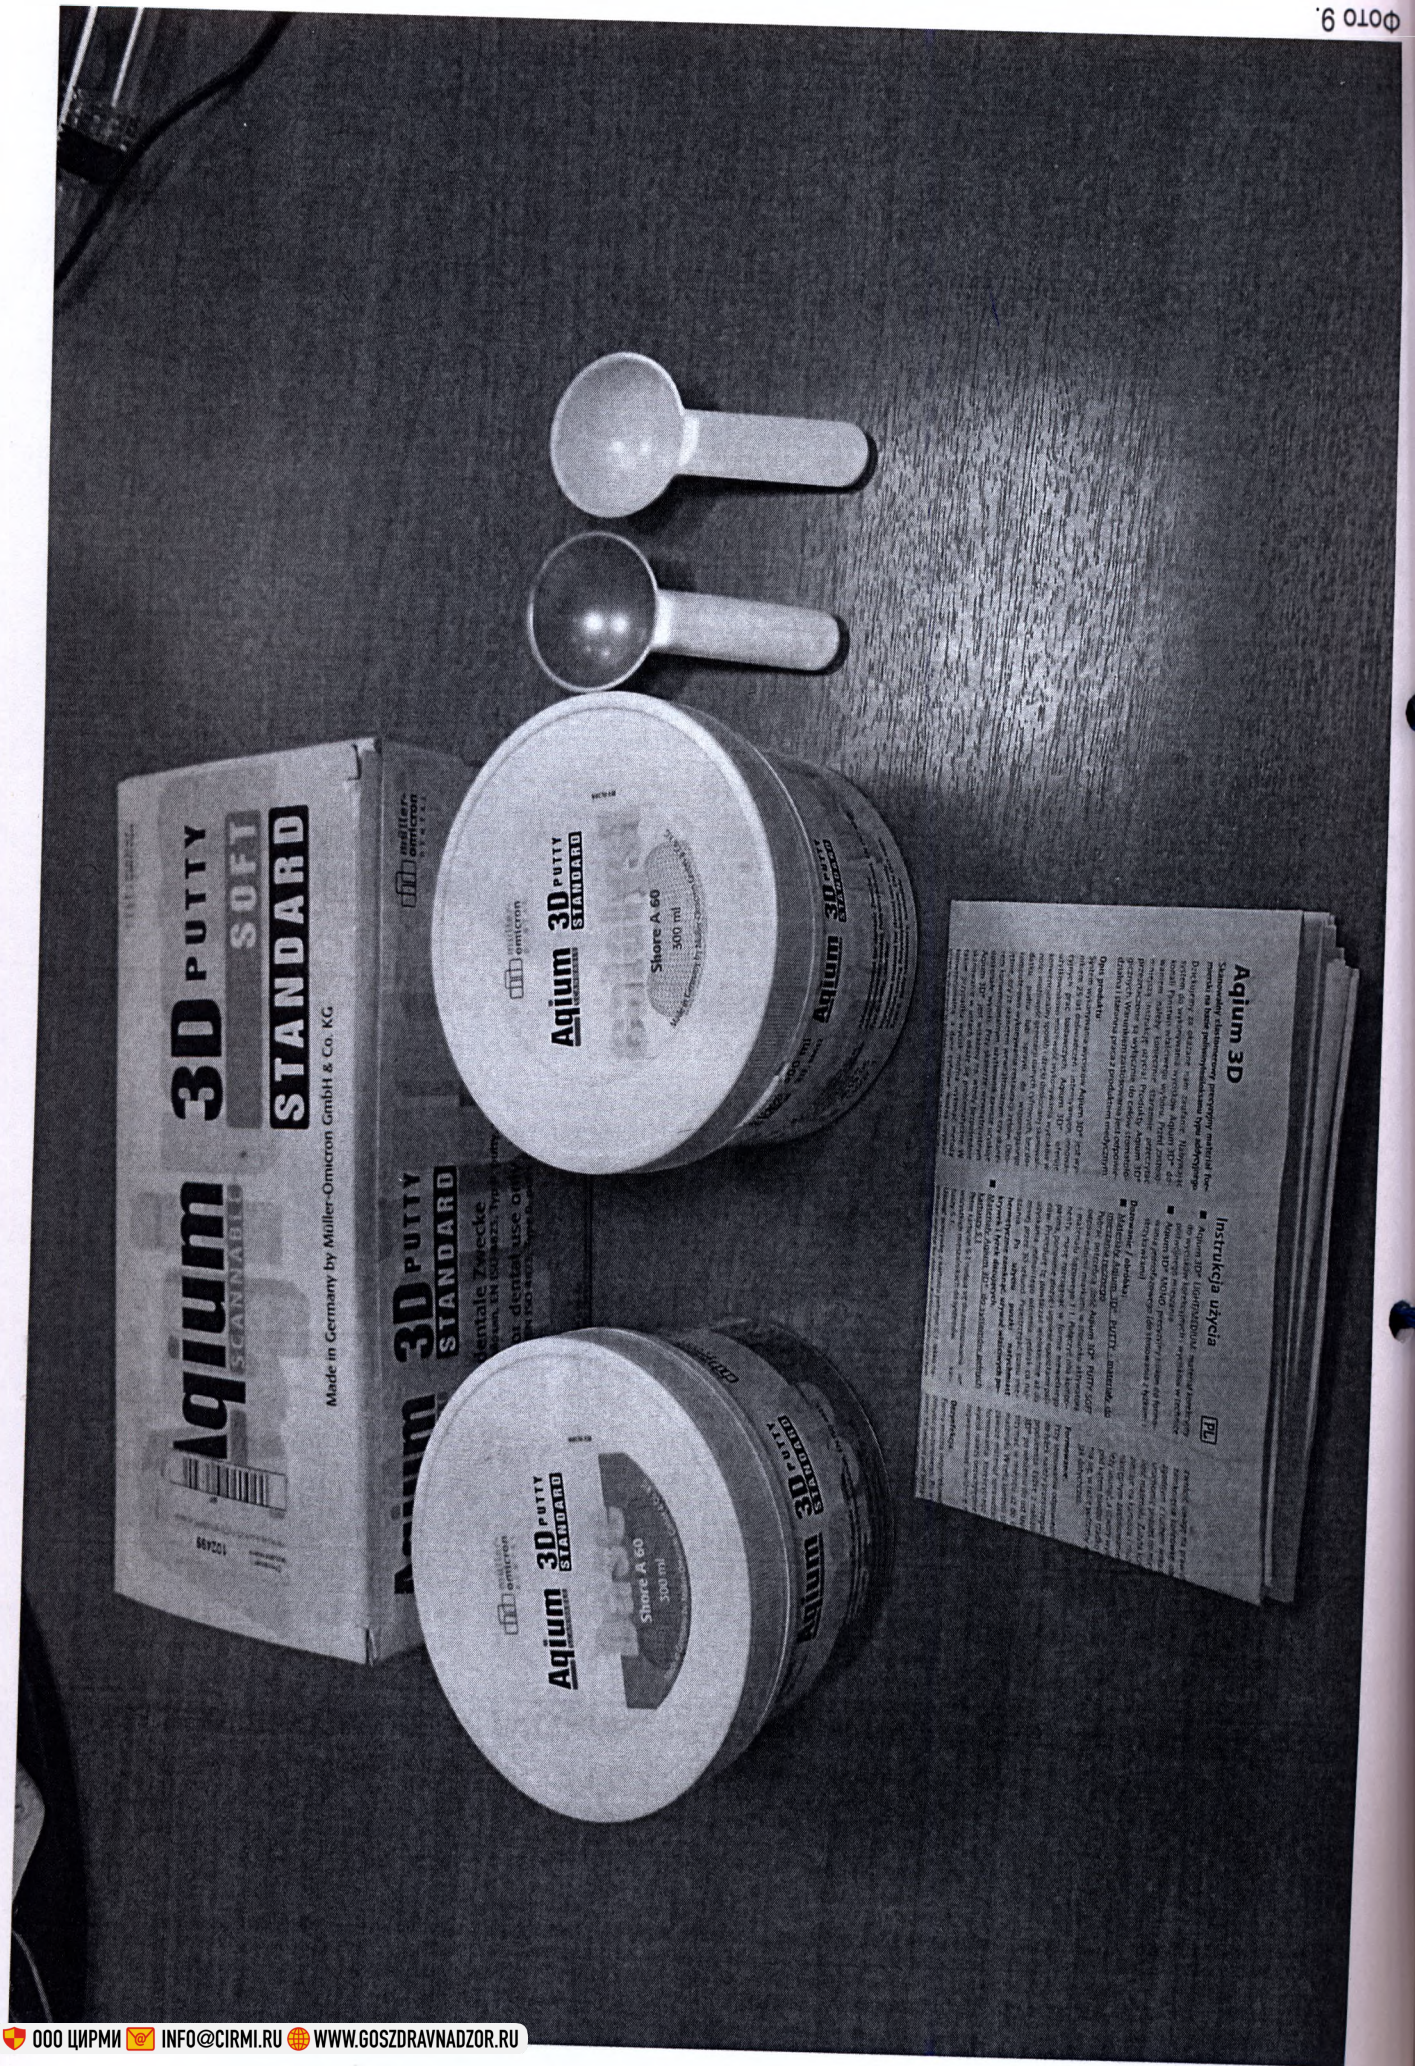




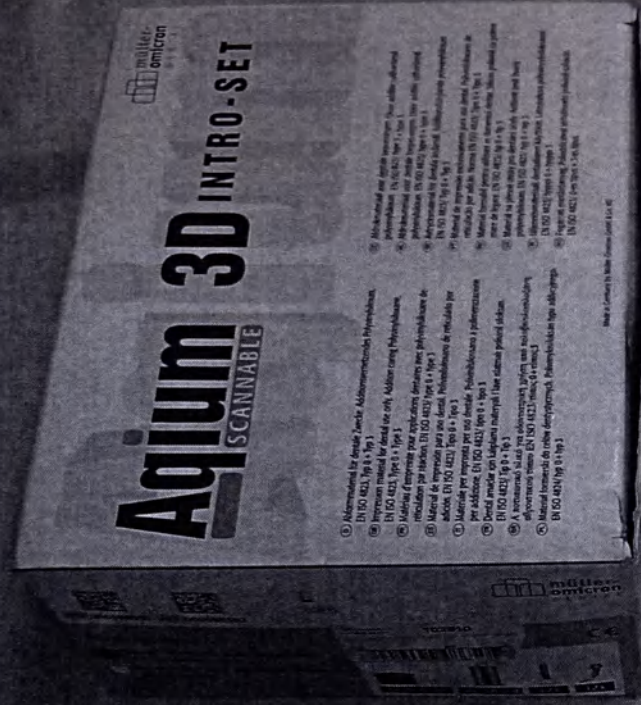


Aqium

3D BITE SCANNABLE



COMPRESSOR 102511







**Bissregistriermaterial
für dentale Zwecke**
additionsvernetztes Polyvinylsiloxan,
schwer fließend, Härte Shore D45, scanbar

**Bite registration material
for dental use only**
addition curing Polyvinylsiloxane,
heavy-bodied consistency, hardness Shore D45,
scannable

REF 82538

Made in Germany

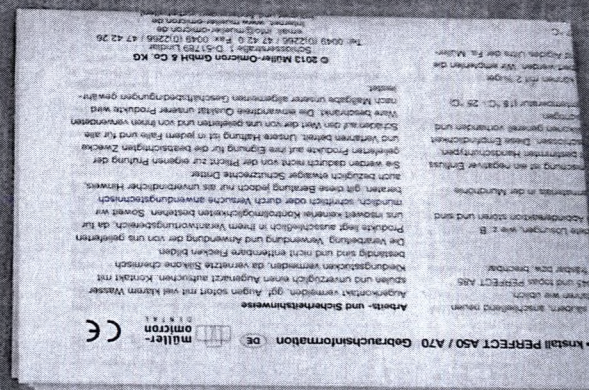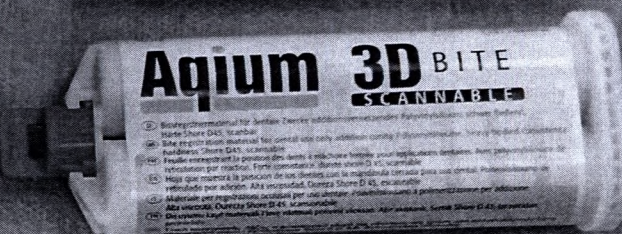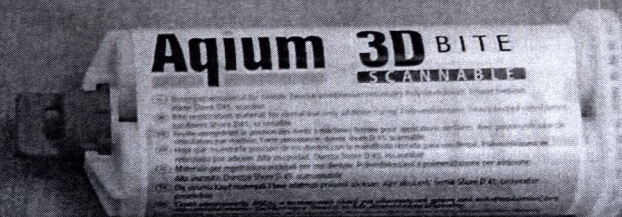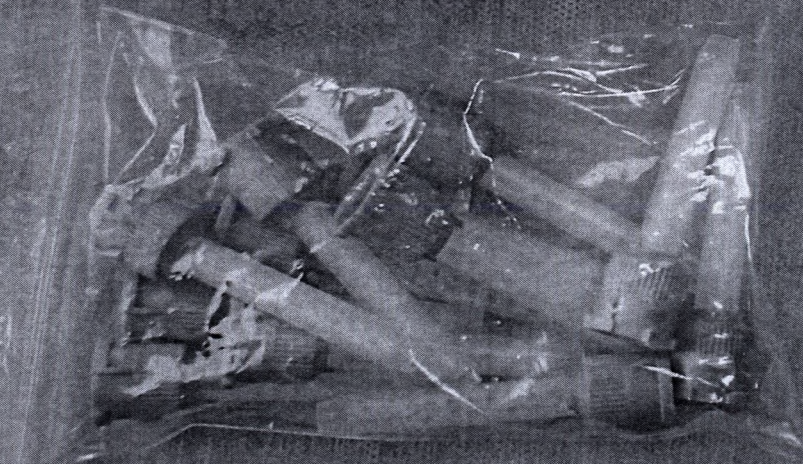

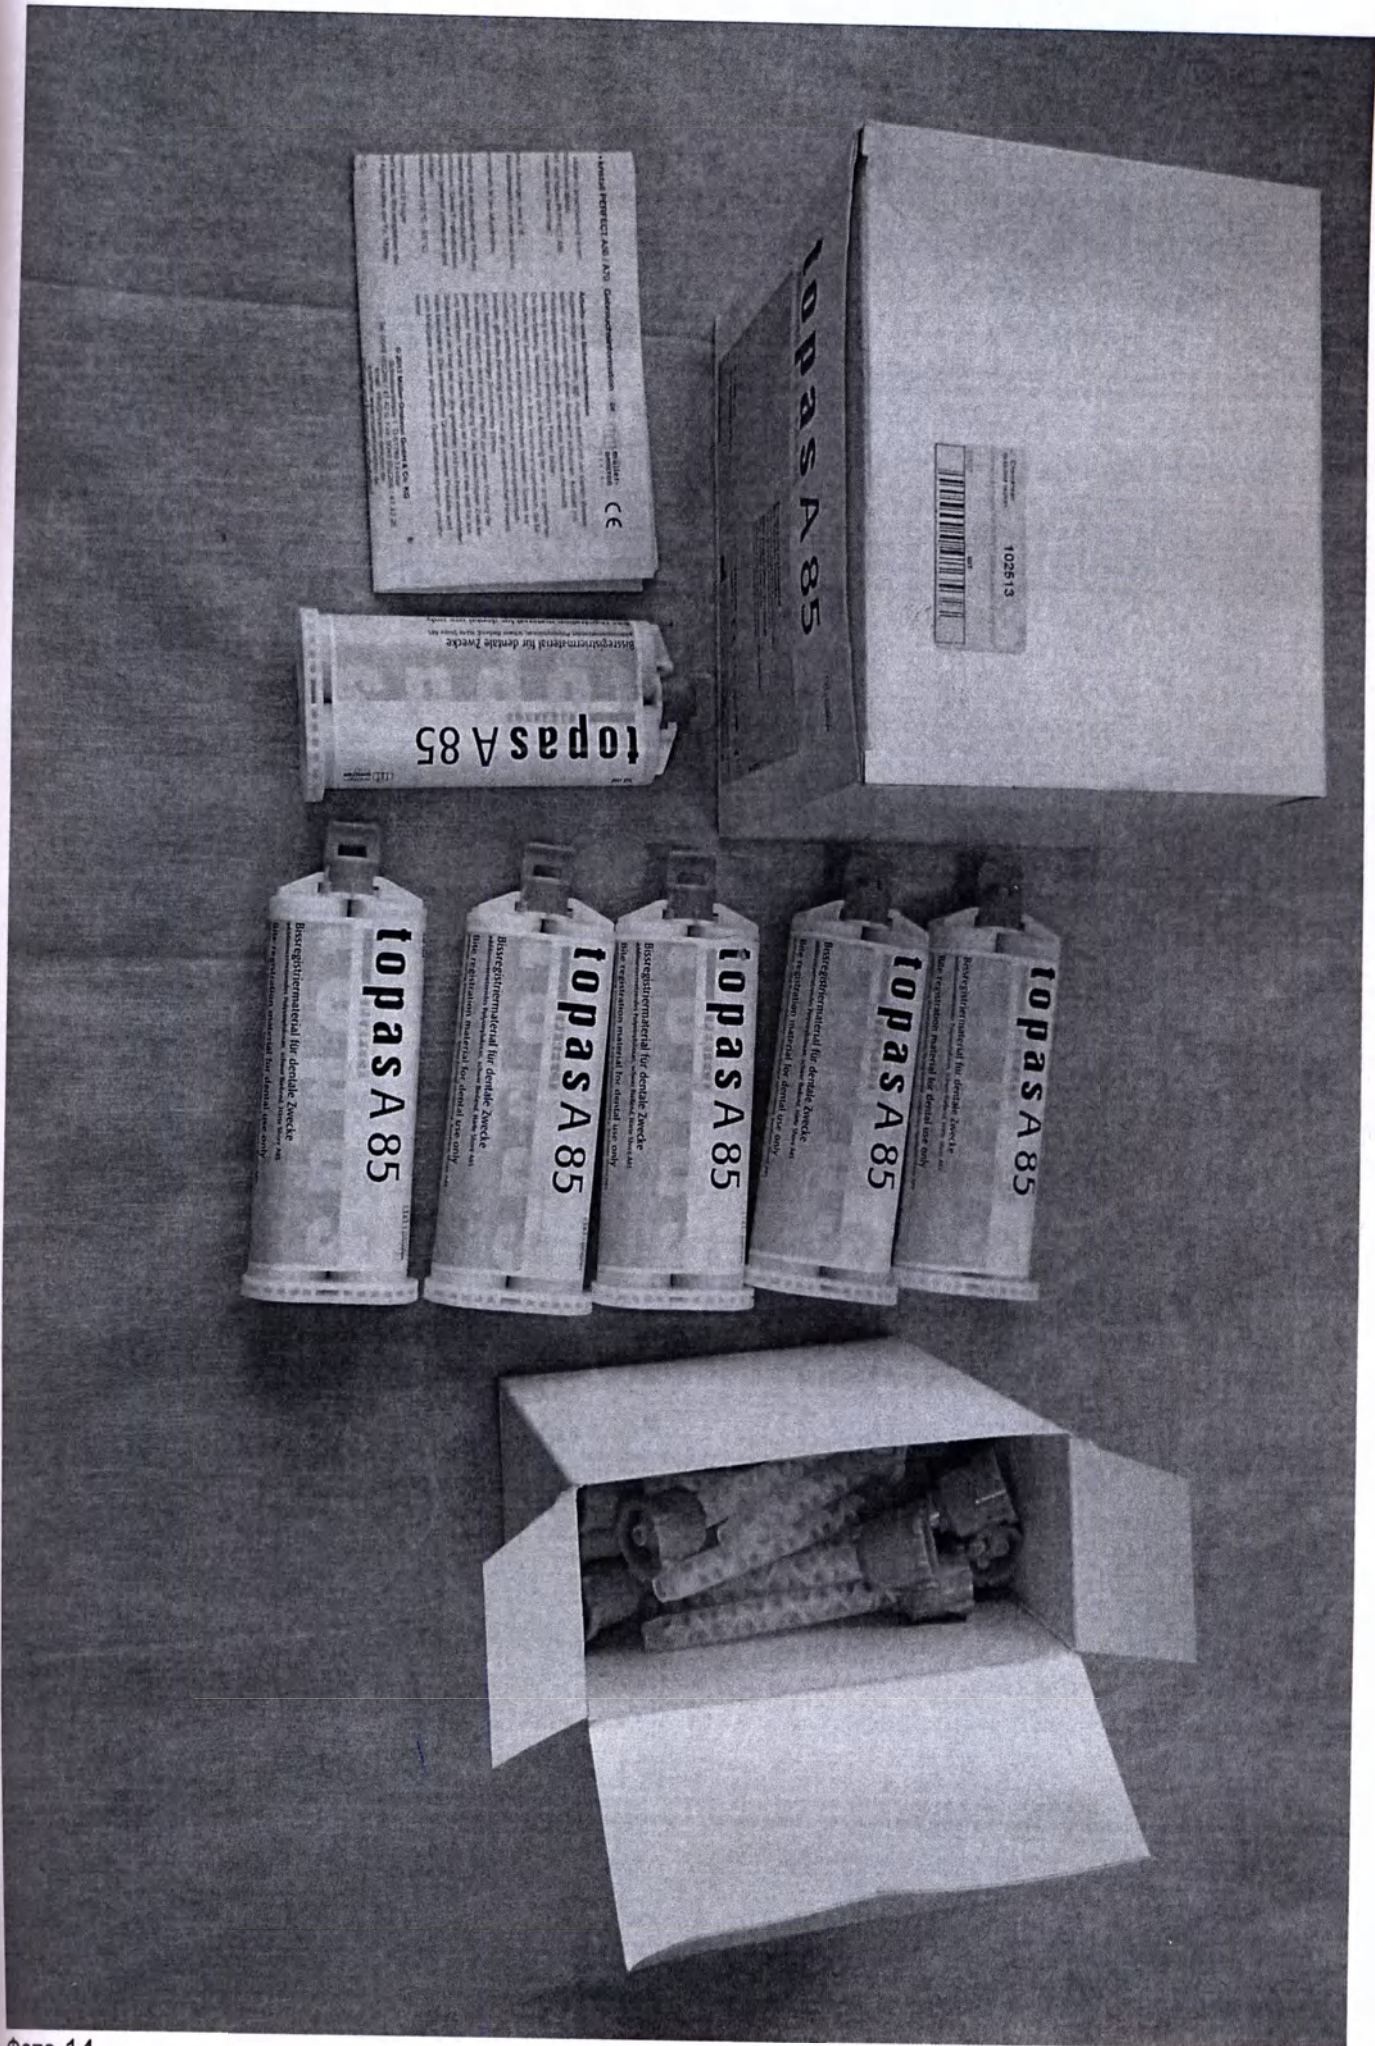


Фото 14.

kristall A 70

müller-
omicon

102514



REF 82576

Transparentes Silikon für dentale Zwecke zur Abformung von Kau- und Zahnoberflächen, Bissregistriermaterial, additionsvernetztes Polyvinylsiloxan, schwer fließend, Härte Shore A70

Transparency silicone for dental use only, for impression of surfaces of teeth and occlusal surfaces, bite registration material, addition curing Polyvinylsiloxane, heavy-bodied consistency, hardness Shore A70

CE

kristall A70

Transparentes Silikon für dentale Zwecke zur Abformung von Kau- und Zahnoberflächen, Bissregistriermaterial, additionsvernetztes Polyvinylsiloxan, schwer fließend, Härte Shore A70

kristall A70

Transparentes Silikon für dentale Zwecke zur Abformung von Kau- und Zahnoberflächen, Bissregistriermaterial, additionsvernetztes Polyvinylsiloxan, schwer fließend, Härte Shore A70

Eigenschaften

Verwendung (1-1)	Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit	Mundverweildauer	Gesamt-Abbindzeit	Härte Shore	Lineare Maßänderung
manuell	30 Sek.	30 Sek.	1 Min.	D45	0.1 %
manuell	30 Sek.	30 Sek.	1 Min.	D45	0.1 %
manuell	30 Sek.	1 Min.	1 Min. 30 Sek.	A70	0.1 %
manuell	30 Sek.	1 Min.	1 Min. 30 Sek.	A70	0.2 %

Die Werte sind auf 23 °C und einer relativen Luftfeuchte von 50-70 % angegeben. Höhere Temperaturen und höhere Luftfeuchte verlängern die Abbindzeit.

IS - kristall PERFECT A50 / A70 - Instructions for use

Operating and safety instructions

Avoid contact with eyes; if necessary, wash eyes immediately with plenty of water and consult an eye specialist without delay. Avoid contact with clothes; any soiling should be removed immediately. Avoid contact with flames; the curing silicone is extremely flammable and can cause fires that cannot be removed.

The processing, storage and disposal of this product is subject to the following instructions:

1. Avoid contact with eyes; if necessary, wash eyes immediately with plenty of water and consult an eye specialist without delay. Avoid contact with clothes; any soiling should be removed immediately. Avoid contact with flames; the curing silicone is extremely flammable and can cause fires that cannot be removed.

2. The processing, storage and disposal of this product is subject to the following instructions:

3. Avoid contact with eyes; if necessary, wash eyes immediately with plenty of water and consult an eye specialist without delay. Avoid contact with clothes; any soiling should be removed immediately. Avoid contact with flames; the curing silicone is extremely flammable and can cause fires that cannot be removed.

4. The processing, storage and disposal of this product is subject to the following instructions:

5. Avoid contact with eyes; if necessary, wash eyes immediately with plenty of water and consult an eye specialist without delay. Avoid contact with clothes; any soiling should be removed immediately. Avoid contact with flames; the curing silicone is extremely flammable and can cause fires that cannot be removed.









6. The processing, storage and disposal of this product is subject to the following instructions:




7. Avoid contact with eyes; if necessary, wash eyes immediately with plenty of water and consult an eye specialist without delay. Avoid contact with clothes; any soiling should be removed immediately. Avoid contact with flames; the curing silicone is extremely flammable and can cause fires that cannot be removed.

8. The processing, storage and disposal of this product is subject to the following instructions:

9. Avoid contact with eyes; if necessary, wash eyes immediately with plenty of water and consult an eye specialist without delay. Avoid contact with clothes; any soiling should be removed immediately. Avoid contact with flames; the curing silicone is extremely flammable and can cause fires that cannot be removed.

10. The processing, storage and disposal of this product is subject to the following instructions:

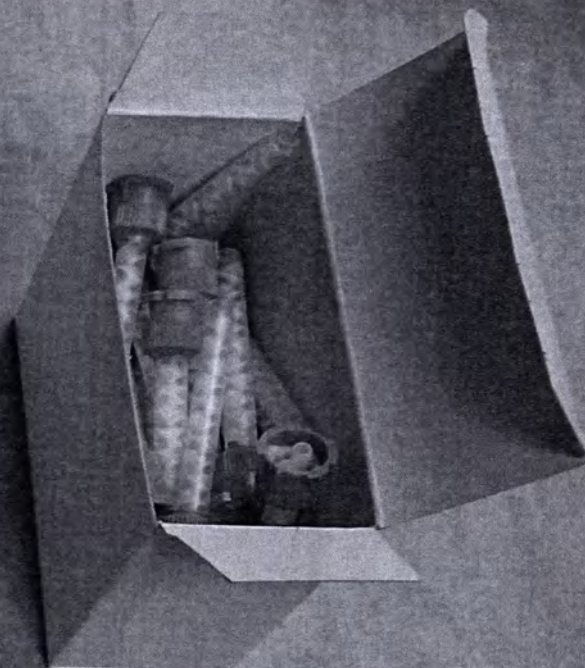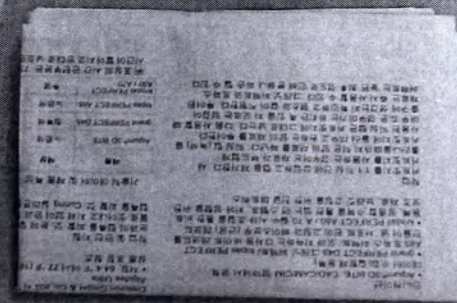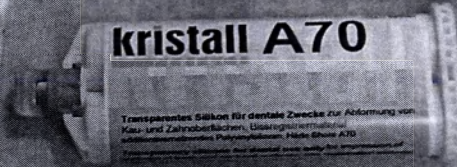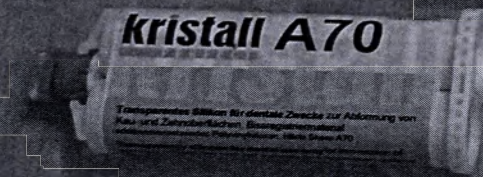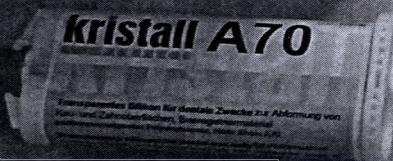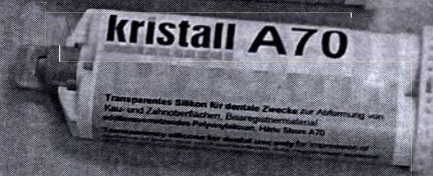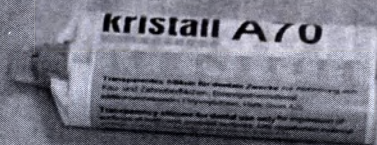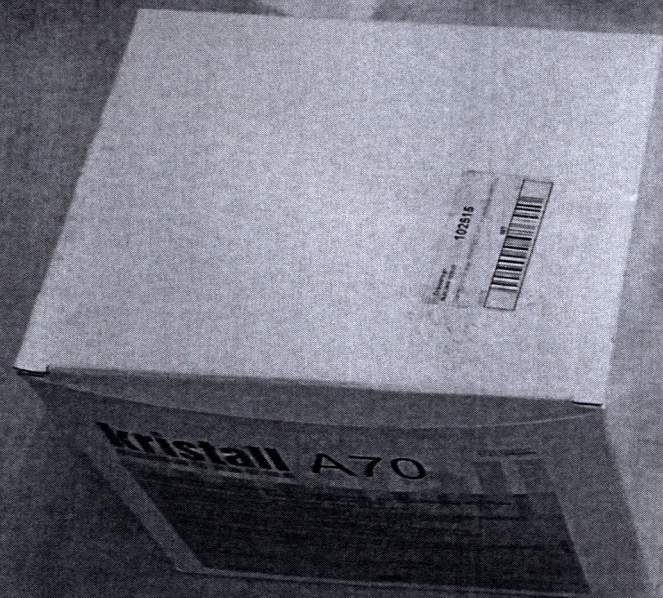

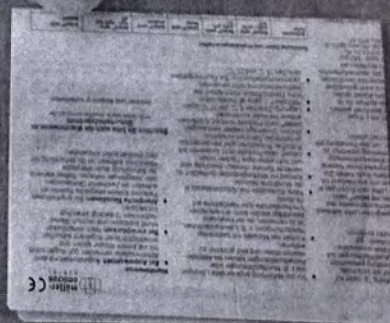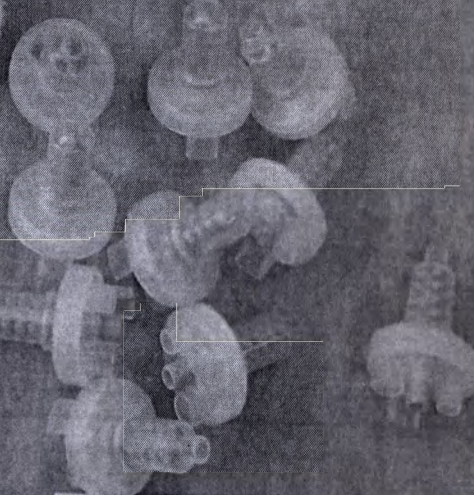

betasil IMPLANT

müller-omicon

5:1

Abformmaterial für dentale Zwecke

- MONOPHASE -

additionsvernetztes Polyvinylsiloxan,
EN ISO 4823, Typ 2, mittelfließend,
zur Anwendung in Mischgeräten
für 5:1 Kartuschensysteme

Impression material
for dental use only

- MONOPHASE -

addition curing Polyvinylsiloxane,
EN ISO 4823, Type 2, medium-bodied
consistency, for only use in mixing
devices for 5:1 cartridge-systems

2x 380 ml
1x Fix cap

REF 85129

2019-07
43185-3



Made in Germany by Müller-omicon GmbH & Co. KG
Schlossstraße 1 D-52799 Lindlar Tel: +49 (0) 2366-47420

Hinweis zum Gebrauch!
Vor Aufsetzen eines neuen Misch-Tips immer etwas
Material ausbringen, bis es gleichmäßig fließt.
Special note before use!
Based the cartridge before installing a new mixing tip.

betasil IMPLANT

müller-omicon

5:1

Abformmaterial für dentale Zwecke

- MONOPHASE -

additionsvernetztes Polyvinylsiloxan,
EN ISO 4823, Typ 2, mittelfließend,
zur Anwendung in Mischgeräten
für 5:1 Kartuschensysteme

Impression material for dental use only

Hinweis zum Gebrauch!
Vor Aufsetzen eines neuen Misch-Tips immer etwas
Material ausbringen, bis es gleichmäßig fließt.
Special note before use!
Based the cartridge before installing a new mixing tip.

betasil IMPLANT

müller-omicon

5:1

Abformmaterial für dentale Zwecke

- MONOPHASE -

additionsvernetztes Polyvinylsiloxan,
EN ISO 4823, Typ 2, mittelfließend,
zur Anwendung in Mischgeräten
für 5:1 Kartuschensysteme

betasil VARIO Istruzioni per l'uso

Materiali e strumenti per impressione in
preparazione su base di polivinilsilossano, a
preparazione per addizione

La miscelazione può essere effettuata con il
sistema per miscelazione a 5:1. Con il sistema per
miscelazione a 5:1, il materiale deve essere
miscelato accuratamente in un unico
contenitore. La miscelazione deve essere
completata prima di utilizzare il materiale.

Descrizione del prodotto
betasil VARIO è un materiale di stampa in
silossano polivinilico a base di addizione
che, quando è miscelato, si trasforma in una
massa solida e non si indurisce più. È
adatto per la stampa di modelli dentali in
silossano polivinilico a base di addizione.

procedura fino ad ottenere un rivestimento
omogeneo su tutta la superficie. Dopo 30
secondi, il rivestimento deve essere
rimosso e il materiale deve essere
utilizzato immediatamente.

Materiali betasil VARIO
Il materiale betasil VARIO è un
materiale di stampa in silossano polivinilico
a base di addizione. È adatto per la
stampa di modelli dentali in silossano
polivinilico a base di addizione. Il
materiale deve essere miscelato accuratamente
in un unico contenitore prima di
utilizzarlo.

Il rivestimento deve essere
omogeneo su tutta la superficie. Dopo
30 secondi, il rivestimento deve essere
rimosso e il materiale deve essere
utilizzato immediatamente.

Prova del prodotto
Il materiale betasil VARIO è un
materiale di stampa in silossano polivinilico
a base di addizione. È adatto per la
stampa di modelli dentali in silossano
polivinilico a base di addizione. Il
materiale deve essere miscelato accuratamente
in un unico contenitore prima di
utilizzarlo.

betasil IMPLANT

medien-
amicon
GmbH

102618



betasil IMPLANT

betasil IMPLANT

14296 5
20-0202 8

	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
100%	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
90%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%	0%
80%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%	0%	0%
70%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%	0%	0%	0%
60%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%	0%	0%	0%	0%
50%	50%	40%	30%	20%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
40%	40%	30%	20%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
30%	30%	20%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
20%	20%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

medien-
amicon
GmbH

CE

betasil HEAVY VARIO

5:1

Abformmaterial für dentale Zwecke
additionsvernetztes Polyvinylsiloxan,
EN ISO 4823, Typ 1, schwerfließend,
zur Anwendung in Mischgeräten
für 5:1 Kartuschensysteme

Impression material for dental use only
addition curing Polyvinylsiloxane,
EN ISO 4823, Type 1, heavy-bodied
consistency, for only use in mixing
devices for 5:1 cartridge-systems

REF 000085103

Made in Germany

CE

Mindest 70 Sekunden auf
einen 100%igen
Verdichtungsgrad
ausreichenden
Verdichtungsgrad
zu erreichen. Bei
unzureichender
Verdichtung kann
das Material
nicht richtig
abformen und
die Qualität des
Abformmaterials
wird beeinträchtigt.
Bei unzureichender
Verdichtung kann
das Material
nicht richtig
abformen und
die Qualität des
Abformmaterials
wird beeinträchtigt.

- Vor der Abformung angewandte Lösungen
wie z. B. Mundspüllösungen oder
Desinfektionslösungen können die Abform-
materialien schädigen und sind gründlich zu
entfernen.
- Kontakt des Materials mit bestimmten
Metallwerkstoffen, z. B. Silber-Palladium-
Legierungen, ist zu vermeiden, da die Kartusche
beschädigt werden kann. Ein separater
Verpackungsbeutel oder Handschuhe auf
zu tragen.
- Keine Rückstände des Abformmaterials in
die Mundhöhle gelangen lassen.
- Kontakt mit Klebungsflächen vermeiden, da
einzelne Teilchen in der Mundhöhle verbleiben
und nicht gründlich entfernt werden
können.
- Zahnärztliche Produkte nicht zusammen mit
Phosphor, Phosphor oder anderen
verwendbaren Substanzen verwenden.
- Bei einer Unverträglichkeit mit dem Material
sollte eine Allergieprobe mit einem
anderen Material durchgeführt werden.
- Lagerung: Zwischen 5 °C und 22 °C lagern.
Nicht über 2 Jahre ab Herstellungs-
datum. Nach Ablauf der
Haltbarkeitsdauer nicht verwenden.
Verpackungsdauer: Bei Raumtemperatur
zwischen 18 °C und 22 °C.

Technische Daten und Produktmerkmale

Parameter	Wert	Parameter	Wert	Parameter	Wert	Parameter	Wert	Parameter	Wert
Verdichtungszeit	70 s	Verdichtungsdruck	10 MPa	Verdichtungszeit	70 s	Verdichtungsdruck	10 MPa	Verdichtungszeit	70 s
Verdichtungsdruck	10 MPa	Verdichtungszeit	70 s	Verdichtungsdruck	10 MPa	Verdichtungszeit	70 s	Verdichtungsdruck	10 MPa
Verdichtungszeit	70 s	Verdichtungsdruck	10 MPa	Verdichtungszeit	70 s	Verdichtungsdruck	10 MPa	Verdichtungszeit	70 s

- Warnhinweise:**
- Bei Augenkontakt: Augen sofort mit dem-
stehendem Wasser ausspülen, ggf. Augen sofort
mit viel kühlem Wasser spülen und
unverzüglich einen Augenarzt aufsuchen.
 - Bei Verschlucken: Nach Verschlucken
Mund ausspülen und reichlich Wasser
trinken. Unbedingt einen Arzt
kontaktieren.
 - **Allergische Reaktionen:** Bei empfindlichen
Personen können allergische Reaktionen
auftreten. Im Zweifelsfall Dermatologen
oder Allergologen konsultieren. Bei der
Behandlung akute allergische
Reaktionen zu beachten, ist die Behandlung
mit dem Produkt sofort zu stoppen.

**Beachten Sie bitte auch die Warnhinweise im
Sicherheitsteil des Produkts.**
Bitte auch die Warnhinweise im
Sicherheitsteil des Produkts
beachten und beachten.

Special note before use!
Bleed the cartridge before installing a new mixing tip.

betasil HEAVY VARIO

5:1

Minimum 70 Sekunden auf
einen 100%igen
Verdichtungsgrad
ausreichenden
Verdichtungsgrad
zu erreichen. Bei
unzureichender
Verdichtung kann
das Material
nicht richtig
abformen und
die Qualität des
Abformmaterials
wird beeinträchtigt.
Bei unzureichender
Verdichtung kann
das Material
nicht richtig
abformen und
die Qualität des
Abformmaterials
wird beeinträchtigt.

380 ml betasil HEAVY VARIO

5:1

Abformmaterial für dentale Zwecke, additionsvernetztes Polyvinylsiloxan,
EN ISO 4823, Typ 1, schwerfließend, zur Anwendung in Mischgeräten
für 5:1 Kartuschensysteme


Impression material for dental use only, addition curing Polyvinylsiloxane,
EN ISO 4823, Type 1, heavy-bodied consistency, for only use in mixing
devices for 5:1 cartridge-systems

Minimum 70 Sekunden auf
einen 100%igen
Verdichtungsgrad
ausreichenden
Verdichtungsgrad
zu erreichen. Bei
unzureichender
Verdichtung kann
das Material
nicht richtig
abformen und
die Qualität des
Abformmaterials
wird beeinträchtigt.
Bei unzureichender
Verdichtung kann
das Material
nicht richtig
abformen und
die Qualität des
Abformmaterials
wird beeinträchtigt.

Warnhinweise:
• Bei Augenkontakt: Augen sofort mit dem-
stehendem Wasser ausspülen, ggf. Augen sofort
mit viel kühlem Wasser spülen und
unverzüglich einen Augenarzt aufsuchen.
• Bei Verschlucken: Nach Verschlucken
Mund ausspülen und reichlich Wasser
trinken. Unbedingt einen Arzt
kontaktieren.
• **Allergische Reaktionen:** Bei empfindlichen
Personen können allergische Reaktionen
auftreten. Im Zweifelsfall Dermatologen
oder Allergologen konsultieren. Bei der
Behandlung akute allergische
Reaktionen zu beachten, ist die Behandlung
mit dem Produkt sofort zu stoppen.

Beachten Sie bitte auch die Warnhinweise im
Sicherheitsteil des Produkts.
Bitte auch die Warnhinweise im
Sicherheitsteil des Produkts
beachten und beachten.

betasil HEAVY VARIO



Abformmaterial
für dentale Zwecke

additionsvernetzendes Polyvinylsiloxan, Typ 1,
schwer fließend, EN ISO 4823


Impression material
for dental use only

addition curing Polyvinylsiloxane, Type 1,
heavy-bodied consistency, EN ISO 4823



REF 000082503

Made in Germany

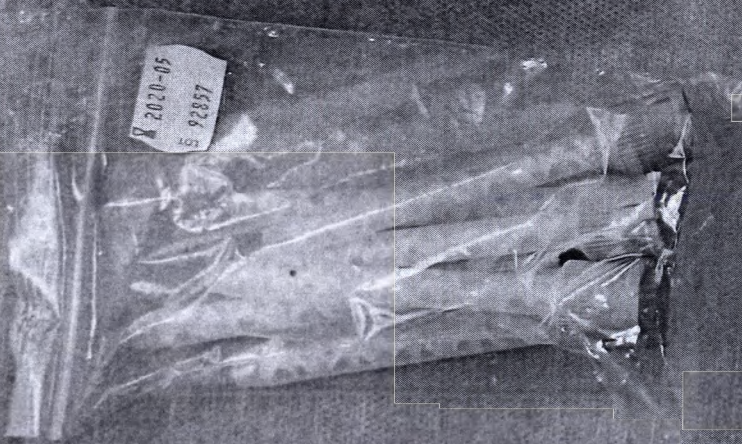

Mixing Tip bleibt auf
ent alle Verschleiss.
wendung gebrauchten
Austrittsstörungen auf
Fällen entstandene
rollieren, ggf.
sofort fortfahren.

Geeigneten Löffel-Adhäsiv
gebrauchswiese des
mit betasil® vario-
Löffel nach Einbringen in
in und anschließend die
fung in situ halten. Zur
grades immer Material
Korrekturenformung
formung unbedingt zu
1, um eine Vernetzung mit
sicherzustellen.

in mit 2-3er
beim Druck werden.
im Abdruck für 15
mit Wasser spülen
sok durch gründliches
ionemittel desinfizieren.
des Desinfektionsmittel-
er empfehlen die
2-3er / MD für
Löffel A-Lin. MD
im unter www.digitel.de
bayer, 0163 671

- Vor der Abformung angewendete Lösungen, wie z. B. Mundspüllösungen oder Retraktionslösungen können die Abdeckschicht stören und sind gründlich zu entfernen.
- Kontakt des Materials mit bestimmten Handschuhtypen, z. B. Latexhandschuhen, ist zu vermeiden, da der Katalysator beschädigt werden kann. Wir empfehlen Vinylhandschuhe oder Handschuhe auf PE-Basis.
- Keine Rückläufe des Abformmaterials in der Mundhöhle belassen.
- Kontakt mit Kleidungsstücken vermeiden, da vernetzte Silikone chemisch beständig sind und nicht entfernbar. Flecken bilden.
- betasil® vario-Produkte nicht zusammen mit Polyether, Polyäthern oder kondensationsvernetzenden Silikonen verwenden.
- Um evtl. Unverträglichkeiten vorzubeugen, betasil® vario-Produkte nicht mit A-Silikonen anderer Hersteller kombinieren.
- Lagerung: Zwischen 5 °C und 27 °C lagern.
- Haltbarkeit: 2 Jahre ab Herstellungsdatum, siehe Etikettaufdruck. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht verwenden.
- Verarbeitungstemperatur: Bei Raumtemperatur zwischen 18 °C und 25 °C.


Warnhinweise:



- **Bei Augenkontakt:** Augenkontakt mit dem Abformmaterial vermeiden, ggf. Augen sofort mit viel klarem Wasser spülen und unverzüglich einen Augenarzt aufsuchen.
- **Bei Verschlucken:** Nach Verschlucken Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Unbedingt einen Arzt kontaktieren.
- **Allergische Reaktionen:** Bei empfindlichen Personen können allergische Reaktionen auftreten. Im Zweifelsfall Dermatologen oder Allergologen befragen. Sollten während der Behandlung akute allergische Reaktionen auftreten, ist die Behandlung mit dem Produkt sofort einzustellen.

Beachten Sie bitte auch die Warnhinweise im Sicherheitsdatenblatt!
Info unter www.muller-omicon.de
Impressur und Änderung vorbehalten.

Technische Daten und Produkteigenschaften

Technische Daten	betasil® vario 102500	betasil® vario 102500	betasil® vario 102500	betasil® vario 102500	betasil® vario 102500	betasil® vario 102500	betasil® vario 102500

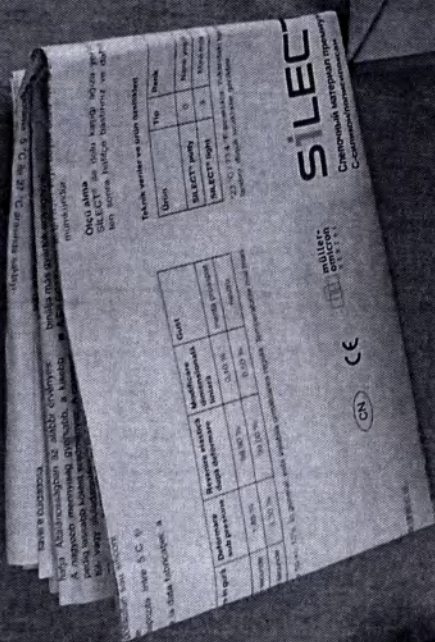

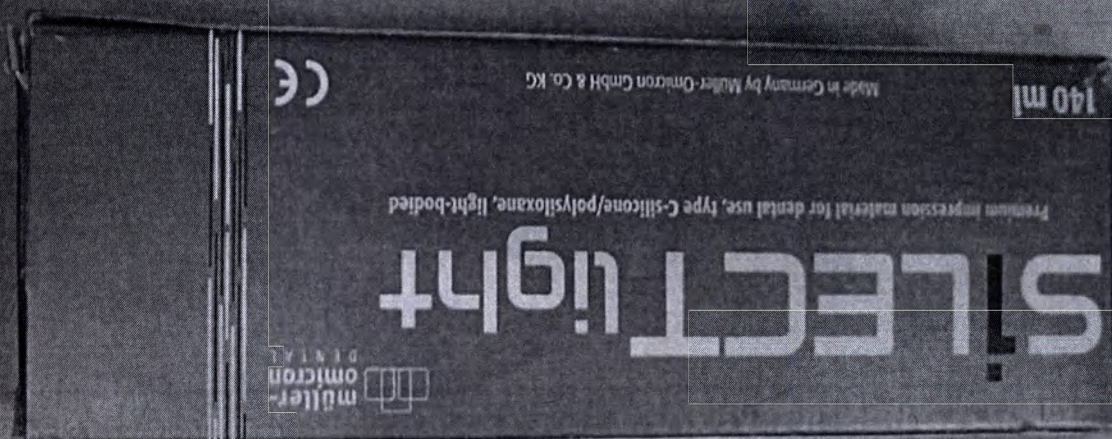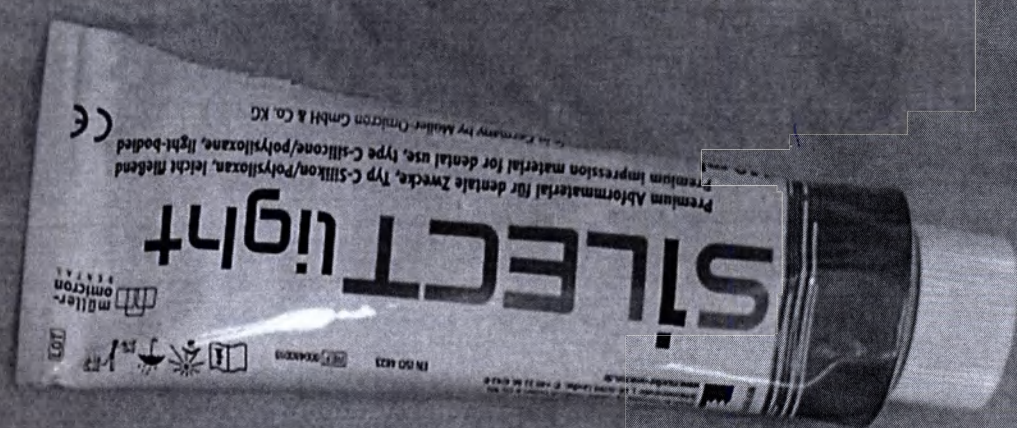

Ο SILECT light είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται για την προτύπωση των οδοντοστοιχιών. Είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται για την προτύπωση των οδοντοστοιχιών. Είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται για την προτύπωση των οδοντοστοιχιών.

Ενδείξεις
Στεφάνες και γέφυρες, μερικές στεφάνες, σφραγίσματα, επένετα, ολική και μερική προσθετική.

Τεχνική αποτύπωσης
Κατάλληλο για διαοδμήκη αποτύπωση και τεχνική διπλής ανάμειξης λήψης αποτυπώματος, νέα επένδυση της τεχνικής οδοντοστοιχίας.

Δοσολογία/επεξεργασία
SILECT putty + SILECT catalyst:
Διαμορφώστε τη μάζα από putty και catalyst σε ένα μικρό κομμάτι, διπλώστε το ξανά και ζυμώστε το με τα ακροδάκτυλα. Επαναλάβετε πολλές φορές αυτή τη διαδικασία μέχρι να επιτευχθεί ένας ομοιογενής χρωματικός τόνος, αλλά για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα χρόνου ανάμειξης. Κλείνετε τομωτικά τα κομμάτια και τα συλλέγετε αμέσως μετά τη χρήση.



Το SILECT light είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται για την προτύπωση των οδοντοστοιχιών. Είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται για την προτύπωση των οδοντοστοιχιών. Είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται για την προτύπωση των οδοντοστοιχιών.

Απολύμανση
Τα εκμάνια μπορούν γενικά να απολυμανθούν με διάλυμα γλουταρικής διαλυμένης 2%. Μετά την απολύμανση, ξεπλύνετε το εκμάνιο με τρεχούμενο νερό. Στη συνέχεια απομακρύνετε το εκμάνιο. Αποβάλλετε απομακρύνετε υπόψη της υποδοχής που περιλαμβάνει τον απολυμαντικό. Συνεχίστε τη μέθοδο λουτρού επιβεβαίωσης με τα προϊόντα Dentopress MD ή Dentopress MD της εταιρείας Müller-Omnicron GmbH & Co. KG. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Γαλβανισμός
Τα εκμάνια μπορούν να επεξεργασθούν ή να επεξεργασθούν γαλβανικά στα συνήθη λουτρά.

Κατασκευή μοντέλου
Η χύτευση στο εκμάνιο είναι δυνατή ήδη αμέσως από 30 λεπτά έως 10 ημέρες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε γυμναστική κατασκευή τύπου 2 και 4 που πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 6873. Τα εκμάνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλαπλή χύτευση.

■ Οδηγίες
Υποδείξεις
SILECT
Σε περιπτώσεις που απαιτείται επεξεργασία, η επεξεργασία πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
Σε περιπτώσεις που απαιτείται επεξεργασία, η επεξεργασία πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
Σε περιπτώσεις που απαιτείται επεξεργασία, η επεξεργασία πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

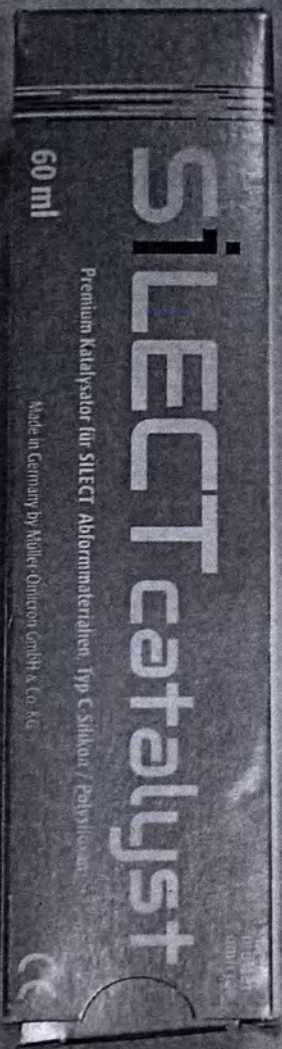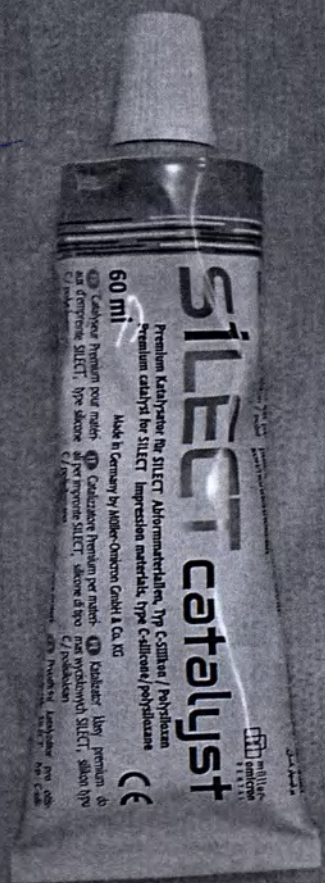

Απολυμαντική
Το εκχύλισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απολύμανση των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με το προϊόν. Για να απολυμανθεί η επιφάνεια, αρκεί να εφαρμοστεί το εκχύλισμα με ένα καθαρό πανό ή σφουγγάρι. Το εκχύλισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την απολύμανση των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του προϊόντος.

Ενδείξεις
Σταθερές και γρήγορες μερικές φορές και μερικές φορές για την απολύμανση των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με το προϊόν.

Τεχνική εφαρμογή
Κατάλληλο για δοκιμασίες απολύμανσης και τεχνική δοκιμή των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με το προϊόν. Το εκχύλισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την απολύμανση των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του προϊόντος.

Δοσολογία/επεξεργασία
SILECT putty + SILECT catalyst
SILECT putty + SILECT catalyst σε ποσότητα 1:1 (μια μέρη SILECT putty + ένα μέρος SILECT catalyst) αρκεί για να απολυμανθεί η επιφάνεια. Το εκχύλισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την απολύμανση των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του προϊόντος.

Ενδείξεις
Σταθερές και γρήγορες μερικές φορές και μερικές φορές για την απολύμανση των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με το προϊόν.

Τεχνική εφαρμογή
Κατάλληλο για δοκιμασίες απολύμανσης και τεχνική δοκιμή των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με το προϊόν. Το εκχύλισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την απολύμανση των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του προϊόντος.

Δοσολογία/επεξεργασία
SILECT putty + SILECT catalyst
SILECT putty + SILECT catalyst σε ποσότητα 1:1 (μια μέρη SILECT putty + ένα μέρος SILECT catalyst) αρκεί για να απολυμανθεί η επιφάνεια. Το εκχύλισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την απολύμανση των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του προϊόντος.

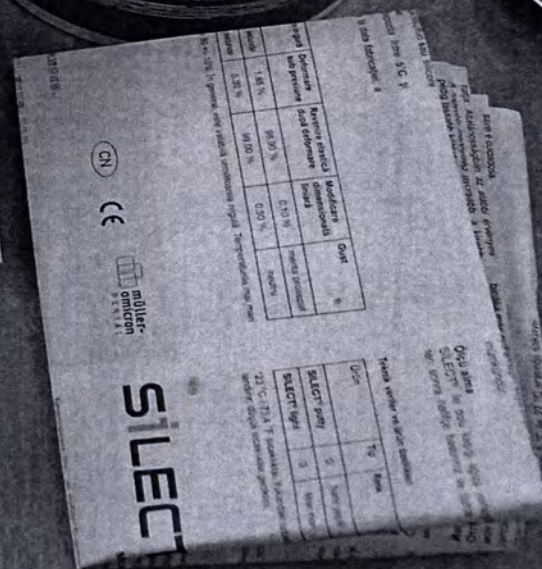
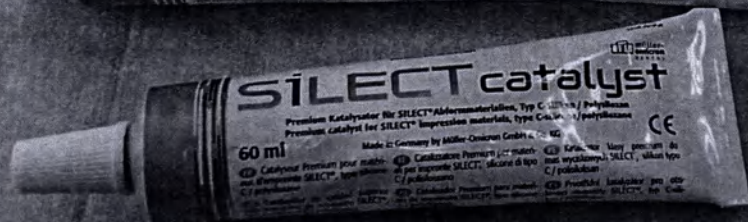




Фото 26.

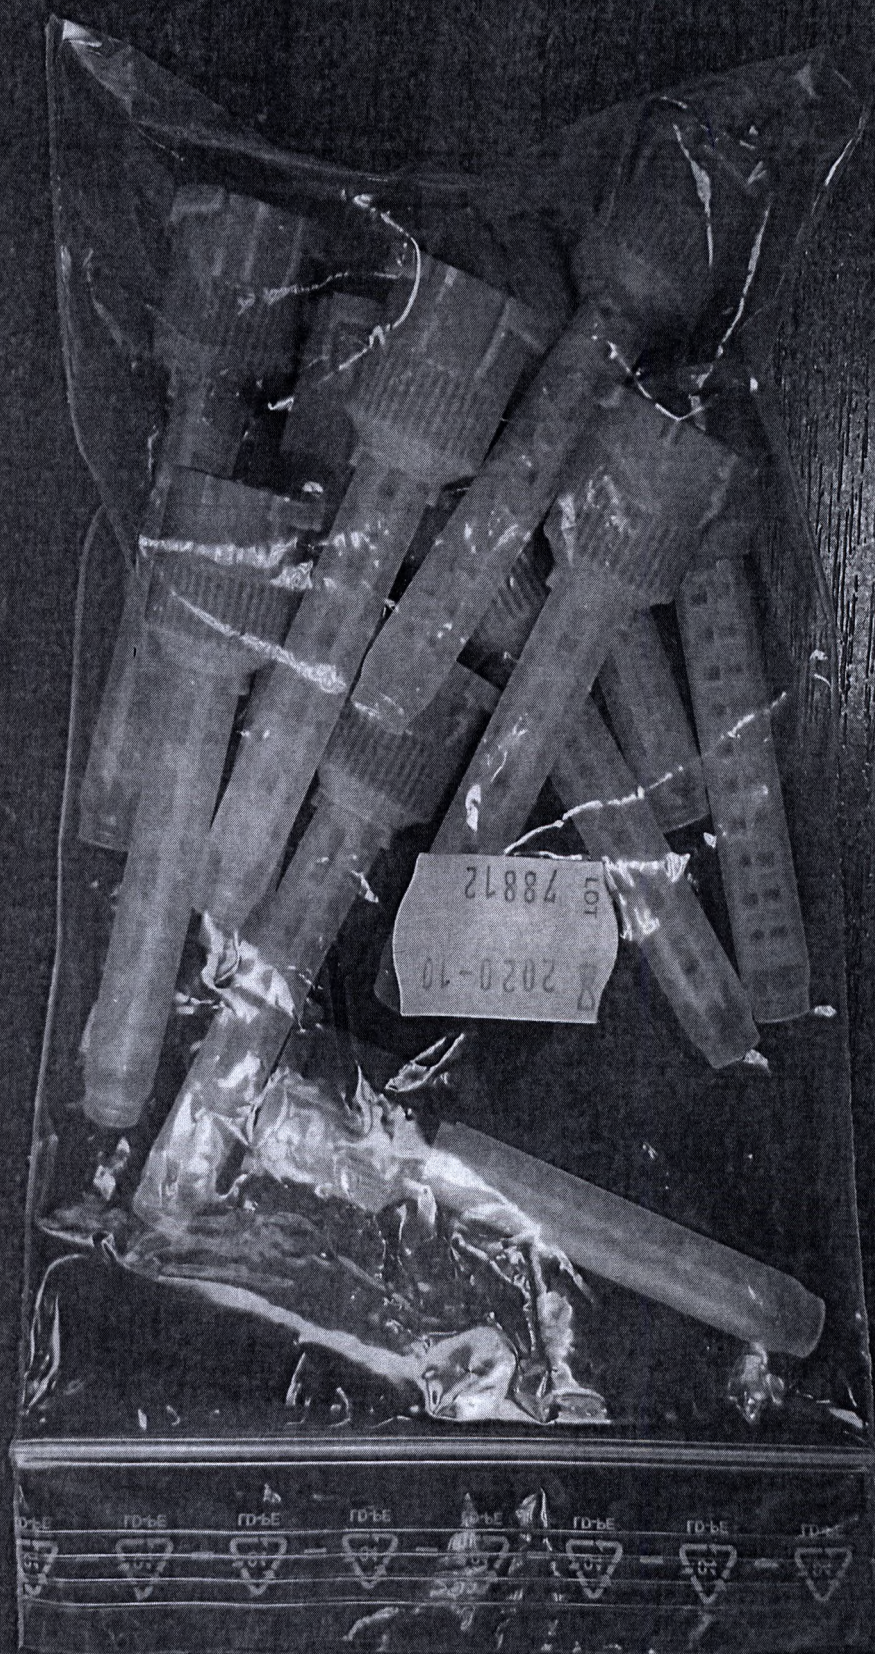




ФОТО 28.

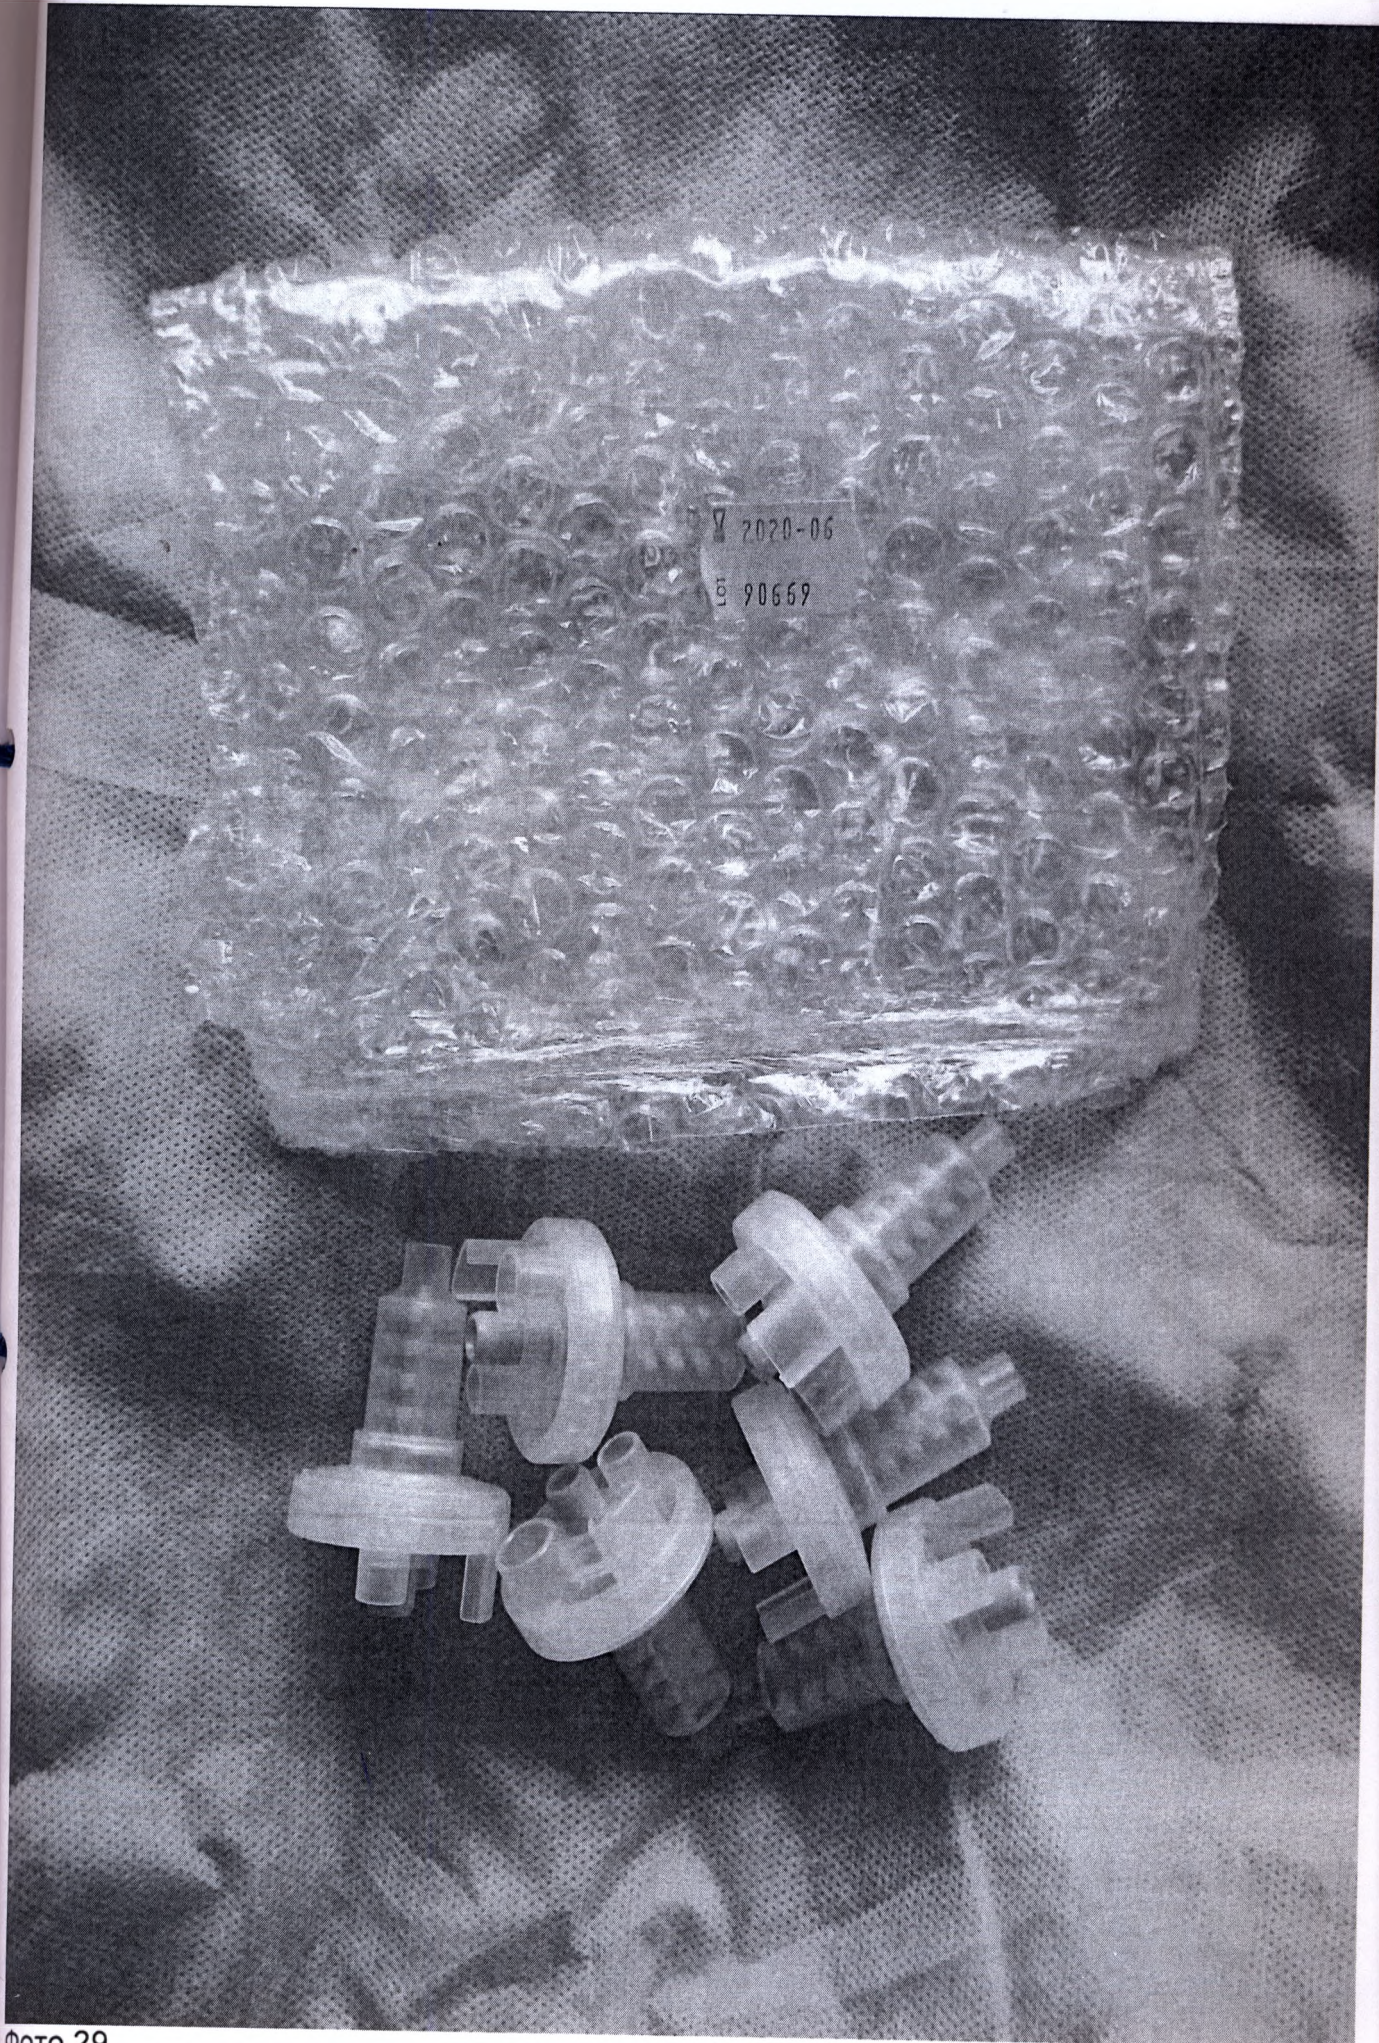


ФОТО 29.

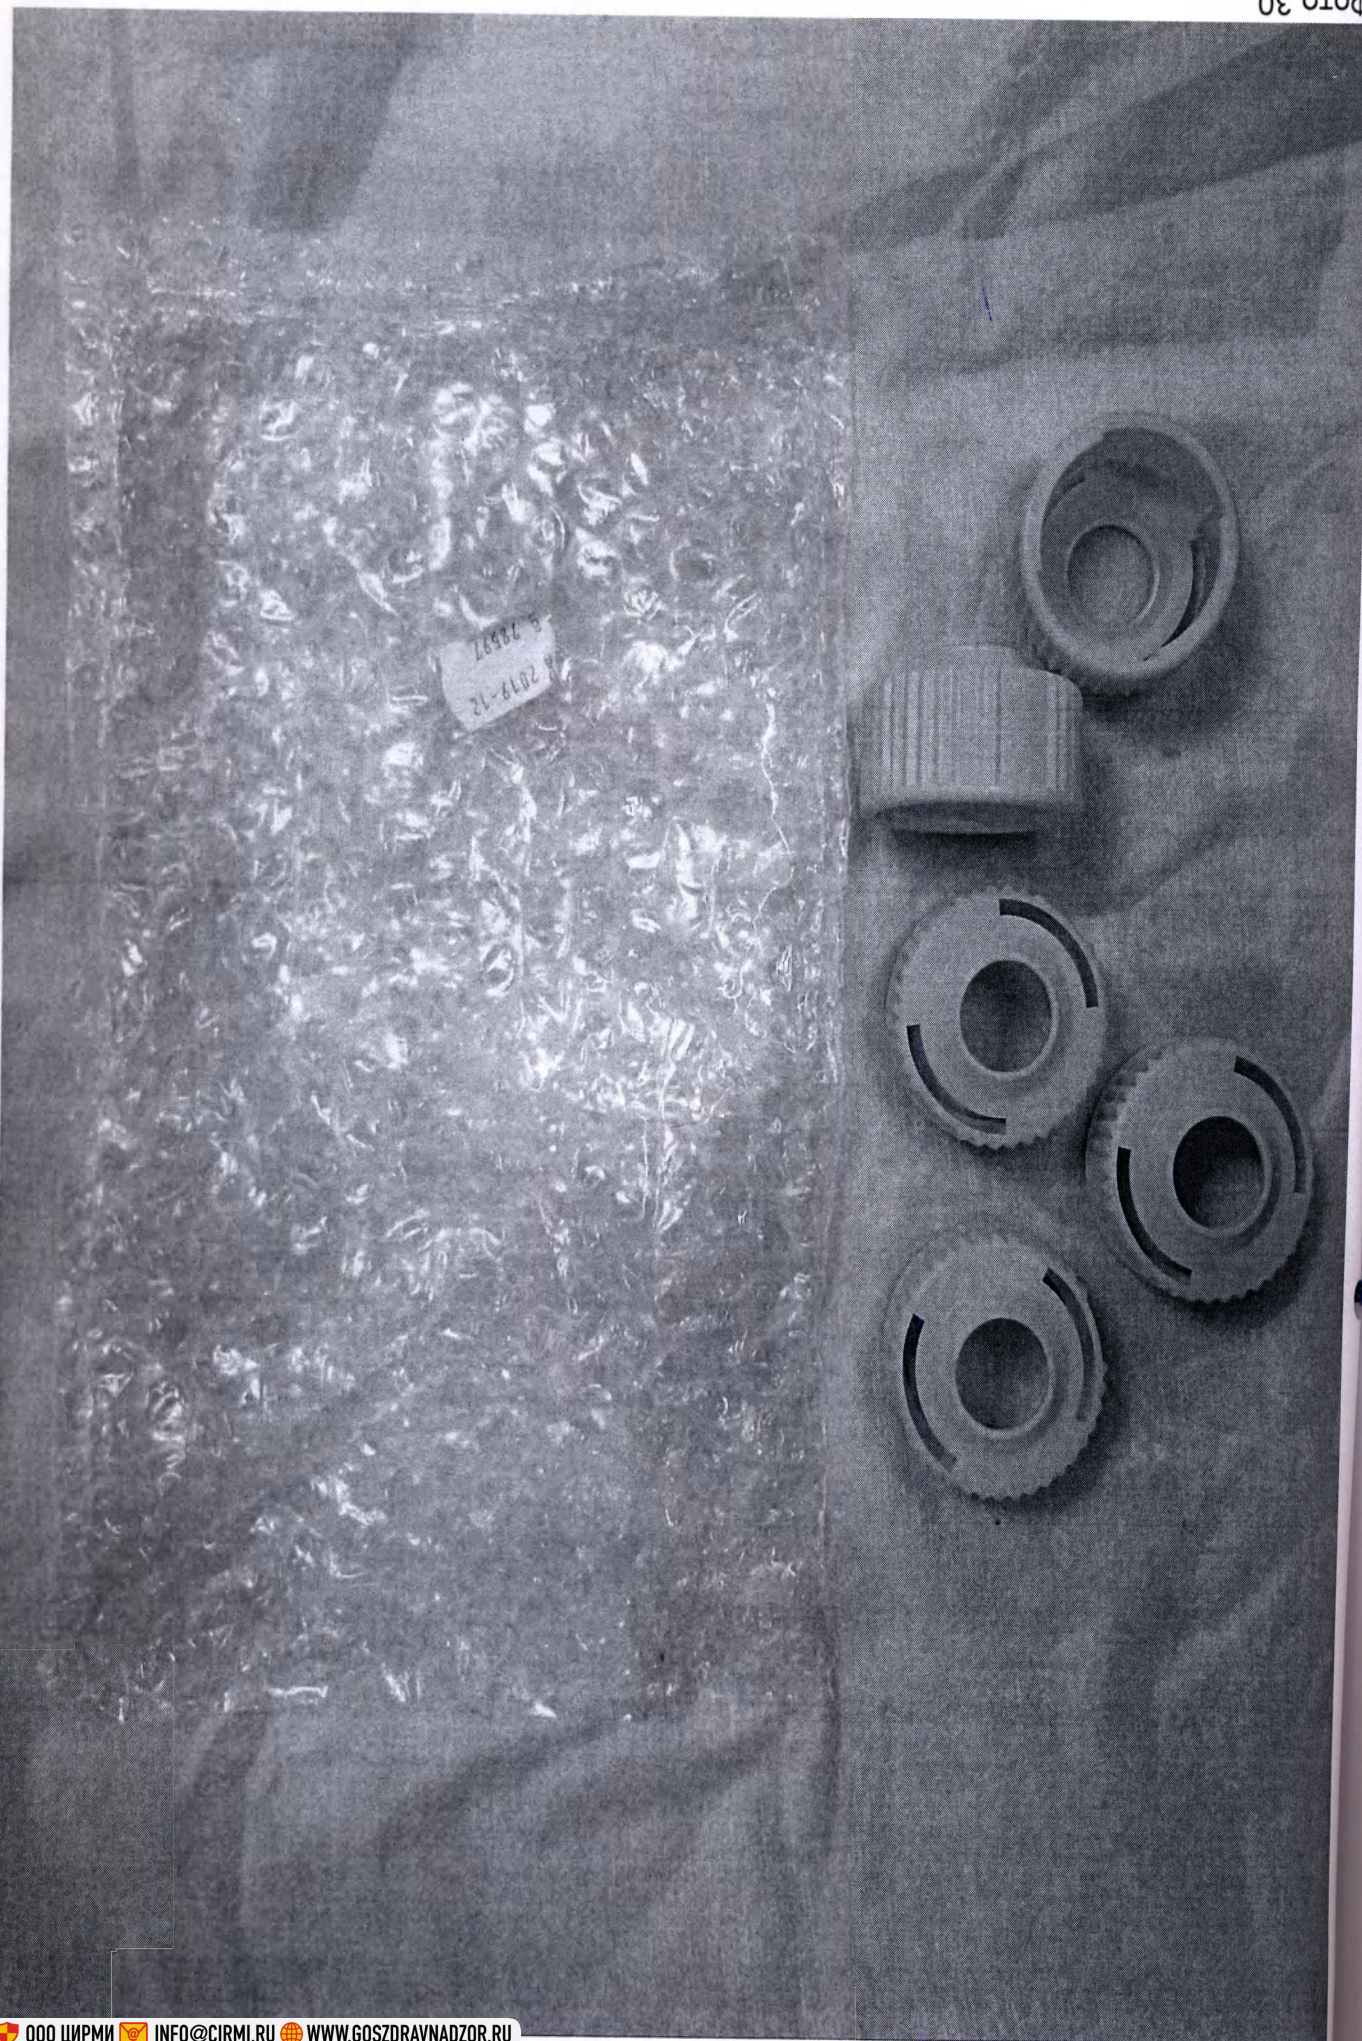




Фото 31.

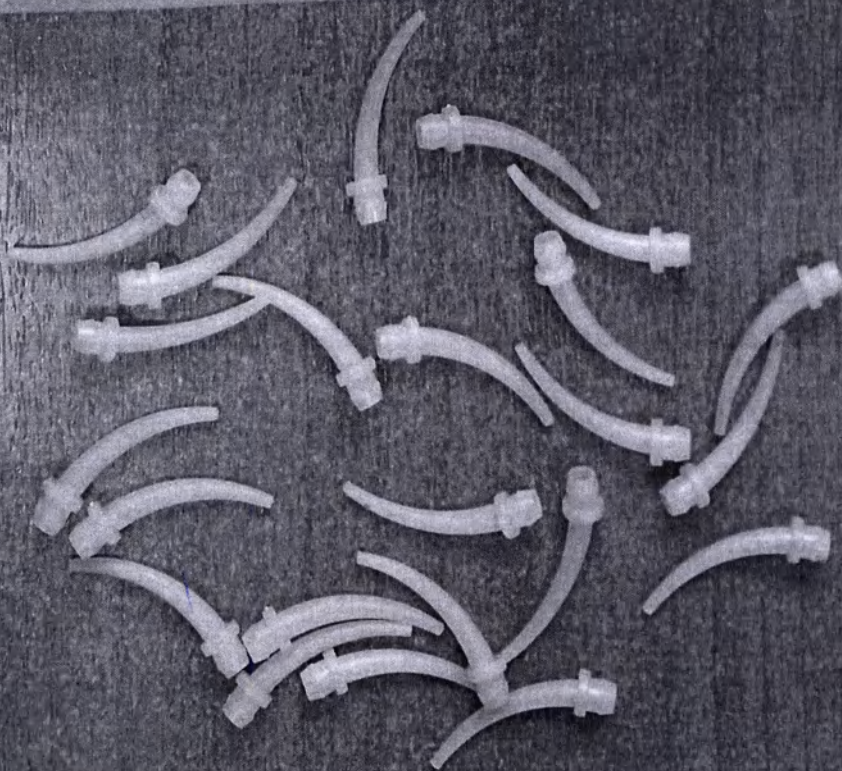


Фото 32.

Пояснение к фотографическим изображениям медицинского изделия:

Фото 1.

Материал Aqium 3D PUTTY SOFT в составе:

- компонент базовый base в банке 300 мл;
- компонент каталитический catalyst в банке 300 мл;
- ложка мерная - 2 шт;
- инструкция по применению;

Фото 2.

Материал Aqium 3D PUTTY SOFT в картридже двойном 5:1 (2 x 380 мл); инструкция по применению;

Фото 3.

Материал Aqium 3D HEAVY в картридже двойном (2 x 50 мл) в составе:

- насадка смесительная NT зеленая – 6 шт / уп;
- инструкция по применению;

Фото 4.

Материал Aqium 3D HEAVY в картридже двойном 5:1 (2 x 380 мл); инструкция по применению;

Фото 5.

Материал Aqium 3D LIGHT в картридже двойном (2 x 50 мл) в составе:

- насадка смесительная NT желтая – 12 шт / уп;
- инструкция по применению;

Фото 6.

Материал Aqium 3D MEDIUM в картридже двойном (2 x 50 мл) в составе:

- насадка смесительная NT желтая – 12 шт / уп;
- инструкция по применению;

Фото 7.

Материал Aqium 3D MONO в картридже двойном 5:1 (2 x 380 мл); инструкция по применению;

Фото 8.

Материал Aqium 3D MONO в картридже двойном 5:1 (1 x 380 мл) в составе:

- насадка смесительная 5:1 желтая – 10 шт / уп;
- колпачок фиксирующий;
- инструкция по применению;

Фото 9.

Материал Aqium 3D PUTTY STANDARD в составе:

- компонент базовый base в банке 300 мл;
- компонент каталитический catalyst в банке 300 мл;
- ложка мерная - 2 шт;
- инструкция по применению;

Фото 10.

Материал Aqium 3D PUTTY STANDARD INTRO-SET в составе:

- Aqium 3D PUTTY STANDARD base в банке 300 мл;
- Aqium 3D PUTTY STANDARD catalyst в банке 300 мл;
- ложка мерная - 2 шт;
- Aqium 3D LIGHT в картридже двойном (2 x 50 мл);
- насадка смесительная NT желтая – 12 шт / уп;
- насадка интраоральная желтая – 12 шт / уп;

- инструкция по применению;

Фото 11.

Материал Aqium 3D PUTTY SOFT INTRO-SET в составе:

- Aqium 3D PUTTY SOFT base в банке 300 мл;
- Aqium 3D PUTTY SOFT catalyst в банке 300 мл;
- ложка мерная - 2 шт;
- Aqium 3D LIGHT в картридже двойном (2 x 50 мл);
- насадка смесительная NT желтая – 12 шт / уп;
- насадка интраоральная желтая – 12 шт / уп;
- инструкция по применению;

Фото 12.

Материал Aqium 3D BITE в картридже двойном (2 x 50 мл) в составе:

- насадка смесительная NT зеленая – 12 шт / уп;
- инструкция по применению;

Фото 13.

Материал toras PERFECT A85 в картридже двойном (2 x 50 мл) в составе:

- насадка смесительная зеленая – 12 шт / уп;
- инструкция по применению;

Фото 14.

Материал toras PERFECT A85 в картридже двойном (6 x 50 мл) в составе:

- насадка смесительная зеленая – 36 шт / уп;
- инструкция по применению;

Фото 15.

Материал kristall PERFECT A70 в картридже двойном (2 x 50 мл) в составе:

- насадка смесительная зеленая – 12 шт / уп;
- инструкция по применению;

Фото 16.

Материал kristall PERFECT A70 в картридже двойном (6x 50 мл) в составе:

- насадка смесительная зеленая – 36 шт / уп;
- инструкция по применению;

Фото 17.

Материал betasil VARIO IMPLANT в картридже двойном 5:1 (1 x 380 мл) в составе:

- насадка смесительная 5:1 желтая - 10 шт / уп;
- колпачок фиксирующий;
- инструкция по применению;

Фото 18.

Материал betasil VARIO IMPLANT в картридже двойном 5:1 (2 x 380 мл) в составе:

- колпачок фиксирующий;
- инструкция по применению;

Фото 19.

Материал betasil VARIO IMPLANT в картридже двойном (2 x 50 мл) в составе:

- насадка смесительная зеленая - 6 шт / уп;
- инструкция по применению.

Фото 20.

Материал betasil VARIO HEAVY в картридже двойном 5:1 (2 x 380 мл); инструкция по применению;

Фото 21.

Материал betasil VARIO HEAVY в картридже двойном (2 x 50 мл) в составе:

- насадка смесительная зеленая - 6 шт / уп;
- инструкция по применению;

Фото 22.

Материал SILECT putty в банке 910 мл в составе:

- ложка мерная;
- инструкция по применению;

Фото 23.

Материал SILECT light в тубе 140 мл; инструкция по применению;

Фото 24.

Материал SILECT catalyst в тубе 60 мл; инструкция по применению;

Фото 25.

Материал SILECT-Set в составе:

- SILECT putty в банке 910 мл;
- ложка мерная;
- SILECT light в тубе 140 мл;
- SILECT catalyst в тубе 60 мл;
- инструкция по применению.

Фото 26.

Принадлежность:

насадка смесительная зеленая

(к материалам: Aqium 3D HEAVY в картридже двойном (2 x 50 мл); Aqium 3D BITE в картридже двойном (2 x 50 мл))

Фото 27.

Принадлежность:

насадка смесительная NT зеленая

(к материалам: topas PERFECT A85 в картридже двойном (2 x 50 мл); topas PERFECT A85 в картридже двойном (6 x 50 мл); kristall PERFECT A70 в картридже двойном (2 x 50 мл); kristall PERFECT A70 в картридже двойном (6x 50 мл); betasil VARIO IMPLANT в картридже двойном (2 x 50 мл); betasil VARIO HEAVY в картридже двойном (2 x 50 мл));

Фото 28.

Принадлежность:

насадка смесительная желтая

(к материалам: Aqium 3D LIGHT в картридже двойном (2 x 50 мл); Aqium 3D MEDIUM в картридже двойном (2 x 50 мл))

Фото 29.

Принадлежность:

насадка смесительная 5:1 желтая

(к материалам: Aqium 3D PUTTY SOFT в картридже двойном 5:1 (2 x 380 мл); Aqium 3D HEAVY в картридже двойном 5:1 (2 x 380 мл); Aqium 3D MONO в картридже двойном 5:1 (2 x 380 мл); betasil VARIO IMPLANT в картридже двойном 5:1 (2 x 380 мл); betasil VARIO HEAVY в картридже двойном 5:1 (2 x 380 мл))

Фото 30.

Принадлежность:

колпачок фиксирующий

(к материалам: Aqium 3D PUTTY SOFT в картридже двойном 5:1 (2 x 380 мл); Aqium 3D HEAVY в картридже двойном 5:1 (2 x 380 мл); Aqium 3D MONO в картридже двойном 5:1 (2 x 380 мл); betasil VARIO HEAVY в картридже двойном 5:1 (2 x 380 мл)).

Фото 31.

Принадлежность:

насадка интраоральная жёлтая

(к материалам: Aqium 3D LIGHT в картридже двойном (2 x 50 мл); Aqium 3D MEDIUM в картридже двойном (2 x 50 мл))

Фото 32.

Принадлежность:

насадка интраоральная прозрачная

(к материалам: kristall PERFECT A70 в картридже двойном (2 x 50 мл); kristall PERFECT A70 в картридже двойном (6x 50 мл))

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

37

лист(ов)

Ген. директор
Роспотребнадзора И.А.

