


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Цитометр проточный AQUIOS CL, в составе:

1. Аналитический блок цитометра в комплекте с:
 - 1.1. Тележка подачи – 1 шт.
 - 1.2. Кабель питания C13 под установку вилки (с зачищенными проводами) – 1 шт.
 - 1.3. Источник бесперебойного питания 800 ВА – 1 шт.
 - 1.4. Кабель питания, C14-C13, 2 метра – до 5 шт.
 - 1.5. Кабели для подключения к источнику бесперебойного питания – до 5 шт.
 - 1.6. Штатив для пробирок на 40 позиций – 1 шт.
 - 1.7. Контейнер для отходов (в комплекте: пластиковый контейнер, крышка контейнера, картонная коробка) – 1 шт.
 - 1.8. Пробирки прозрачные 4 мл с круглым дном – до 5 уп. из 25 шт.
 - 1.9. Бутылка прозрачная 37 мл (1.25 жидкая унция) – до 5 уп. из 2 шт.
 - 1.10. Глубоколуночные планшеты на 96 лунок – 1 уп. из 10 шт.
 - 1.11. Карусель для реагентов – 1 шт.
 - 1.12. Кабель USB – до 5 шт.
 - 1.13. Кабель питания для источника бесперебойного питания – до 5 шт.
 - 1.14. Сборка трубок и кабелей с датчиком уровня жидкости для изотонического раствора, в составе:
 - Кабель – 1 шт.;
 - Датчик уровня жидкости для изотонического раствора – 1 шт.;
 - Трубка – 5 шт.
 - 1.15. Сборка трубок и кабелей с датчиком уровня жидкости для отходов, в составе:
 - Кабель – 1 шт.;
 - Датчик уровня жидкости для отходов – 1 шт.;
 - Трубка – 1 шт.
2. Рабочая станция в составе:
 - 2.1. Компьютер-моноблок со встроенным монитором – 1 шт.
 - 2.2. Манипулятор «мышь» – 1 шт.
 - 2.3. Клавиатура – 1 шт.
 - 2.4. Руководство по программному обеспечению системы AQUIOS Tetra – до 5 шт.
 - 2.5. Лицензия Microsoft office – 1 шт.
 - 2.6. Крышка декоративная с набором креплений – 1 шт.
 - 2.7. Флеш-накопитель для восстановления системы – 1 шт.
 - 2.8. Кабель питания – 1 шт.
3. Программное обеспечение для проточного цитометра:
 - 3.1. CD-диск – до 5 шт.
4. Кассета тип 1, для пробирок диаметром 13 мм и длиной 75 мм – до 20 шт. (при необходимости);
5. Кассета тип 2, для пробирок диаметром 13 мм и длиной 100 мм – до 20 шт. (при необходимости);
6. Кассета тип 3, для пробирок диаметром 16 мм и длиной 100 мм – до 20 шт. (при необходимости);
7. Кассета тип 4, для пробирок диаметром 10.25 мм и длиной 50 мм – до 20 шт. (при необходимости);
8. Кассета тип 5, для контрольных материалов – до 5 шт. (при необходимости);

9. Кассета тип 6, для пробирок SARSTEDT диаметром 13 мм и длиной 75 мм – до 20 шт. (при необходимости);
10. Кассета тип 7, для пробирок SARSTEDT диаметром 13 мм и длиной 90 мм – до 20 шт. (при необходимости);
11. Кассета тип 8, для пробирок SARSTEDT диаметром 11 мм и длиной 66 мм – до 20 шт. (при необходимости);
12. Кассета тип 9, для пробирок SARSTEDT диаметром 15 мм и длиной 92 мм – до 20 шт. (при необходимости);
13. Кассета тип 10, для пробирок SARSTEDT диаметром 13 мм и длиной 65 мм – до 20 шт. (при необходимости);
14. Глубоколуночные планшеты на 96 лунок – упаковка из 50 шт. – до 20 шт. (при необходимости);
15. Принтер (при необходимости);
16. Руководство пользователя проточного цитометра Aquios (при необходимости);

Фотография 1 – Цитометр проточный AQUIOS CL. Фотография общего вида.

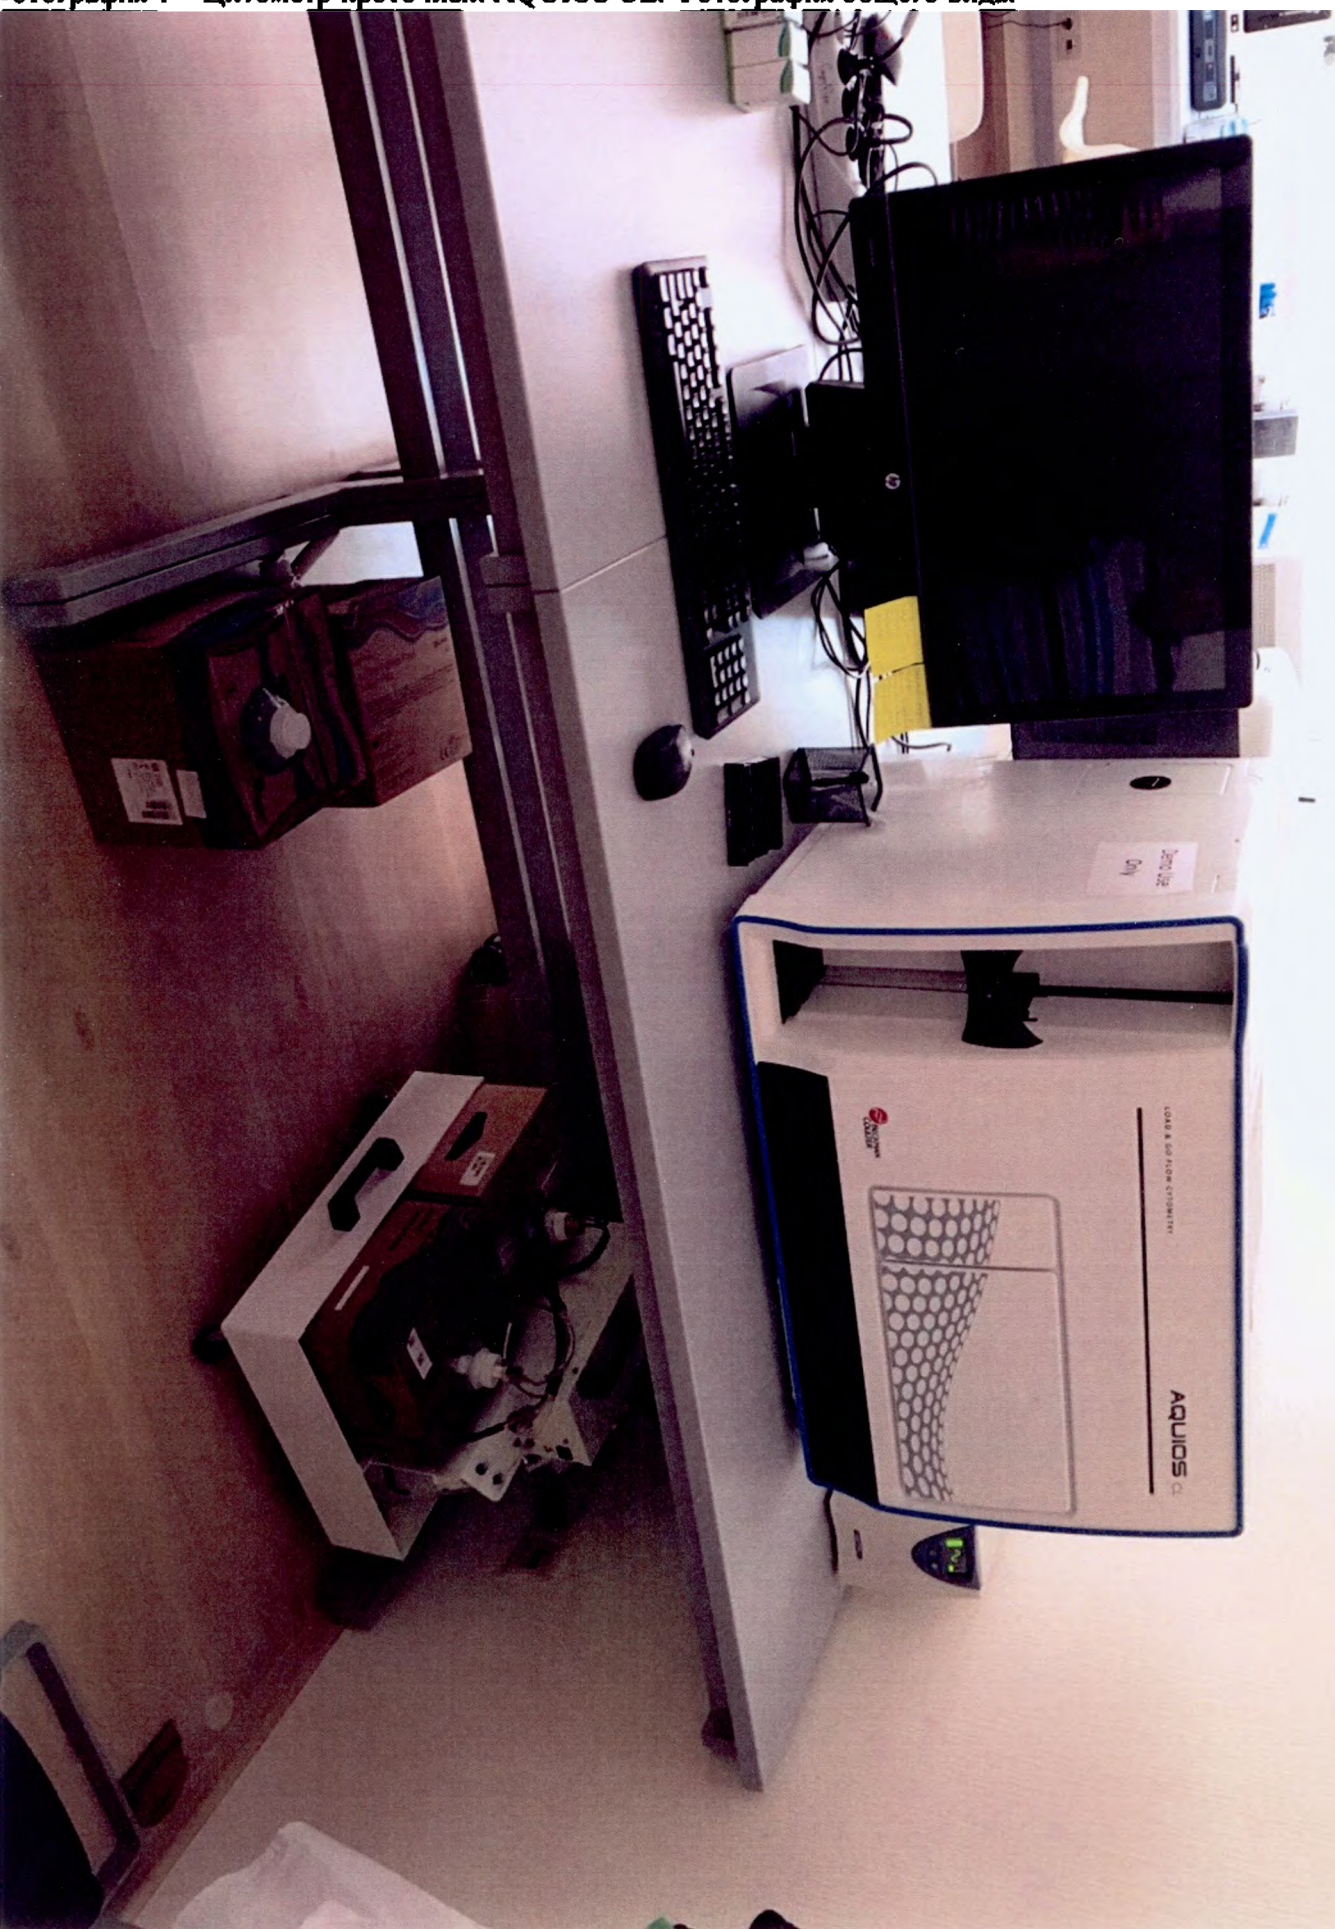


Фотография 2.1 – Аналитический блок цитометра.



фотография 2.2 – Маркировка аналитического блока цитометра.



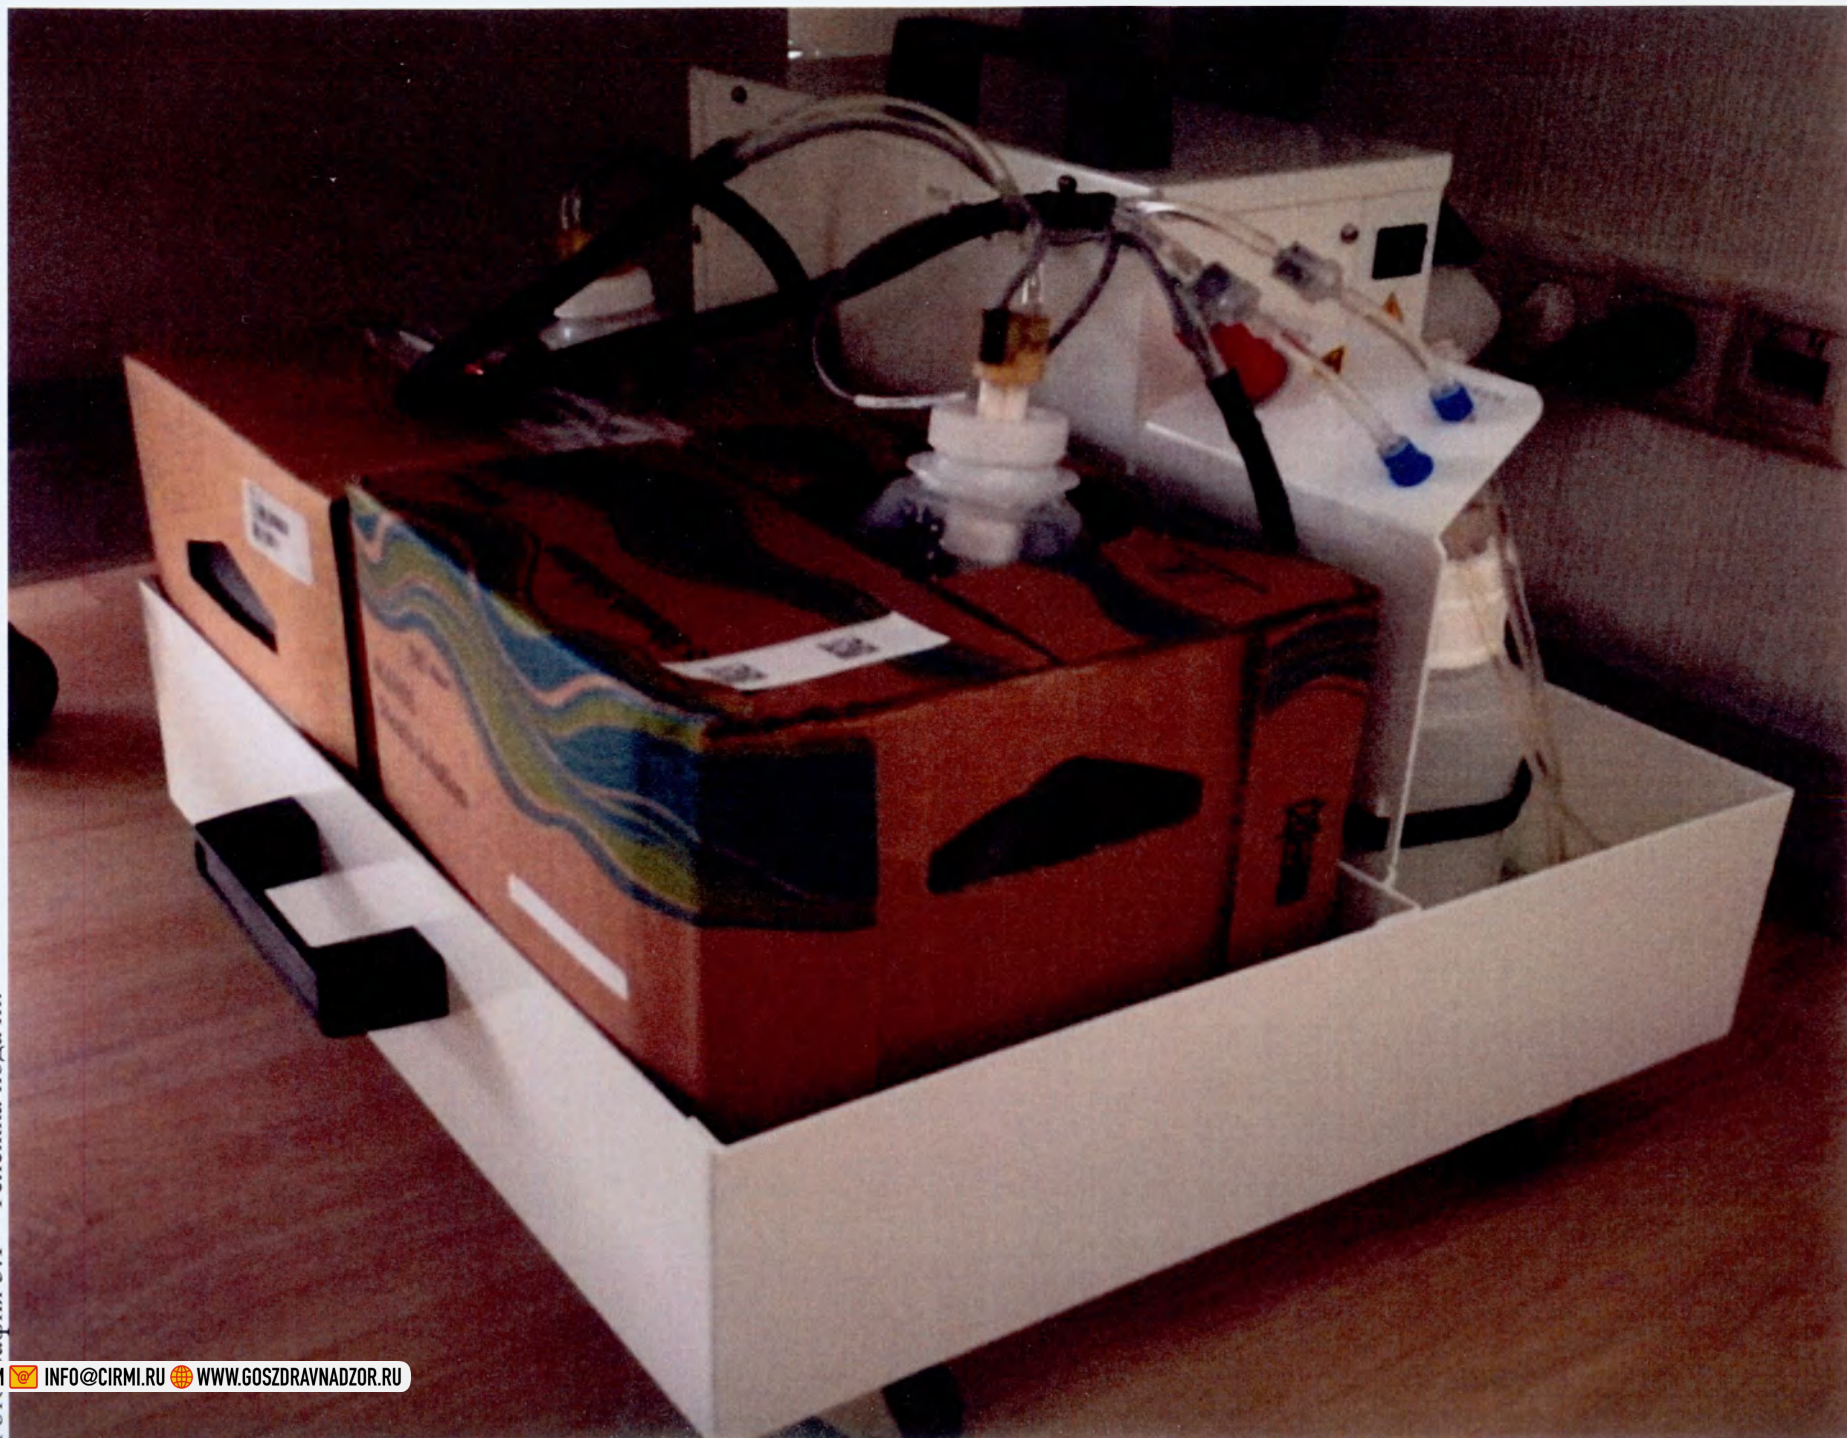

Фотография 3.2 – Маркировка тележки для подачи.



Assembly No.

B38110

Model


ASSY:PUMP CABINET, AQUIOS

Bockman Coulter Inc.
250 S. Kraemer Blvd.
Brea, CA 92821

Made in U.S.A.

08/05/2016 10:09


Фотография 4 – Кабель питания С13 под установку вилки (с зачищенными проводами).

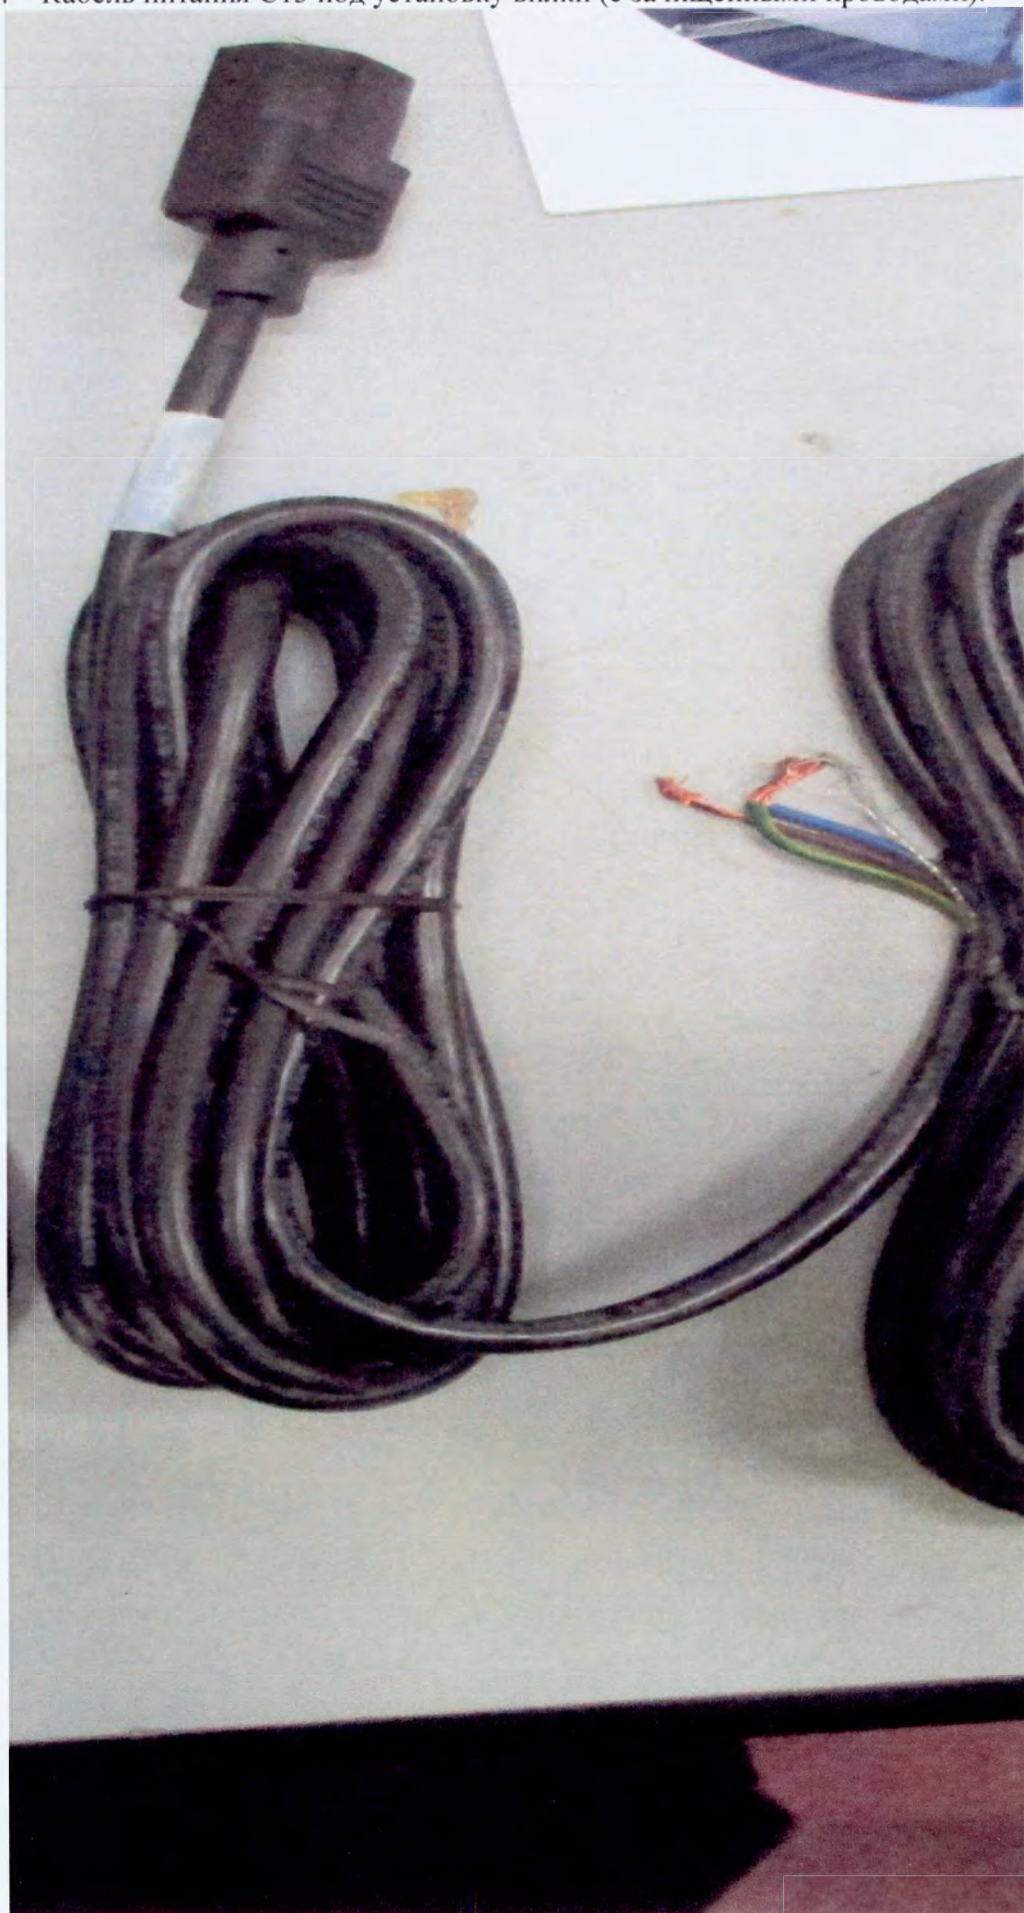

Фотография 5.1 – Источник бесперебойного питания 800 ВА.




Фотография 5.2 – Маркировка источника бесперебойного питания..

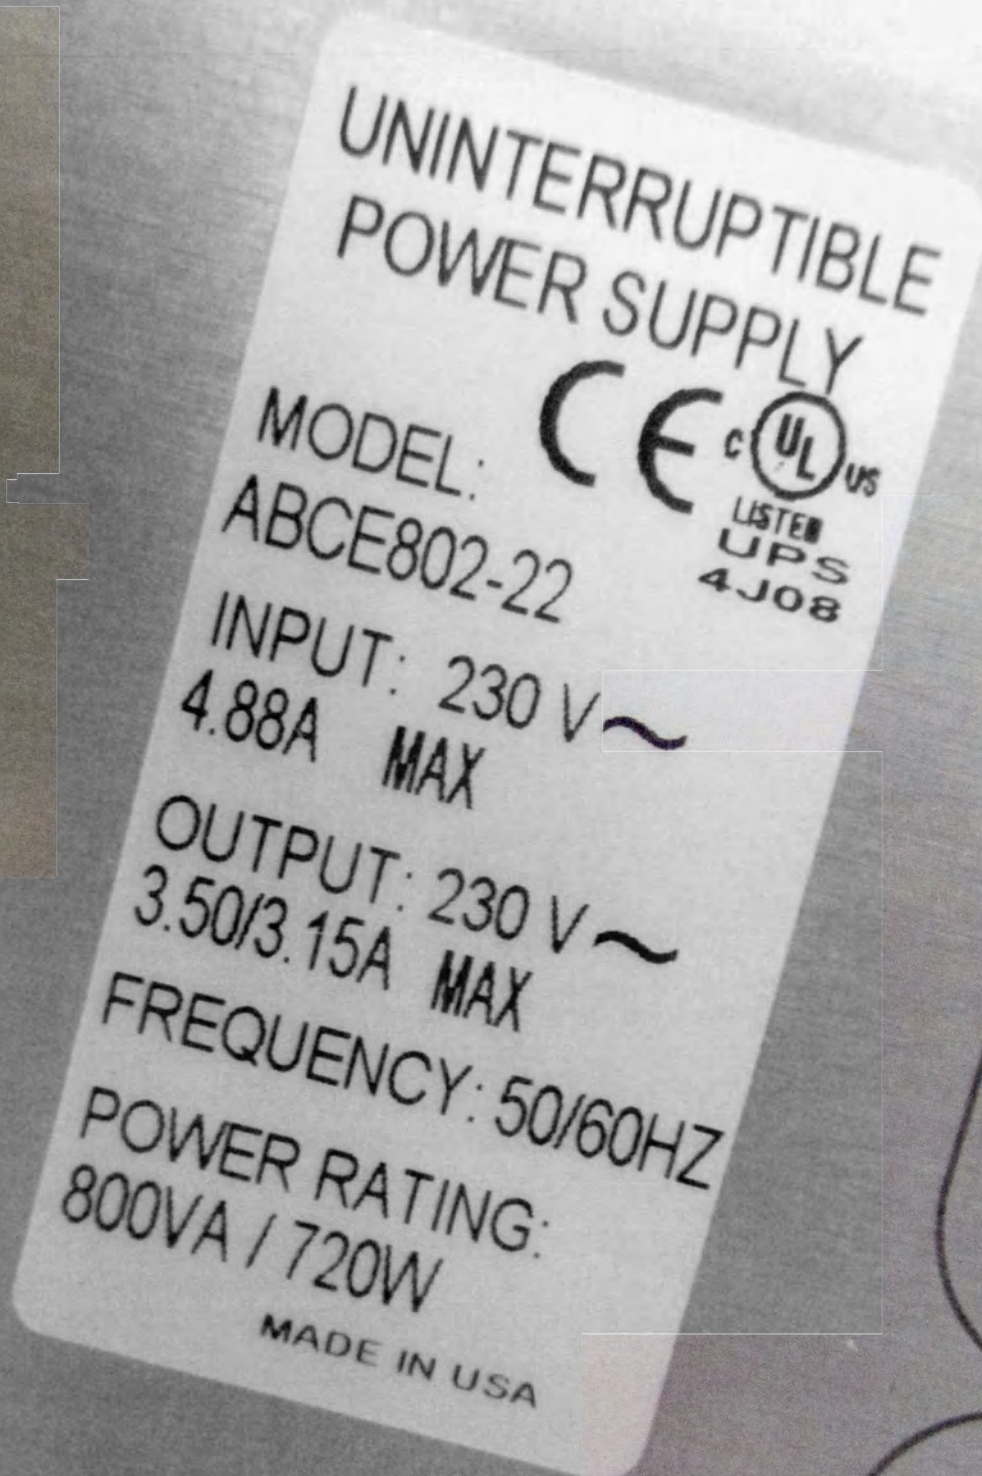

08/05/2016 10:05

Фотография 6 - Кабель питания, C14-C13, 2 метра.

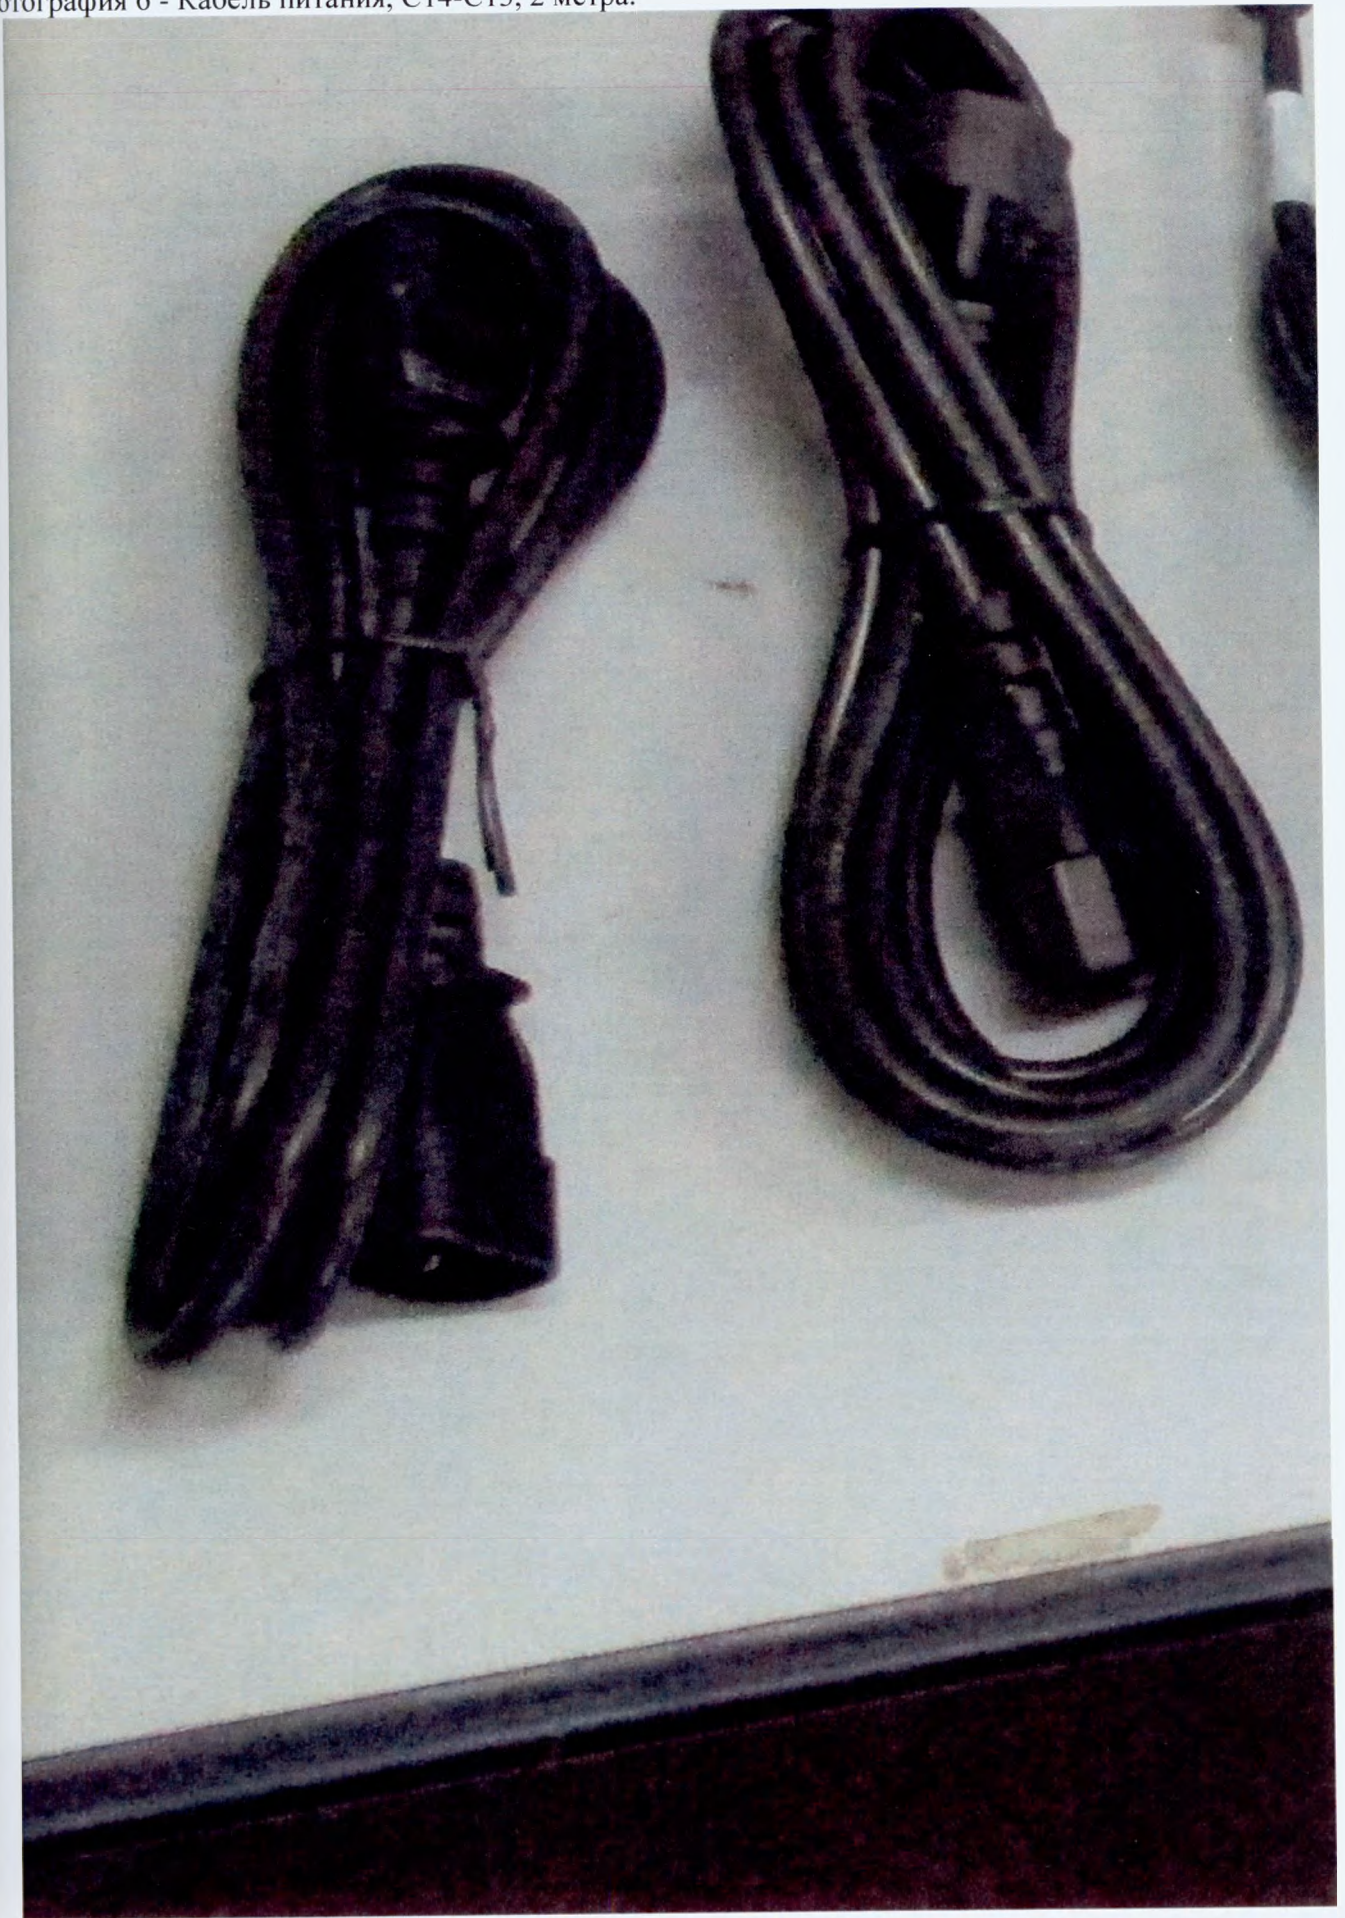

Фотография 7 – Кабели для подключения к источнику бесперебойного питания.






REF

178696

40 TUBE HOLDER

Revision: BA



2016-03-25

Quantity: 1



(01)15099590573737

(11)160325

(30)00001



+H6281786961Q



+\$\$\$900001720160325BAQU

Made in USA of US and foreign components

08/05/2016 10:19

Фотография 9 – Контейнер для отходов (в комплекте: пластиковый контейнер, крышка контейнера, картонная коробка). Вид сверху.



Фотография 10 – Контейнер для отходов (в комплекте: пластиковый контейнер, крышка контейнера, картонная коробка). Общий вид.



Фотография 11 – Пробирки прозрачные 4 мл с круглым дном. Вид сбоку.



08/05/2016 10:21



REF

B42830

Revision: AB

ASSY, 25 EA B39982 LAB EQUIP, TU



2016-03-25

Quantity: 1



08/05/2016 10:21

Фотография 13 – Бутыль прозрачная 37 мл (1.25 жидкая унция).



Фотография 14 – Глубоколоночные планшеты на 96 лунок.



Фотография 15 – Карусель для реагентов.



08/05/2016 10:20

Фотография 16 – Кабель USB.



Фотография 17 – Кабель питания для источника бесперебойного питания.



Фотография 18.1 – Сборка трубок и кабелей с датчиком уровня жидкости для изотонического раствора,
в составе: Кабель – 1 шт.; Датчик уровня жидкости для изотонического раствора – 1 шт.; Трубка – 5
шт.




Фотография 18.2 – Маркировка Сборки трубок и кабелей с датчиком уровня жидкости для изотонического раствора, в составе: Кабель – 1 шт.; Датчик уровня жидкости для изотонического раствора – 1 шт.; Трубка – 5 шт.



Фотография 19.1 – Сборка трубок и кабелей с датчиком уровня жидкости для отходов, в составе: Кабель – 1 шт.; Датчик уровня жидкости для отходов – 1 шт.; Трубка – 1 шт.



Фотография 19.2 – Маркировка Сборки трубок и кабелей с датчиком уровня жидкости для отходов, в составе: Кабель – 1 шт.; Датчик уровня жидкости для отходов – 1 шт.; Трубка – 1 шт.

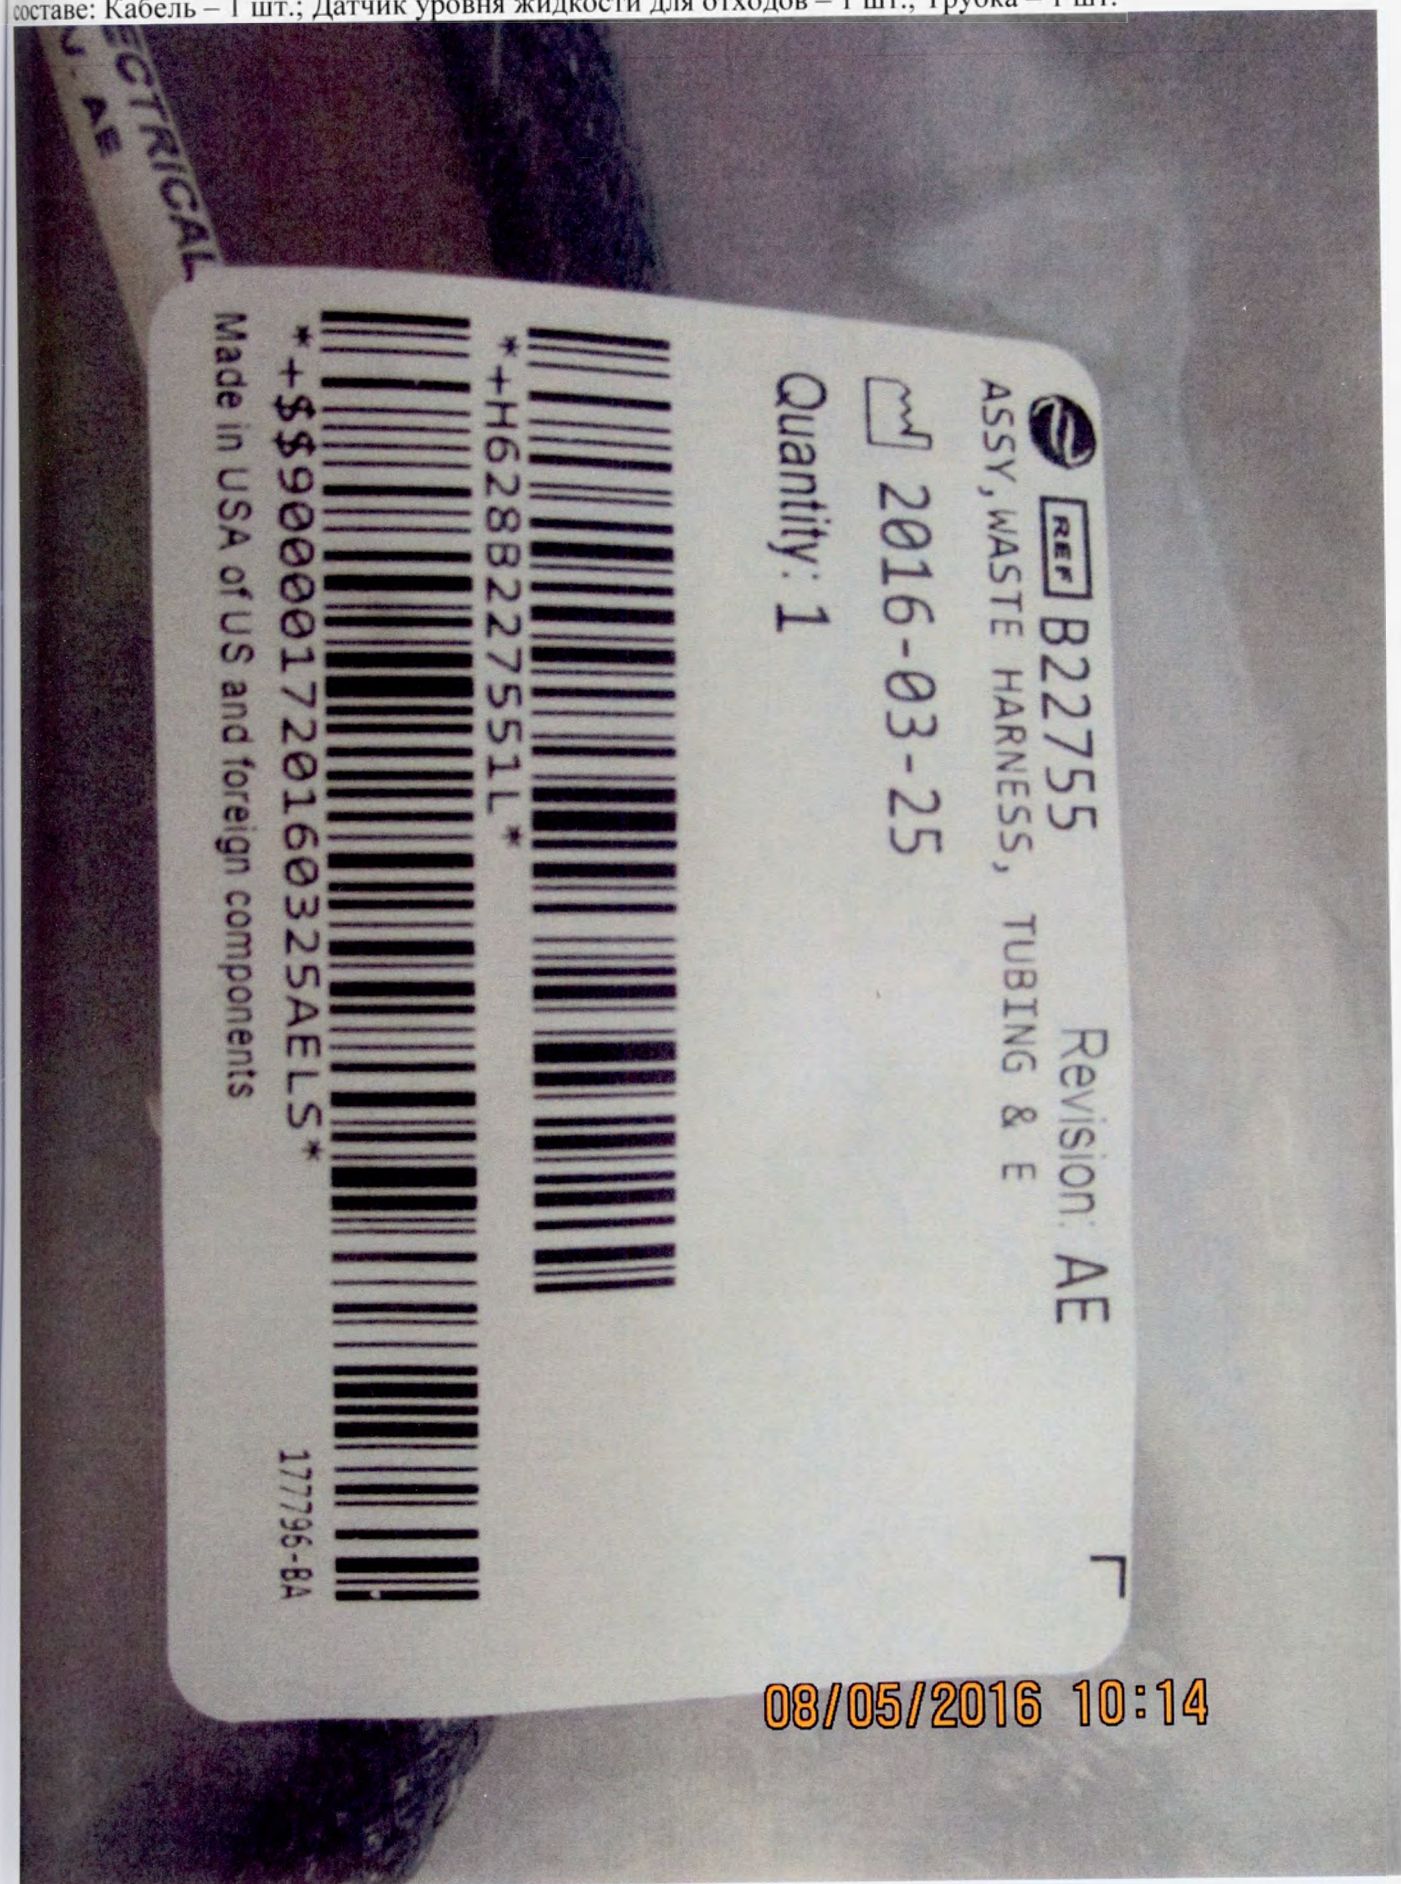

Фотография 20 - Рабочая станция. Общий вид.



Фотография 21.1 – Компьютер-моноблок со встроенным монитором.





COMPUTER SYS; I7 AQUIOS AIO
TOUCHSCREEN WORKSTATION, EXCEL


A Contec Company

BCI P/N: B58225 Rev: AC

DTx T/N: 16F46184

DTx S/N: BCM0216F46184

DTx P/N: 90855

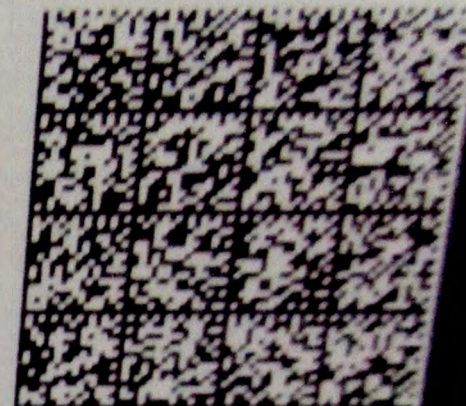

1800 Penn Street * Suite 1 * Melbourne * FL * 32901

DTxSN: BCM0216F46184

HP_SN: MXL60512DN


Product Key: NRWKD-CVG2T-MKPPGG-YB6WQ-RJM23

Confirmation ID:

167171	882731	496503	604656
395636	195725	352286	835731

08/05/2016 09:58

Фотография 22 – Манипулятор «мышь».

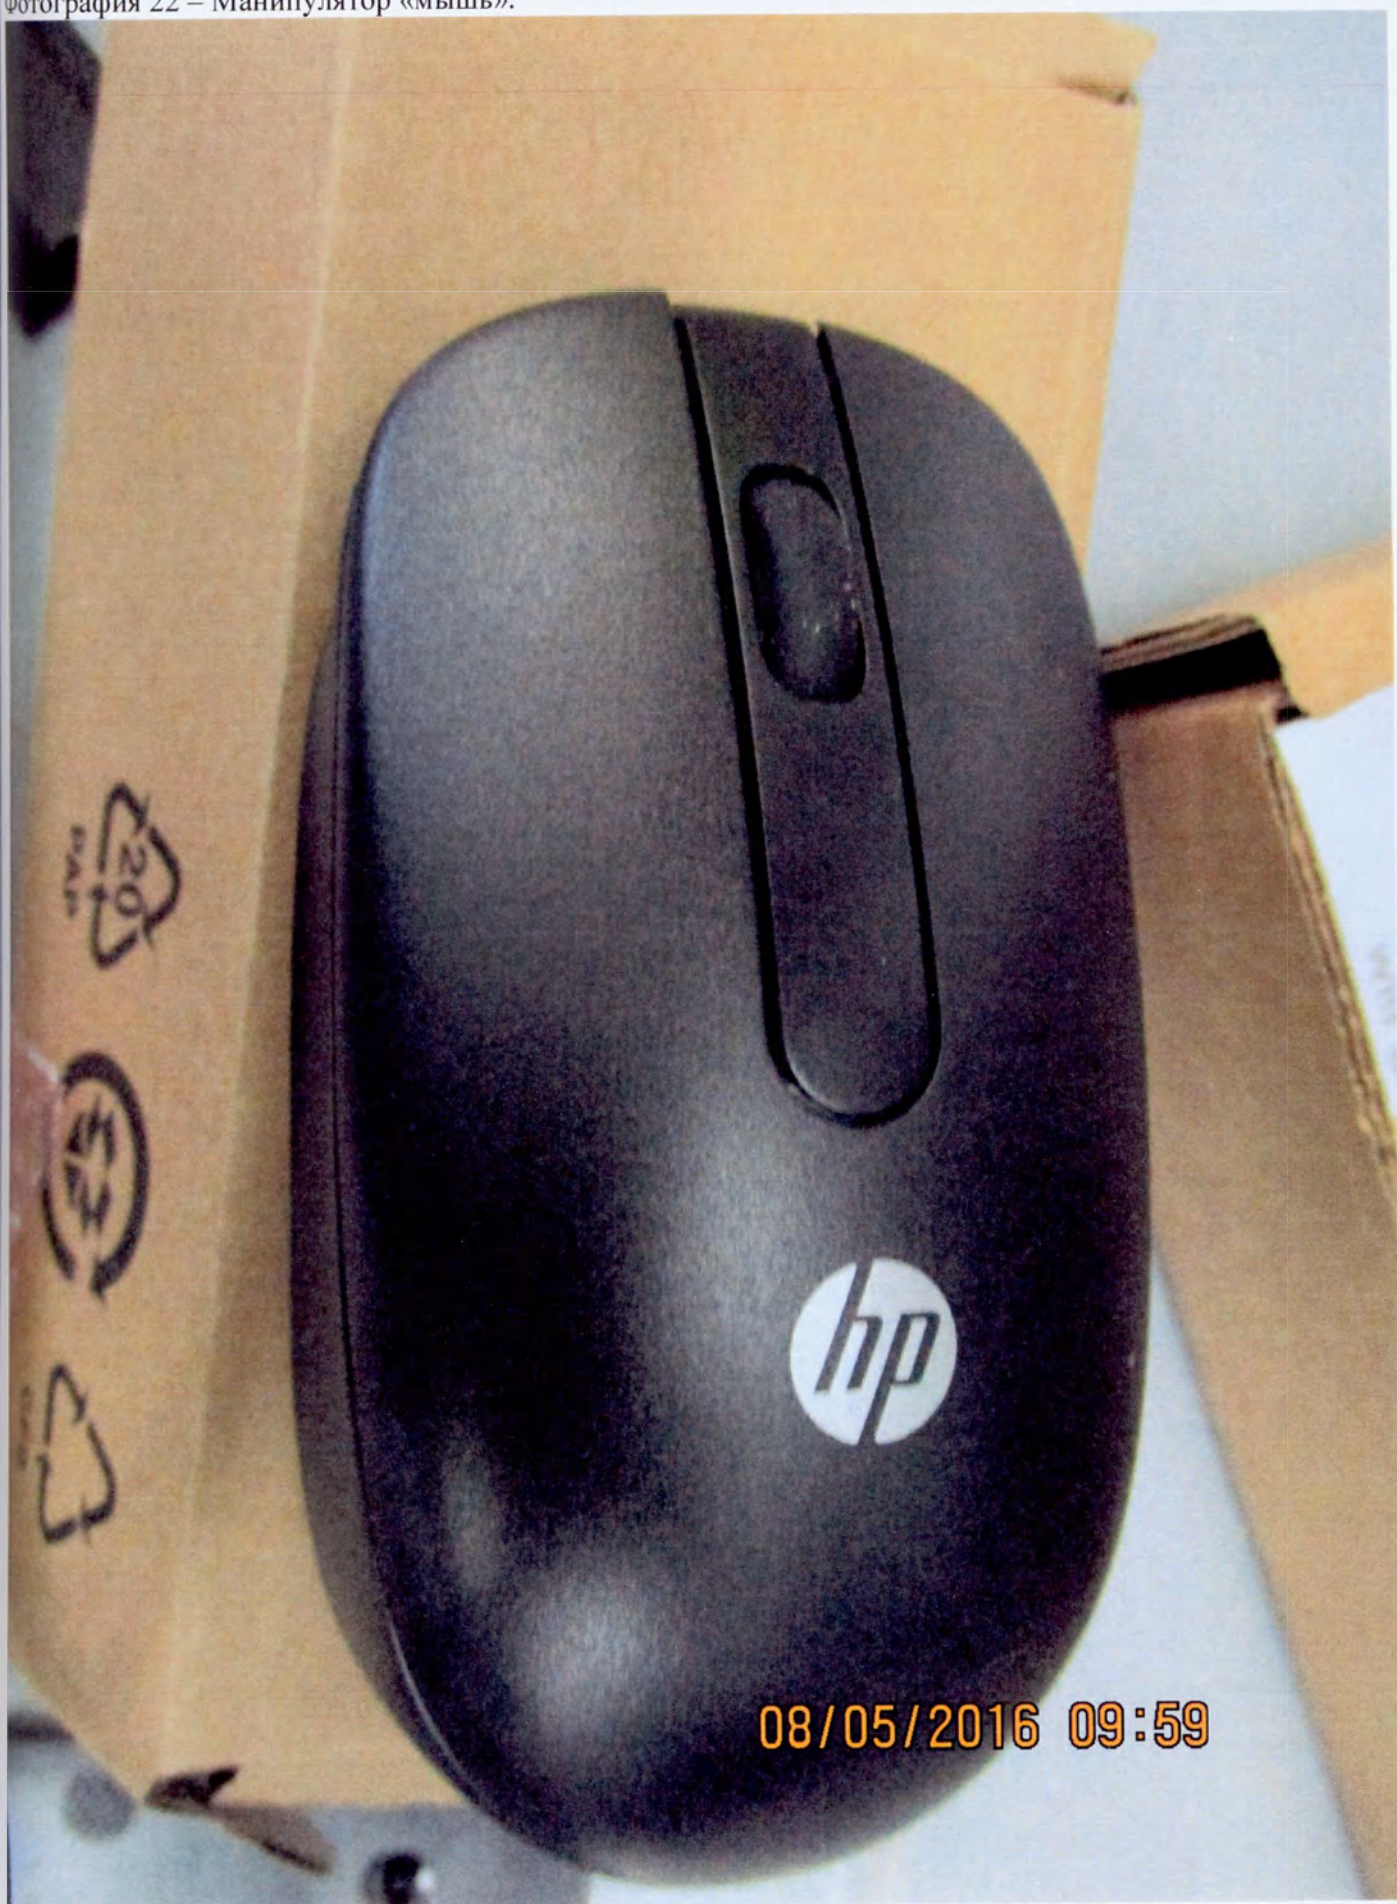



08/05/2016 09:58



HP Wireless Keyboard
HP 無線鍵盤/无线键盘

Model No.(型號/型号) : KBRF57711

Rating(額定/额定) : 3V --- 20mA

FCC ID : EMJKKBRF57711

IC : 4251A-KKBRF57711

CNC : C-10237

SCT : RCPHPKB120112

CMIIT ID : 2011DJ8080

CCAI11LP3040T4

Made in China

中國製造/中国制造



E134780 2G55
I.T.E. ACCESSORY
US LISTED



www.tuv.com
ID 1000000000



0012-12-3596



(01)07898940474028

HP, HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany



R41108 004



KCC-CRM-PMX-KKBRF57711

당해 무선설비는 운용 중

전파혼신 가능성이 있음

인용받은 자의 상호 : PRIMAX ELECTRONICS LTD.

제조사/제조국가 : PRIMAX ELECTRONICS LTD./중국




201 WW
11215506



MCMC
CIDF15000435

HP P/N:672648-003 Spare P/N:724722-001

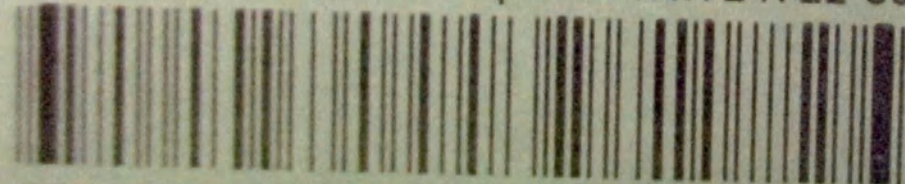

CT: BDMKA0DHH9Q2VD

08/05/2016 09:59

08/05/2016 10:23



May 15, 2014

Product Announcement Letter
AQUIOS CL Flow Cytometer

Dear Beckman Coulter Customer:

Congratulations on your purchase of an AQUIOS CL Flow Cytometry System with AQUIOS System Software.

We are pleased to announce that all AQUIOS flow cytometry instrument, reagent, and control documentation is now available on the Beckman Coulter website. Please visit www.beckmancoulter.com to download the latest product documentation.

The following includes supplemental information to the AQUIOS System labeling that is specific for AQUIOS System Software. Please share this information with your laboratory staff and retain this notification as part of your laboratory Quality System documentation. After installation has been successfully completed, store the program CD in a safe location along with your other system software.


The HELP Pull Down Menu on the AQUIOS System Software provides a hotlink to www.beckmancoulter.com/customer-support/support. This hotlink is provided as a convenience to customers that are linked to the Internet via a network. For purposes of cybersecurity, Beckman Coulter requires the use of a module called a "RAP box" to provide a firewall for connecting to the Internet. The current version of software on the RAP box will allow access to the Beckman Coulter website, but will not allow the downloading of manuals from the site. We are planning to correct this issue in the future. During the interim, we recommend that you use a separate computer to download your manuals from the Beckman Coulter website.

If you have any questions or concerns regarding this product announcement please contact your local Beckman Coulter Representative.

Thank you for your business and for your continued support of Beckman Coulter products.

Sincerely,


William Cullum
Sr. Manager, Strategic Marketing

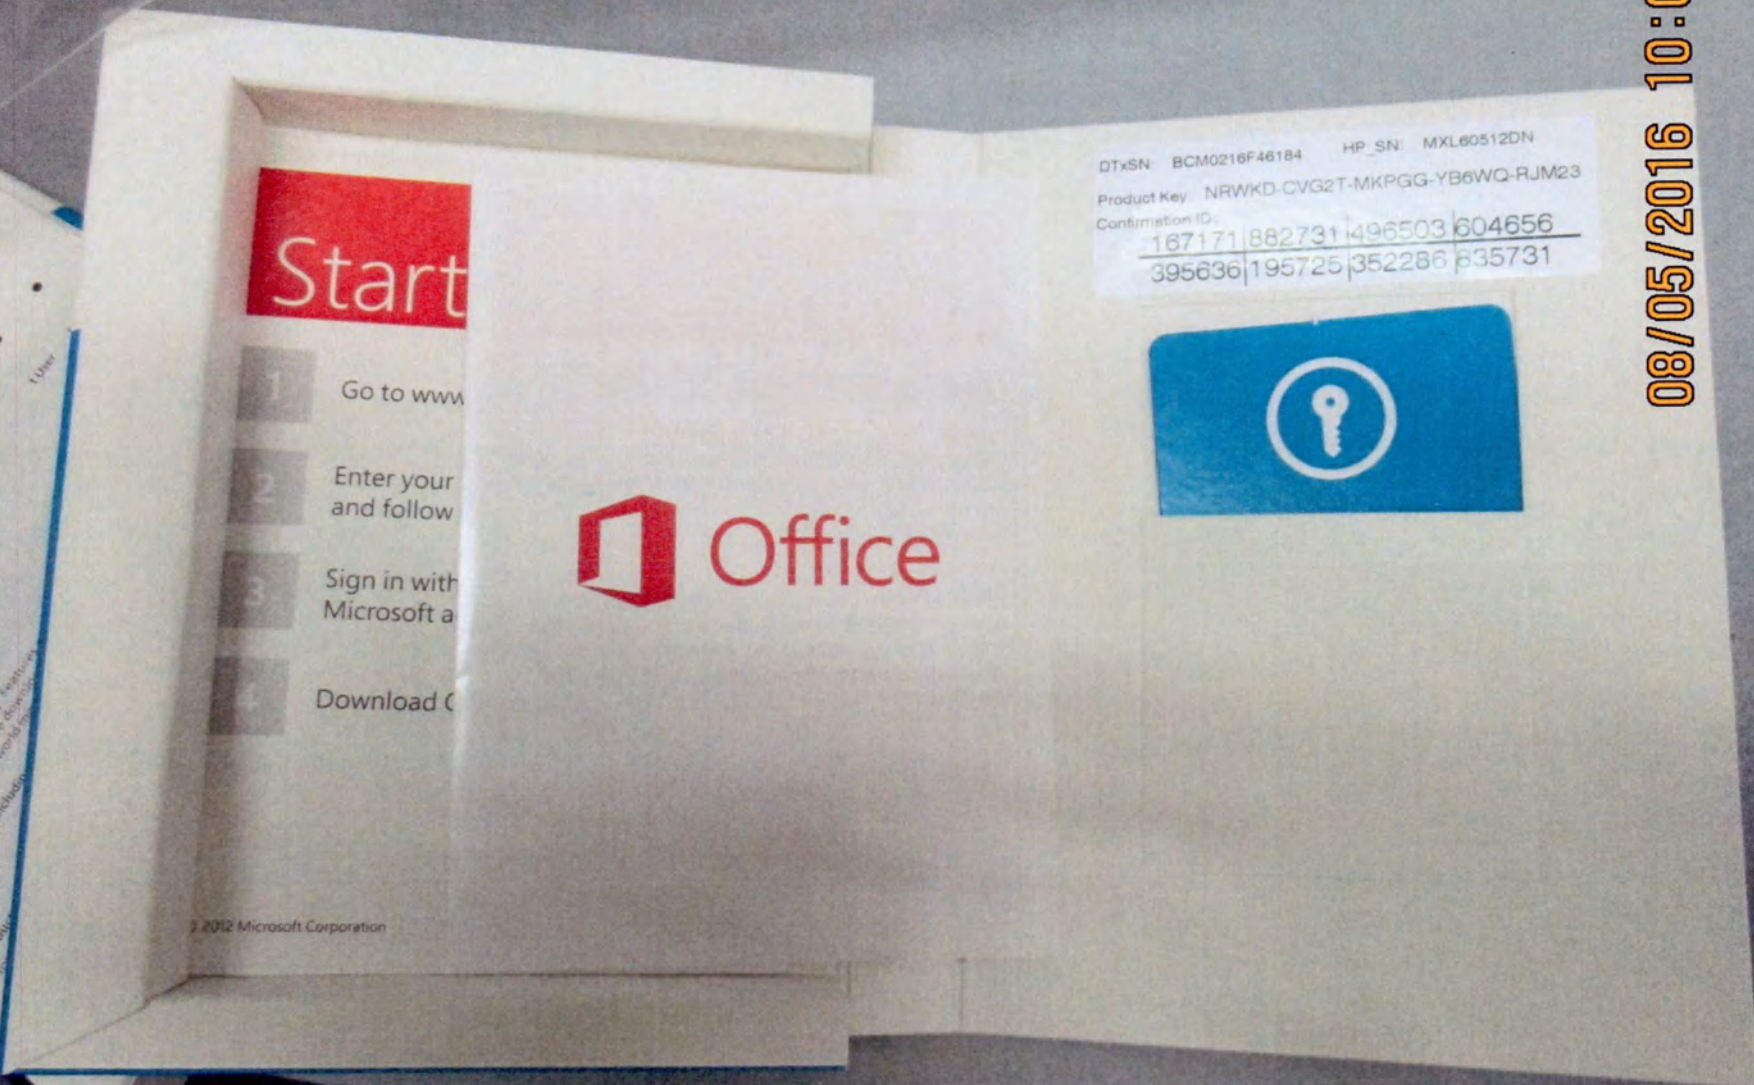

DTxSN: BCM0216F46184 HP_SN: MXL60512DN
Product Key: NRWKD-CVG2T-MKPGG-YB6WQ-RJM23
Confirmation ID:
167171|882731|496503|604656
395636|195725|352286|835731

08/05/2016 10:01

Фотография 26 – Крышка декоративная с набором креплений.

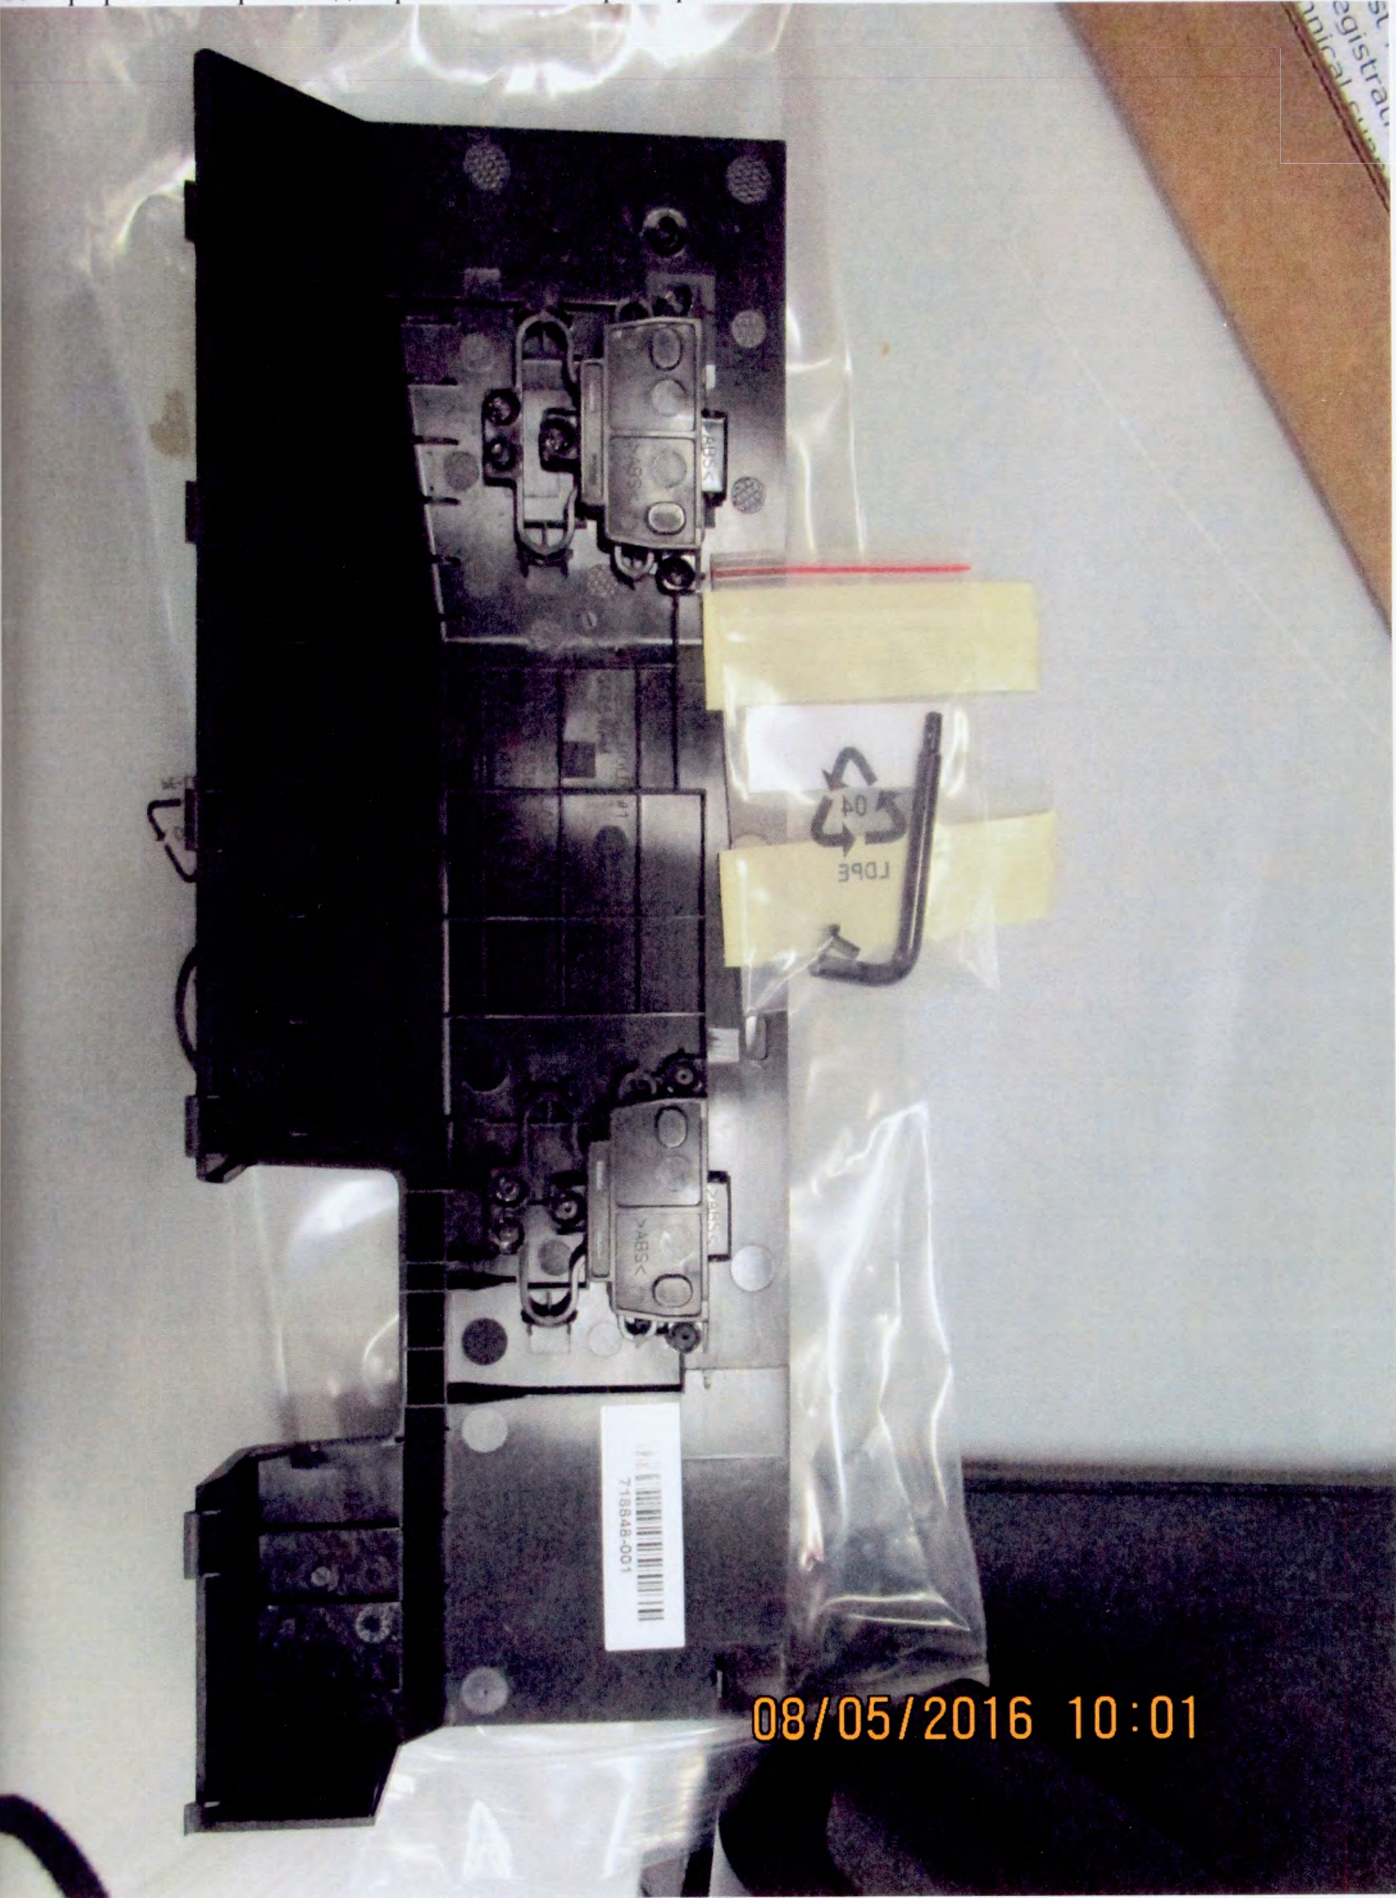

08/05/2016 10:01


Фотография 27 – Флеш-накопитель для восстановления системы.



Фотография 28 – Кабель питания.



Фотография 29 – Программное обеспечение для проточного цитометра: CD-диск.

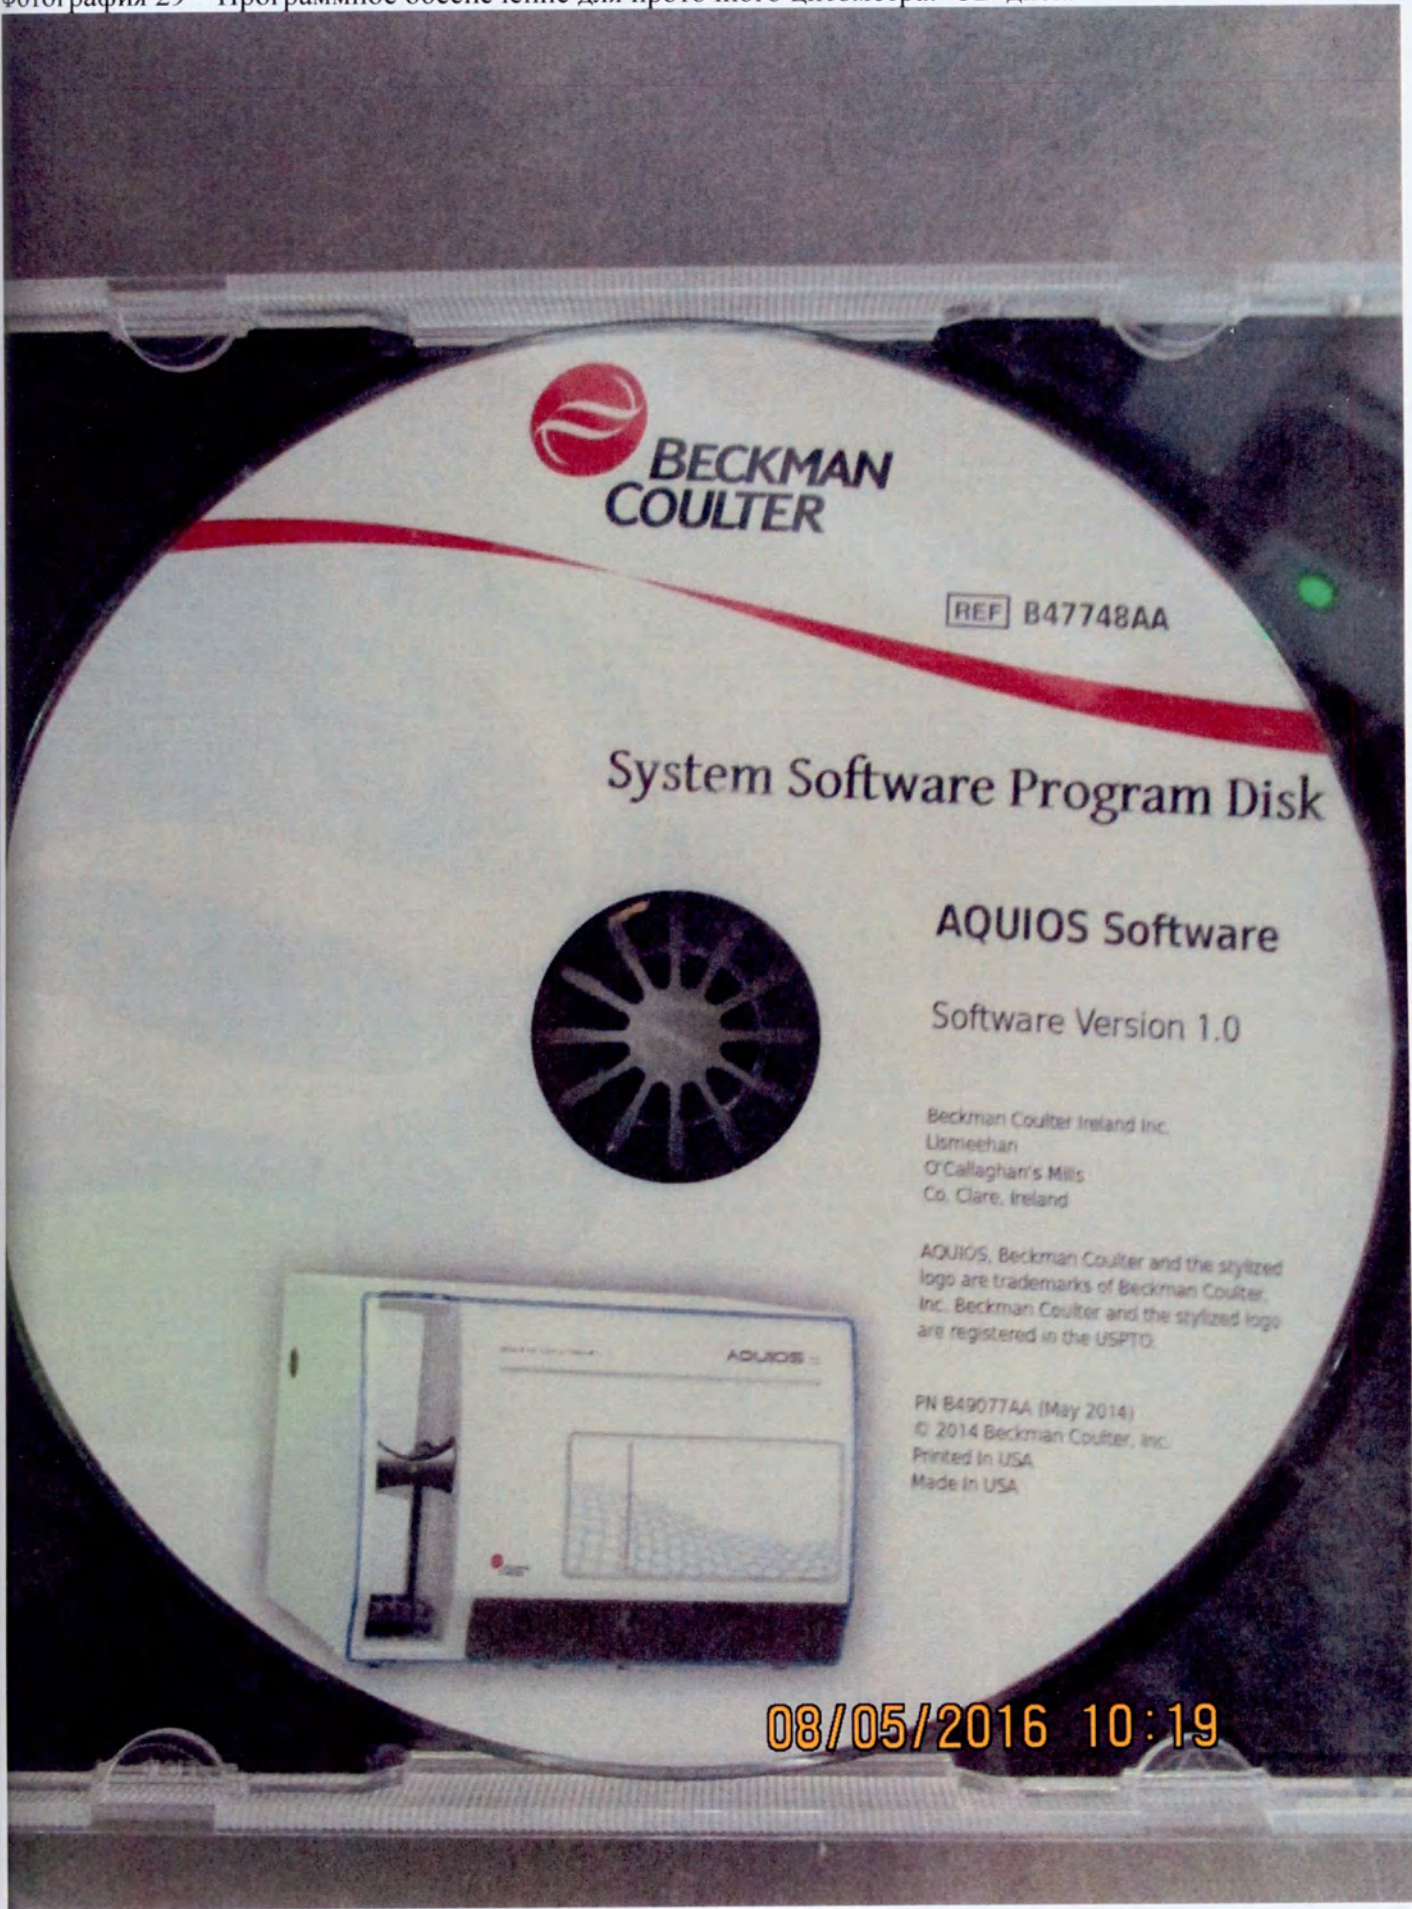

Фотография 30 – Кассеты для пробирок. Общий вид.





REF

B25318

Revision: AC

ASSY, CASSETTE TYPE 5, CONTROL




2016-03-25


Quantity: 1

08/05/2016 10:17

Фотография 32 – Маркировка кассеты для пробирок SARSTEDT.

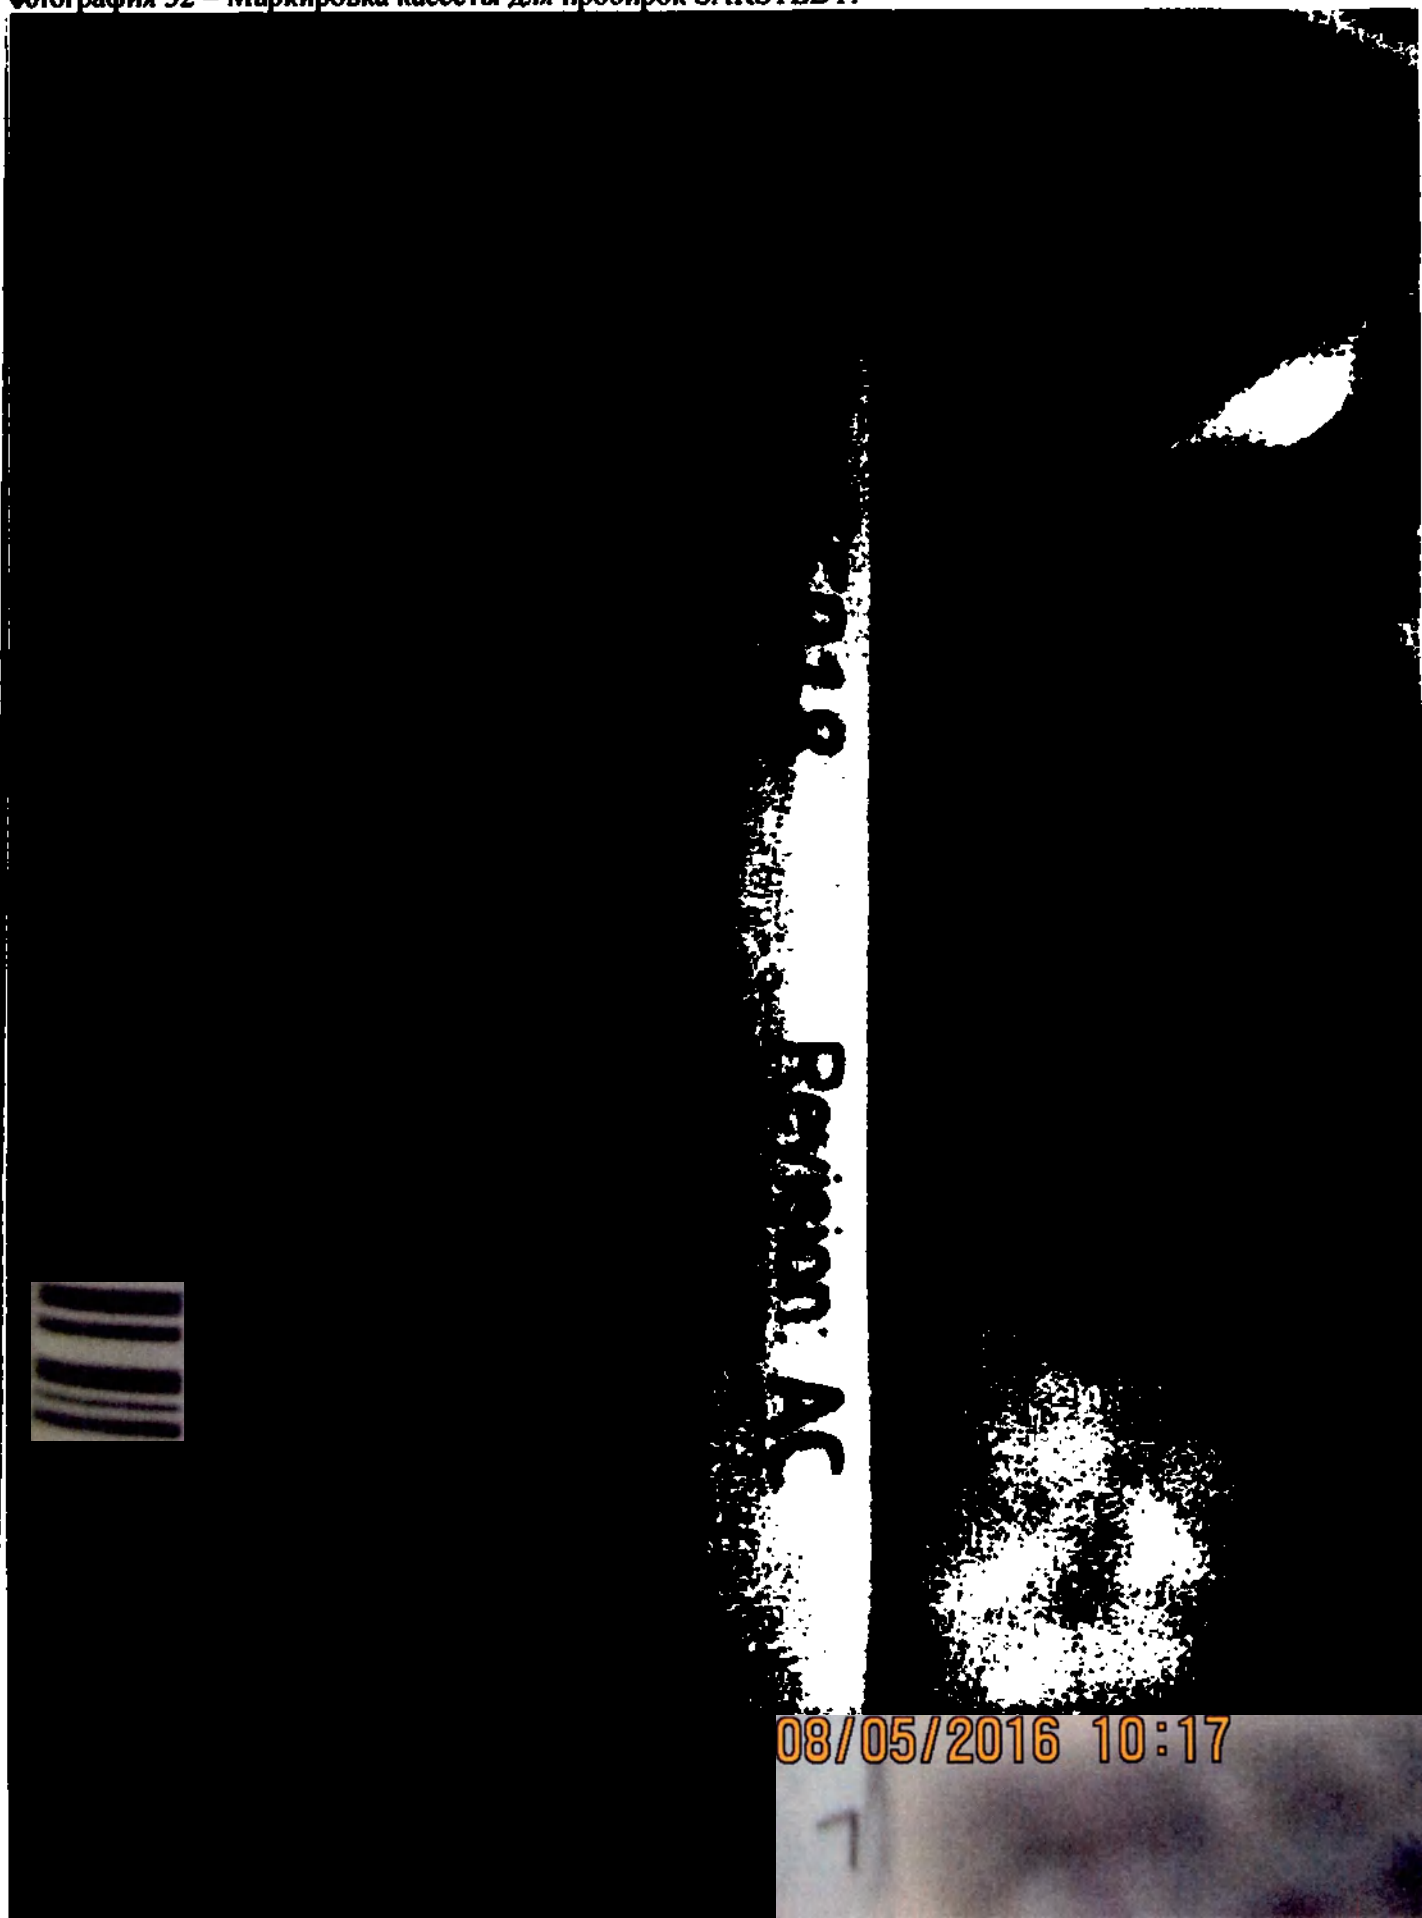


Фотография 33 – Маркировка кассеты для пробирок 10.25 мм.

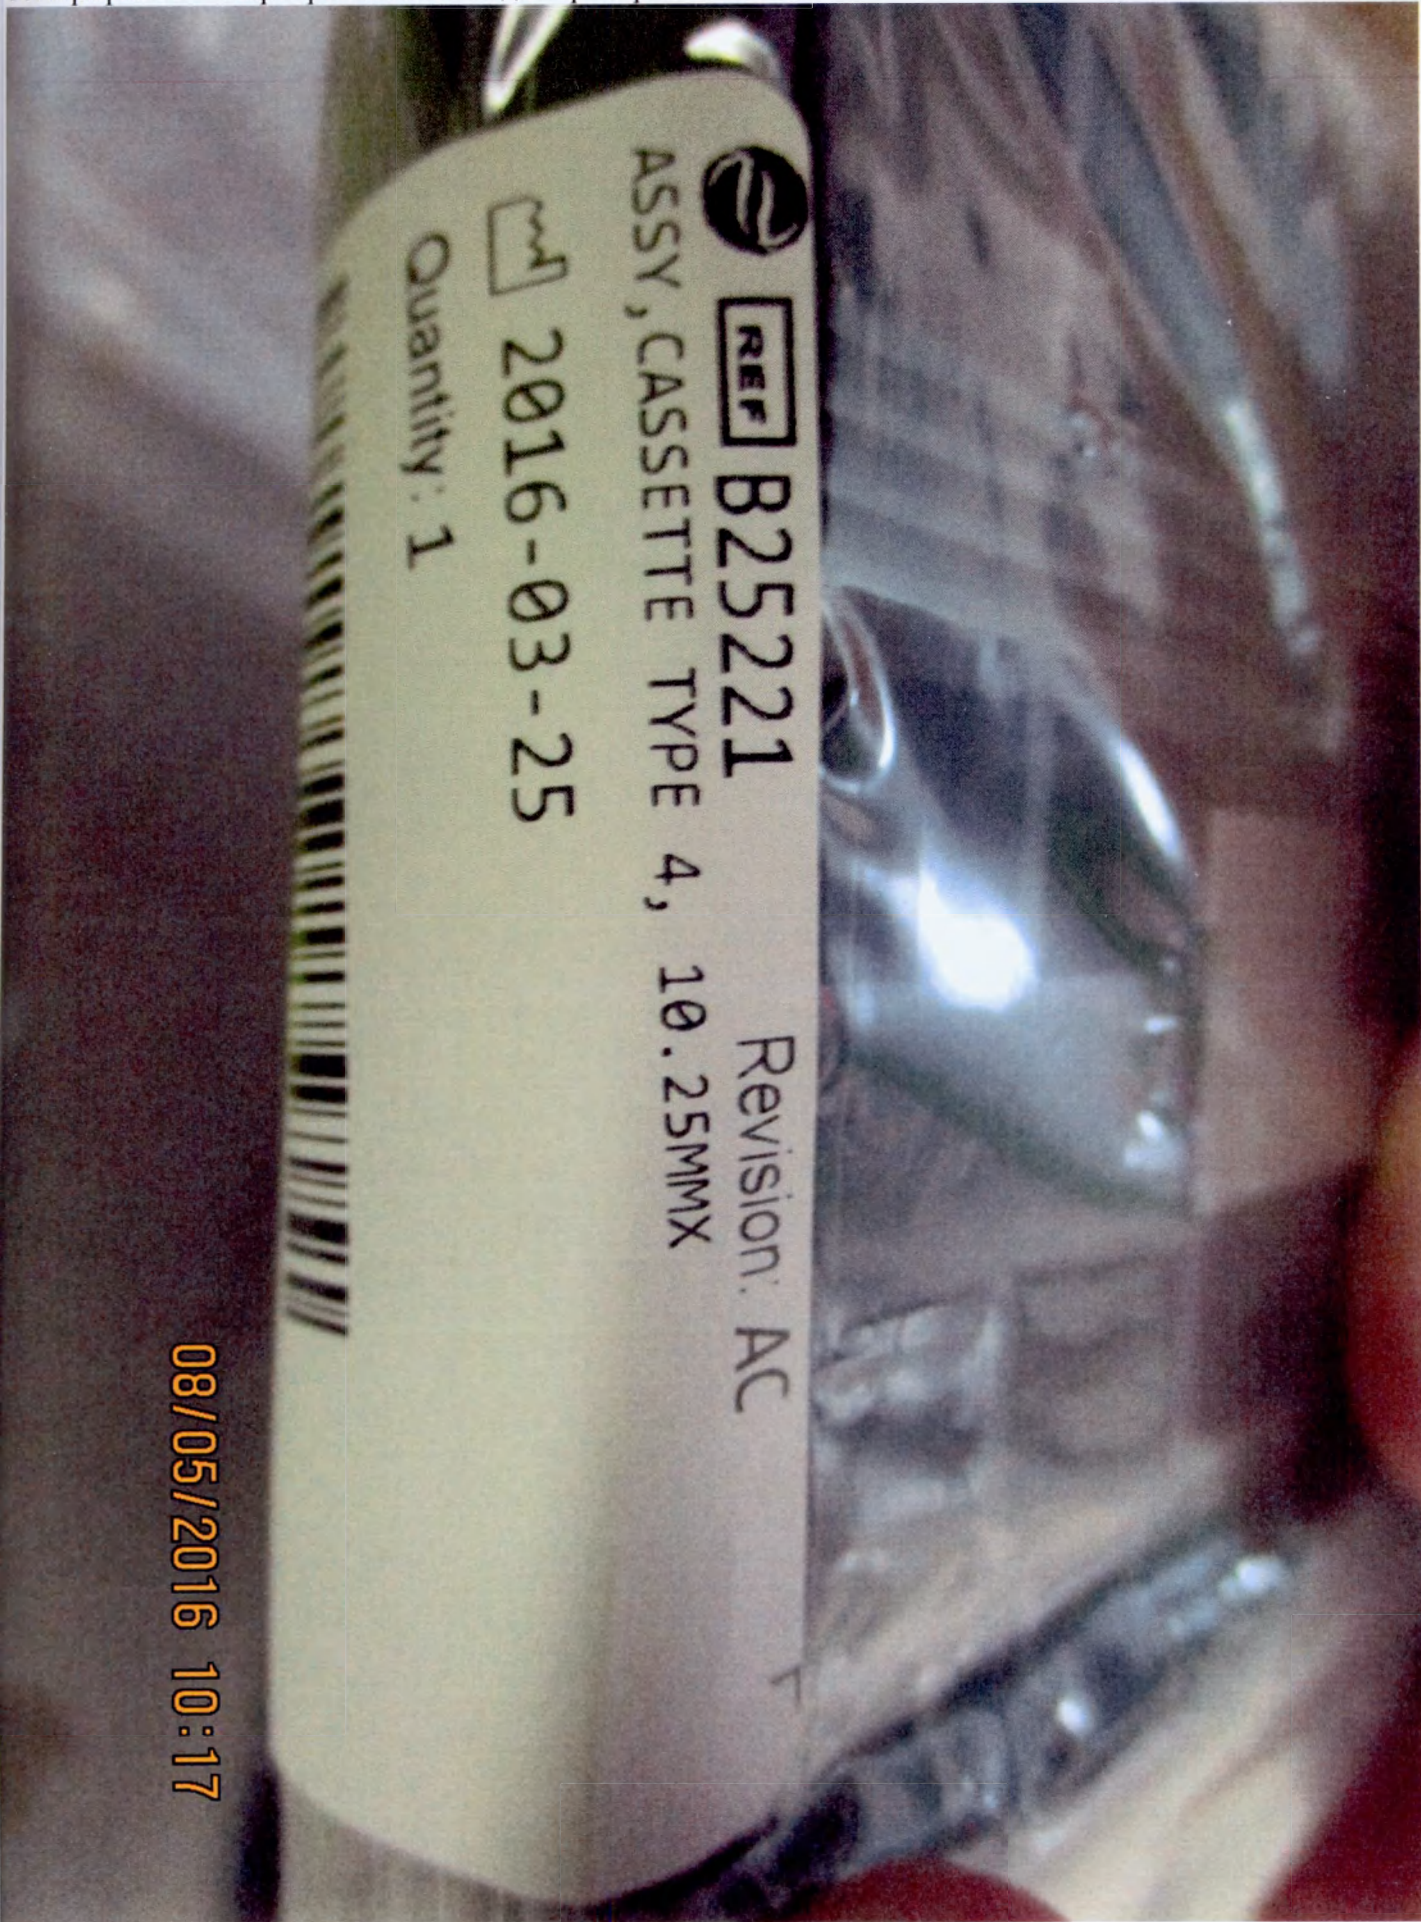


08/05/2016 10:17

Фотография 34 – Маркировка кассеты для пробирок 13 мм.

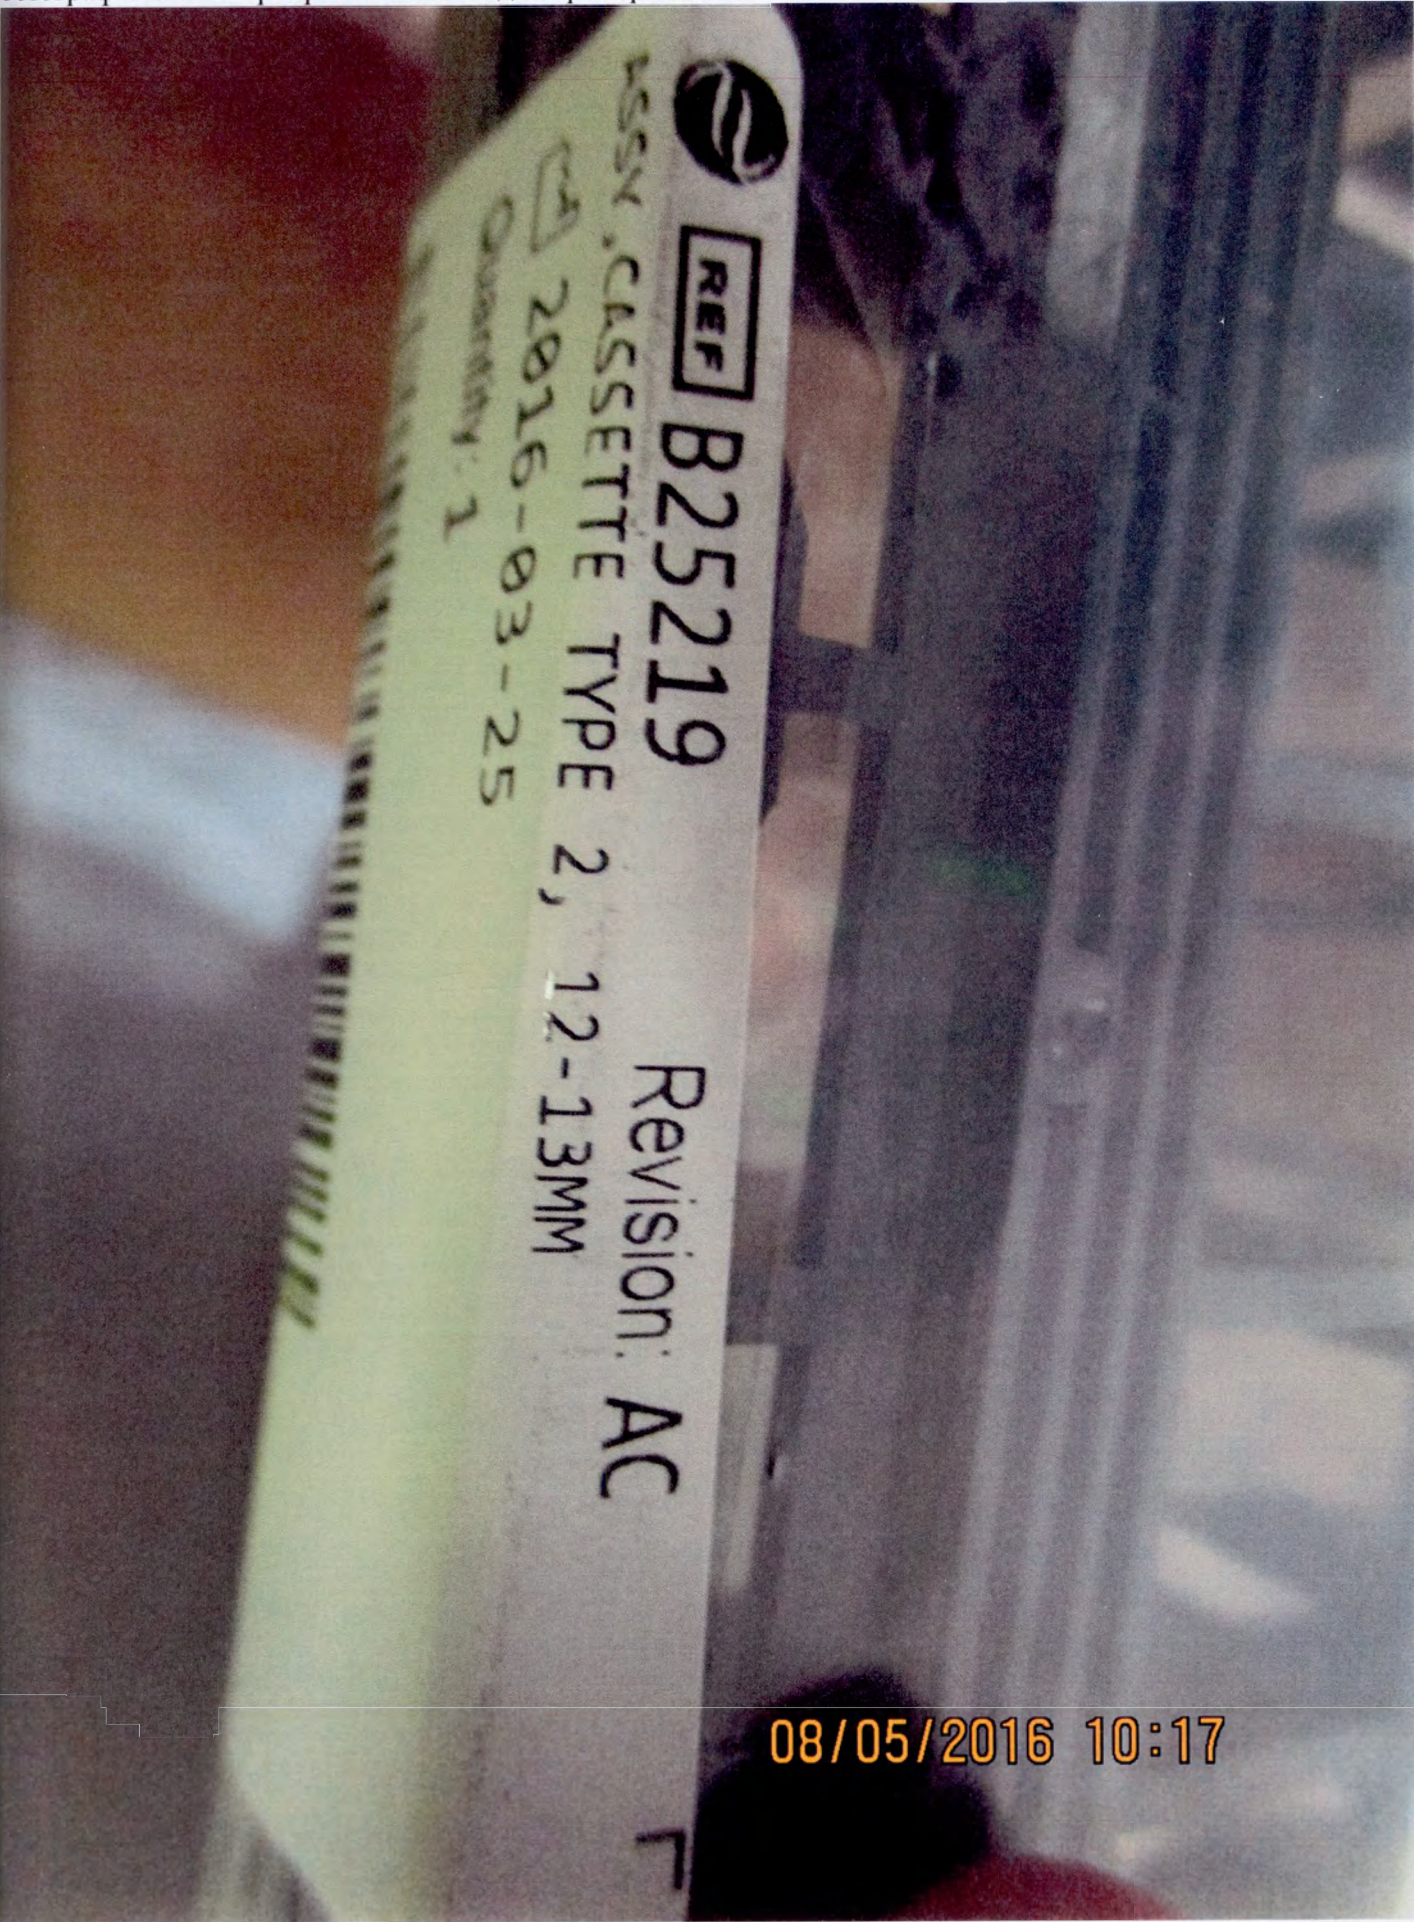


Фотография 35 – Маркировка кассеты для пробирок 16 мм.

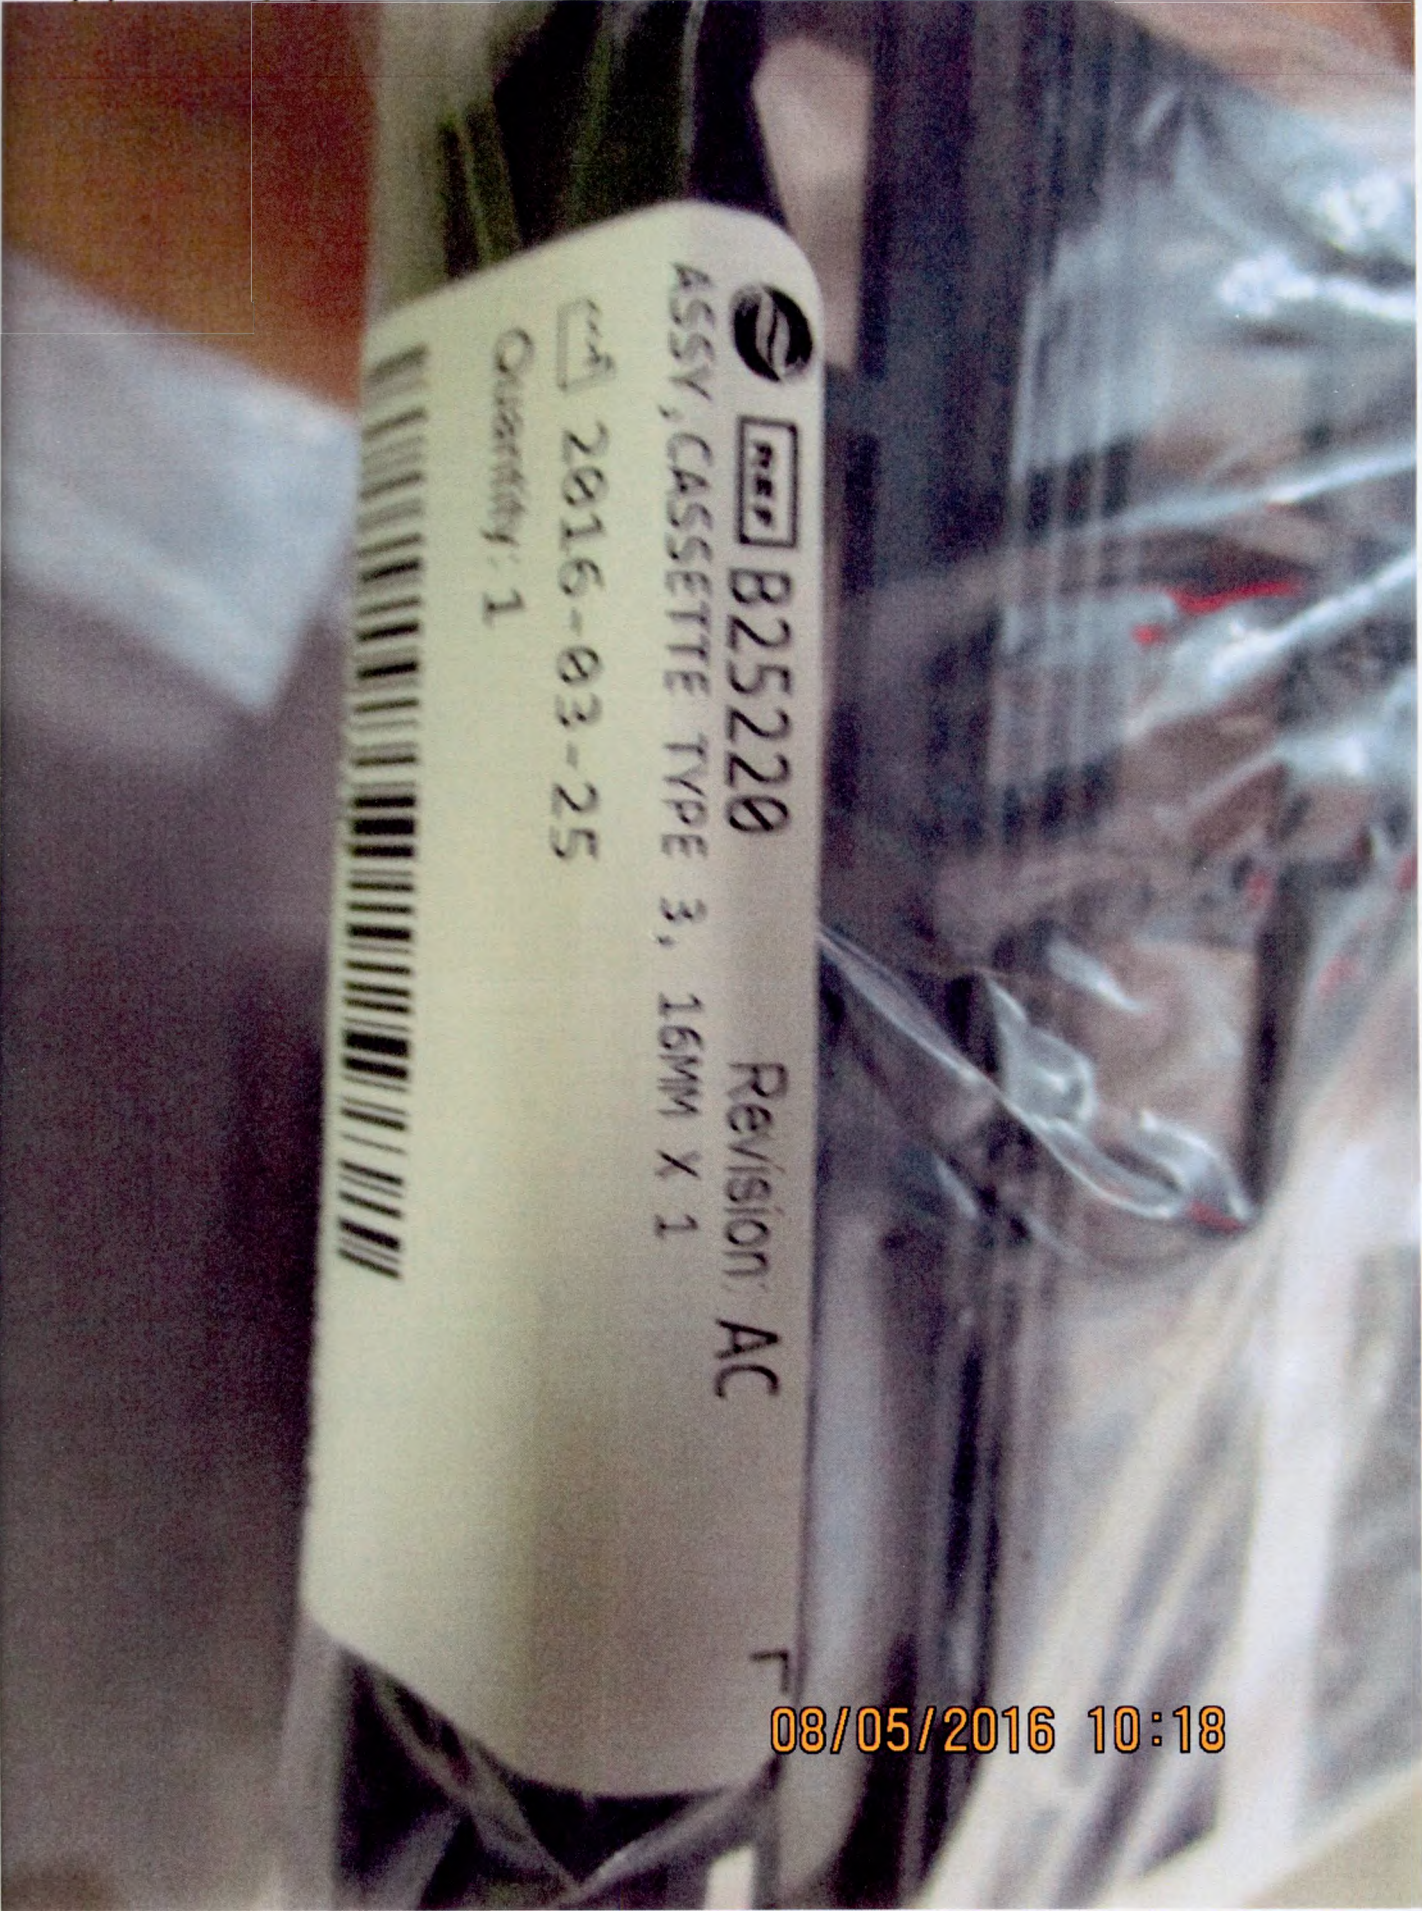

08/05/2016 10:18

Фотография 36 – Глубоколуночные планшеты на 96 лунок – упаковка из 50 шт.

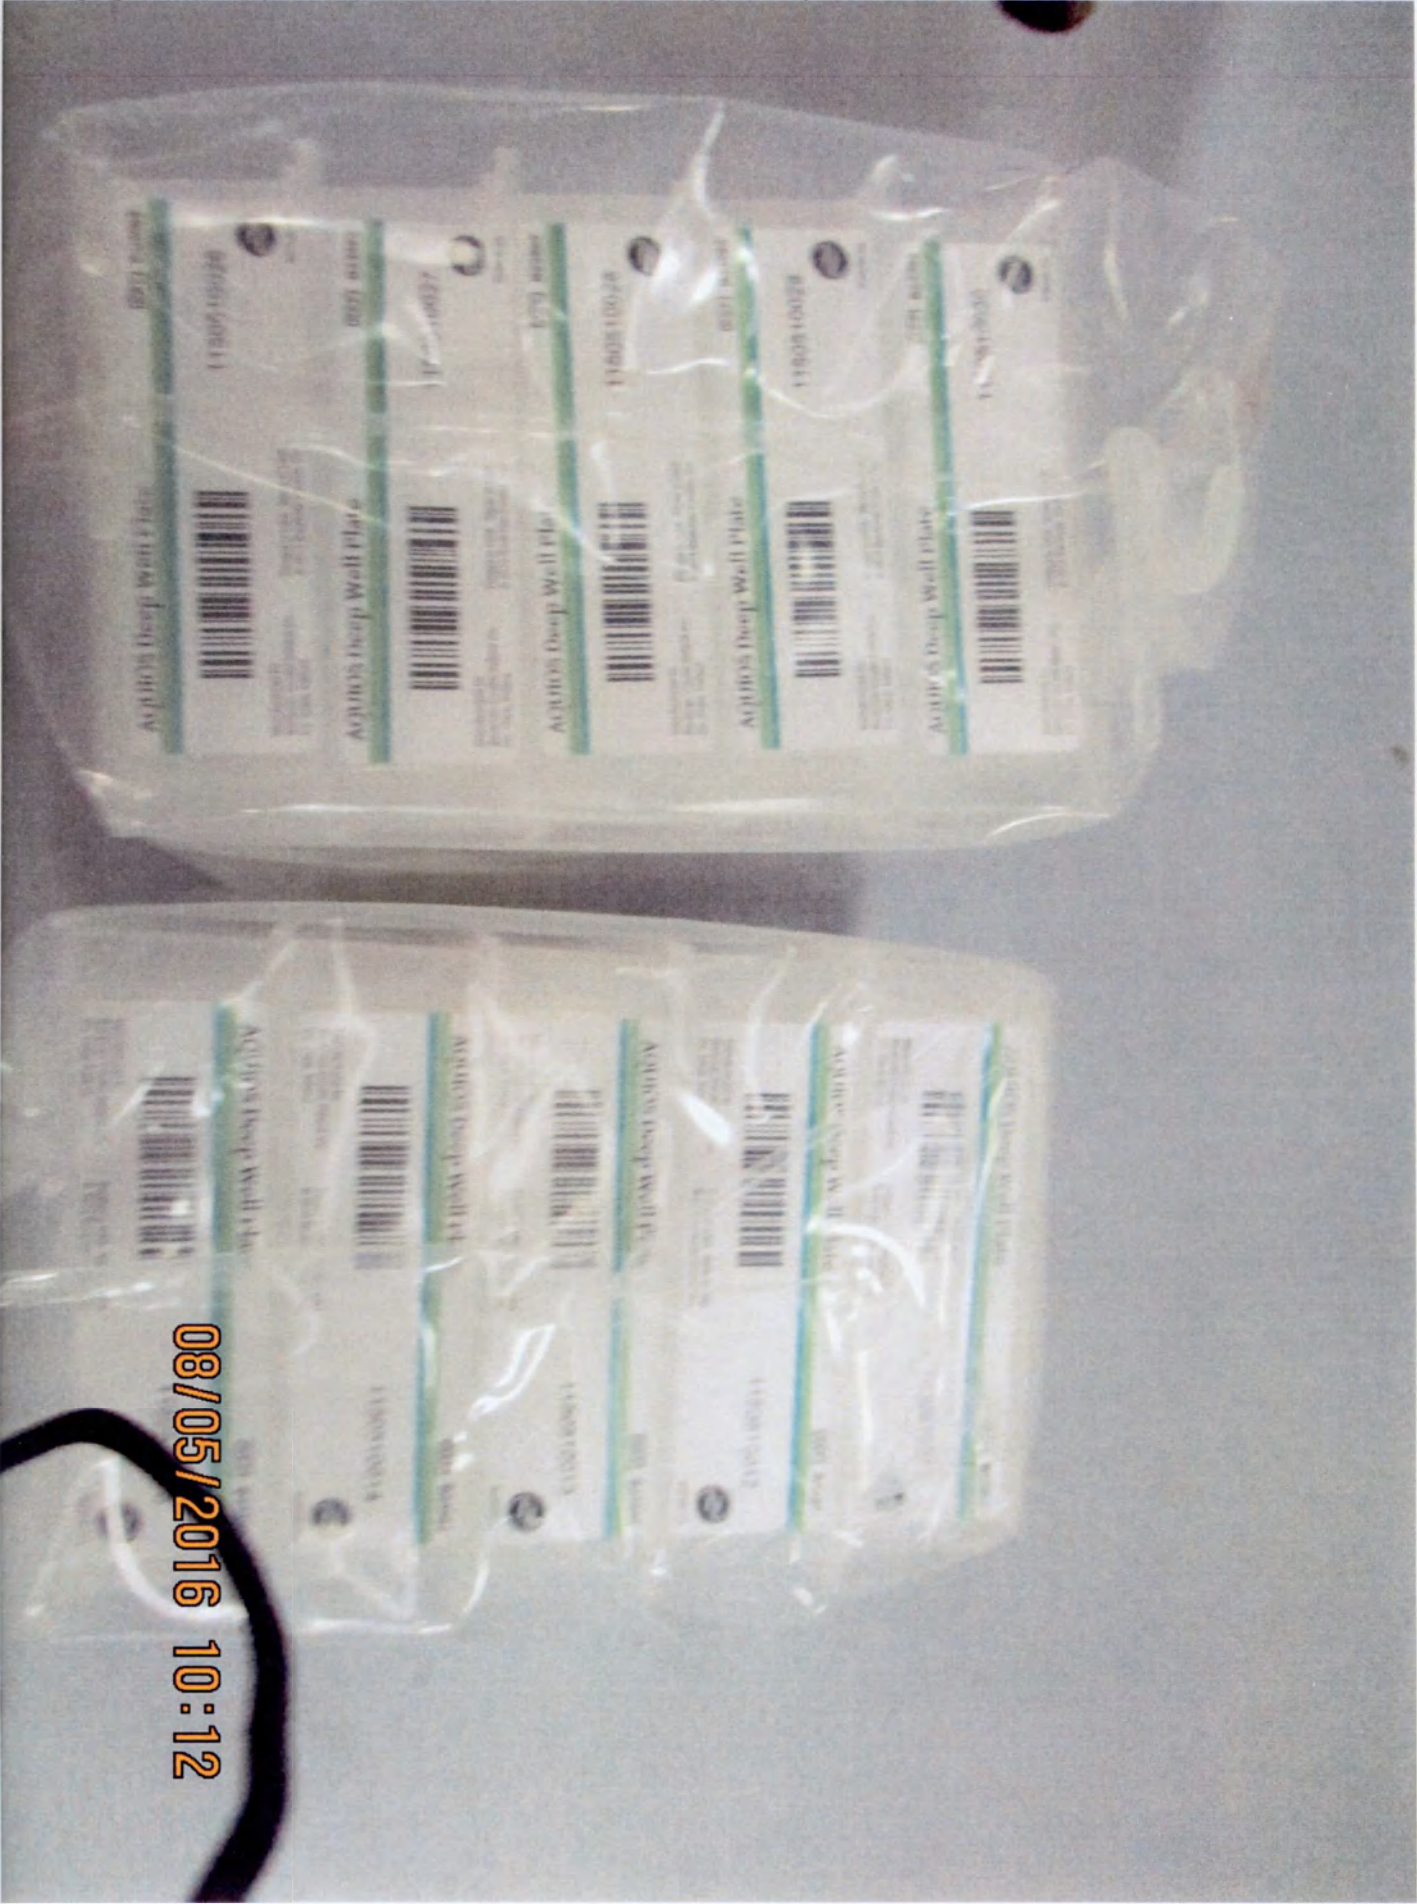

08/05/2016 10:12

Фотография 37 – Принтер.




Фотография 38 – Руководство пользователя цитометра проточного.



Руководство пользователя

проточного цитометра AQUIOS CL



PN B40257A.E
Древильск 2017



Beckman Coulter Ireland Inc.
Lismacash
O'Callaghan's Mills
Co. Clare, Ireland 353-02-460-1100





ПРОШИТО, 2011
И СКРЕПЛЕ...

49

1. ИЮН 2011

