


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»
Носова Т.А.

2019 г.




Фотографические изображения изделия:

Кассета с реагентами для количественного определения лютеинизирующего гормона (Luteinizing hormone (LH)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd («Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.»), Китай

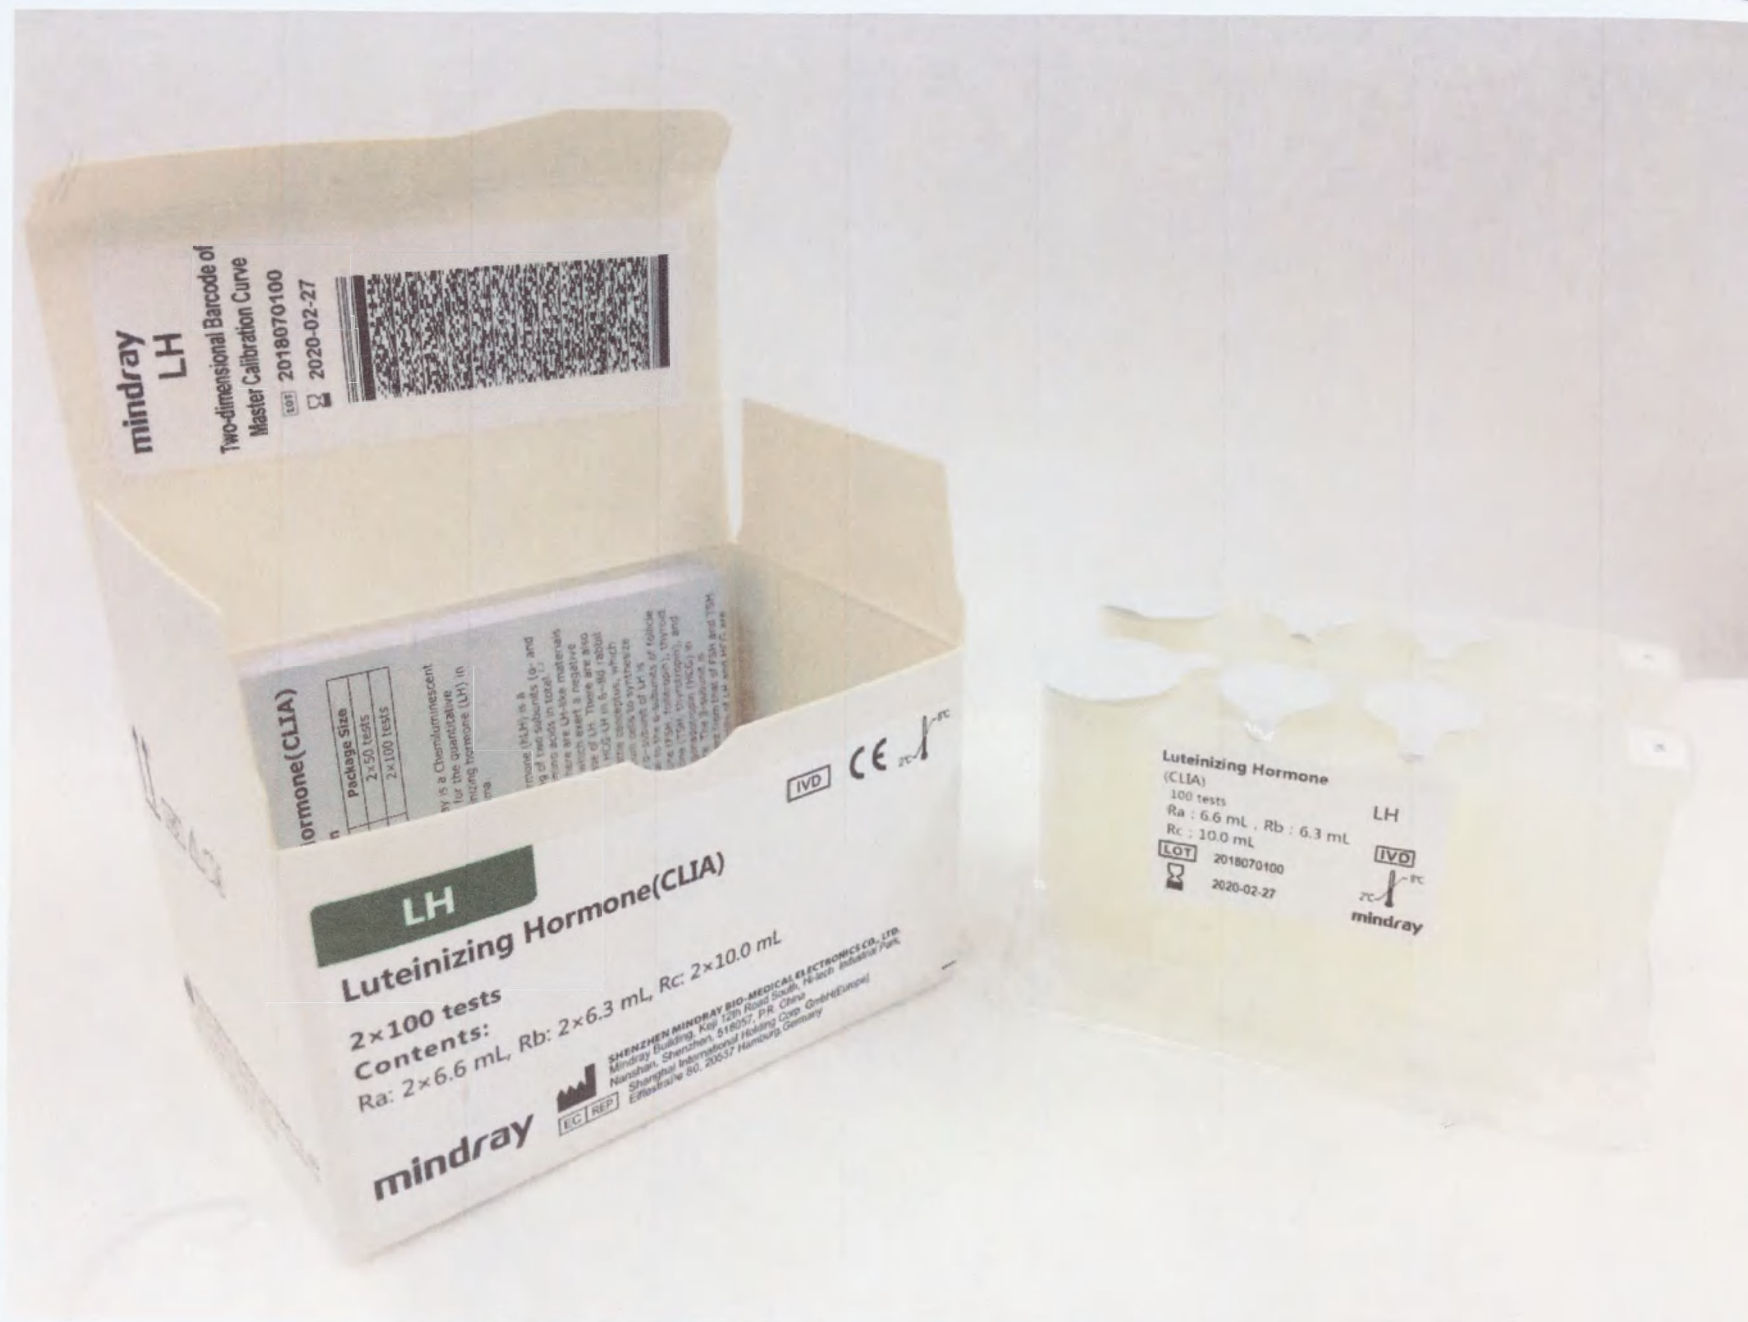

Общий вид медицинского изделия (Кассета с реагентами для количественного определения лютеинизирующего гормона (Luteinizing hormone (LH)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro LH12 (2 x 100 тестов))

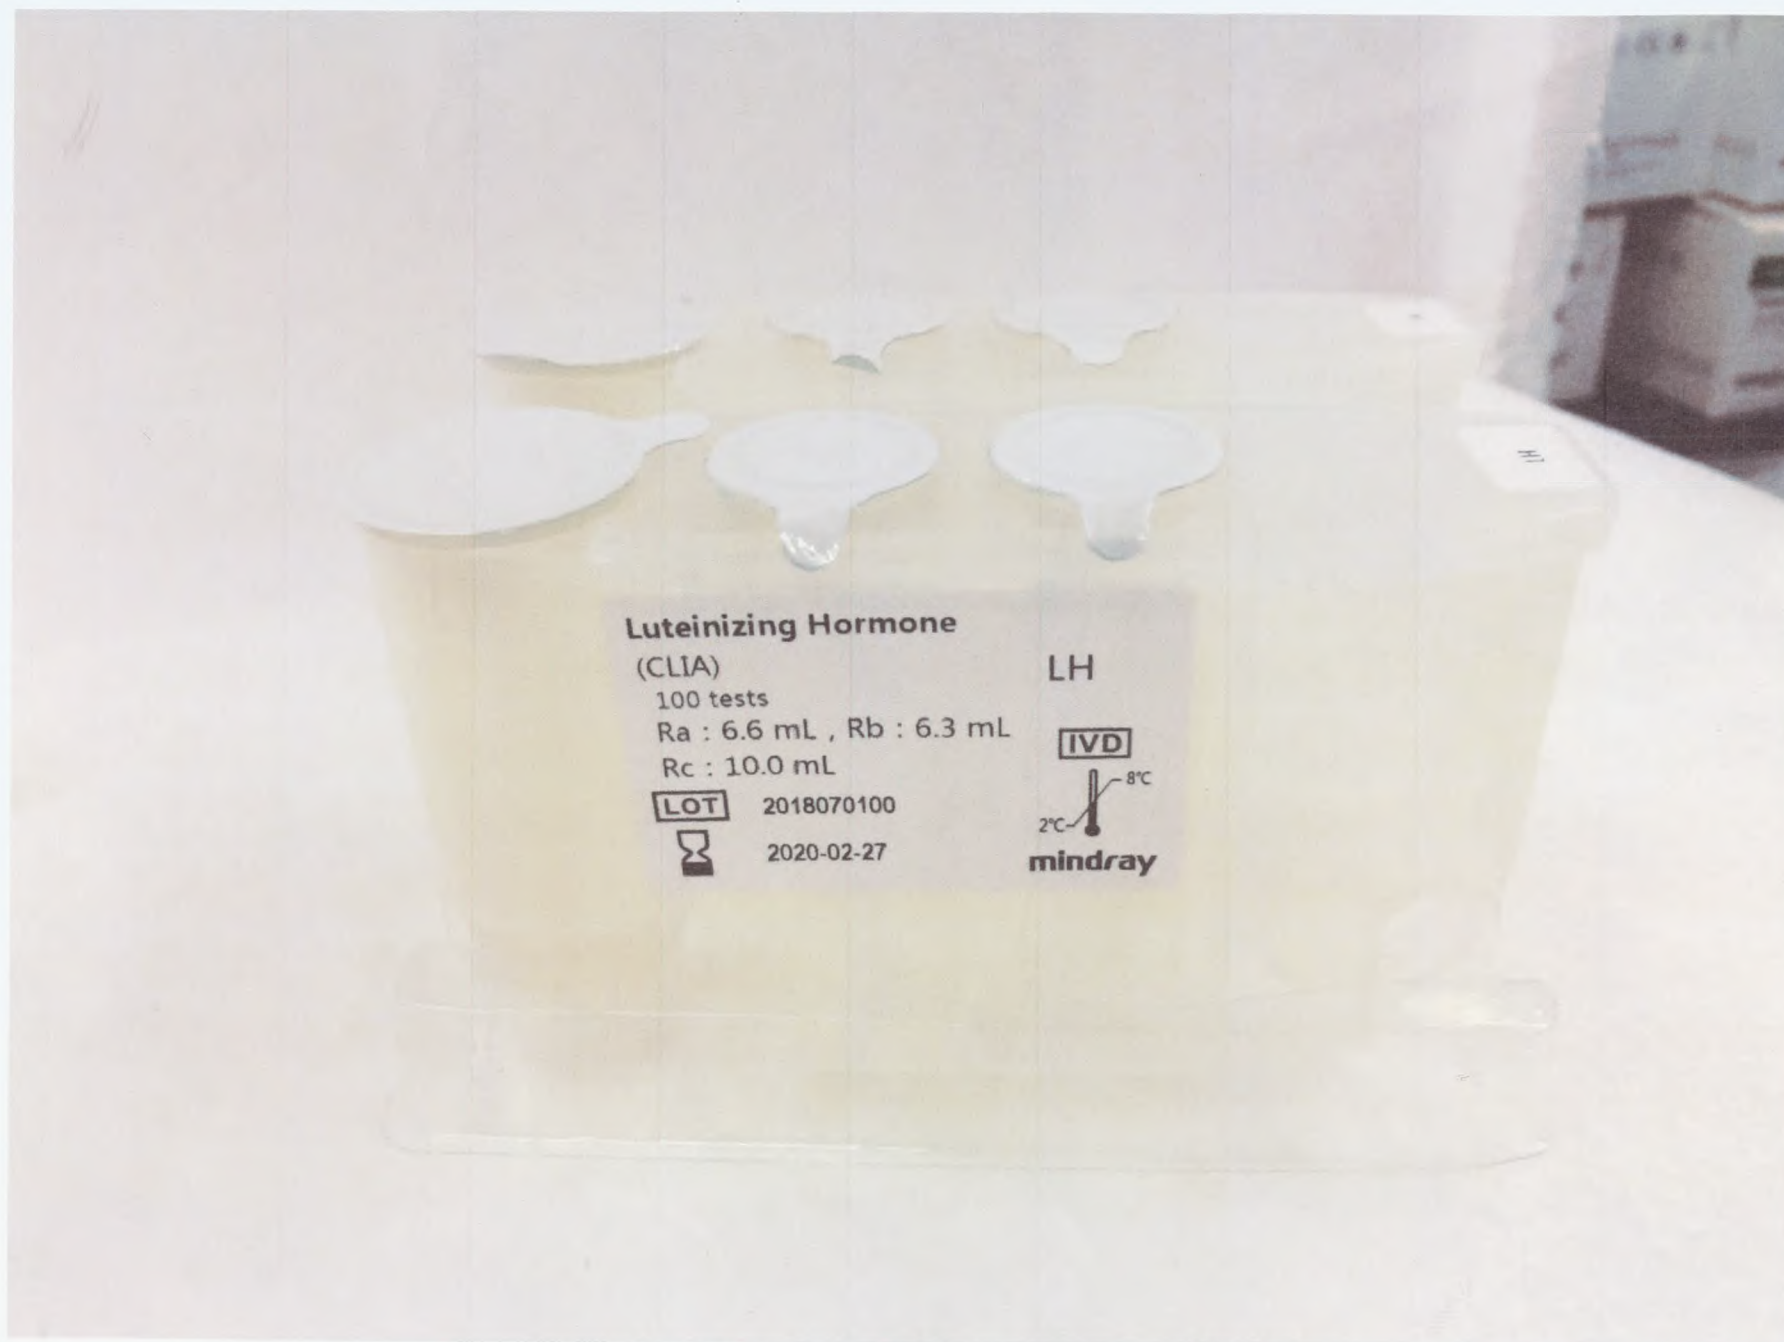

Фотографическое изображение кассеты с реагентами LH112

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 3 листа (-ов)

Генеральный Директор Носова Т.А. / Носова Т.А.
М.П.

