




**Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
«Дезар - NEW» в исполнении:**

**«Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
«Дезар-2 NEW».**

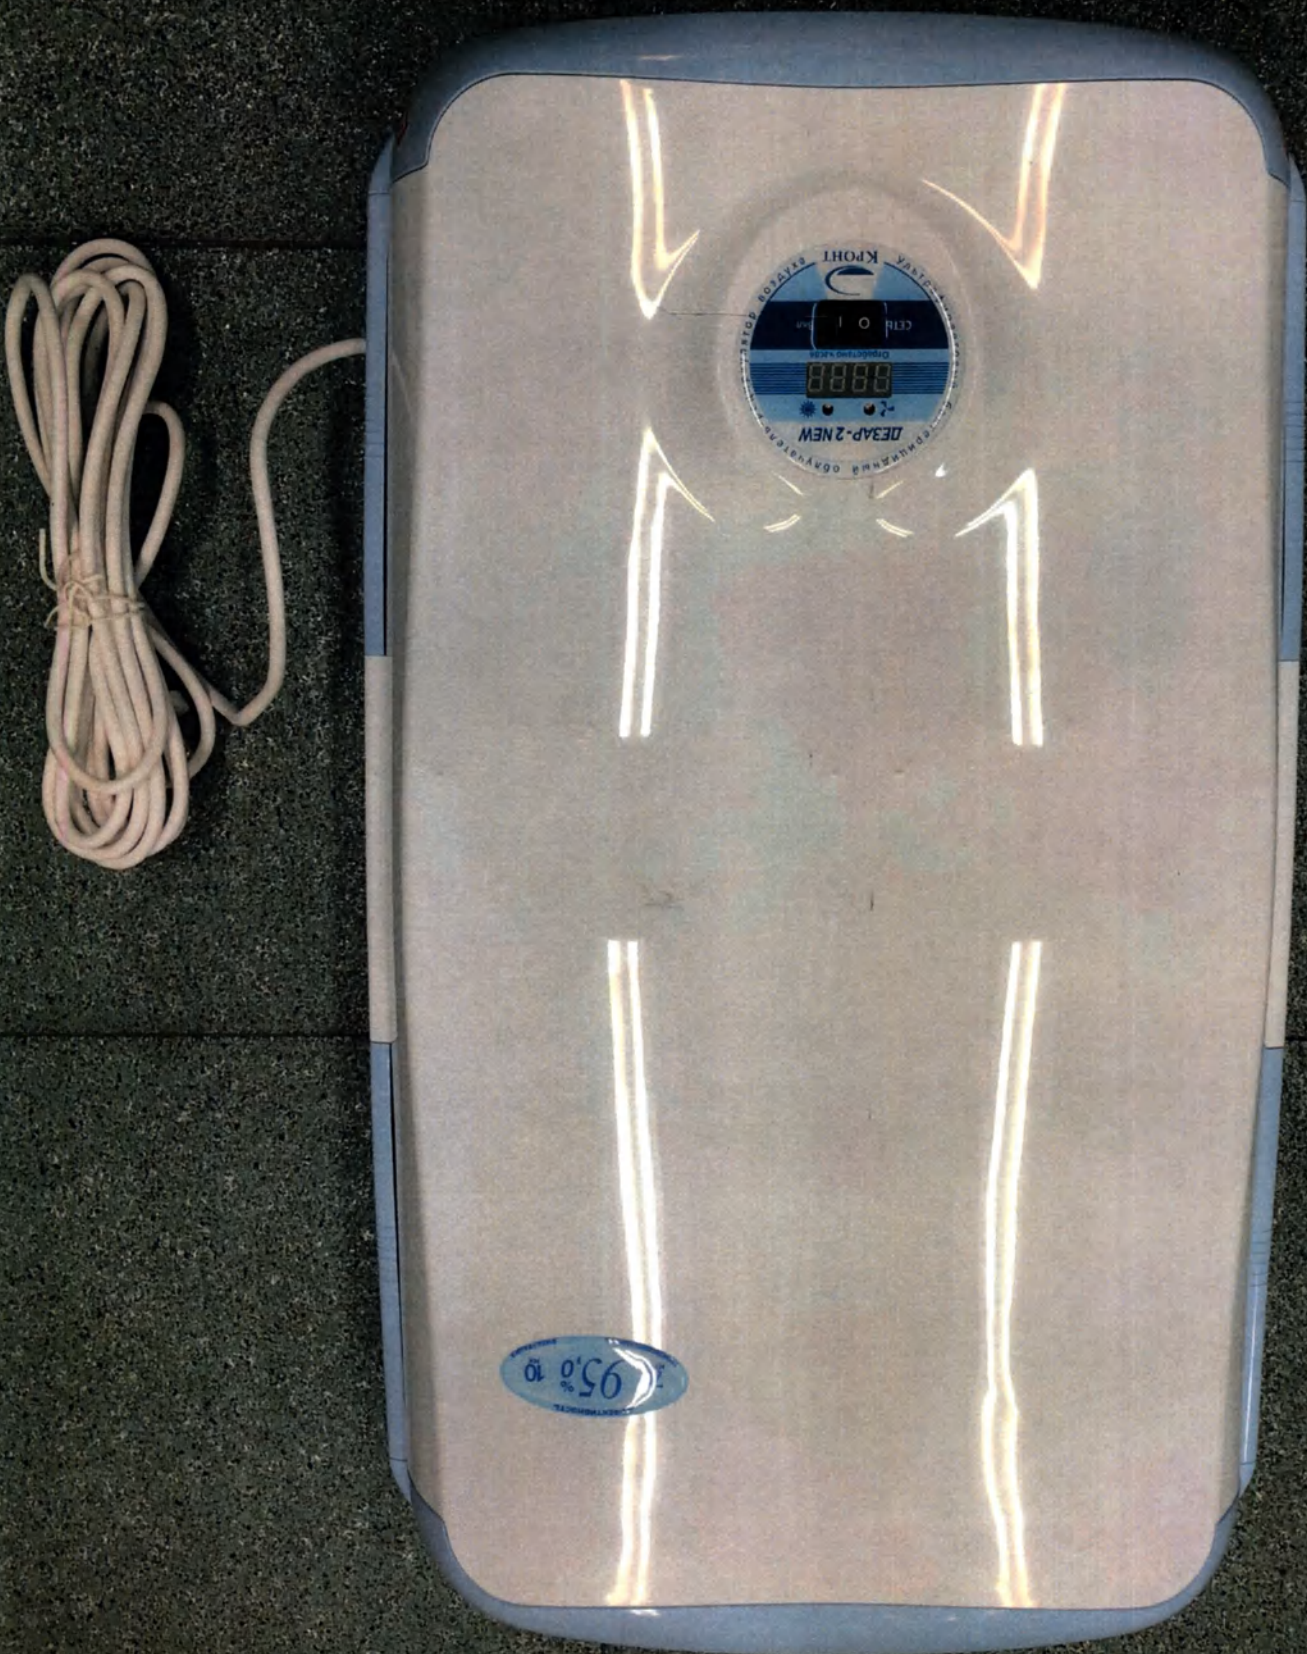





КронТ

РУ № _____

Дезар-2 NEW

ТУ 32.50.50-076-11769436-2019

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый
бактерицидный Дезар-NEW, в исполнении Дезар-2 NEW

50 Гц/220 В, 45 ВА, IP2X ☐

Россия

Год выпуска: 20 19


Зав. № 1

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
«Дезар - NEW» в исполнении:

«Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
«Дезар-2П NEW».







КронТ

РУ № _____

Дезар-2П NEW

ТУ 32.50.50-076-11769436-2019

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый
бактерицидный Дезар-NEW, в исполнении Дезар-2П NEW

50 Гц/220 В, 45 ВА, IP2X 

Россия

Год выпуска: 2019


Зав. № 4

**Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
«Дезар - NEW» в исполнении:**

**«Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
«Дезар-3 NEW».**







КронТ

РУ № _____

Дезар-3 NEW

ТУ 32.50.50-076-11769436-2019

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый
бактерицидный Дезар-NEW, в исполнении Дезар-3 NEW

50 Гц/220 В, 95 ВА, IP2X 


Россия

Год выпуска: 2019


Зав. № 2

**Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
«Дезар - NEW» в исполнении:**

**«Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
«Дезар-4 NEW».**

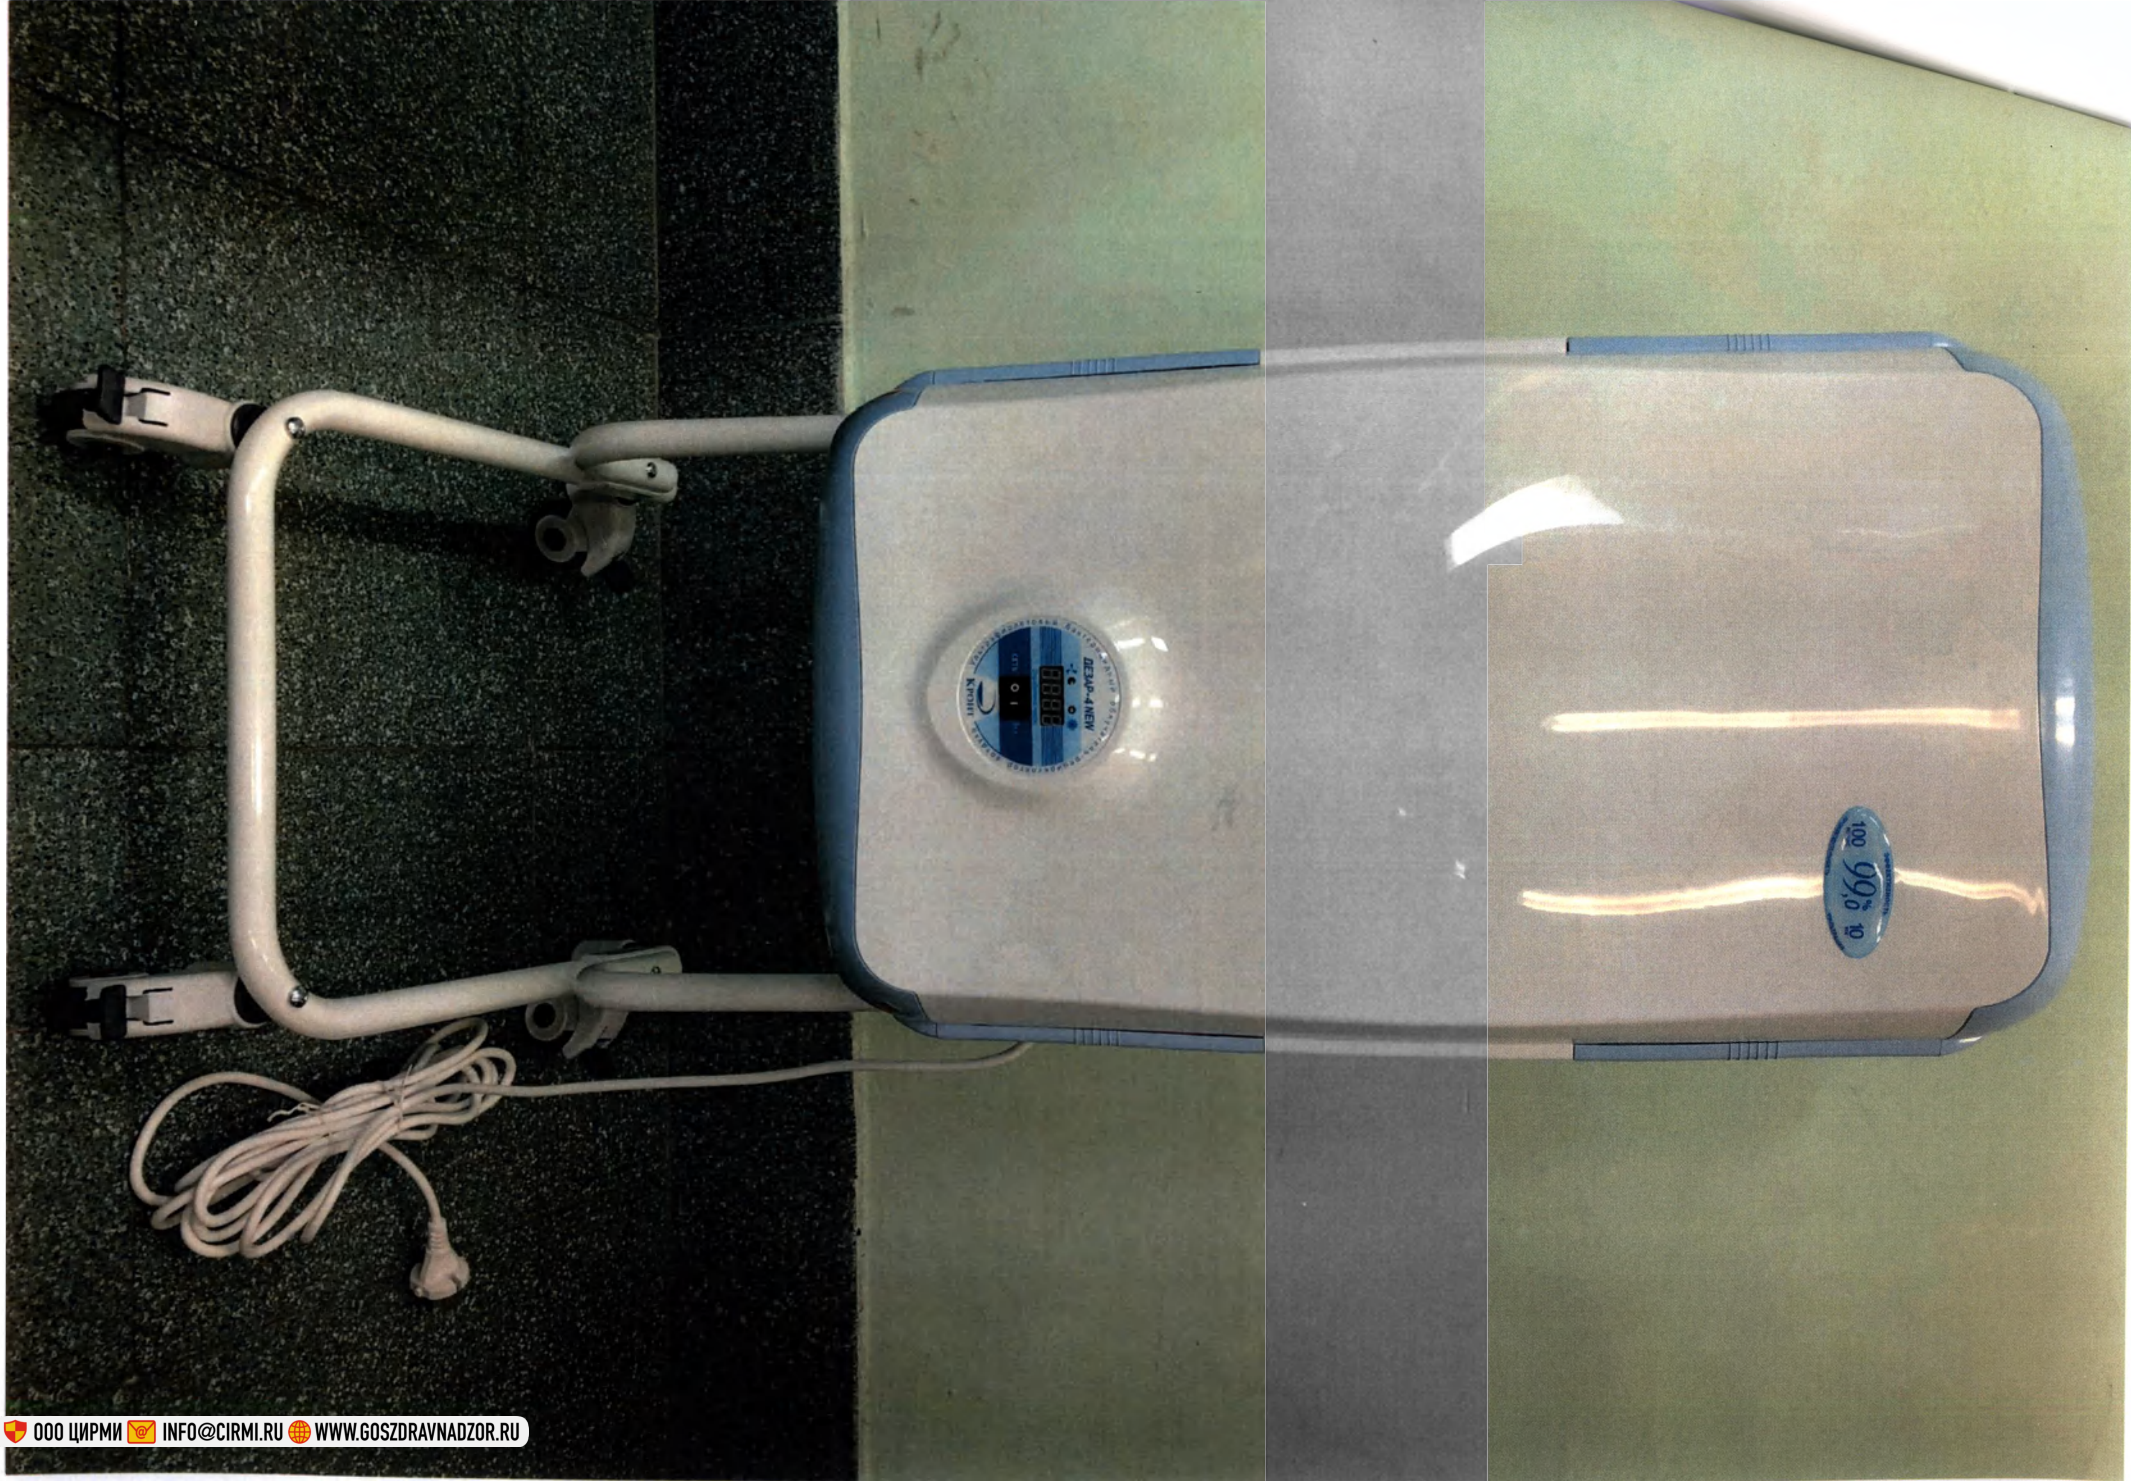





КронТ

Дезар-4 NEW

РУ № _____

ТУ 32.50.50-076-11769436-2019

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый
бактерицидный Дезар-NEW, в исполнении Дезар-4 NEW

50 Гц/220 В, 95 ВА, IP2X ☐


Россия

Год выпуска: 2019

Зав.№ 5

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
«Дезар - NEW» в исполнении:
«Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
«Дезар-5 NEW».



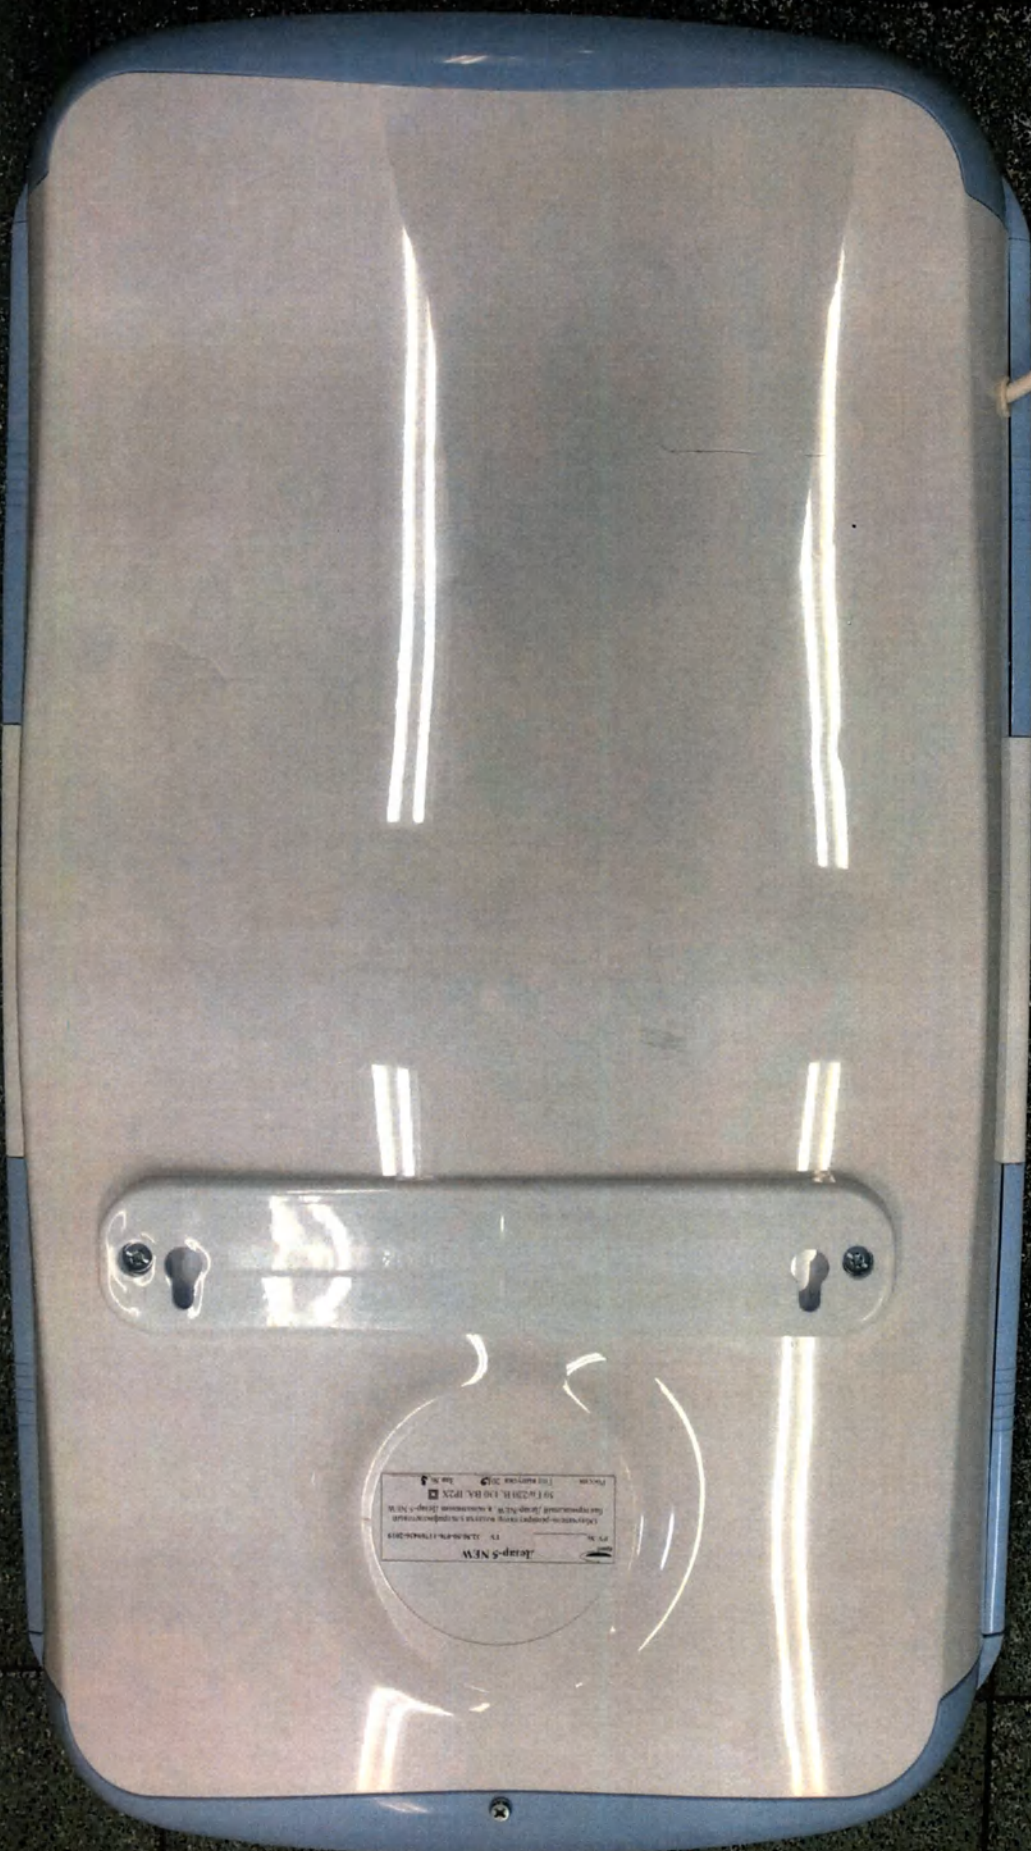

Jump 5-NEW
1. Неисправности, связанные с работой устройства, не являются гарантийными случаями.
2. Гарантия на Jump 5-NEW составляет 12 месяцев.
3. Адрес: 125080, г. Москва, ул. Лесная, д. 10, стр. 1.
4. Контактный телефон: 8 (495) 125-125-125.
5. E-mail: info@jump5.ru
6. Сайт: www.jump5.ru



КронТ

Дезар-5 NEW

РУ № _____

ТУ 32.50.50-076-11769436-2019

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый
бактерицидный Дезар-NEW, в исполнении Дезар-5 NEW

50 Гц/220 В, 130 ВА, IP2X

Россия

Год выпуска: 2019

Зав.№ 3


**Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
«Дезар - NEW» в исполнении:**

**«Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
«Дезар-7 NEW».**



100 99,9 %



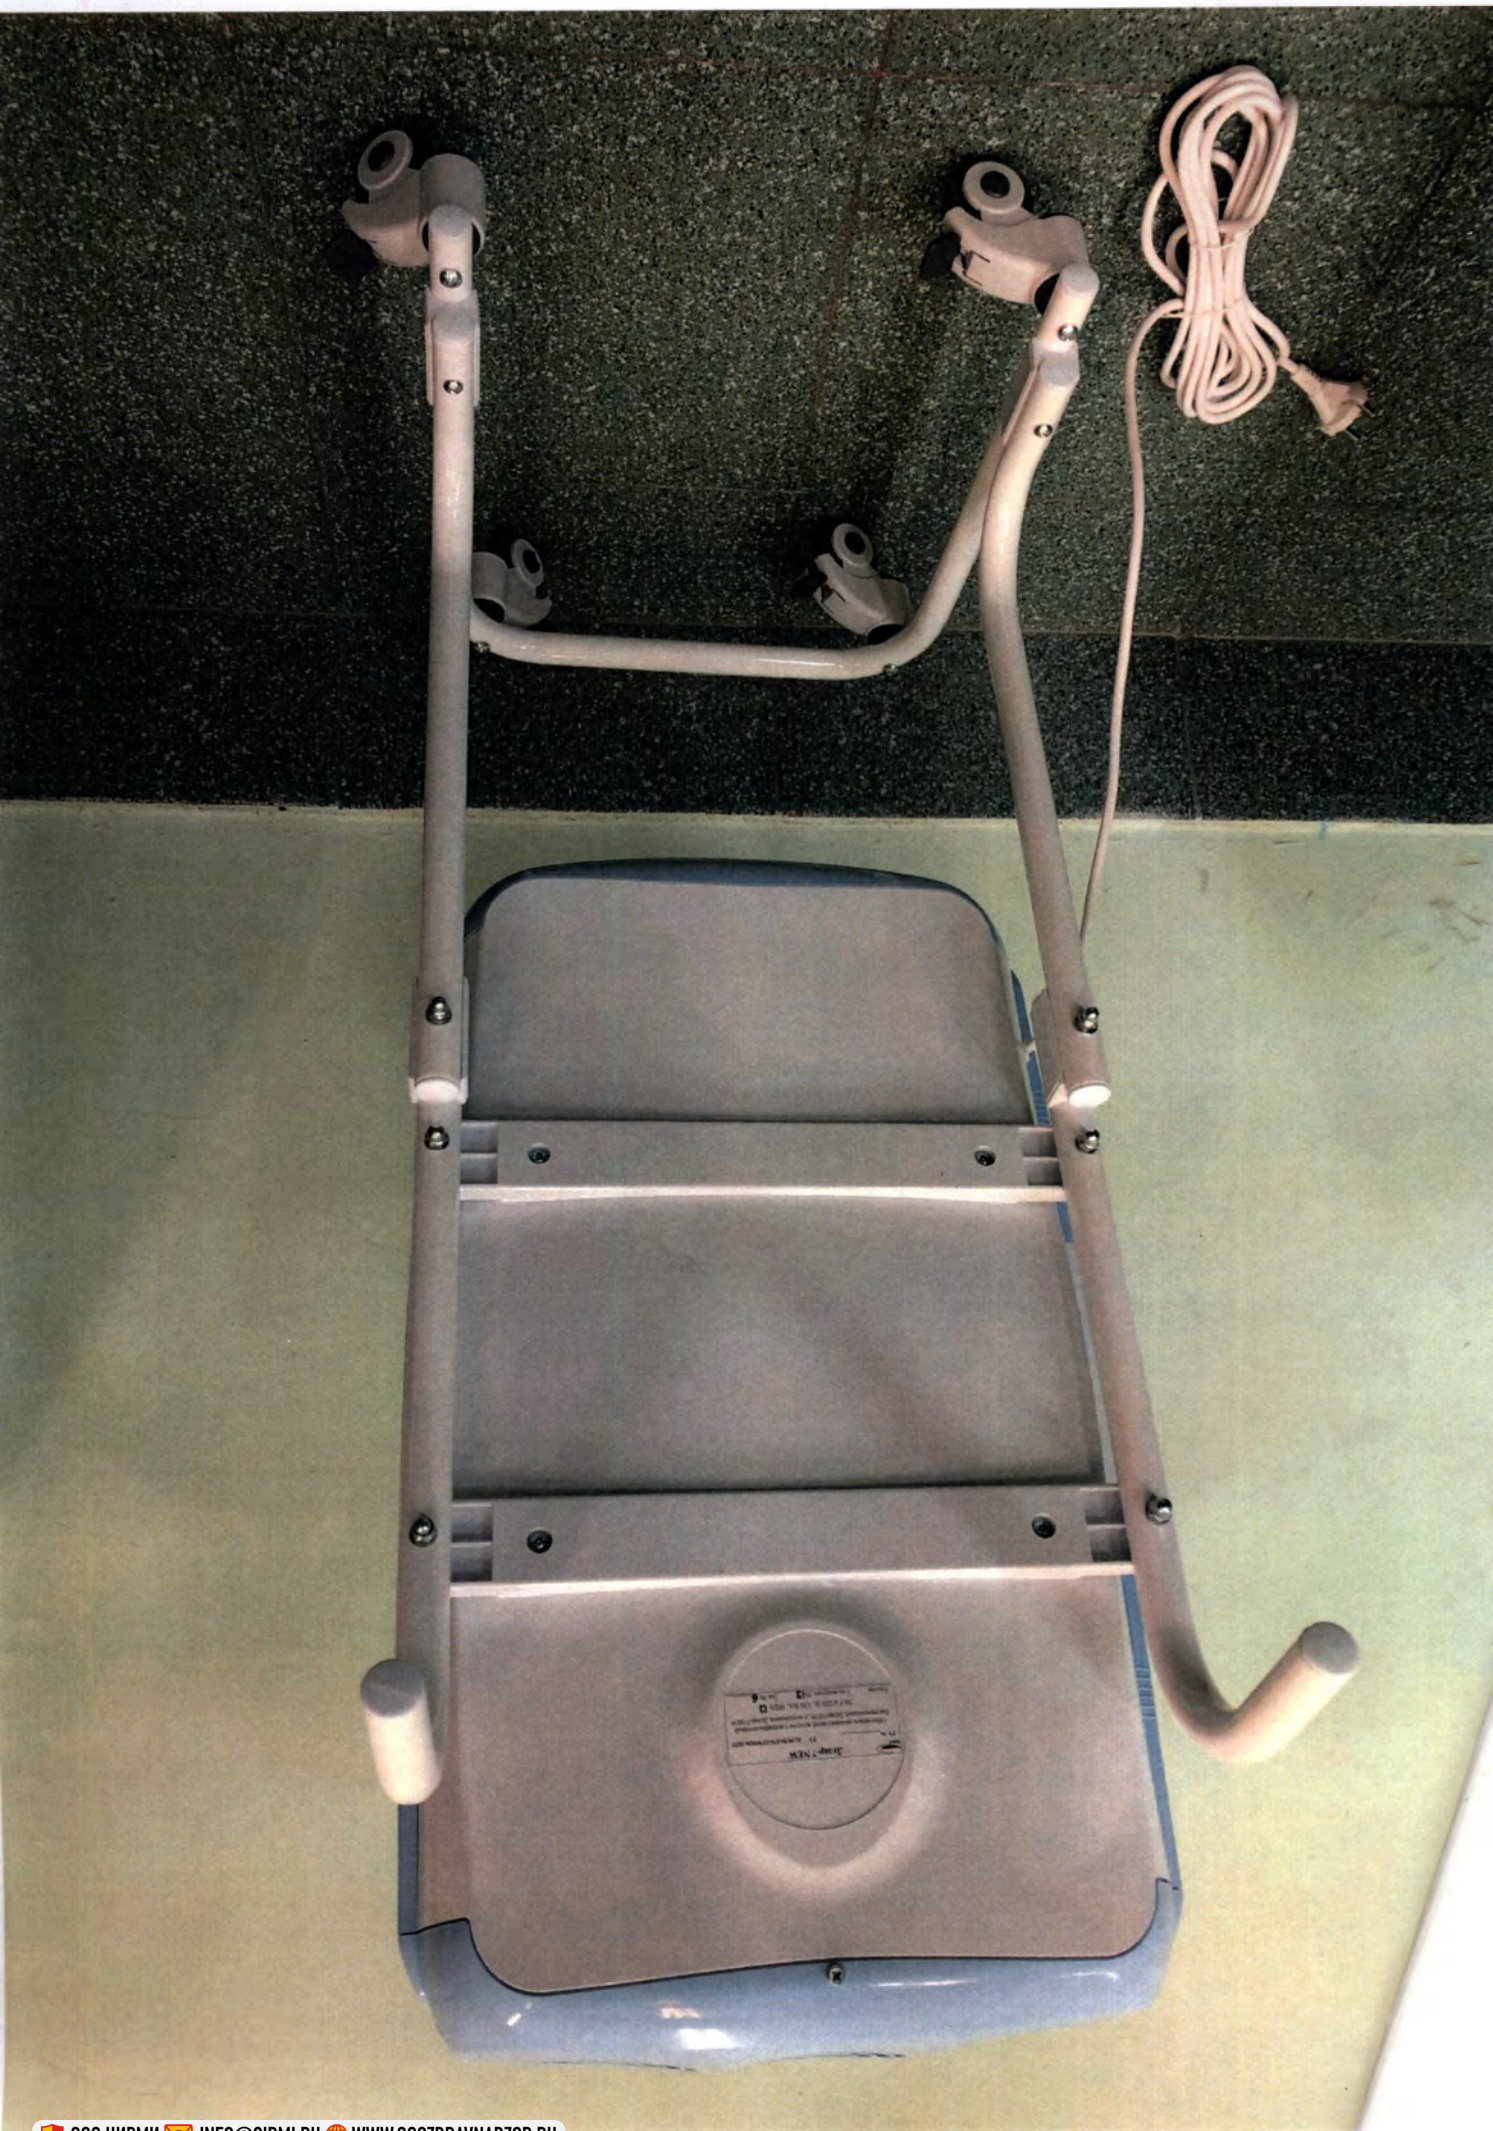



КронТ

Дезар-7 NEW

РУ № _____

ТУ 32.50.50-076-11769436-2019

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый
бактерицидный Дезар-NEW, в исполнении Дезар-7 NEW

50 Гц/220 В, 130 ВА, IP2X ☐

Россия

Год выпуска: 2019

Зав. № 6

Прошнуровано и скреплено

печатью 24 листов

