Руководство по эксплуатации

Экран пластмассовый для предохранения глаз медицинского персонала ЭПГ-«ЕЛАТ» по ТУ 9398-022-24320270-2008

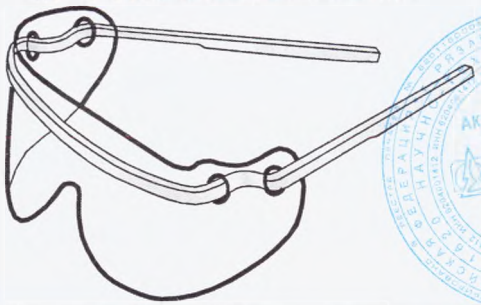

КОПИЯ ВЕРНА

ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЕЛАМЕД ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД

Лёгкий, удобный в эксплуатации

Защита глаз от механических частиц и брызг (крови, гноя, мочи и др.)

КОМПАНИЯ ЕЛАМЕД

Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: Россия, 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
Тел. (49131) 2-04-57
E-mail: admin@elamed.com INTERNET: www.elamed.com

Руководство по эксплуатации

Экран пластмассовый для предохранения глаз медицинского персонала ЭПГ-«ЕЛАТ» по ТУ 9398-022-24320270-2008

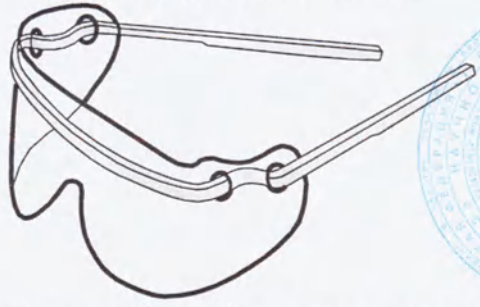

КОПИЯ ВЕРНА

ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЕЛАМЕД ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД

Лёгкий, удобный в эксплуатации

Защита глаз от механических частиц и брызг (крови, гноя, мочи и др.)

КОМПАНИЯ ЕЛАМЕД

Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: Россия, 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
Тел. (49131) 2-04-57
E-mail: admin@elamed.com INTERNET: www.elamed.com

Руководство по эксплуатации

Экран пластмассовый для предохранения глаз медицинского персонала ЭПГ-«ЕЛАТ» по ТУ 9398-022-24320270-2008

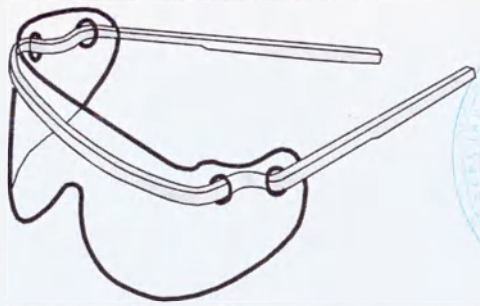

КОПИЯ ВЕРНА

ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЕЛАМЕД ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД

Лёгкий, удобный в эксплуатации

Защита глаз от механических частиц и брызг (крови, гноя, мочи и др.)

КОМПАНИЯ ЕЛАМЕД

Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: Россия, 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
Тел. (49131) 2-04-57
E-mail: admin@elamed.com INTERNET: www.elamed.com

Руководство по эксплуатации

Экран пластмассовый для предохранения глаз медицинского персонала ЭПГ-«ЕЛАТ» по ТУ 9398-022-24320270-2008

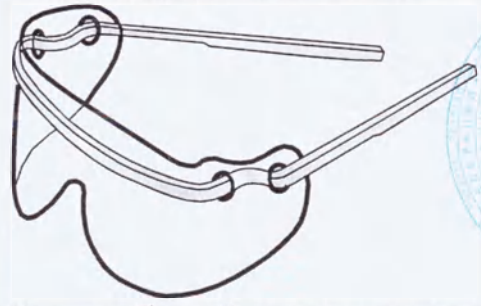

КОПИЯ ВЕРНА

ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЕЛАМЕД ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД

Лёгкий, удобный в эксплуатации

Защита глаз от механических частиц и брызг (крови, гноя, мочи и др.)

КОМПАНИЯ ЕЛАМЕД

Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: Россия, 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
Тел. (49131) 2-04-57
E-mail: admin@elamed.com INTERNET: www.elamed.com

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Предназначен для индивидуальной защиты глаз медицинского и технического персонала от брызг и частиц биологического происхождения, механических частиц, капель дезинфицирующих растворов, во время проведения медицинских манипуляций и лабораторных исследований, а также во время уборок помещений. Экран является средством индивидуального применения и может использоваться в медицинских учреждениях различного профиля.

Экран устойчив к санитарно-гигиенической обработке и дезинфекции дезинфицирующими агентами для полимерных материалов с температурой до (20±5) °С по МУ-287-113.

Средний ресурс экрана – не менее 5000 разгибаний заушных частей оправы при удалении концов этих частей на расстояние (145±5) мм друг от друга. Критерием предельного состояния экрана является поломка оправы.

Утилизация: после окончания эксплуатации экрана он подлежит утилизации по правилам, предусмотренными в СанПиН 2.1.7.2790-10 для отходов класса «Б».

Размер экрана: 130_{-2} x 165_{-2} x 70_{-2} мм

Масса: не более 15 г.

Срок сохраняемости: не менее 2 лет.

Меры предосторожности: не допускать удаление заушных частей оправы более чем на 150 мм.

Транспортирование и хранение:

- Условия транспортирования экрана по ГОСТ 15150 по условиям хранения 5.
- Условия хранения экрана – по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

Не использовать изделие при обнаружении повреждений и дефектов.

В случае обнаружения повреждений и дефектов обратиться к предприятию-изготовителю или его представителю.

Гарантийный срок – 1 год.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03716 от 12 декабря 2008 года.

ОМ № 23.126.07

Комплект поставки:
- оправа – 1 шт.
- защитная пленка – 1 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.
- конверт.

Дата выпуска
Штамп ОТК

Для сборки экрана необходимо один из концов оправы продеть в отверстие 1, затем в отверстие 2, другой конец оправы в отверстие 3, затем в отверстие 4 защитной пленки.

Предназначен для индивидуальной защиты глаз медицинского и технического персонала от брызг и частиц биологического происхождения, механических частиц, капель дезинфицирующих растворов, во время проведения медицинских манипуляций и лабораторных исследований, а также во время уборок помещений. Экран является средством индивидуального применения и может использоваться в медицинских учреждениях различного профиля.

Экран устойчив к санитарно-гигиенической обработке и дезинфекции дезинфицирующими агентами для полимерных материалов с температурой до (20±5) °С по МУ-287-113.

Средний ресурс экрана – не менее 5000 разгибаний заушных частей оправы при удалении концов этих частей на расстояние (145±5) мм друг от друга. Критерием предельного состояния экрана является поломка оправы.

Утилизация: после окончания эксплуатации экрана он подлежит утилизации по правилам, предусмотренными в СанПиН 2.1.7.2790-10 для отходов класса «Б».

Размер экрана: 130_{-2} x 165_{-2} x 70_{-2} мм

Масса: не более 15 г.

Срок сохраняемости: не менее 2 лет.

Меры предосторожности: не допускать удаление заушных частей оправы более чем на 150 мм.

Транспортирование и хранение:

- Условия транспортирования экрана по ГОСТ 15150 по условиям хранения 5.
- Условия хранения экрана – по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

Не использовать изделие при обнаружении повреждений и дефектов.

В случае обнаружения повреждений и дефектов обратиться к предприятию-изготовителю или его представителю.

Гарантийный срок – 1 год.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03716 от 12 декабря 2008 года.

ОМ № 23.126.07

Комплект поставки:
- оправа – 1 шт.
- защитная пленка – 1 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.
- конверт.

Дата выпуска
Штамп ОТК

Для сборки экрана необходимо один из концов оправы продеть в отверстие 1, затем в отверстие 2, другой конец оправы в отверстие 3, затем в отверстие 4 защитной пленки.

Предназначен для индивидуальной защиты глаз медицинского и технического персонала от брызг и частиц биологического происхождения, механических частиц, капель дезинфицирующих растворов, во время проведения медицинских манипуляций и лабораторных исследований, а также во время уборок помещений. Экран является средством индивидуального применения и может использоваться в медицинских учреждениях различного профиля.

Экран устойчив к санитарно-гигиенической обработке и дезинфекции дезинфицирующими агентами для полимерных материалов с температурой до (20±5) °С по МУ-287-113.

Средний ресурс экрана – не менее 5000 разгибаний заушных частей оправы при удалении концов этих частей на расстояние (145±5) мм друг от друга. Критерием предельного состояния экрана является поломка оправы.

Утилизация: после окончания эксплуатации экрана он подлежит утилизации по правилам, предусмотренными в СанПиН 2.1.7.2790-10 для отходов класса «Б».

Размер экрана: 130_{-2} x 165_{-2} x 70_{-2} мм

Масса: не более 15 г.

Срок сохраняемости: не менее 2 лет.

Меры предосторожности: не допускать удаление заушных частей оправы более чем на 150 мм.

Транспортирование и хранение:

- Условия транспортирования экрана по ГОСТ 15150 по условиям хранения 5.
- Условия хранения экрана – по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

Не использовать изделие при обнаружении повреждений и дефектов.

В случае обнаружения повреждений и дефектов обратиться к предприятию-изготовителю или его представителю.

Гарантийный срок – 1 год.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03716 от 12 декабря 2008 года.

ОМ № 23.126.07

Комплект поставки:
- оправа – 1 шт.
- защитная пленка – 1 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.
- конверт.

Дата выпуска
Штамп ОТК

Для сборки экрана необходимо один из концов оправы продеть в отверстие 1, затем в отверстие 2, другой конец оправы в отверстие 3, затем в отверстие 4 защитной пленки.

Предназначен для индивидуальной защиты глаз медицинского и технического персонала от брызг и частиц биологического происхождения, механических частиц, капель дезинфицирующих растворов, во время проведения медицинских манипуляций и лабораторных исследований, а также во время уборок помещений. Экран является средством индивидуального применения и может использоваться в медицинских учреждениях различного профиля.

Экран устойчив к санитарно-гигиенической обработке и дезинфекции дезинфицирующими агентами для полимерных материалов с температурой до (20±5) °С по МУ-287-113.

Средний ресурс экрана – не менее 5000 разгибаний заушных частей оправы при удалении концов этих частей на расстояние (145±5) мм друг от друга. Критерием предельного состояния экрана является поломка оправы.

Утилизация: после окончания эксплуатации экрана он подлежит утилизации по правилам, предусмотренными в СанПиН 2.1.7.2790-10 для отходов класса «Б».

Размер экрана: 130_{-2} x 165_{-2} x 70_{-2} мм

Масса: не более 15 г.

Срок сохраняемости: не менее 2 лет.

Меры предосторожности: не допускать удаление заушных частей оправы более чем на 150 мм.

Транспортирование и хранение:

- Условия транспортирования экрана по ГОСТ 15150 по условиям хранения 5.
- Условия хранения экрана – по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

Не использовать изделие при обнаружении повреждений и дефектов.

В случае обнаружения повреждений и дефектов обратиться к предприятию-изготовителю или его представителю.

Гарантийный срок – 1 год.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03716 от 12 декабря 2008 года.

ОМ № 23.126.07

Комплект поставки:
- оправа – 1 шт.
- защитная пленка – 1 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.
- конверт.

Дата выпуска
Штамп ОТК

Для сборки экрана необходимо один из концов оправы продеть в отверстие 1, затем в отверстие 2, другой конец оправы в отверстие 3, затем в отверстие 4 защитной пленки.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU