


Приложение 1

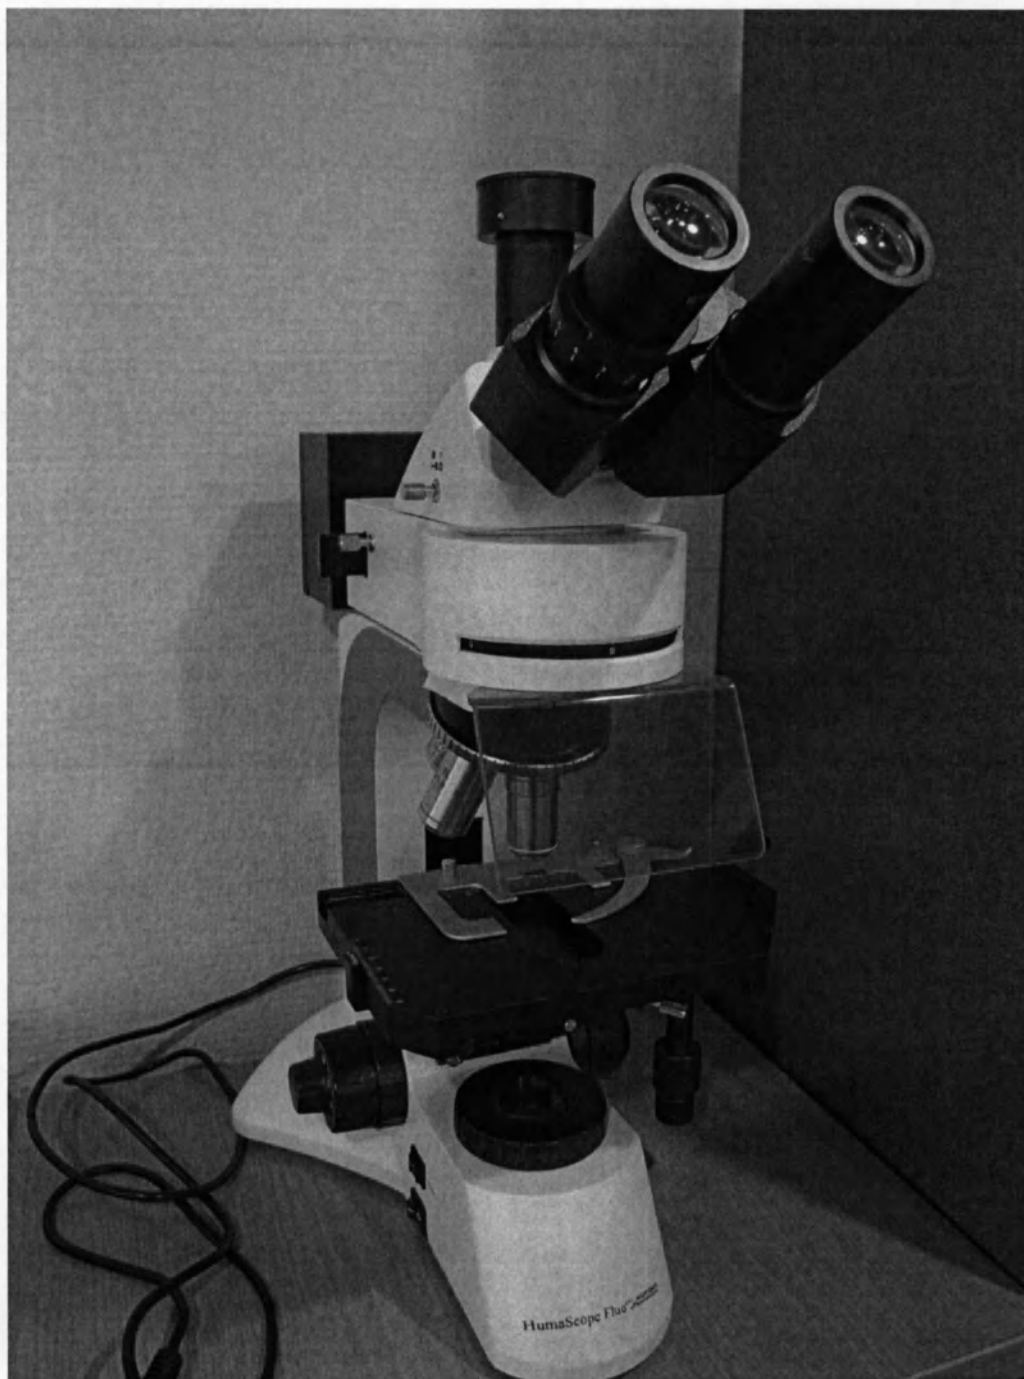

Микроскоп биологический флуоресцентный HumaScope Fluo^{LED}.
Общий вид

Фото 1

Протокол технических испытаний № 326/ЭБ-11
от 28.11.2011 г. на 39 листах

Настоящий протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Не допускается частичная или полная перепечатка настоящего протокола без разрешения
ИЛЦ ФГУ «НИИ ФХМ» ФМБА России