




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови прямым методом (ЛНП-Холестерин-Ново-А (вариант 2))» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



107 2019 г.

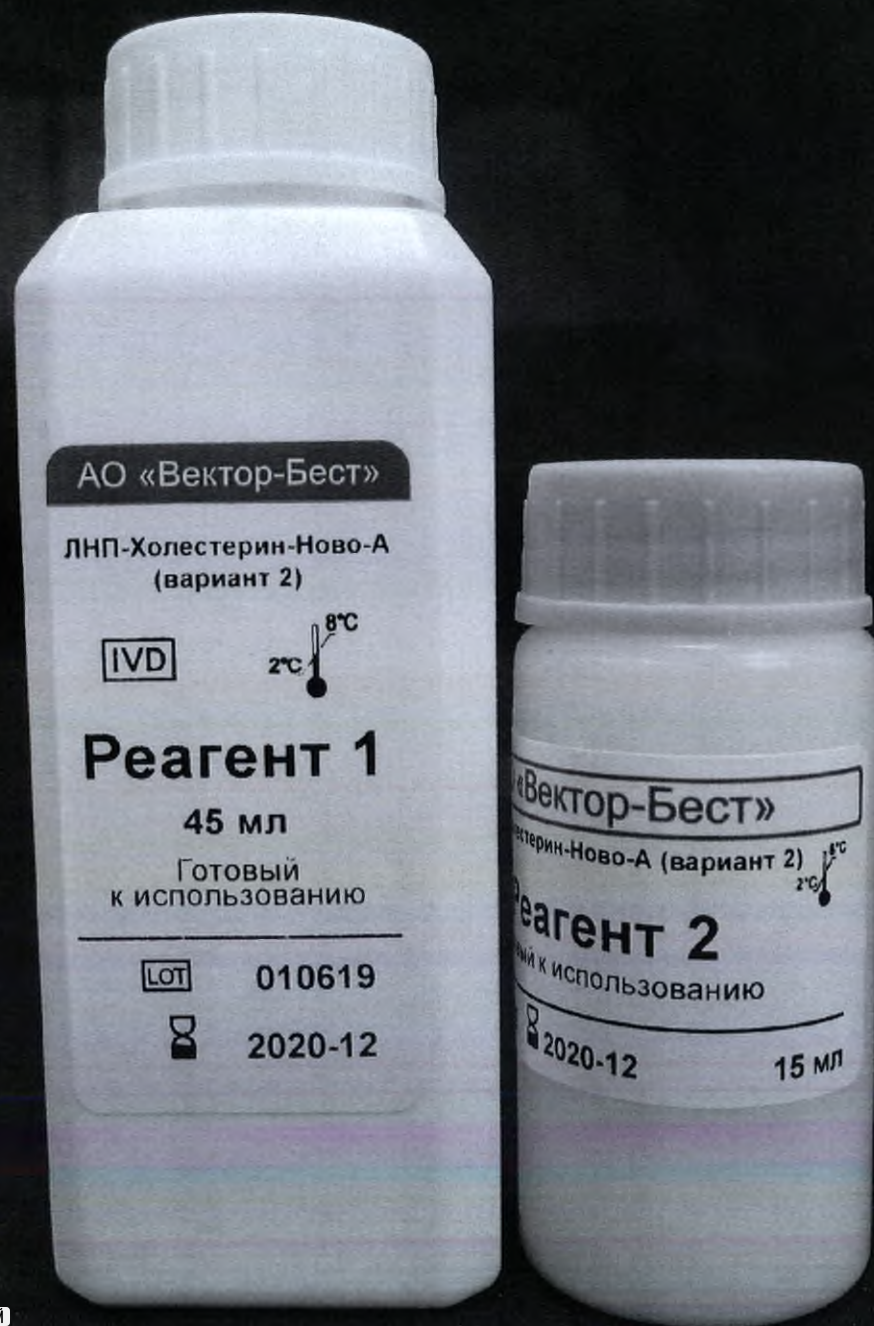

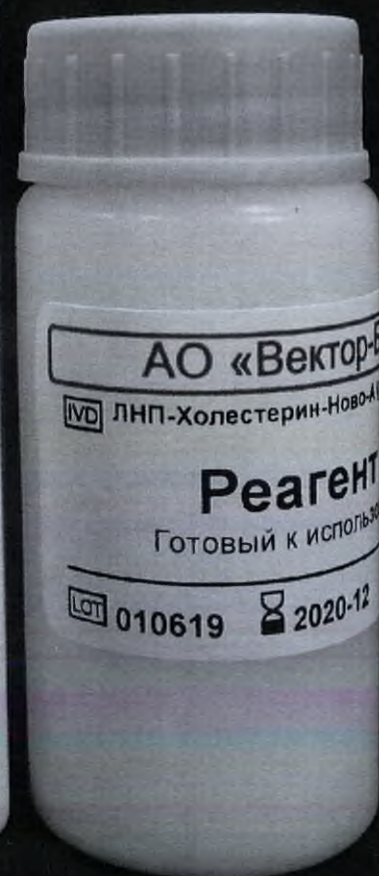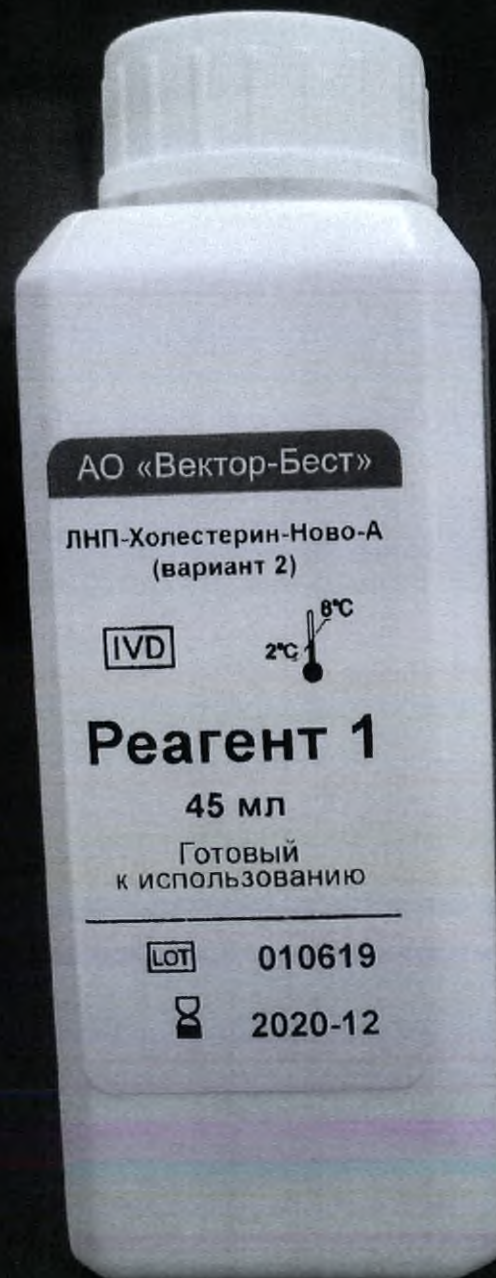




REF

B-8358

LOT

010619



2019-06

2020-12

**ЛНП-Холестерин-Ново-А
(вариант 2)**



835812200010619



Для профессионального применения

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови прямым методом (ЛНП-Холестерин-Ново-А (вариант 2))» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
07 2019 г.

ВЕКТОР

БЕСТ

REF

B-8358

набор реагентов для
определения концентрации
холестерина липопротеидов
низкой плотности в сыворотке
крови прямым методом

**ЛНП-Холестерин-Ново-А
(вариант 2)**


Состав: Реагент 1 (4x45 мл)
Реагент 2 (4x15 мл) ✓

ТУ 9398-505-23548172-2014
ПУ № РЗН 2015/3376 от 10.02.2017

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови прямым методом (ЛНП-Холестерин-Ново-А (вариант 2))»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
07 2019 г.

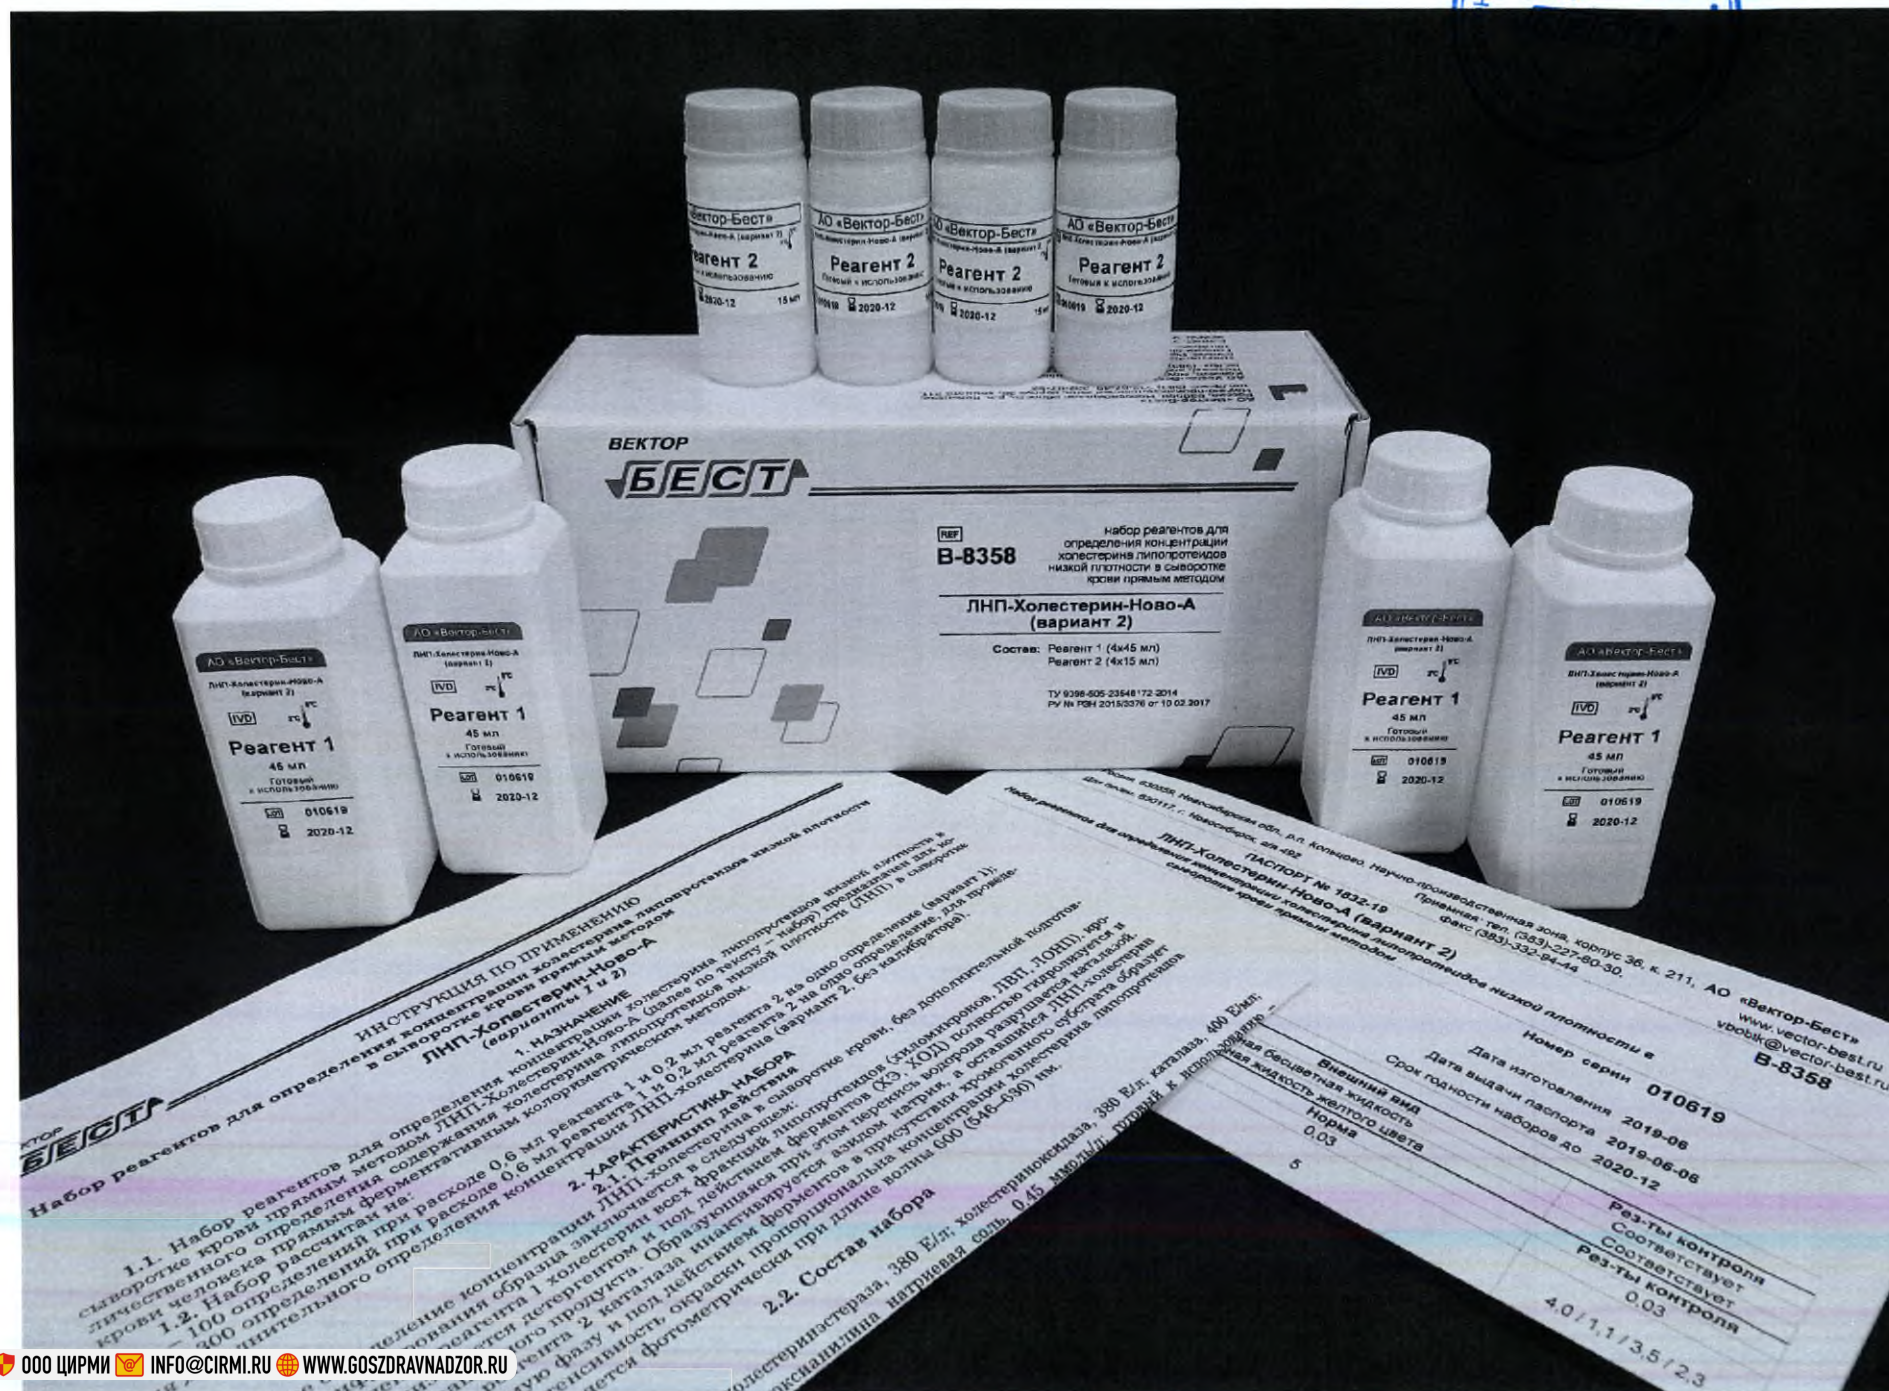

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови прямым методом (ЛНП-Холестерин-Ново-А (вариант 1))» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови прямым методом (ЛНП-Холестерин-Ново-А (вариант 1))» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови прямым методом (ЛНП-Холестерин-Ново-А (вариант 1))» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

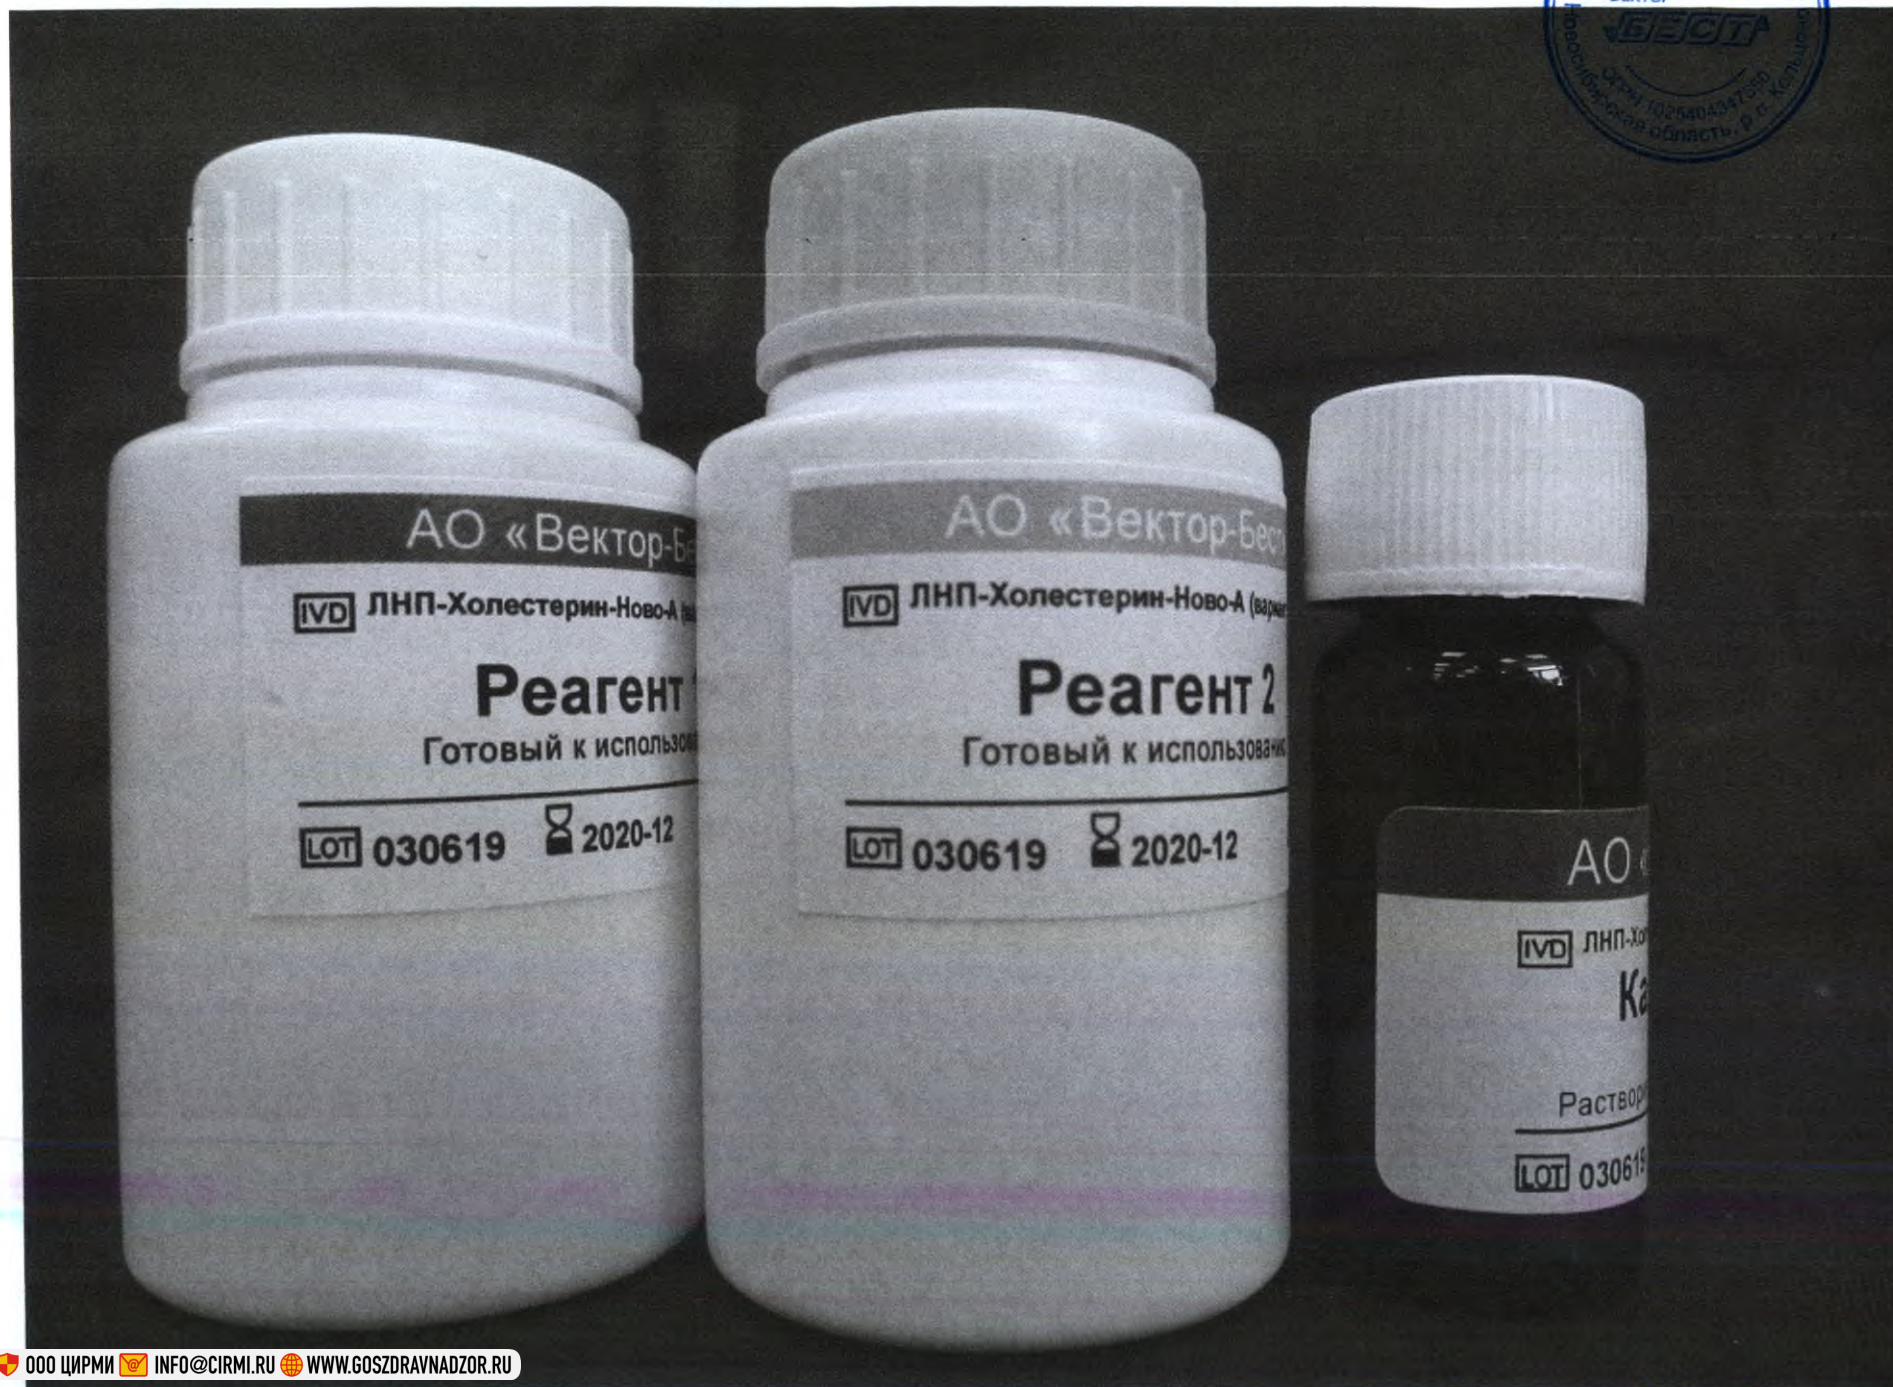

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови прямым методом (ЛНП-Холестерин-Ново-А (вариант 1))» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»




Хусаинов М.Д.
2019 г.

REF

B-8357

LOT

030619



2019-06

2020-12

**ЛНП-Холестерин-Ново-А
(вариант 1)**



835712200030619



Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют



ВЕКТОР

БЕСТ

REF

B-8357

набор реагентов
для определения концентрации
холестерина липопротеидов
низкой плотности в сыворотке
крови прямым методом

**ЛНП-Холестерин-Ново-А
(вариант 1)**

Состав: Реагент 1 (3×20 мл)
Реагент 2 (1×20 мл)
Калибратор (1 фл.)

ТУ 9398-505-23548172-2014
ПУ № РЗН 2015/3376 от 10.02.2017

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови прямым методом (ЛНП-Холестерин-Ново-А (вариант 1))»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

