

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «НекстБио»



А. В. Смирнов

2019 г.

## **ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Набор реагентов для количественного определения ДНК энтеробактерий, стафилококков и стрептококков методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® AV» по ТУ 21.20.23-034-09286667-2018.

Набор выпускается в 2-х формах выпуска.

Форма 1 в составе:

1. ПЦР-смесь AV – 0,01 мл × 96 пробирок (12 стрипов по 8 пробирок).
2. Буфер А – 0,96 мл × 1 пробирка.
3. ПКО STI – 1,0 мл × 1 пробирка.
4. ОКО – 1,0 мл × 1 пробирка.
5. Программное обеспечение «АмплиПрайм® AV ПО» версия 1.0 на USB флэш-накопителе.

Форма 2 в составе:

1. ПЦР-смесь AV – 0,96 мл × 1 пробирка.
2. Буфер А – 0,96 мл × 1 пробирка.
3. ПКО STI – 1,0 мл × 1 пробирка.
4. ОКО – 1,0 мл × 1 пробирка.
5. Программное обеспечение АмплиПрайм® AV ПО» версия 1.0 на USB флэш-накопителе.

В комплект поставки входит:

1. набор реагентов (форма выпуска 1 или 2);
2. инструкция по применению набора в электронном виде на USB флэш-накопителе и на официальном сайте Производителя по адресу: <http://www.nextbio.ru/reagents/>;
3. краткое руководство по применению набора в бумажном виде;
4. вкладыш к набору в бумажном виде;
5. руководство оператора в электронном виде на USB флэш-накопителе и на официальном сайте Производителя по адресу: <http://www.nextbio.ru/reagents/>;
6. паспорт качества в электронном виде на официальном сайте Производителя по адресу: <http://www.nextbio.ru/passport/>.

**AmpliPrime**

## АмплиПрайм® AV

Набор реагентов для количественного определения ДНК энтеробактерий, стафилококков и стрептококков методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® AV» по ТУ 21.20.23-034-09286667-2018



# «АмплиПрайм® AV», форма выпуска 1 ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ

Набор реагентов для количественного определения ДНК энтеробактерий, стафилококков и стрептококков методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® AV» по ТУ 21.20.23-034-09286667-2018

Форма выпуска 1 **REF** P2006-21  96

Состав набора:

ПЦР-смесь AV

0,01 мл x 96  
(12 стрипов по 8 пробирок)

Буфер А

0,96 мл x 1

ПКО STI

1,0 мл x 1

ОКО


1,0 мл x 1

Программное обеспечение

USB флэш-накопитель

«АмплиПрайм® AV ПО»

версия 1.0



**LOT** 0106



2019-05-13



2020-05-13



ООО «НекстБио»

Россия, 111394, Москва ул. Полимерная, д.8, стр. 2

тел. (495) 620-08-73, [www.nextbio.ru](http://www.nextbio.ru)

РУ № РЭН xxxx/xxxx от dd.мм.гг

Набор реагентов для количественного определения ДНК энтеро-стафилококков и стрептококков методом полимеразной цепной детекции в режиме «реального времени» «АмплиПрайм» по ТУ 21.20.23-034-09286667-201

Форма выпуска 1 **REF** P2006-21

Состав набора:


ПЦР-смесь AV

Буфер А

ПКО STI

ОКО

Программное обеспечение  
«АмплиПрайм® AV ПО»  
версия 1.0

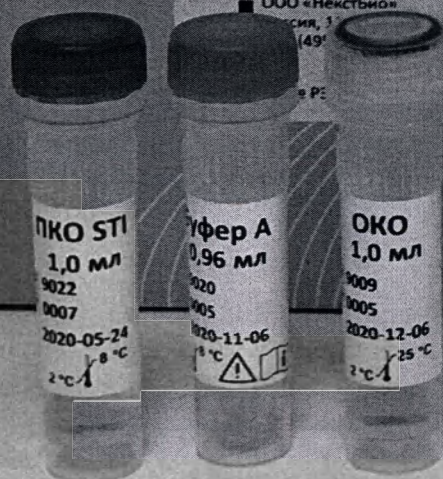

**АМПЛИПРАЙМ**  
Программное обеспечение  
"АмплиПрайм® AV ПО"  
версии 1.0,  
Руководство оператора,  
Инструкция по применению  
к набору реагентов  
АмплиПрайм® AV  
REF P2006-21 REF 2006-22


**АМПЛИПРАЙМ**  
ПЦР-смесь AV  
0,01 мл x 96  
(12 стрипов по 8 пробирок)  
REF 9075  
LOT 0003  
2020-11-08  
2°C - 8°C  
⚠️ ☀️

«АмплиПрайм® AV», форма выпуска 1  
СОСТАВ

**AmpliPrime**

## АмплиПрайм® AV


Набор реагентов для количественного определения ДНК энтеробактерий, стафилококков и стрептококков методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® AV» по ТУ 21.20.23-034-09286667-2018



«АмплиПрайм® AV», форма выпуска 2  
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ

Набор реагентов для количественного определения ДНК энтеробактерий, стафилококков и стрептококков методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® AV» по ТУ 21.20.23-034-09286667-2018

Форма выпуска 2 **REF** 2006-22  $\Sigma$  96



**Состав набора:**

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| ПЦР-смесь AV                                          | 0,96 мл x 1         |
| Буфер А                                               | 0,96 мл x 1         |
| ПКО STI                                               | 1,0 мл x 1          |
| ОКО                                                   | 1,0 мл x 1          |
| Програмное обеспечение «АмплиПрайм® AV ПО» версия 1.0 | USB флэш-накопитель |

**LOT** 0102

 2019-05-13

 2020-05-13



ООО «НекстБио»  
Россия, 111394, Москва ул. Полимерная, д.8, стр. 2  
тел. (495) 620-08-73, [www.nextbio.ru](http://www.nextbio.ru)

РУ № РЗН xxxx/xxxx от дд.мм.гг




«АмплиПрайм® AV», форма выпуска 2  
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ

Набор реагентов для количественного определения ДНК энтеробактерий, стафилококков и стрептококков методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® AV» по ТУ 21.20.23-034-09286667-2018

Форма выпуска 2

REF 2006-22

96



Состав набора:





- ПЦР-смесь AV 0,96 мл x 1
- Буфер А 0,96 мл x 1
- ПКО 1,0 мл x 1
- ОК 1,0 мл x 1

беспечении...ш-накоп  
м® AV ПО»

АМПЛИПРАЙМ

REF P2006-21 REF 2006-22

Программное обеспечение  
"АмплиПрайм® AV ПО"  
версии 1.0,  
Руководство оператора,  
Инструкция по применению  
к набору реагентов  
АмплиПрайм® AV

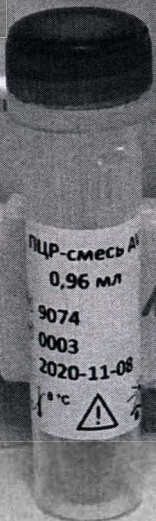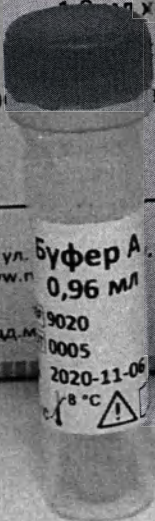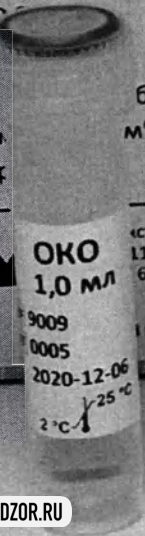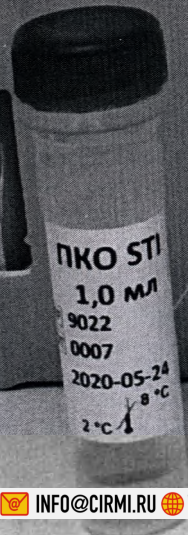

Пронумеровано, скреплено и прошито  
5 лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с  
ограниченной ответственностью  
«НекстБио»

\_\_\_\_\_ А.В. Смирнов

