

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Интрамедуллярная система остеосинтеза SLIM

Рис.1 - Имплантат SLM-26-080



Рис.2 - Имплантат SLM-32-080

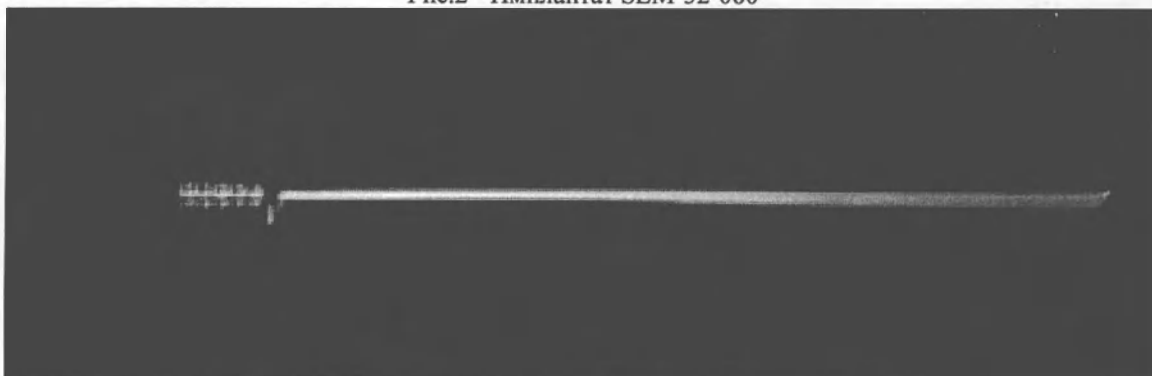


Рис.3 - Имплантат SLM-56-400




Рис.4 - Имплантат SLM-64-400

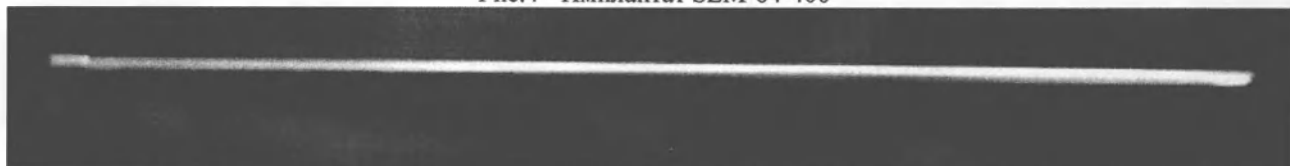


Рис. 5 - Винт M3.5 SLM-CAP-350



Рис.6 Отвёртка для имплантатов, диаметром 2,0, 2,6 мм и 3,2 мм - SLM-DRV123

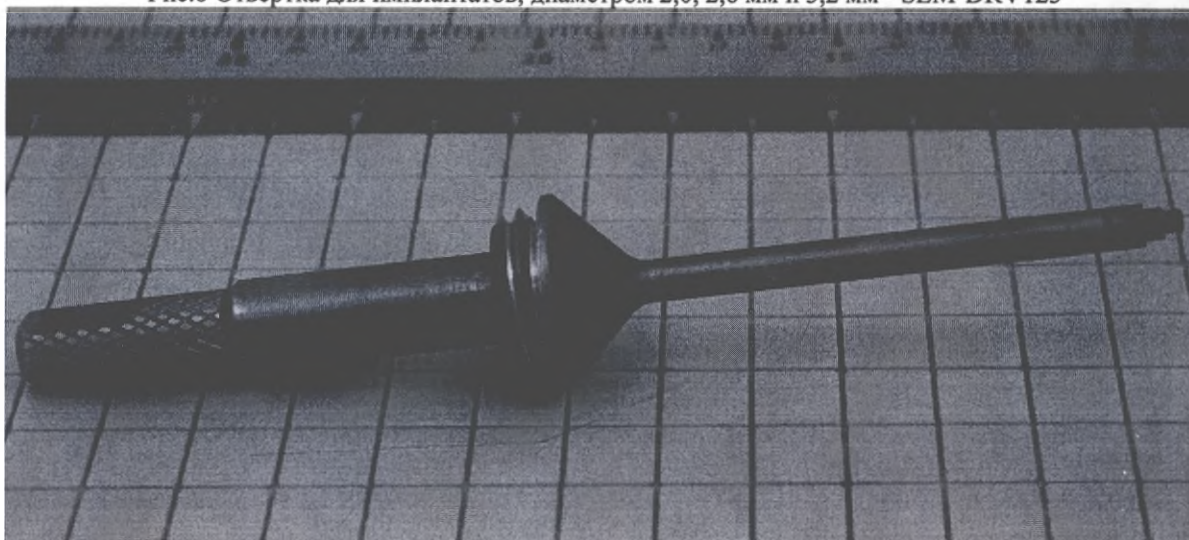


Рис.7 Отвёртка для имплантатов, диаметром 4,0, 4,8, 5,6 и 6,4 мм - SLM-DRV146,



Рис. 8 Ручка в сборе - SLM-HND100

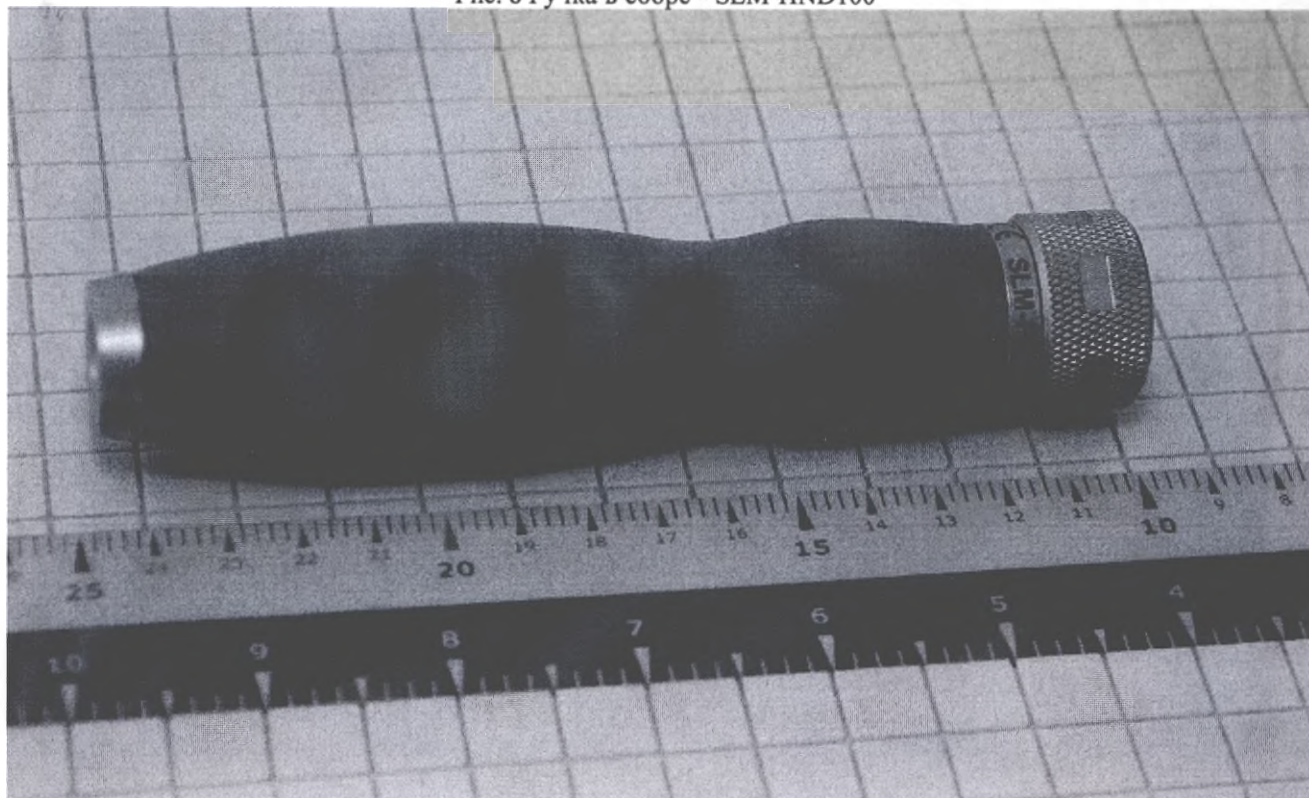


Рис. 9 Ортопедический молоток в сборе - SLM-IPT100

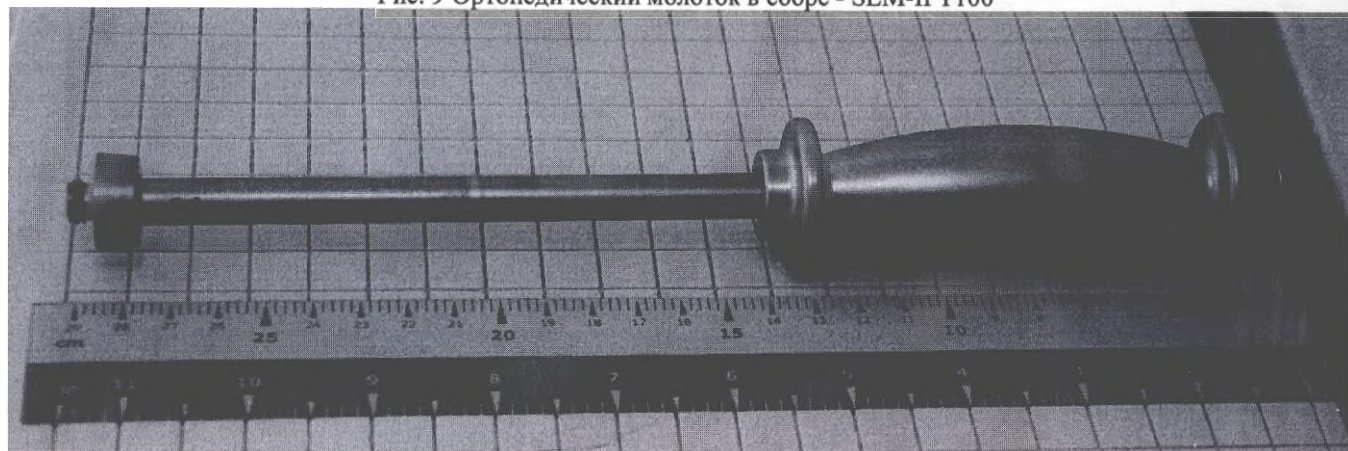


Рис. 10 Многофункциональный ключ - SLM-MPW100



Рис. 11 Динамометрический ключ - SLM-KNW100

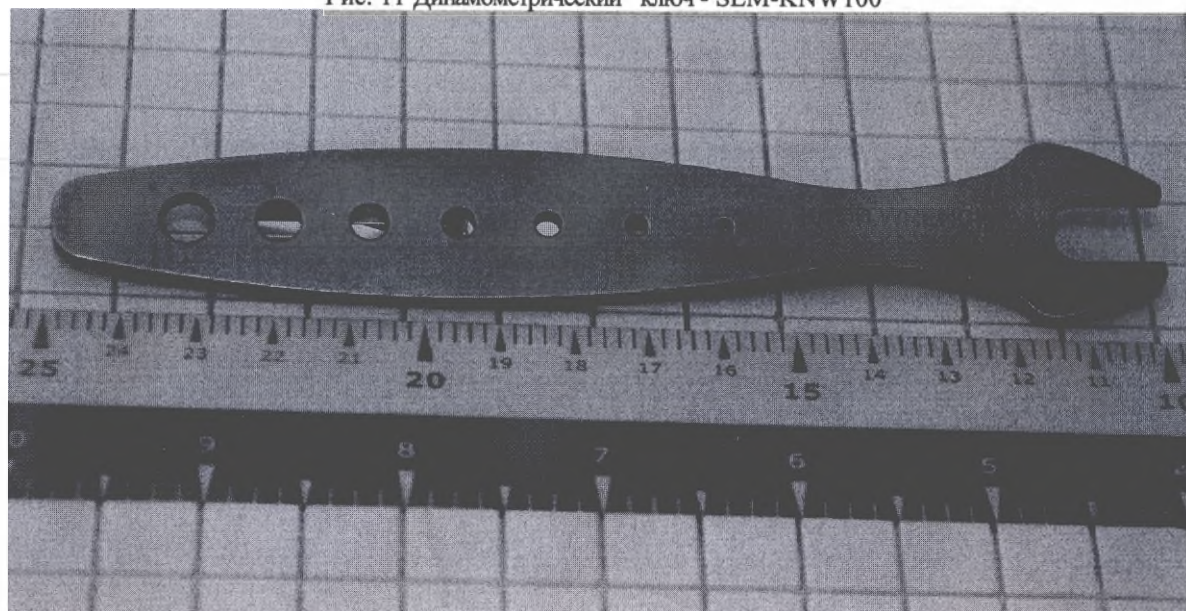


Рис. 12 Насадка отвёртки - SLM-CDR100

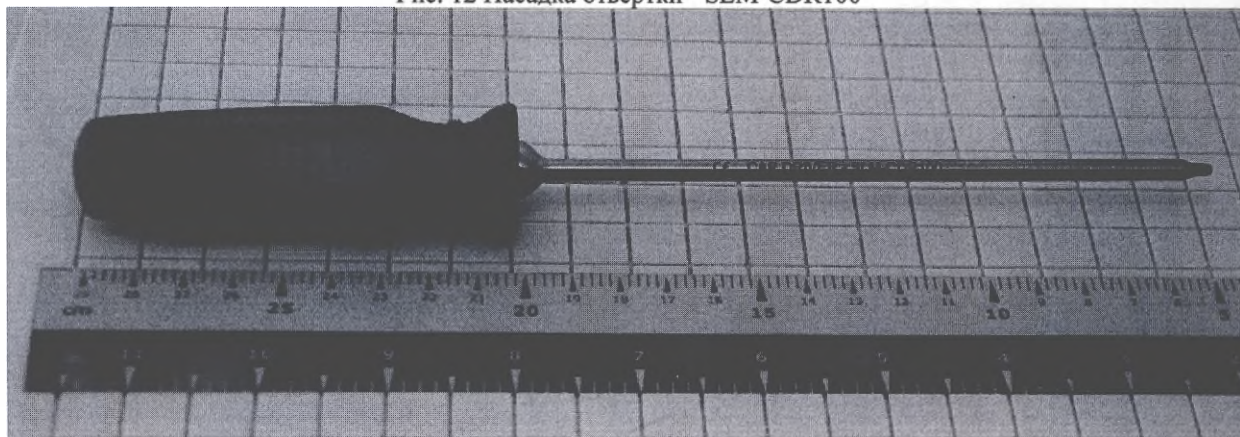


Рис. 13 Зажимная рукоятка Jacob - GIN-JCH100



Рис. 14 Протектор ткани - GIN-TPR100

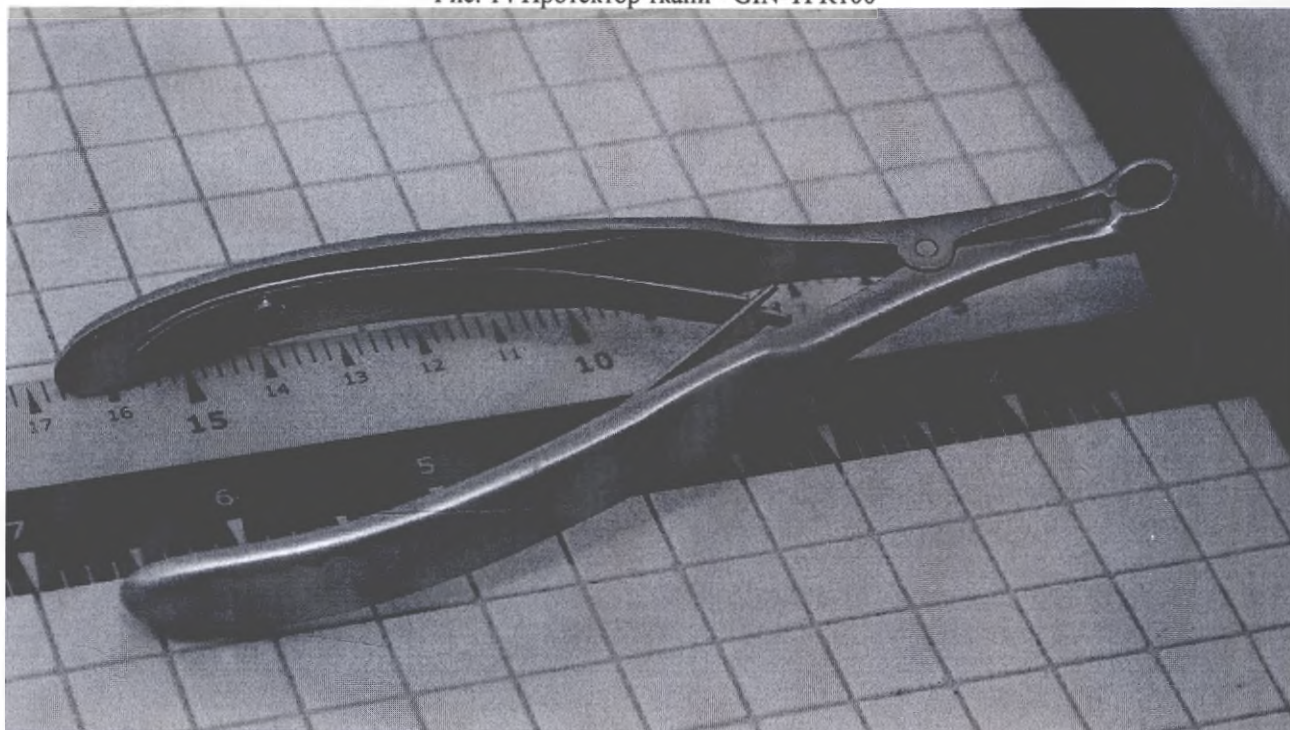



Рис. 15 Направляющая спица 1,6 мм - SLM-GWR160



Рис. 16 Сверло 2.6 мм - SLM-DCA026, Сверло 3.2 мм - SLM-DCA032, Сверло 4.0 мм - SLM-DCA040, Сверло 4.8 мм - SLM-DCA048, Сверло 5.6 мм - SLM-DCA056, Сверло 6.4 мм - SLM-DCA064



Рис. 17 Контейнер для стерилизации инструментов - SLM-INE100

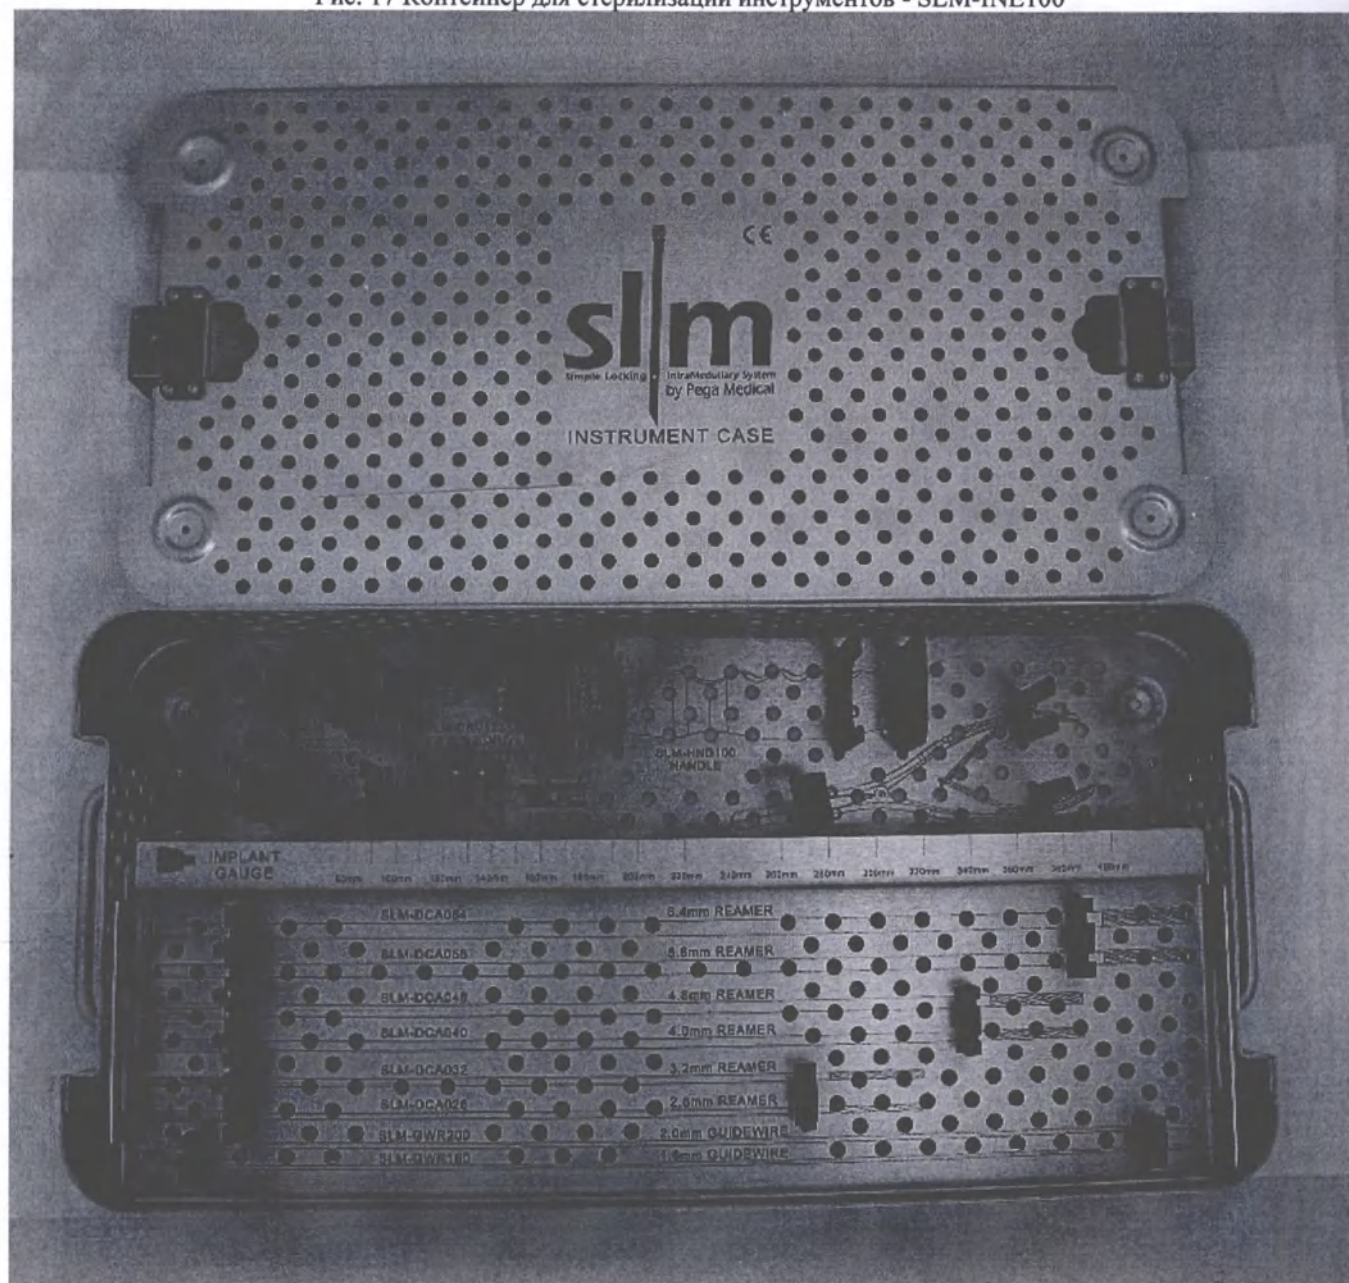

Бис. 18 Образец маркировки на индивидуальной упаковке из картона/пластика

**Интрамедуллярная система остеосинтеза SLIM,
Имплантат SLIM ROD ø 2.6 мм**

CAT # SLM-26-080


 «Пега Медикал Инк.»,
1111 Ауторут Чомеди, Лаваль, Квебек H7W5J8, Канада
Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Орфан групп»
115191, Россия, г. Москва, 2-я Рощинская улица, дом. 4, этаж 3,
помещение 1, комната 8,, офис 42А,
тел.: +7 (499) 463-43-45
08.2018
Срок годности: 08.2024

LOT 160405-018

№ РУ _____

Материал: Сталь SS 316L

Кол-во: 1 Масса брутто: 15 г.

Бис. 19 Образец маркировки на коробке для стерилизации

**Интрамедуллярная система остеосинтеза SLIM
Имплантаты SLIM ROD ø 5.6 мм**

CAT # SLM-IME156

 «Пега Медикал Инк.», Канада («Pega Medical Inc.», Canada)
1111 Ауторут Чомеди, Лаваль, Квебек H7W5J8, Канада
Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Орфан групп»
115191, Россия, г. Москва, 2-я Рощинская улица, дом. 4, этаж 3,
помещение 1, комната 8,, офис 42А,
тел.: +7 (499) 463-43-45
08.2018
Срок годности: 08.2024

№ РУ _____

Кол-во составляющих системы: 24 шт.

Масса: 2705 г.

