

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Набор калибраторов для количественного определения пролактина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Prolactin II CalSet Elecsys and cobas e analyzers), в составе


производства Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany

Набор калибраторов для количественного определения пролактина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Prolactin II CalSet Elecsys and cobas e analyzers), в составе


Общий вид



Набор калибраторов для количественного определения пролактина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Prolactin II CalSet Elecsys and cobas e analyzers), в составе

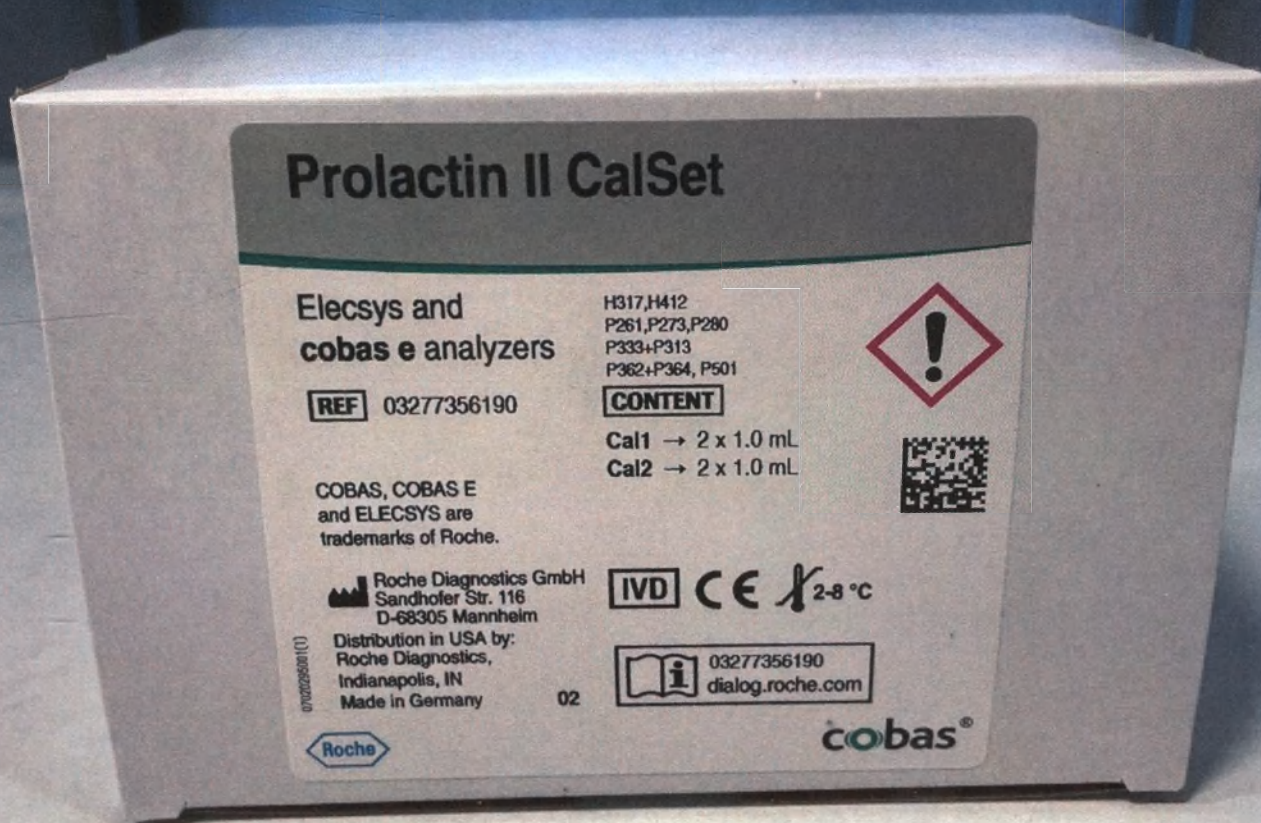

Набор калибраторов для количественного определения пролактина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Prolactin II CalSet Elecsys and cobas e analyzers), в составе

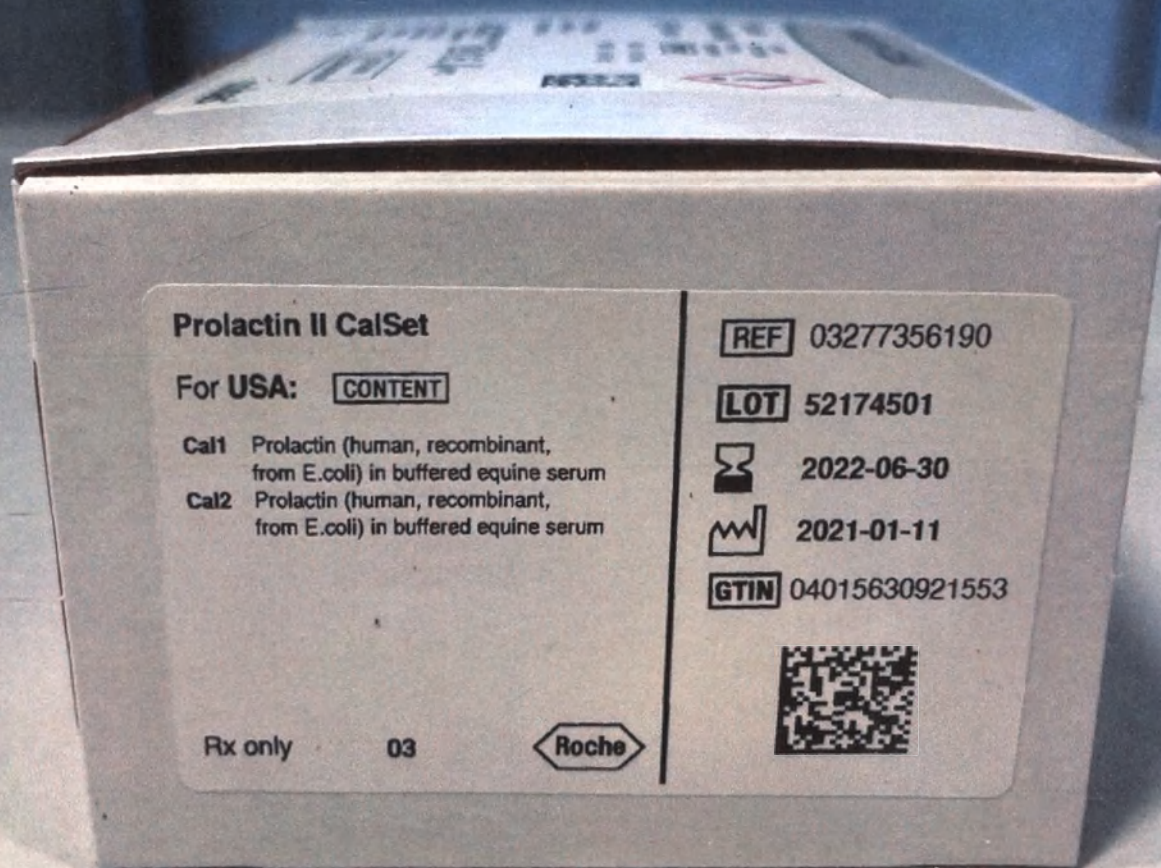

Набор калибраторов для количественного определения пролактина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Prolactin II CalSet Elecsys and cobas e analyzers), в составе

Макет маркировки на русском языке

Набор калибраторов для количественного определения пролактина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Prolactin II CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

в составе:

1. Калибратор 1 (PRL II Cal1), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;
2. Калибратор 2 (PRL II Cal2), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;
3. Флакон пустой – 4 шт.;
4. Карта с штрих-кодом – 1 шт.;
5. Лист с штрих-кодами – 1 шт.;
6. Этикетка со штрих-кодом для флакона – 12 шт.;
7. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке


Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro


Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 03277356190


Калибратор 1 (PRL II Cal1), флакон, 2 шт.

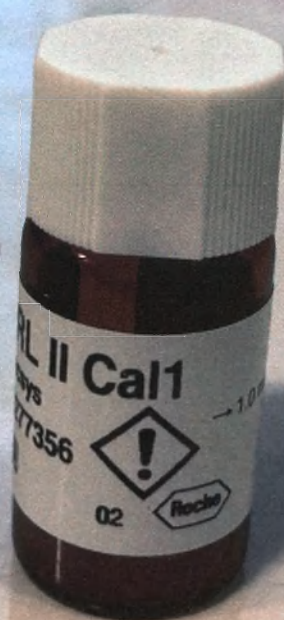


Калибратор 1 (PRL II Cal1), флакон, 2 шт.

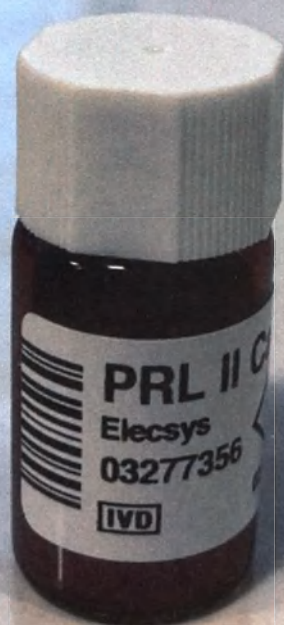


Калибратор 1 (PRL II Cal1), флакон, 2 шт.

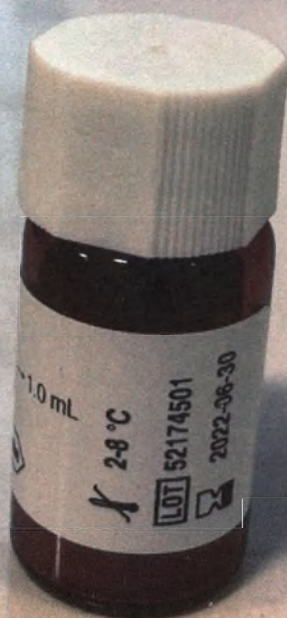


Калибратор 2 (PRL II Cal2), флакон, 2 шт.

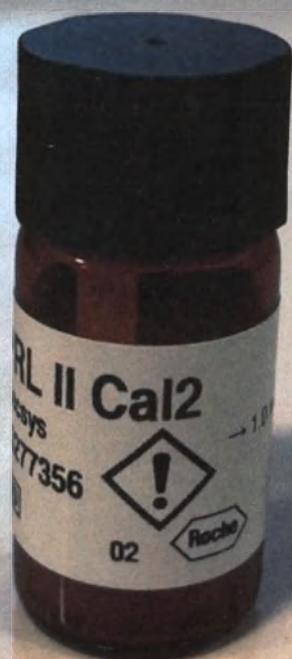


Калибратор 2 (PRL II Cal2), флакон, 2 шт.

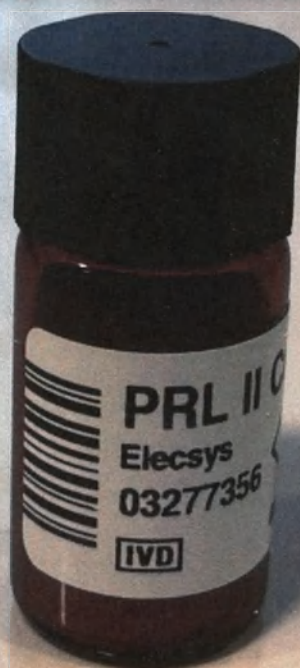

Калибратор 2 (PRL II Cal2), флакон, 2 шт.

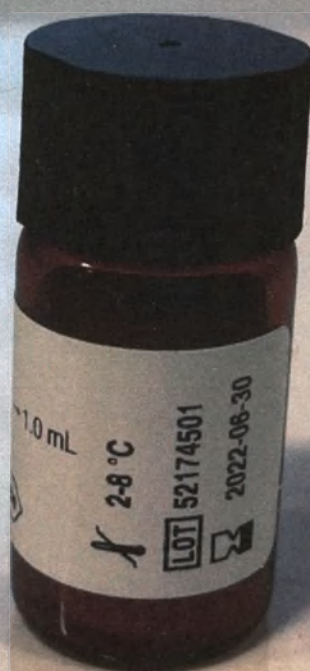


Флакон пустой – 4 шт. (белая крышка - 2 шт.)

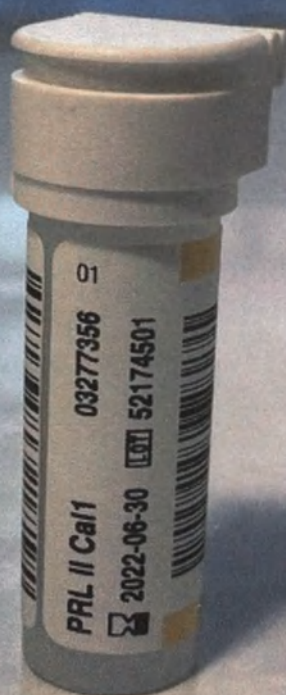


Флакон пустой – 4 шт. (белая крышка - 2 шт.)



Флакон пустой – 4 шт. (черная крышка - 2 шт.)

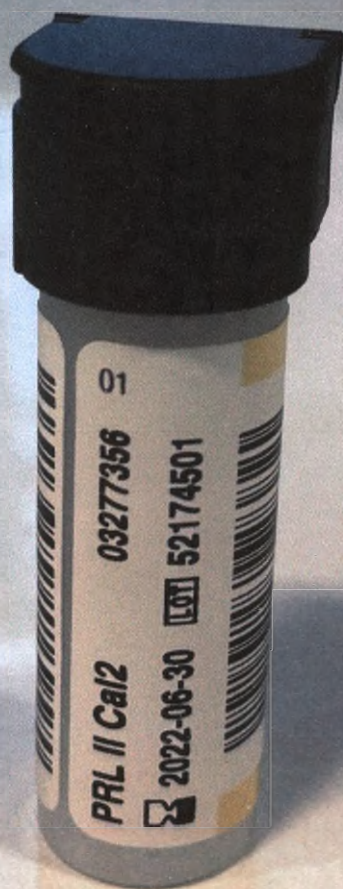

Флакон пустой – 4 шт. (черная крышка - 2 шт.)

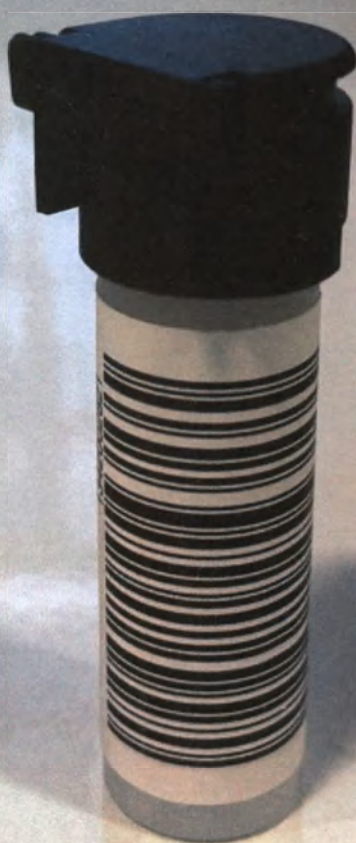

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
15 листа (ов)

Мартин Маржанович

