

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Биосенсор АН»


Гвоздев А.Р.
17 июля 2019 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения алкоголя в слюне
АЛКОСЕНСОР



Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

только для диагностики
ин витро

ВНИМАНИЕ !

- После извлечения полоски немедленно плотно закрывайте пенал
- Не убирайте влагопоглотитель

**Полоски
индикаторные**

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
в плотно закрытом пенале
в сухом месте

+2°C — +30°C



ООО «Биосенсор АН»
РФ, М.О., г. Черноголовка,
1-й проезд, д. 4

полоски индикаторные для
«Биосенсор АН», Россия

Биосенсор АН
алкоголь

АЛКОСЕНСОР

+2°C — +30°C



25

01/2018

01/2019

AP011802

для in-vitro

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев



и полуколичественного

ностью в слюну.
ток слюны
им прикосновением ребра
бум. полотенцу, туалетной
тут) с момента погружения
окраску




ООО «Биосенсор АН»
РФ, г. Черноголовка
1-й проезд, д. 4

Хранить в сухом месте
при температуре от +2-+30°C
ТУ 9398-264-4567786-2019
РУ №

Состав: полоски, этикетка с цветовой шкалой, инструкция

2
,0

1 шт.




2019г. LOT 0118



Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев

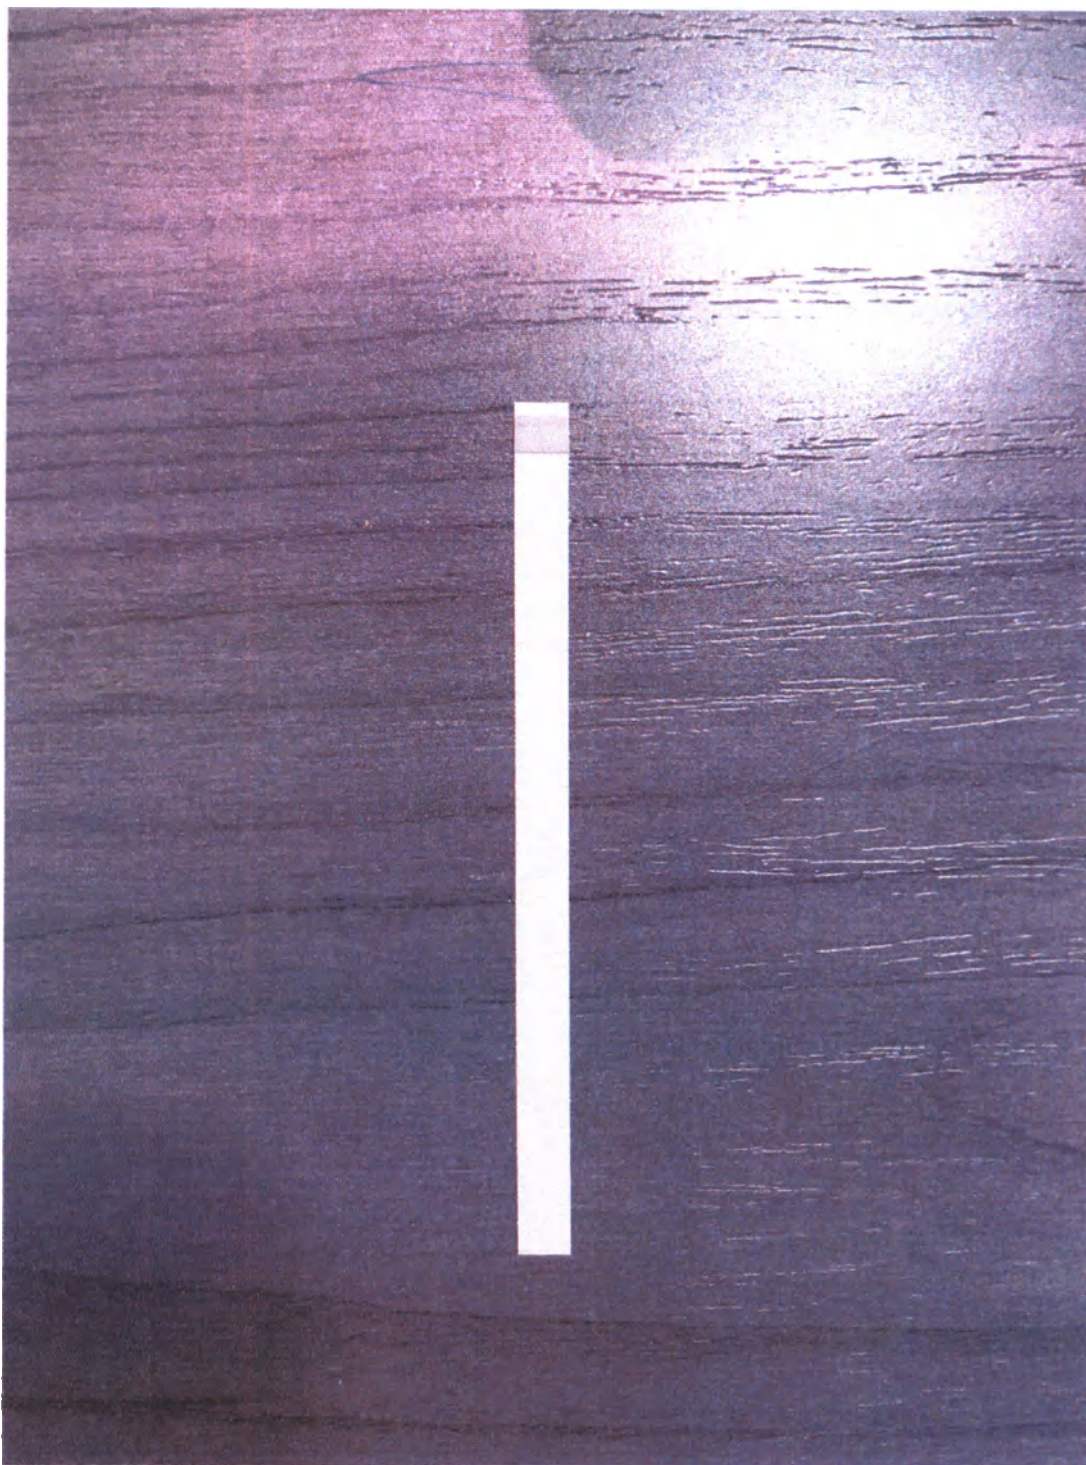

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

сиренцев в медв
Очр. ООО и Биосенсу ЗНЧ
Уголев

