



Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

Кетоглюк-1

только для диагностики
ин витро

ВНИМАНИЕ !

- После извлечения полоски немедленно плотно закрывайте пенал
- Не убирайте влагопоглотитель

Полоски индикаторные

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
в плотно закрытом пенале
в сухом месте

+ 2°C — + 30°C



ООО «Биосенсор АН»
РФ, М.О., г. Черноголовка,
1-й проезд, д. 4

только для диагностики

ООО «Биосенсор АН»
Россия, г. Черноголовка, 1-й проезд

КЕТОГЛЮК

полоски индикаторные
для качественного
и полуколичественного
определения кетоновых
тел и глюкозы в моче

+ 2°C — + 30°C



IVD

Количество
полосок: 50

Сделано: 07/2018

Годен до: 07/2020

Серия: 0718

только для диагностики

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

Кетоглюк-1

1 шт.
полоски индикаторные для качественного
и полуколичественного определения глюкозы и кетоновых тел в моче

КЕТОГЛЮК-1

полоски индикаторные для качественного
и полуколичественного определения глюкозы и кетоновых тел в моче


1 шт.



Состав: полоски индикаторные, этикетка с цветовой шкалой, инструкция по применению

0,0	0,5	1,5	4,0	8,0	≥ 16,0	Кетоны ммоль/л
0,0	2,8	5,6	14,0	28,0	56,0 > 112,0	Глюкоза ммоль/л
0,0	0,05	0,1	0,25	0,5	1,0 > 2,0	%

ООО «Биосенсор АН»
РФ, г. Челябинск
1-й проезд, д. 4
Хранить в сухом месте
при температуре от +2 до +30 °C
ТУ 21-20-20-003-4567786-2019
Р/ч №



06.2019г. 06.2021г. LOT 0619



А.Р. Гвоздев


Директор ООО «Биосенсор АН»

ного
глюкозы и кетоновых тел в моче

торные, этикетка с цветовой шкалой, инструкция по применению

	Кетоны
$\geq 16,0$	ммоль/л
	Глюкоза
$56,0 > 112,0$	ммоль/л
$1,0 \geq 2,0$	%

.2021г. LOT 0619



ООО «Биосенсор АН»
РФ, г. Черноголовка
1-й проезд, д. 4



Хранить в сухом месте
при температуре от +2...+30°C
ТУ 21.20.23-003-45677786-2019
РУ №



Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев

ЭТОГЛЮК-1

ки индикаторные для качественного
/количественного определения глюкозы и кетоновых тел в моче

1 шт.



Состав: тест-полоски индикаторные, этикетка с цветовой шкалой, инструкция по применению

0,5	1,5	4,0	8,0	≥ 16,0	Кетоны ммоль/л
2,8	5,6	14,0	28,0	56,0	≥ 112,0
0,05	0,1	0,25	0,5	1,0	≥ 2,0
					Глюкоза ммоль/л %

ООО «Биосенсор АН»
РФ, г. Черноголовы
1-й проезд, д. 4
Хранить в сухом месте
при температуре от +2 до +30°C
ТУ 21.20.33-003-4587706-2019
Р/м


06.2019г. 06.2021г. LOT 0619



Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

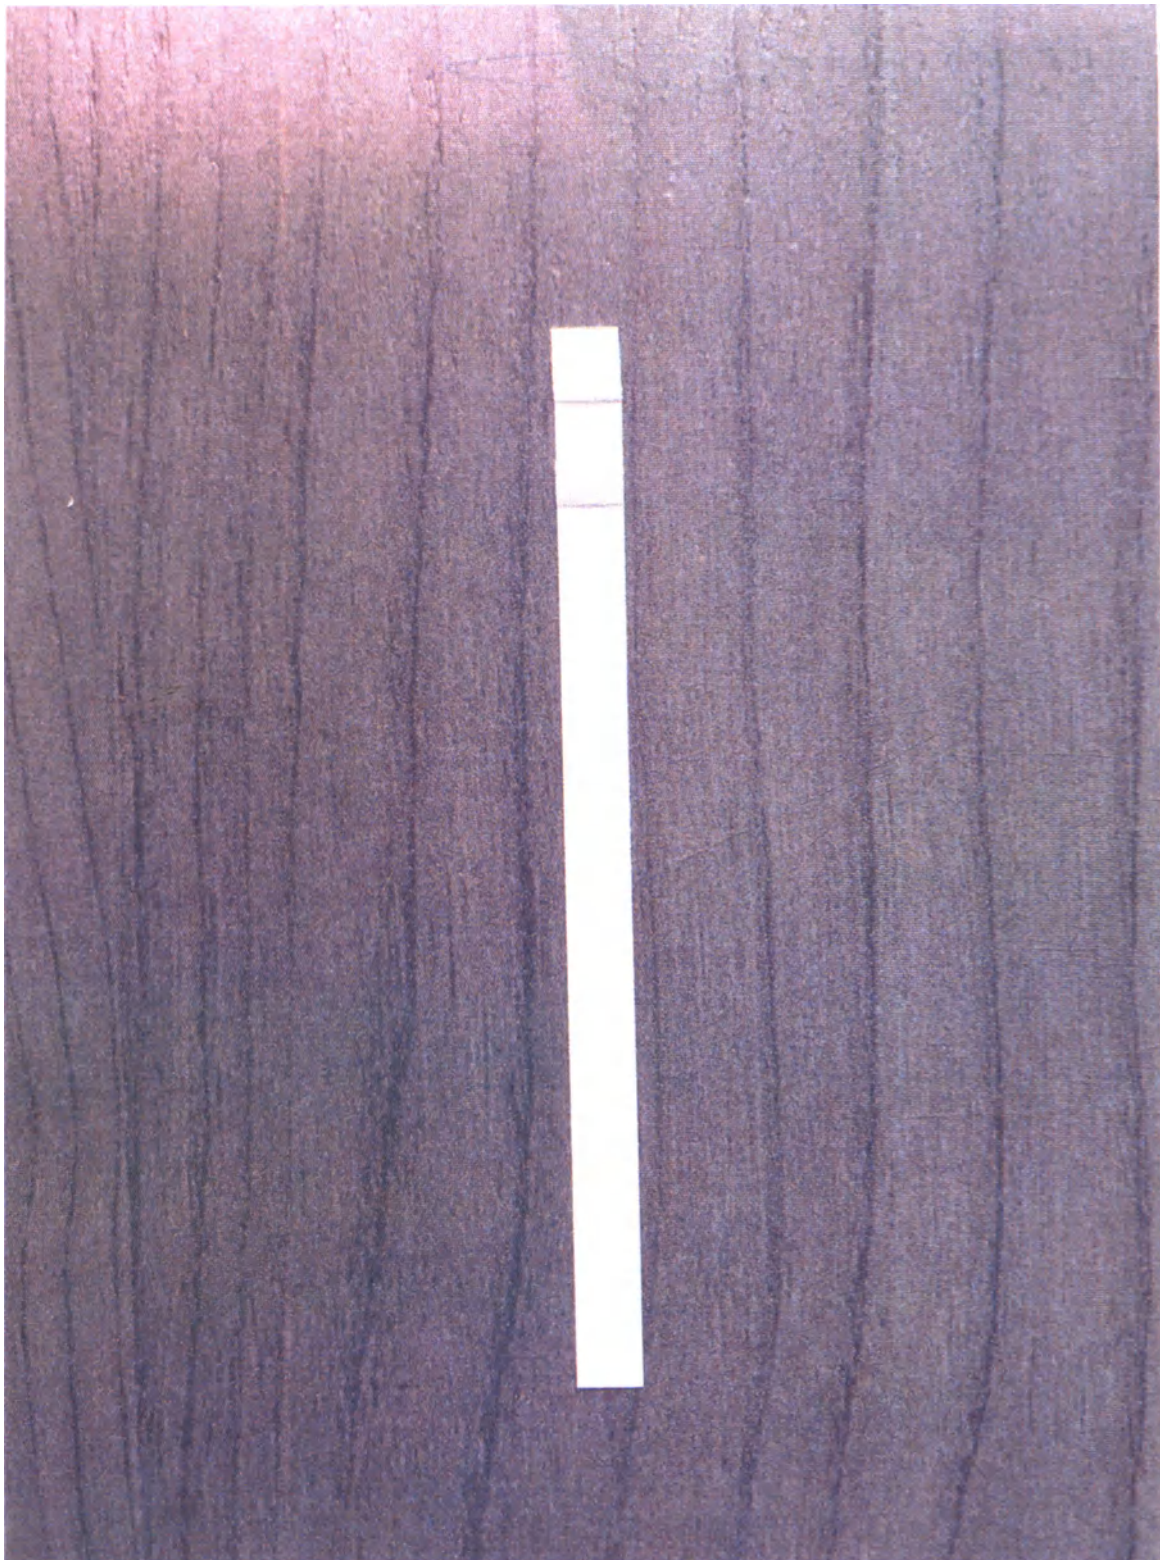

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

экранная 7 листов
Опр. ООО "Биосенсор АН"

Возров А.Р. 

