

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Биосенсор АН»


Гвоздев А.Р.
20 января 2020 г.




Фотографические изображения

медицинского изделия

№ 1

**Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения
кетоновых тел в моче**


УРИКЕТ-1

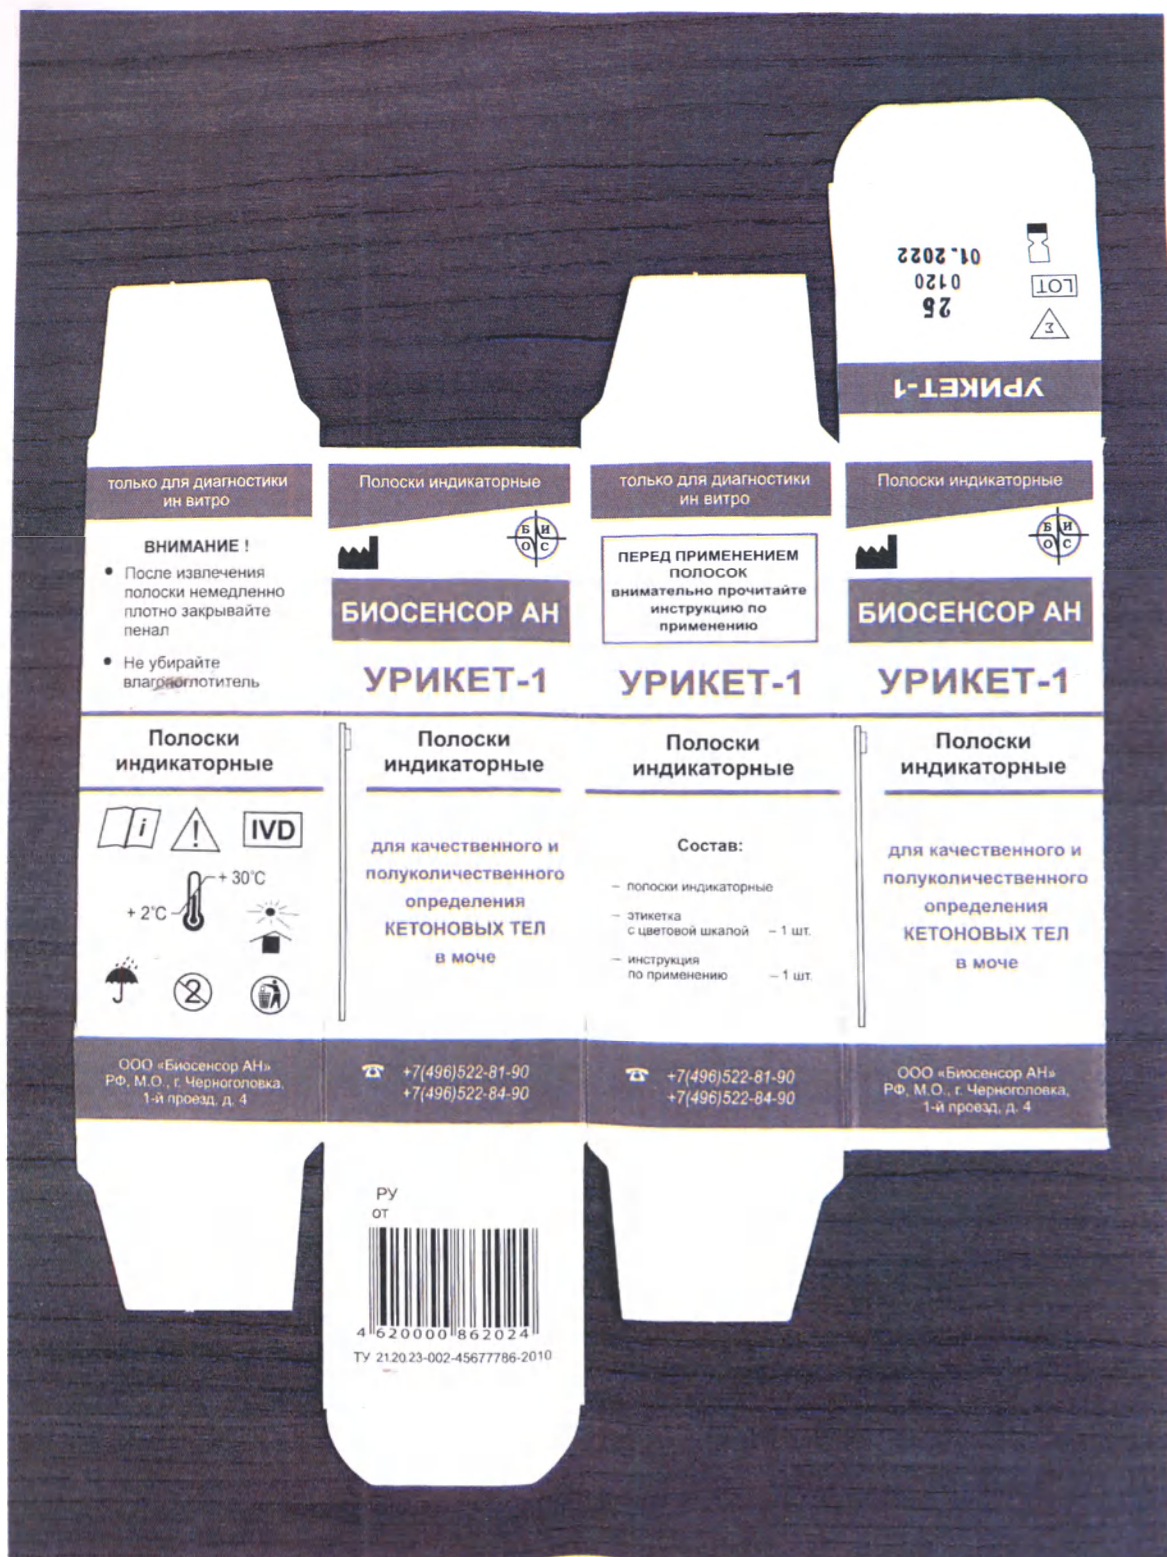

Директор ООО «Биосенсор АН»




А.Р. Гвоздев

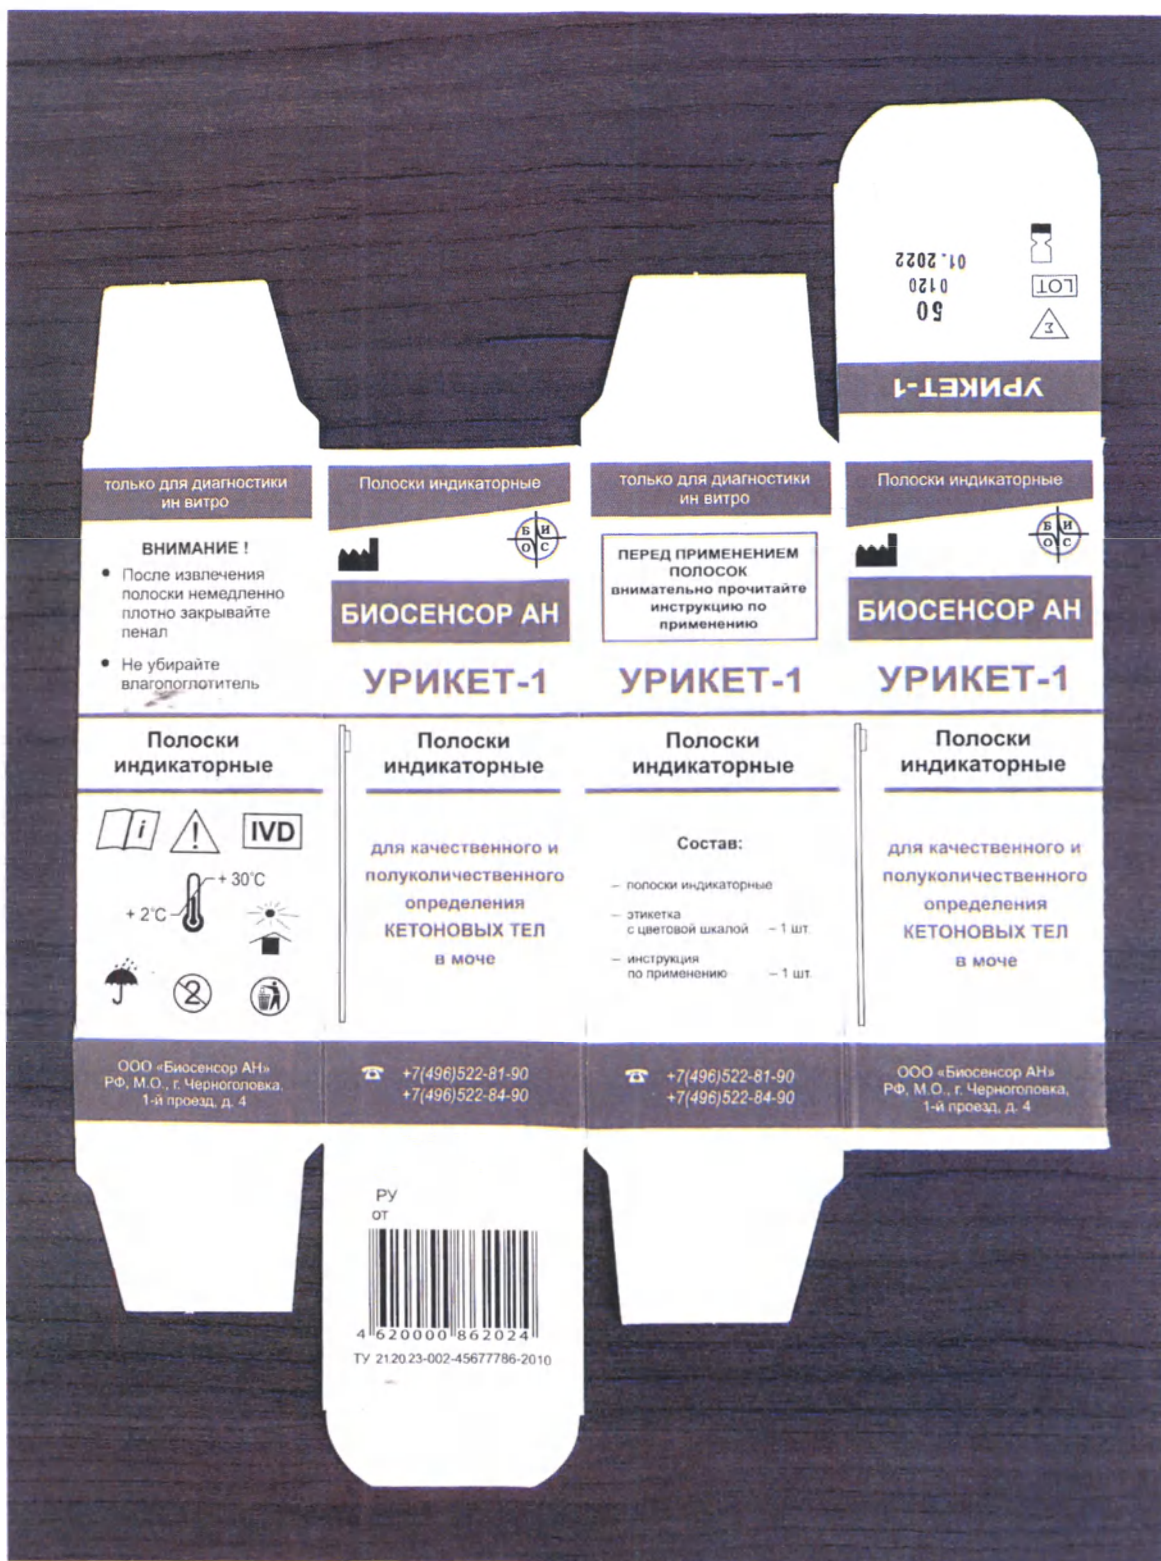

Директор ООО «Биосенсор АН»




А.Р. Гвоздев

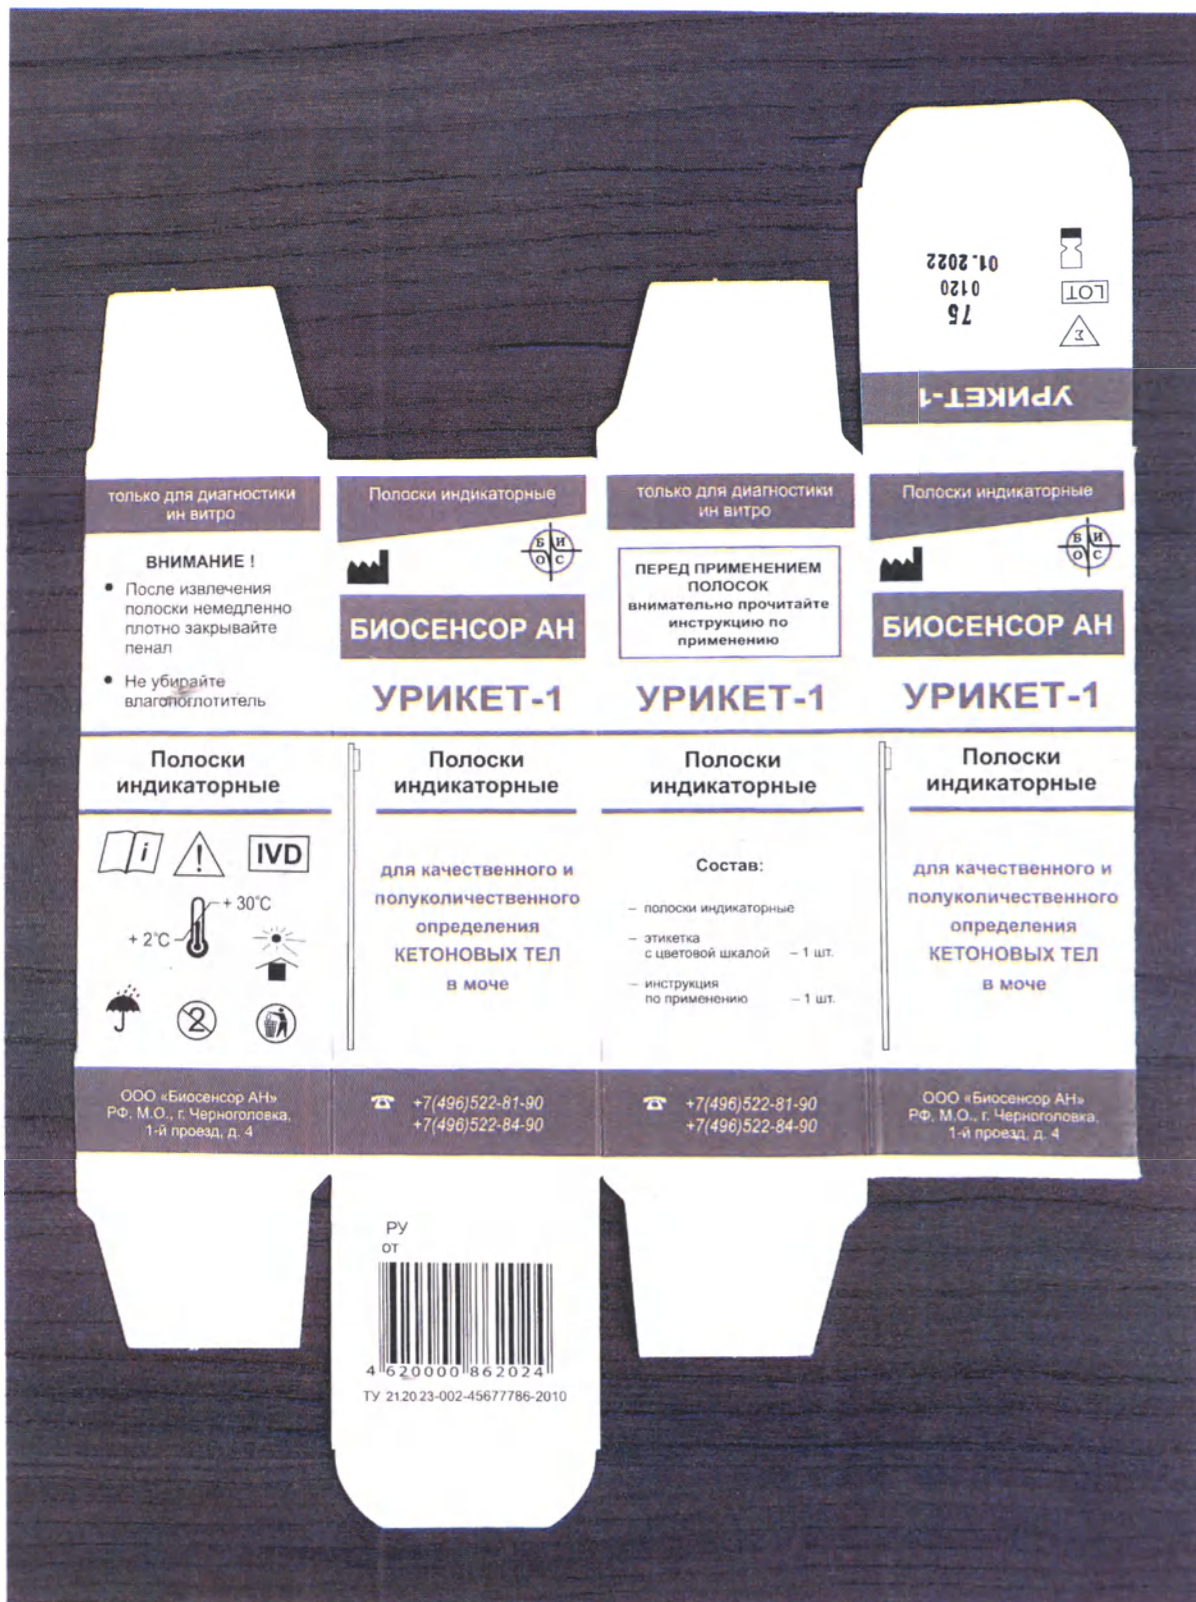

Директор ООО «Биосенсор АН»




А.Р. Гвоздев

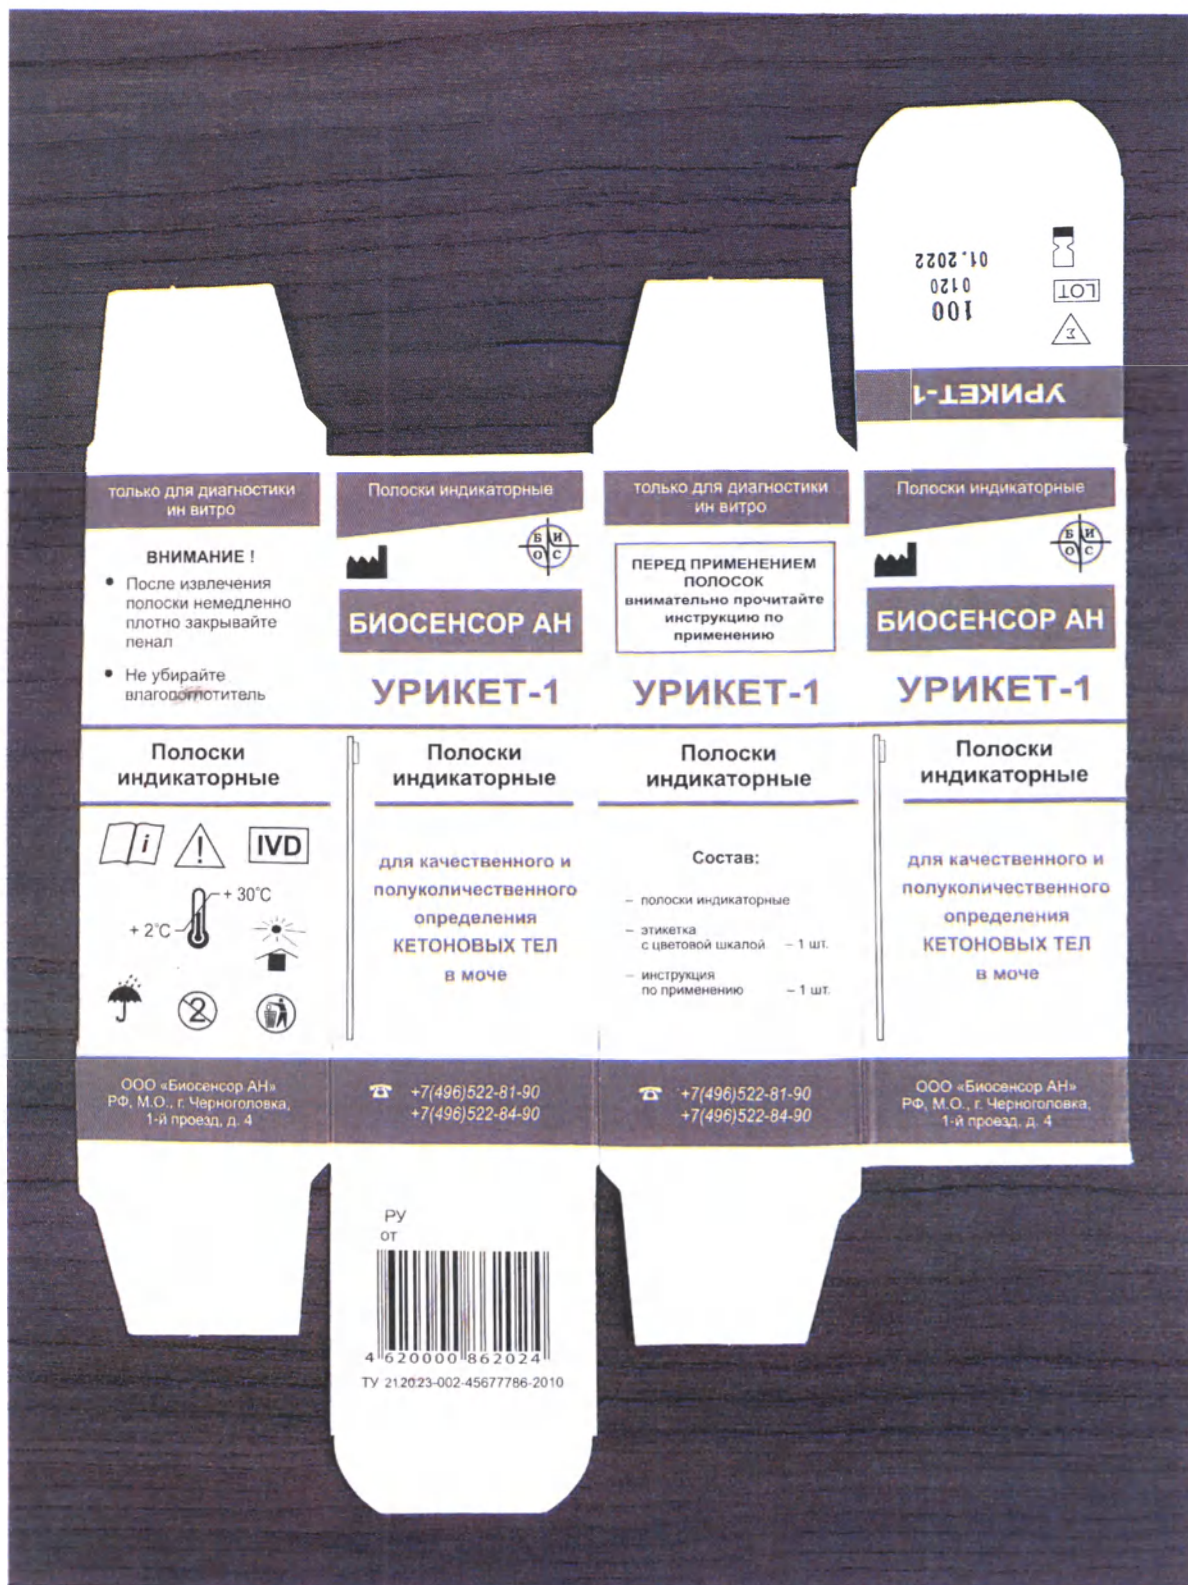

Директор ООО «Биосенсор АН»




А.Р. Гвоздев

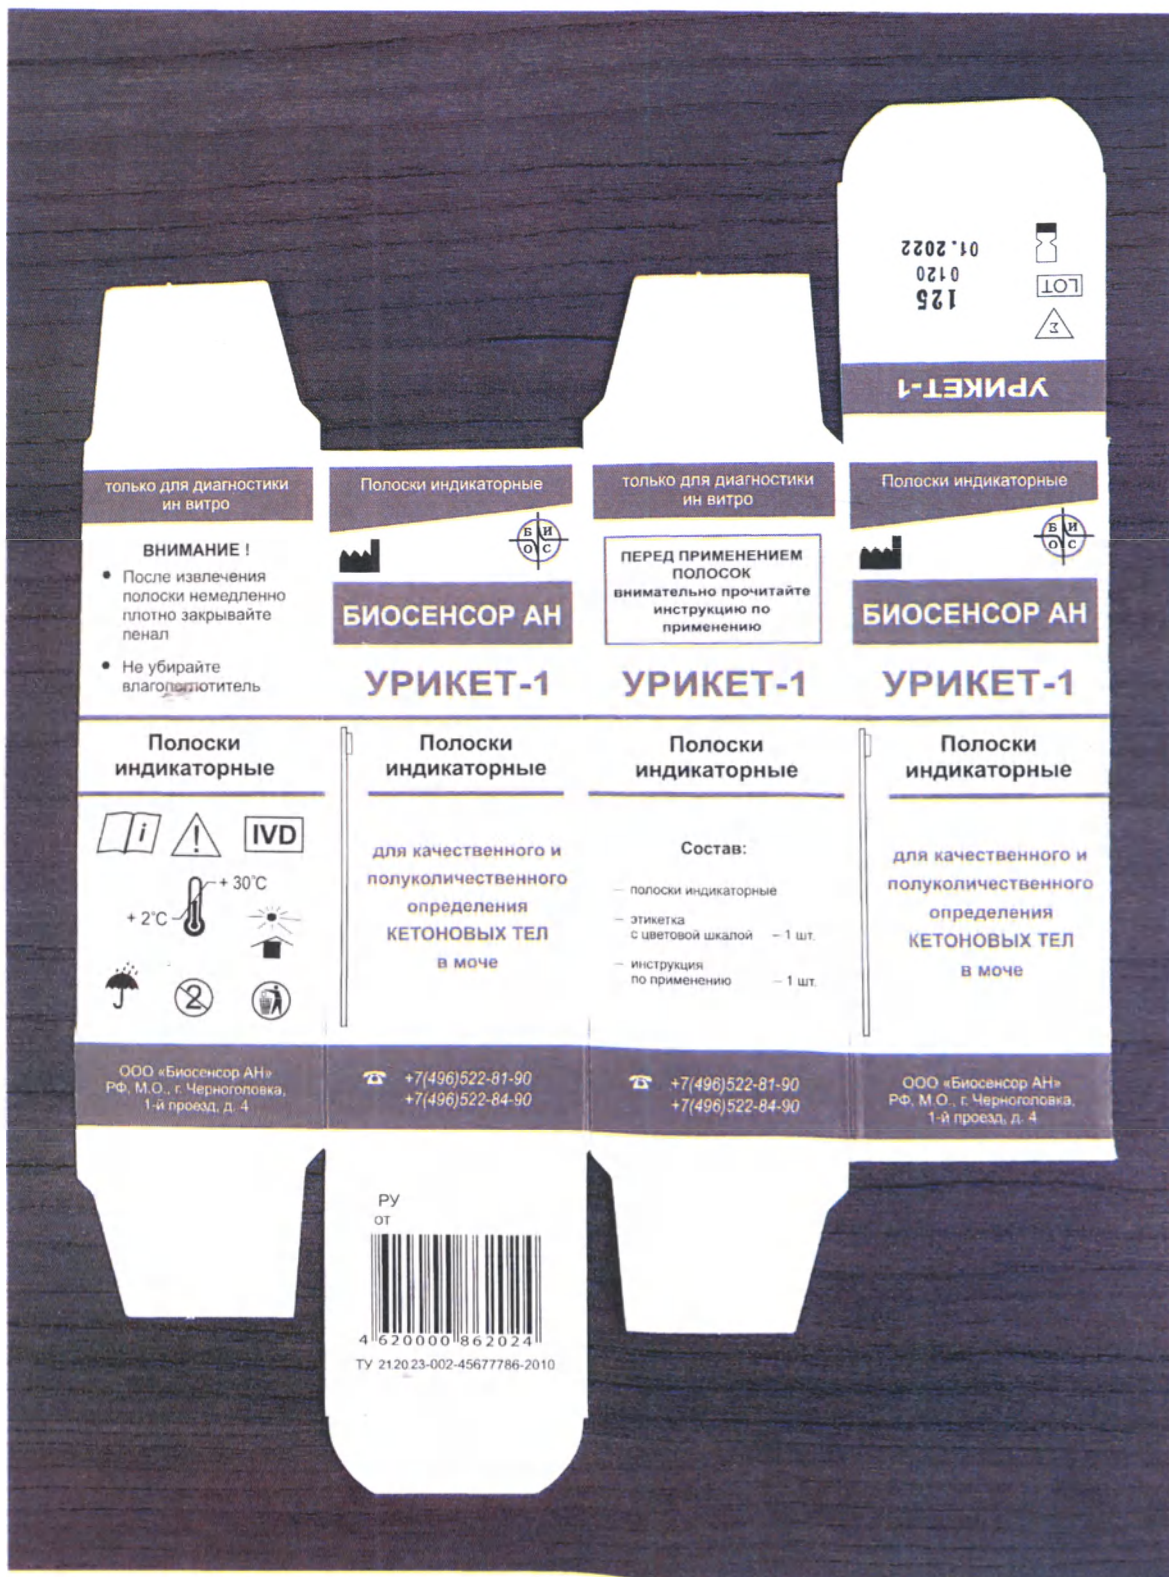

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

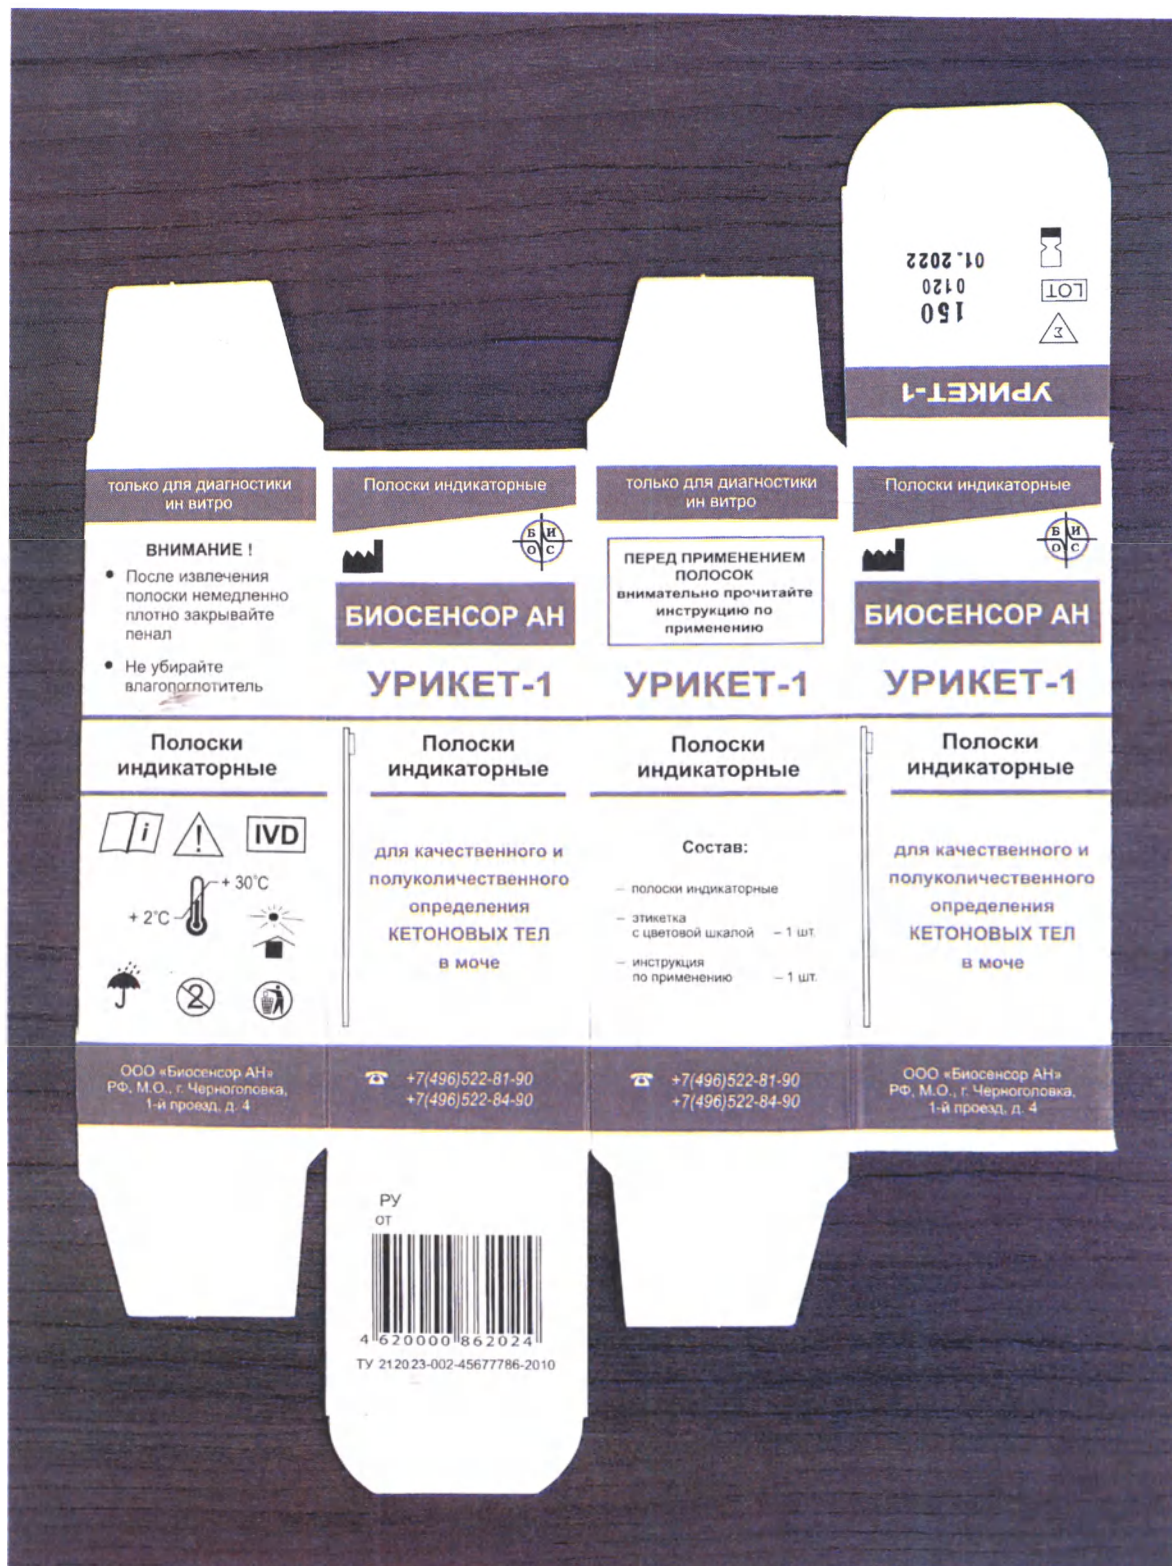

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

Суренко Зинаида
П.З. 000
Воробей А.Р.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Биосенсор АН»




Гвоздев А.Р.


20 января 2020 г.

**Фотографические изображения
медицинского изделия**

№ 2

**Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения
кетоновых тел в моче**

УРИКЕТ-1

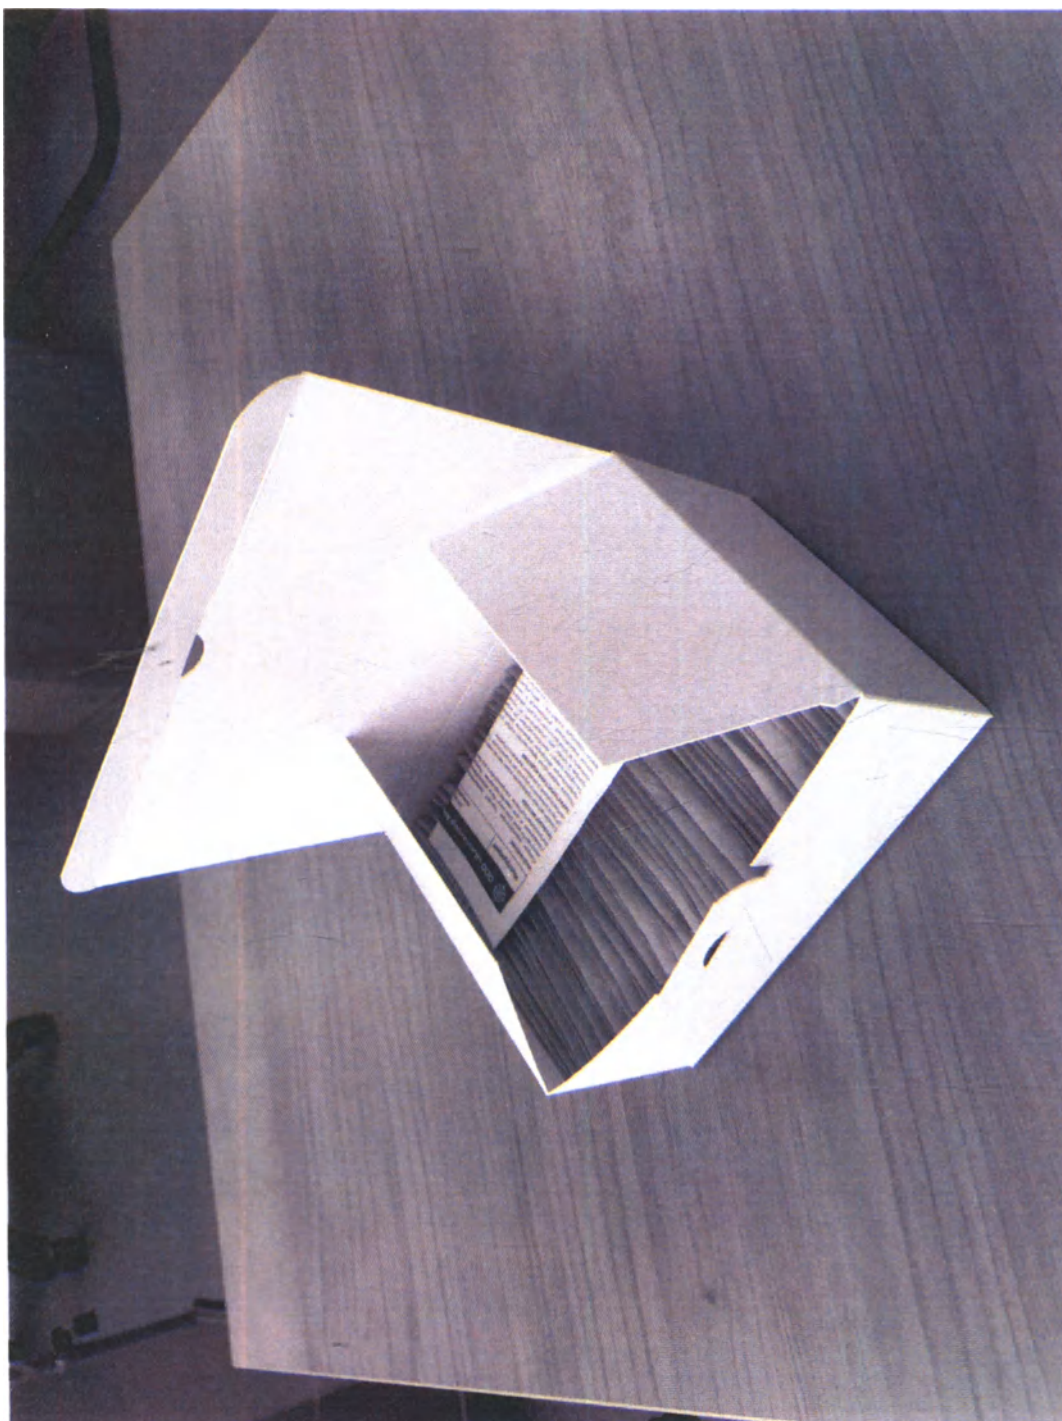

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

Полоски индикаторные для качественного
и полуколичественного определения
кетоновых тел в моче

ТУ 21.20.23-002-45677786-2019

РУ № _____ от _____ г.



УРИКЕТ-1



Количество
полосок в
упаковке:

50

Состав:

- полоски
индикаторные
- этикетка
с цветовой шкалой
- инструкция
по применению

- 50 шт.

- 50 шт.

- 1 шт.



Серия:


0619



Годен до: 06.2021




ООО «БИОСЕНСОР АН»
РФ, М.О. г. Черноголовка,
1-й проезд, д. 4



Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев

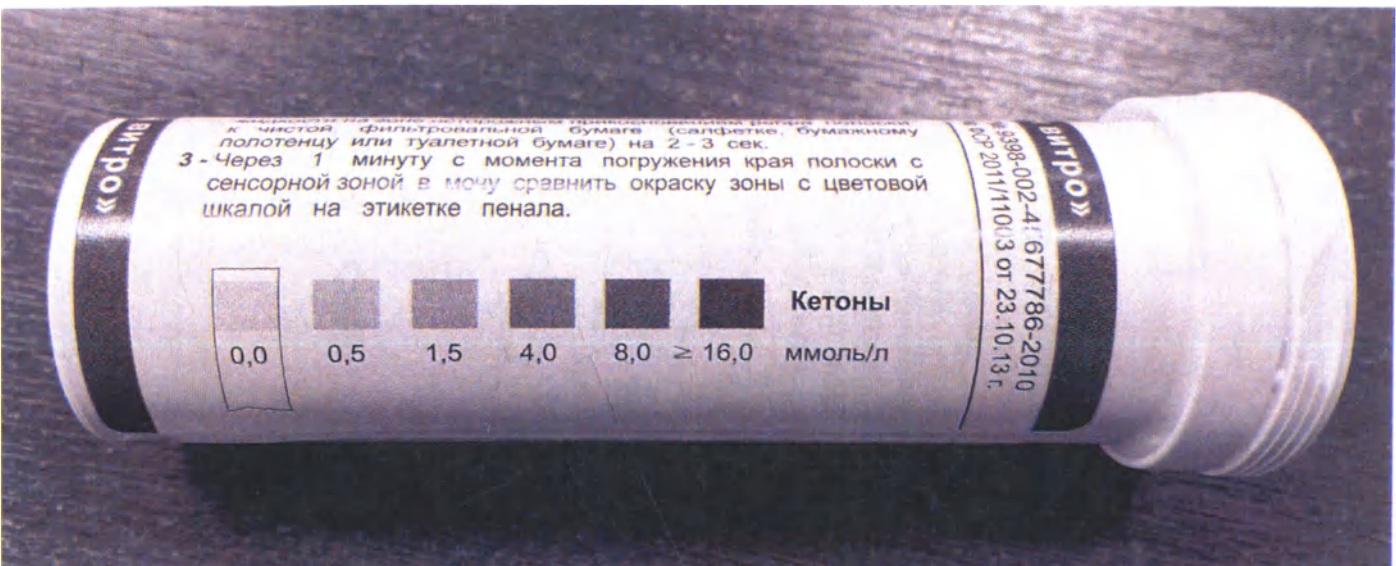

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ «ин витро»


ООО «Биосенсор АН»
Россия, г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4

ТУ №
РУ №



УРИКЕТ-1

полоски индикаторные
для качественного
и полуколичественного
определения
кетоновых тел в моче

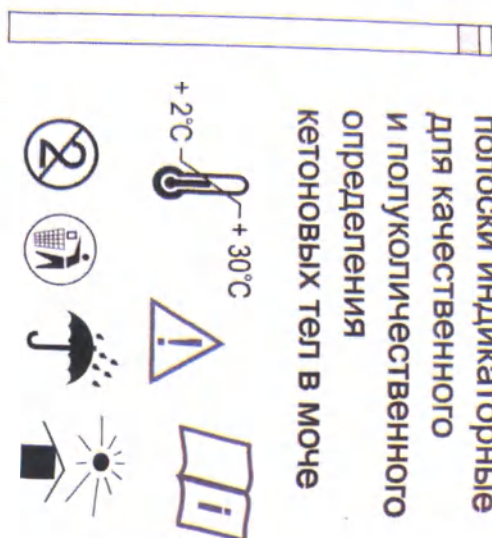

Количество
полосок:


Сделано:

Годен до:

Серия:

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ «ин витро»

- 1 - Достать полоску, пенал немедленно закрыть крышкой.
- 2 - Край полоски с сенсорной зоной полностью погрузить в мочу. Через 2-3 секунды извлечь полоску и удалить избыток жидкости на зоне осторожным прикосновением ребра полоски к чистой фильтровальной бумаге (салфетке, бумажному полотенцу или туалетной бумаге) на 2-3 сек.
- 3 - Через 1 минуту с момента погружения края полоски с сенсорной зоной в мочу сравнить окраску зоны с цветовой шкалой на этикетке пенала.

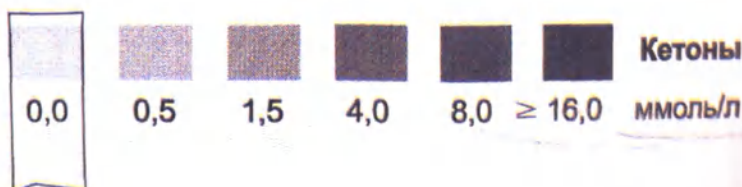

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ «ИН ВИТРО»

ООО «Биосенсор АН»
Россия, г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4


ТУ №
РУ №

УРИКЕТ-1

полоски индикаторные
для качественного
и полуколичественного
определения
кетоновых тел в моче



+2°C
+30°C



Количество
полосок:



Сделано:




Годен до:



Серия:

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ «ИН ВИТРО»

- 1 - Достать полоску, пенал немедленно закрыть крышкой.
- 2 - Край полоски с сенсорной зоной полностью погрузить в мочу. Через 2-3 секунды извлечь полоску и удалить избыток жидкости на зоне осторожным прикосновением ребра полоски к чистой фильтровальной бумаге (салфетке, бумажному полотенцу или туалетной бумаге) на 2-3 сек.
- 3 - Через 1 минуту с момента погружения края полоски с сенсорной зоной в мочу сравнить окраску зоны с цветовой шкалой на этикетке пенала.



0,0



0,5



1,5



4,0



8,0



≥ 16,0

Кетоны
ммоль/л



Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев

А.Р. Гвоздев



Директор ООО «Биосенсор АН»

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ «ИН ВИТРО»

УРИКЕТ-1

полоски индикаторные для качественного и полуквантитативного определения кетоновых тел в моче

Кол-во полосок:

Сделано:

Годен до:

Серия:


Б И О С

ТУ № 9398-002-45677786-2010
РУ № ФСР 2011/11003 от 23.10.13 г.

- Достать полоску, пенал немедленно закрыть крышкой.
- Край полоски с сенсорной зоной полностью погрузить в мочу. Через 2-3 секунды извлечь полоску и удалить избыток жидкости на зоне осторожным прикосновением ребра полоски к чистой фильтровальной бумаге (салфетке, бумажному полотенцу или туалетной бумаге) на 2-3 сек.
- Через 1 минуту с момента погружения края полоски с сенсорной зоной в мочу сравнить окраску зоны с цветовой шкалой на этикетке пенала.

0,0																	Кетоны
0,0	0,5	1,5	4,0	8,0	≥ 16,0							ммоль/л					

Судебная экспертиза
ОГ: 000 Бюджетное АН
Вопрос АР

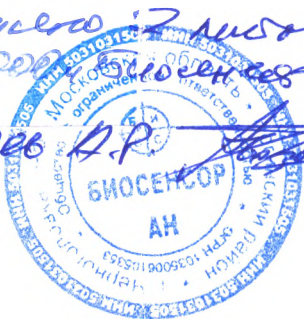

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Биосенсор АН»



Гвоздев А.Р.
20 января 2020 г.


**Фотографические изображения
медицинского изделия**

№ 3

**Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения
кетоновых тел в моче**

УРИКЕТ-1

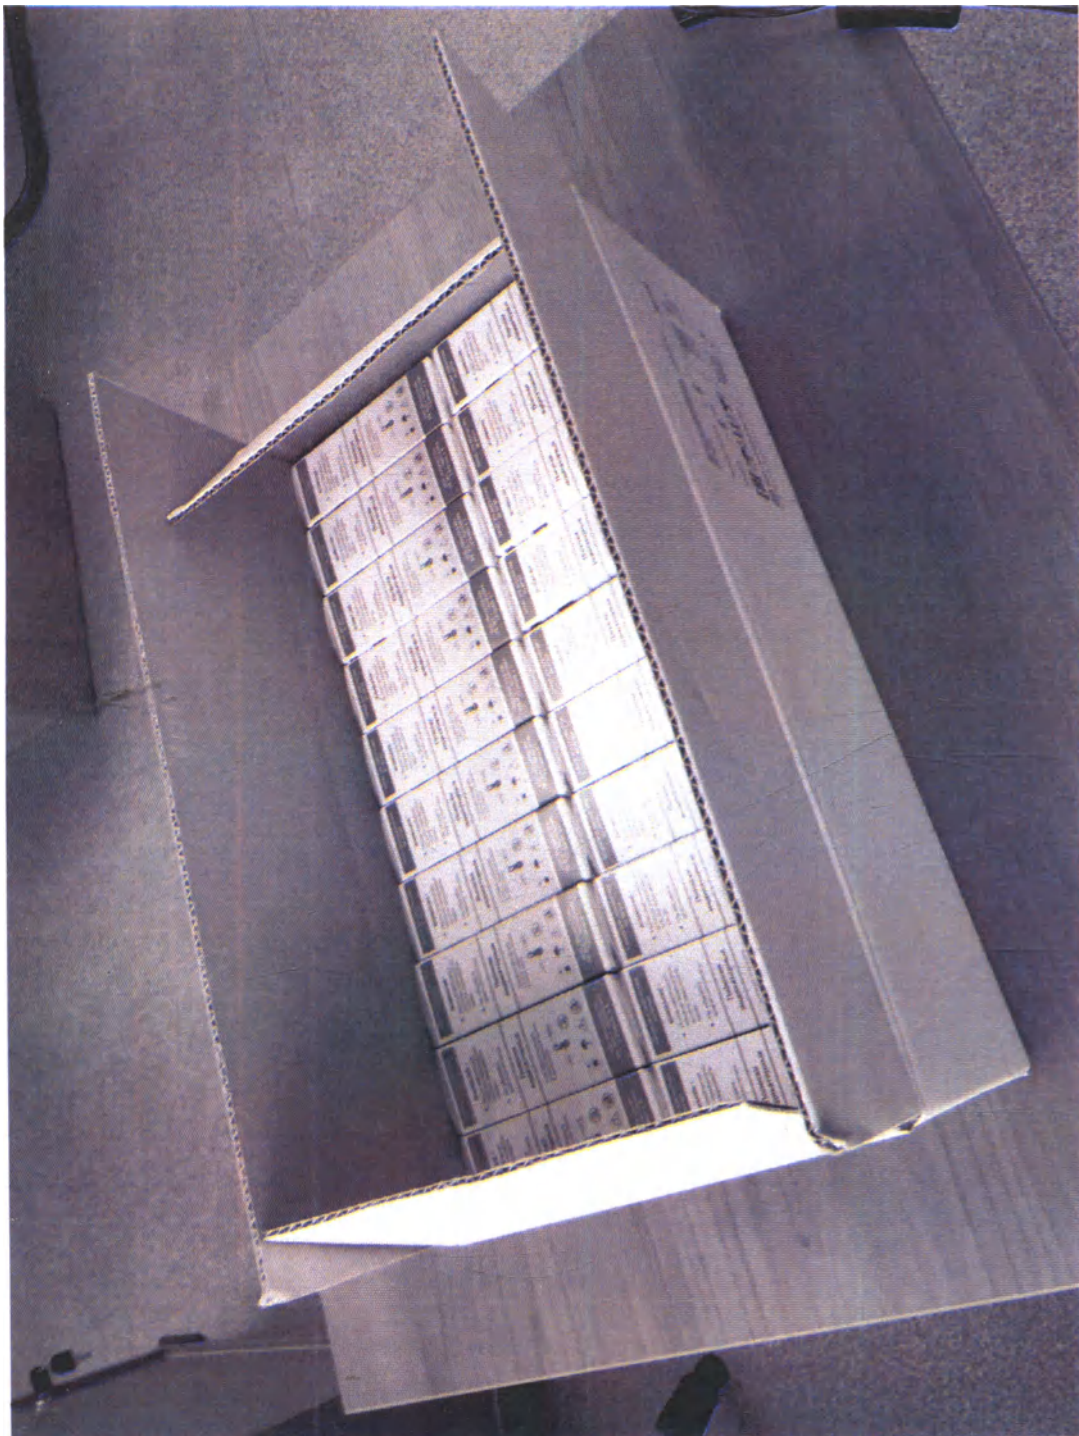

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

Полоски индикаторные
для качественного и полуколичественного определения
кетоновых тел в моче

Урикет-1

Транспортирование:  -25°C - +30°C

Хранение:  +2°C - +30°C

EAC



ООО «БИОСЕНСОР АН»

Россия, 142432, г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4

Кол-во полосок
в упаковке: 25
Количество
упаковок: 60
Сделано: 01.2020
№ Серии: 0120
Годен до: 01.2022

Масса брутто: 1,3-2,2 +/-20%

Масса нетто: 1,2-1,8 +/-20%

Масса нетто
потреб-кой
упаковки: 0,02-0,03 +/-20%



Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев

Полоски индикаторные
для качественного и полуколичественного определения
кетоновых тел в моче

Урикет-1

Транспортирование:  -25°C - +30°C

Хранение:  +2°C - +30°C

Кол-во полосок
в упаковке: 50
Количество
упаковок: 60
Сделано: 01.2020
№ Серии: 0120
Годен до: 01.2022



 ООО «БИОСЕНСОР АН»

Россия, 142432, г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4

Масса брутто: 1,4-2,4 +/-20%
Масса нетто: 1,4-2,1 +/-20%
Масса нетто
потреб-кой
упаковки: 0,02-0,03 +/-20%



Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев

Урикет-1

Хранение: $+2^{\circ}\text{C}$  $+30^{\circ}\text{C}$

Кол-во полосок
в упаковке: 75
Количество
упаковок: 60
Сделано: 01.2020
№ Серии: 0120
Годен до: 01.2022



ООО «БИОСЕНСОР АН»

Россия, 142432, г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4

Масса брутто: 1,5-2,5 +/-20%
 Масса нетто: 1,4-2,2 +/-20%
 Масса нетто
 потреб-кой
 упаковки: 0,02-0,04 +/-20%

А.Р. Гвоздев


Директор ООО «Биосенсор АН»




Полоски индикаторные
для качественного и полуколичественного определения
кетоновых тел в моче

Урикет-1

Транспортирование:



Хранение:



Кол-во полосок
в упаковке: 100
Количество
упаковок: 60
Сделано: 01.2020
№ Серии: 0120
Годен до: 01.2022

EAC



ООО «БИОСЕНСОР АН»

Россия, 142432, г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4

Масса брутто: 1,7-2,8 +/-20%
Масса нетто: 1,6-2,4 +/-20%
Масса нетто
потреб-кой
упаковки: 0,03-0,04 +/-20%



Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев

Полоски индикаторные
для качественного и полуколичественного определения
кетоновых тел в моче

Урикет-1

Транспортирование:  -25°C  +30°C

Хранение:  +2°C  +30°C

Кол-во полосок
в упаковке: 125
Количество
упаковок: 60
Сделано: 01.2020
№ Серии: 0120
Годен до: 01.2022



 **ООО «БИОСЕНСОР АН»**

Россия, 142432, г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4

Масса брутто: 1,8-3,0 +/-20%
Масса нетто: 1,8-2,6 +/-20%
Масса нетто
потреб-кой
упаковки: 0,03-0,04 +/-20%



Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев

Полоски индикаторные
для качественного и полуколичественного определения
кетоновых тел в моче

Урикет-1

Транспортирование:  -25 °C  +30 °C

Хранение:  +2 °C  +30 °C

Кол-во полосок
в упаковке: 150
Количество
упаковок: 60
Сделано: 01.2020
№ Серии: 0120
Годен до: 01.2022



 **ООО «БИОСЕНСОР АН»**

Россия, 142432, г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4

Масса брутто: 1,9-3,1 +/-20%
Масса нетто: 1,8-2,8 +/-20%
Масса нетто
потреб-кой
упаковки: 0,03-0,05 +/-20%



Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев

судебно-экспертное
Дир. ООО «Биосенсор»
Леонидов А.П.

