



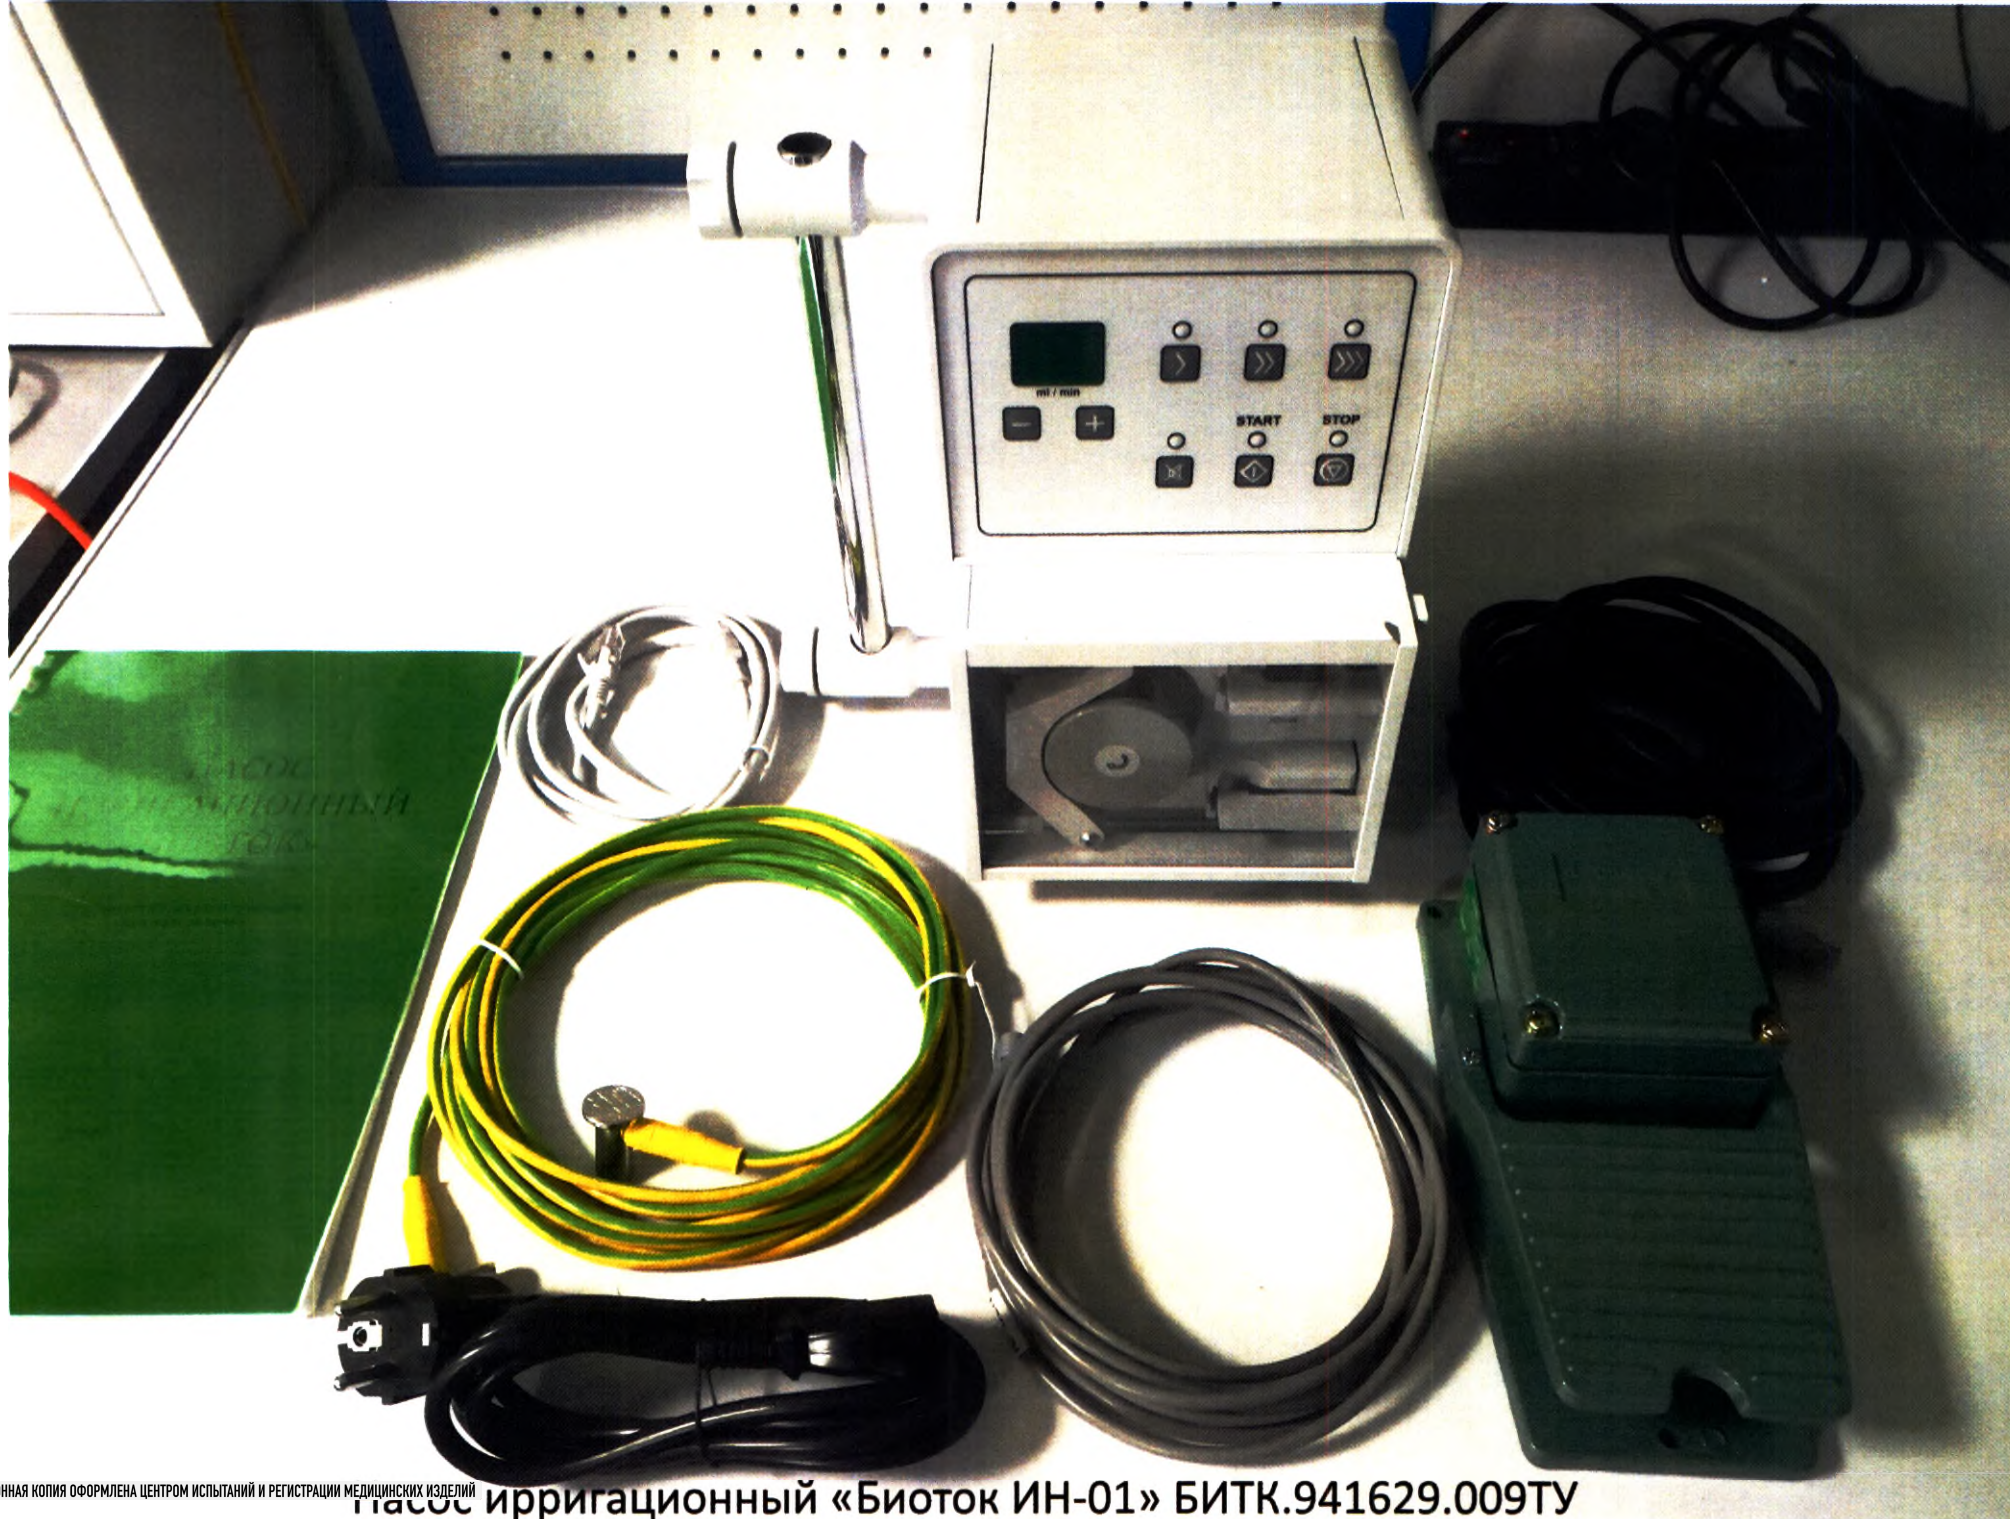

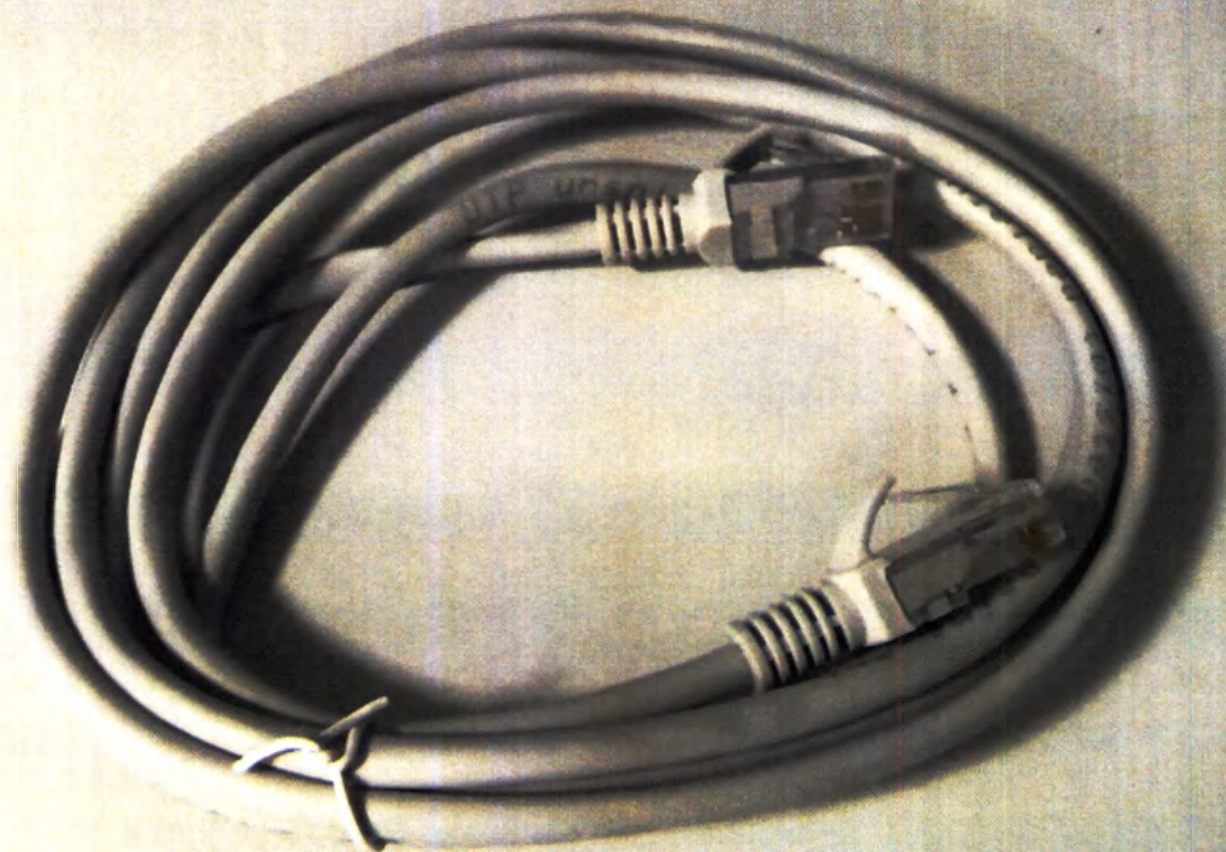

Кабель связи UTP, 2м.

Коммутационный кабель U/UTP категория 5e, 4 пары проводов с разъемами 8P8C

НАСОС ИРРИГАЦИОННЫЙ «БИОТОК»


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БИТК.941629.009РЭ

2018

Руководство по эксплуатации БИТК.941629.009РЭ



Провод выравнивания потенциалов, 5м БИТК.685611.002-5

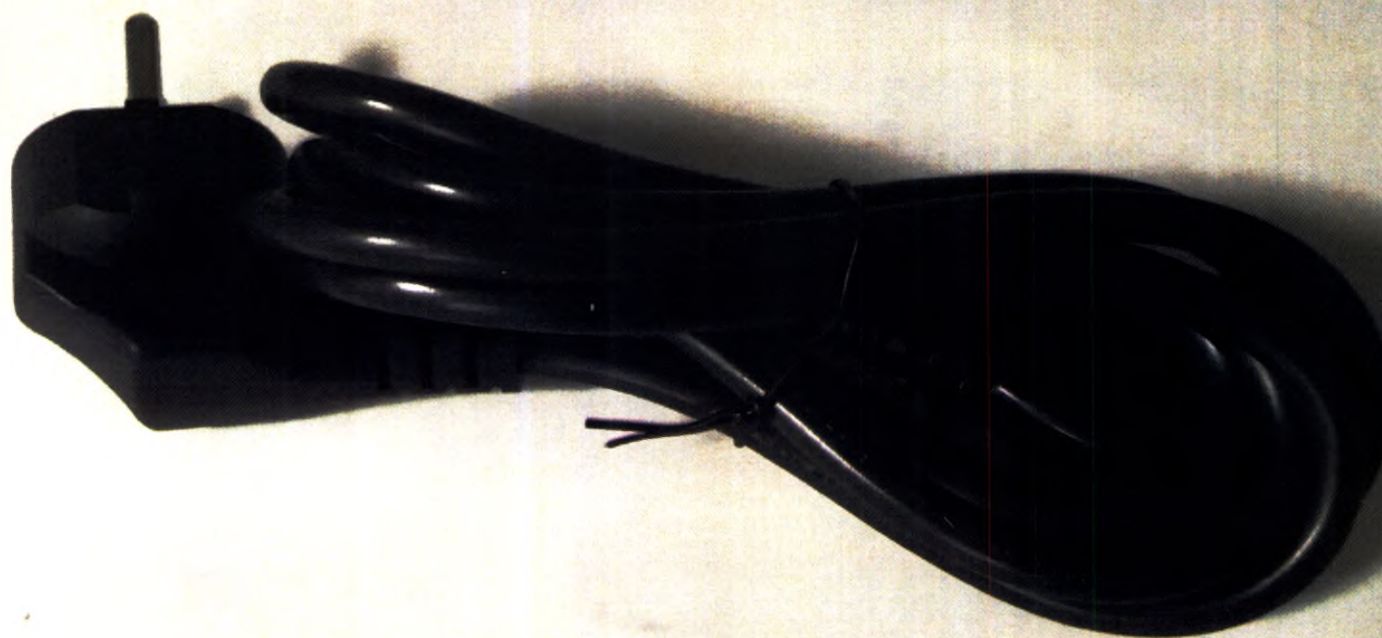

Кабель питания, 2м CEE 7/7 - IEC 320 C13




Кабель связи с деструктором радиочастотным, 3.5м БИТК.685611.600




Педаль FS-4, Camsco Electric Co, Ltd, Тайвань


Биоток ИН-01

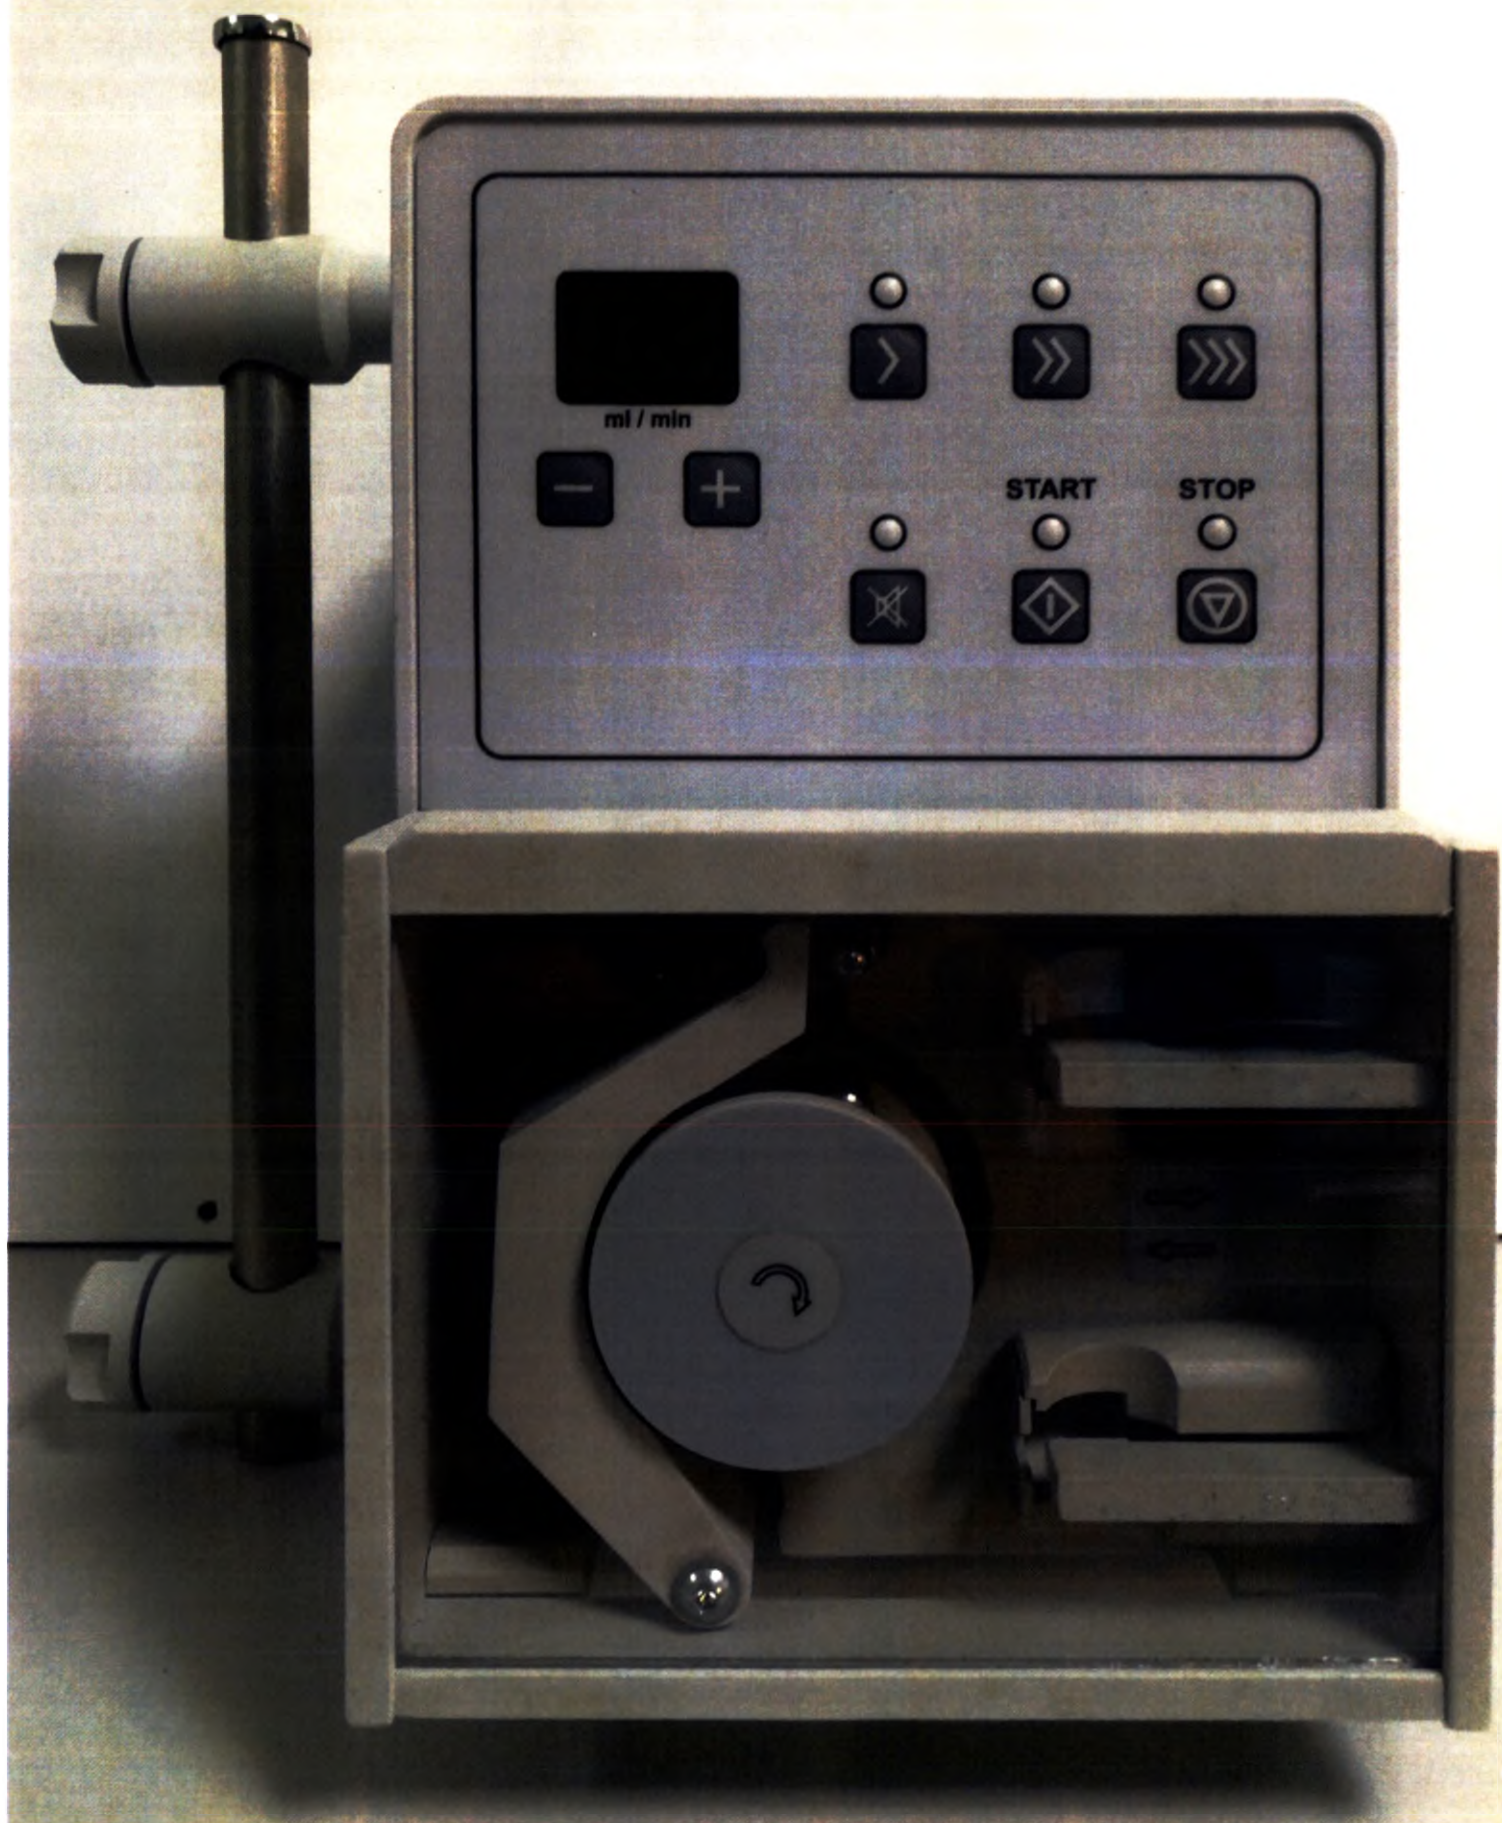


Биоток ИН-02

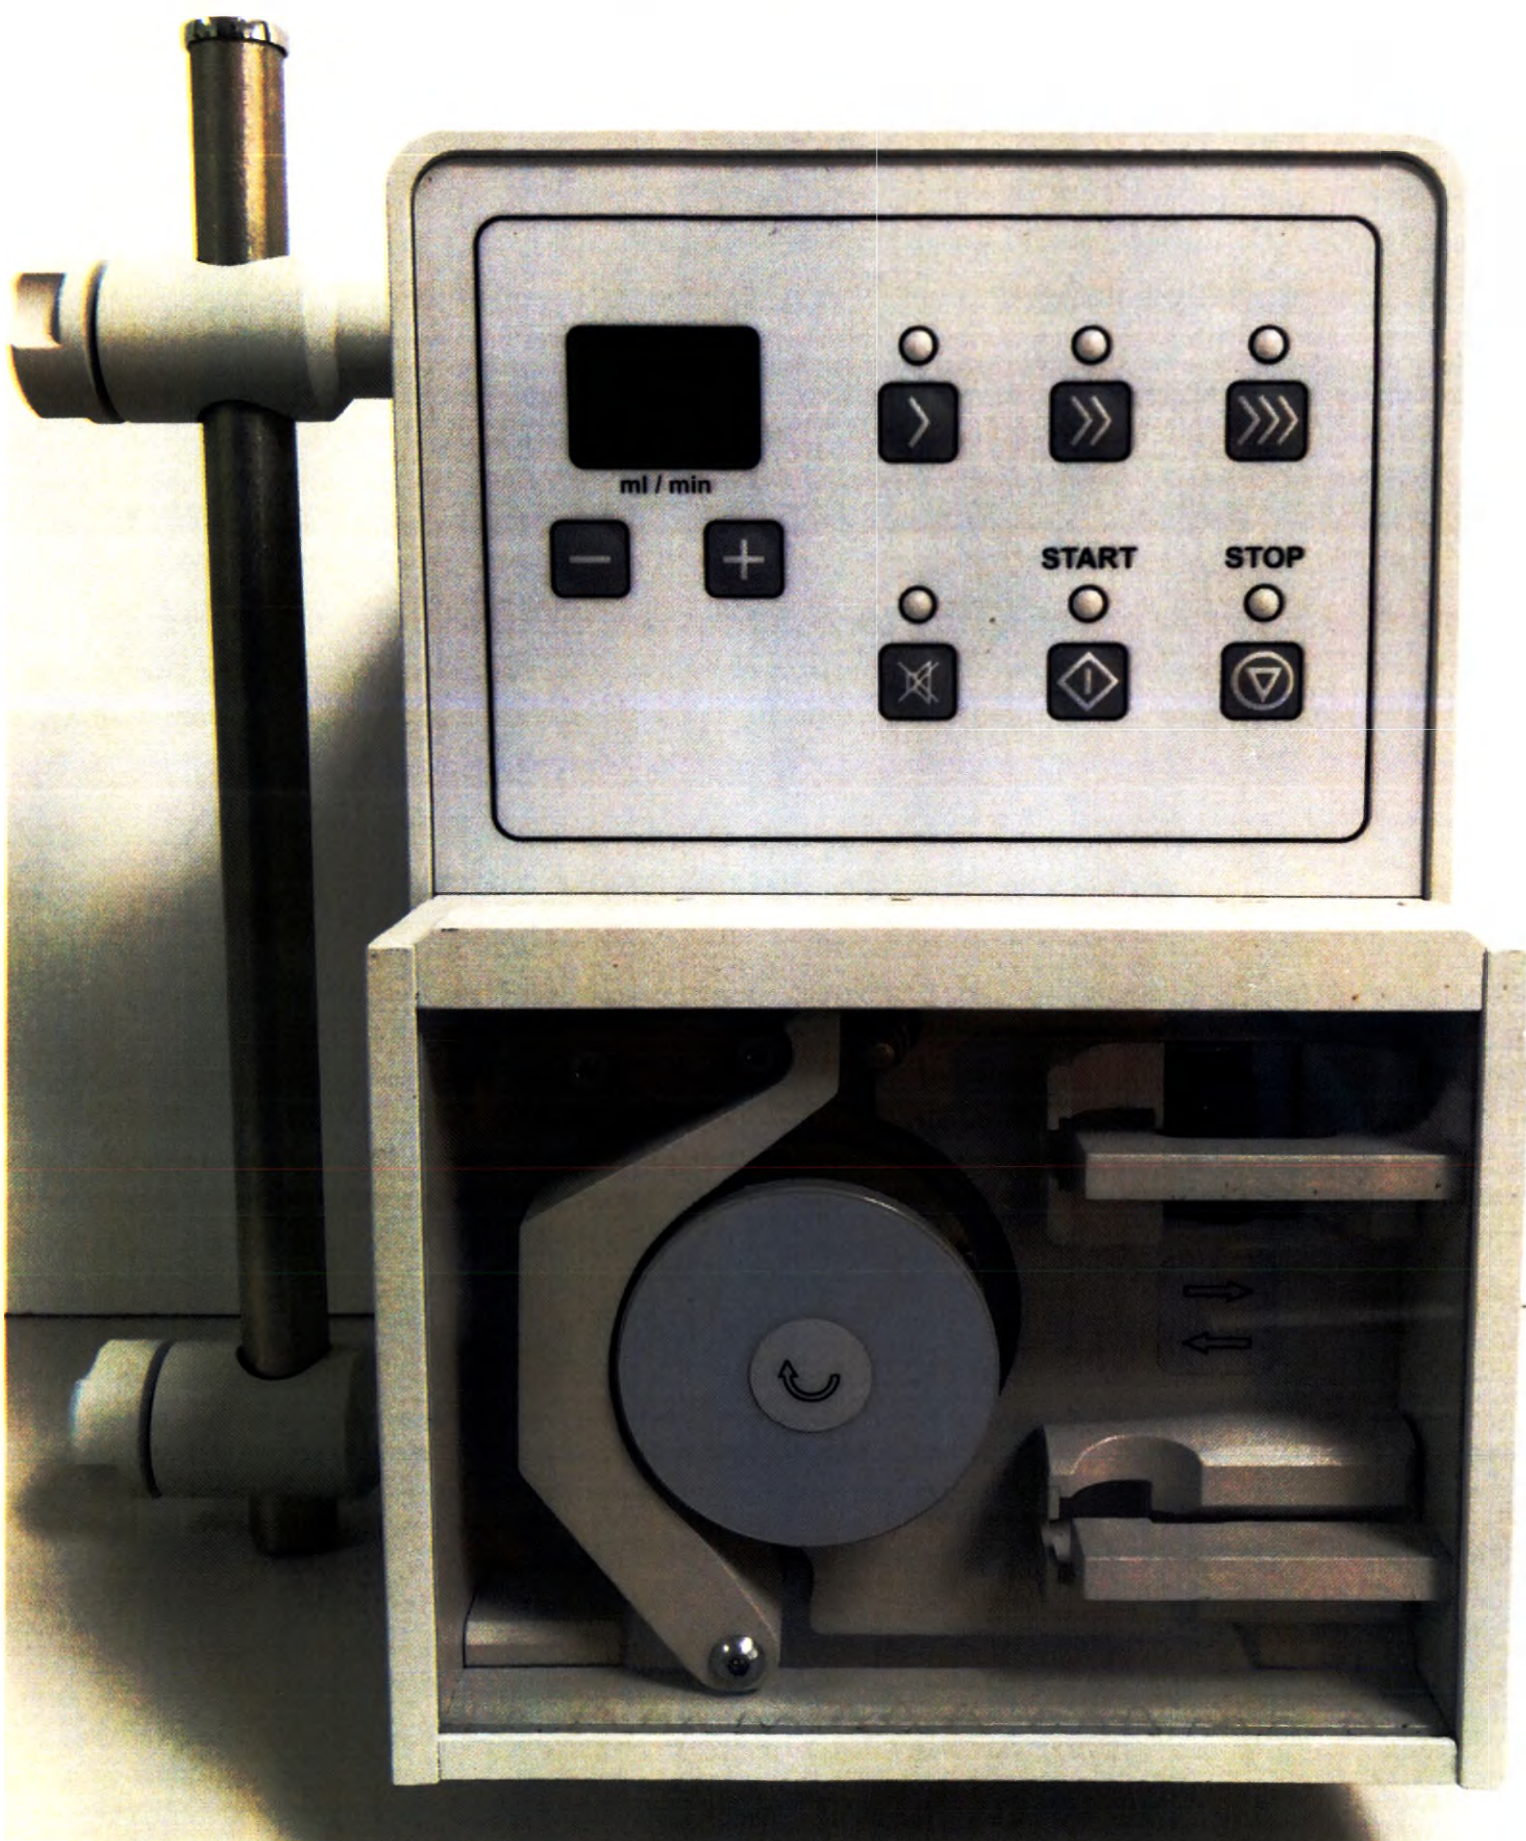


Вид сбоку 1

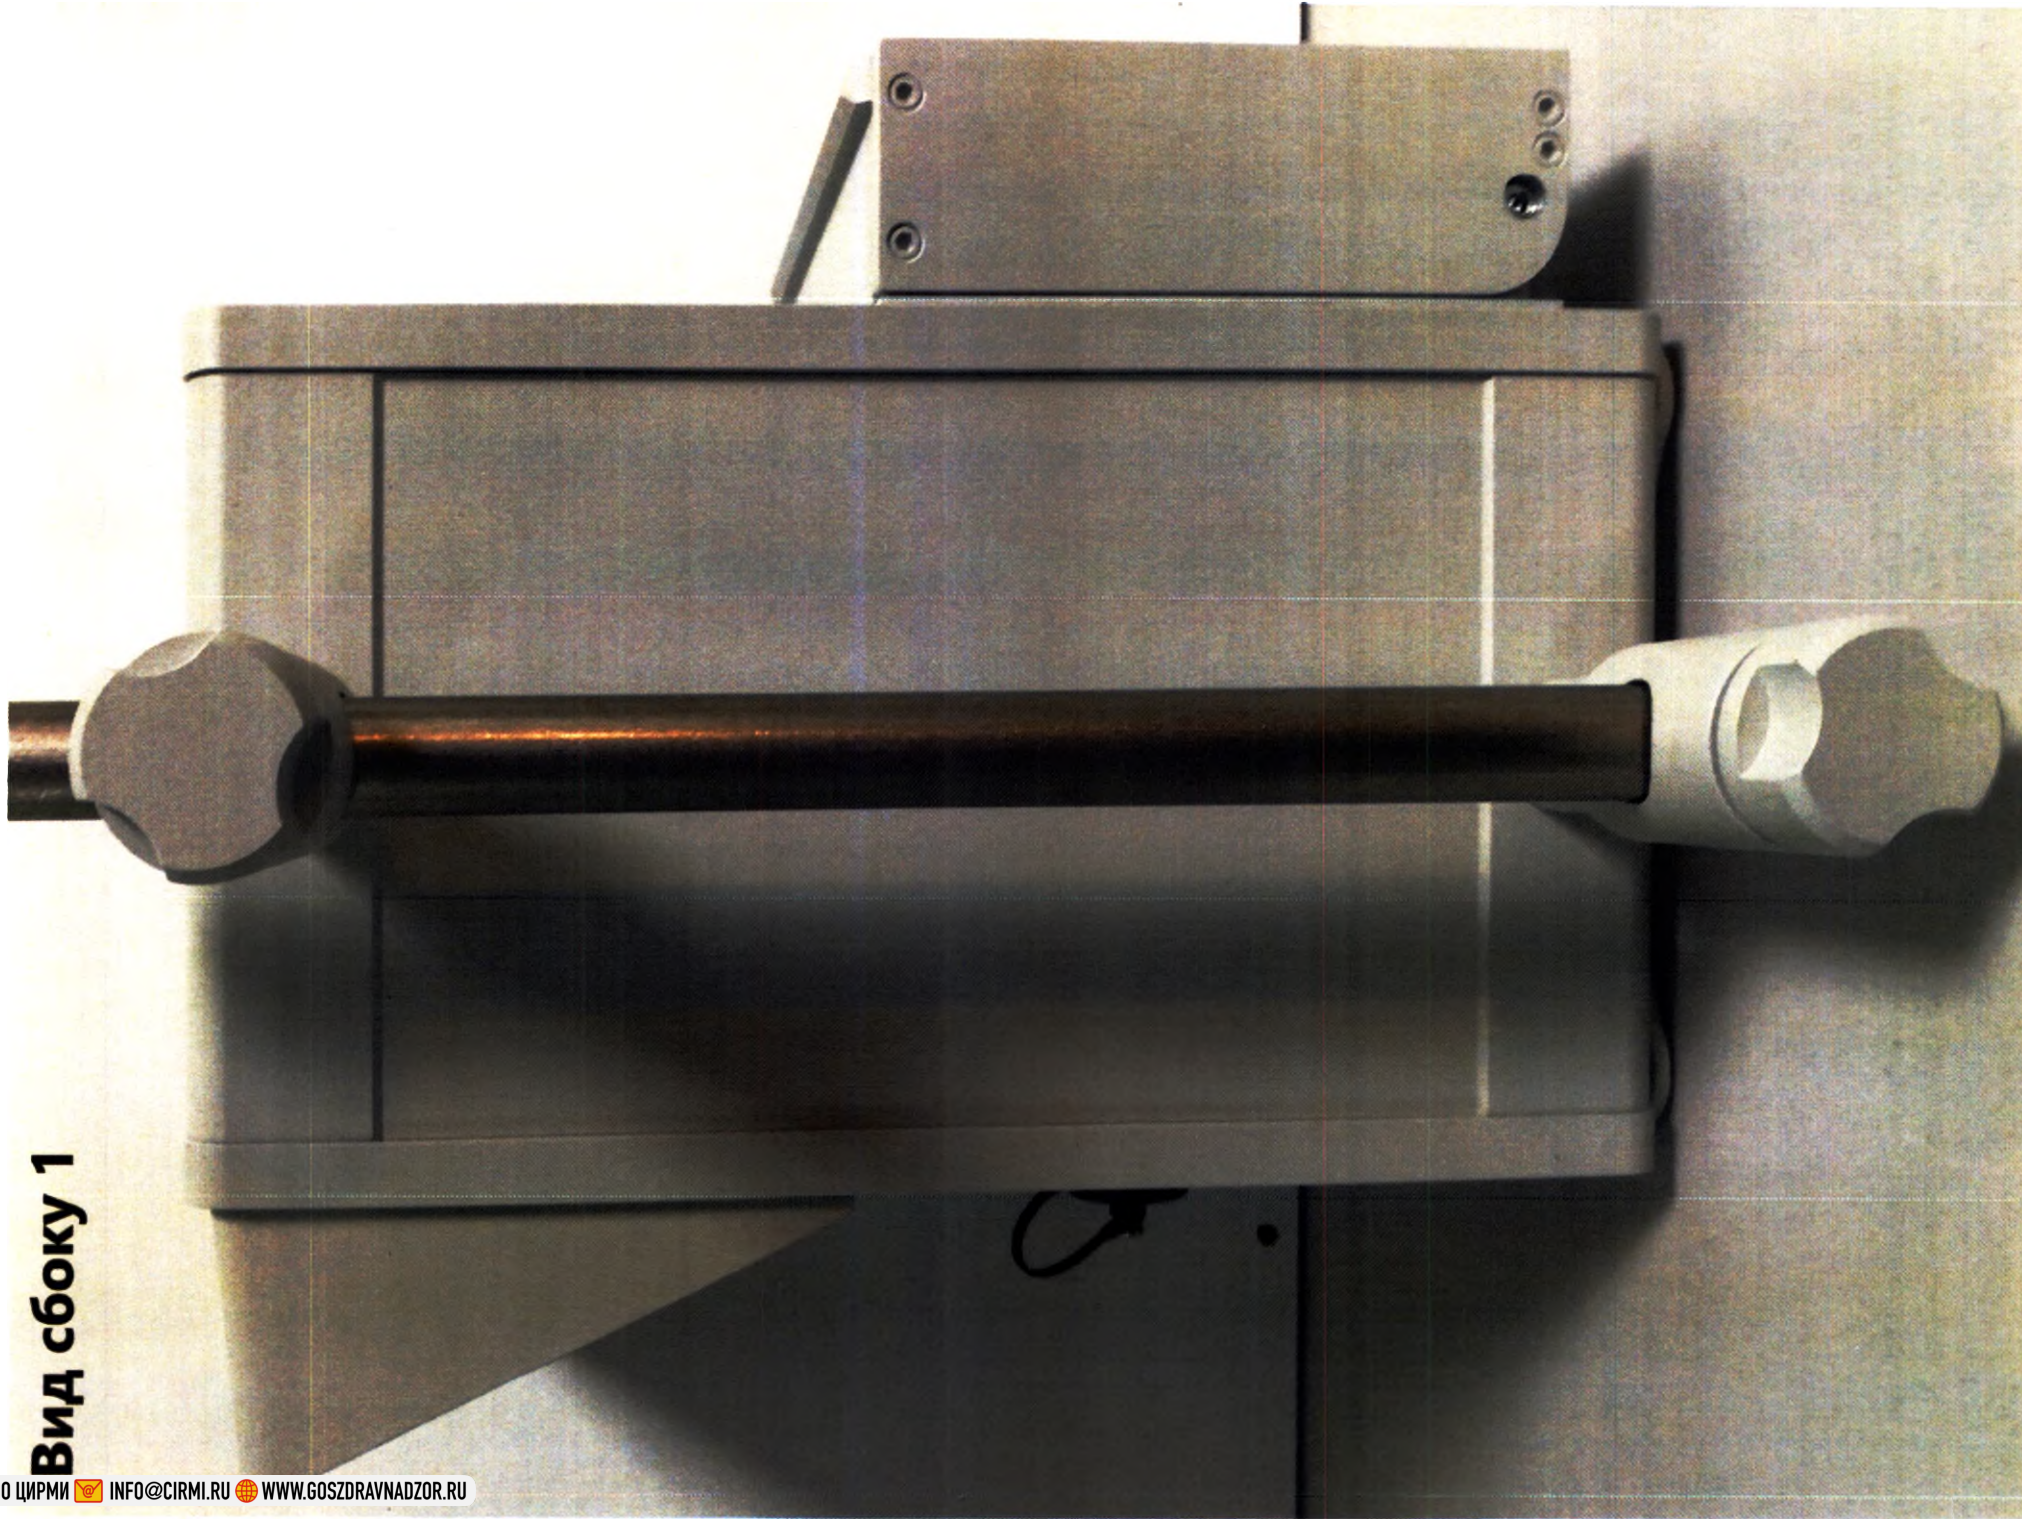

Вид сбоку 2

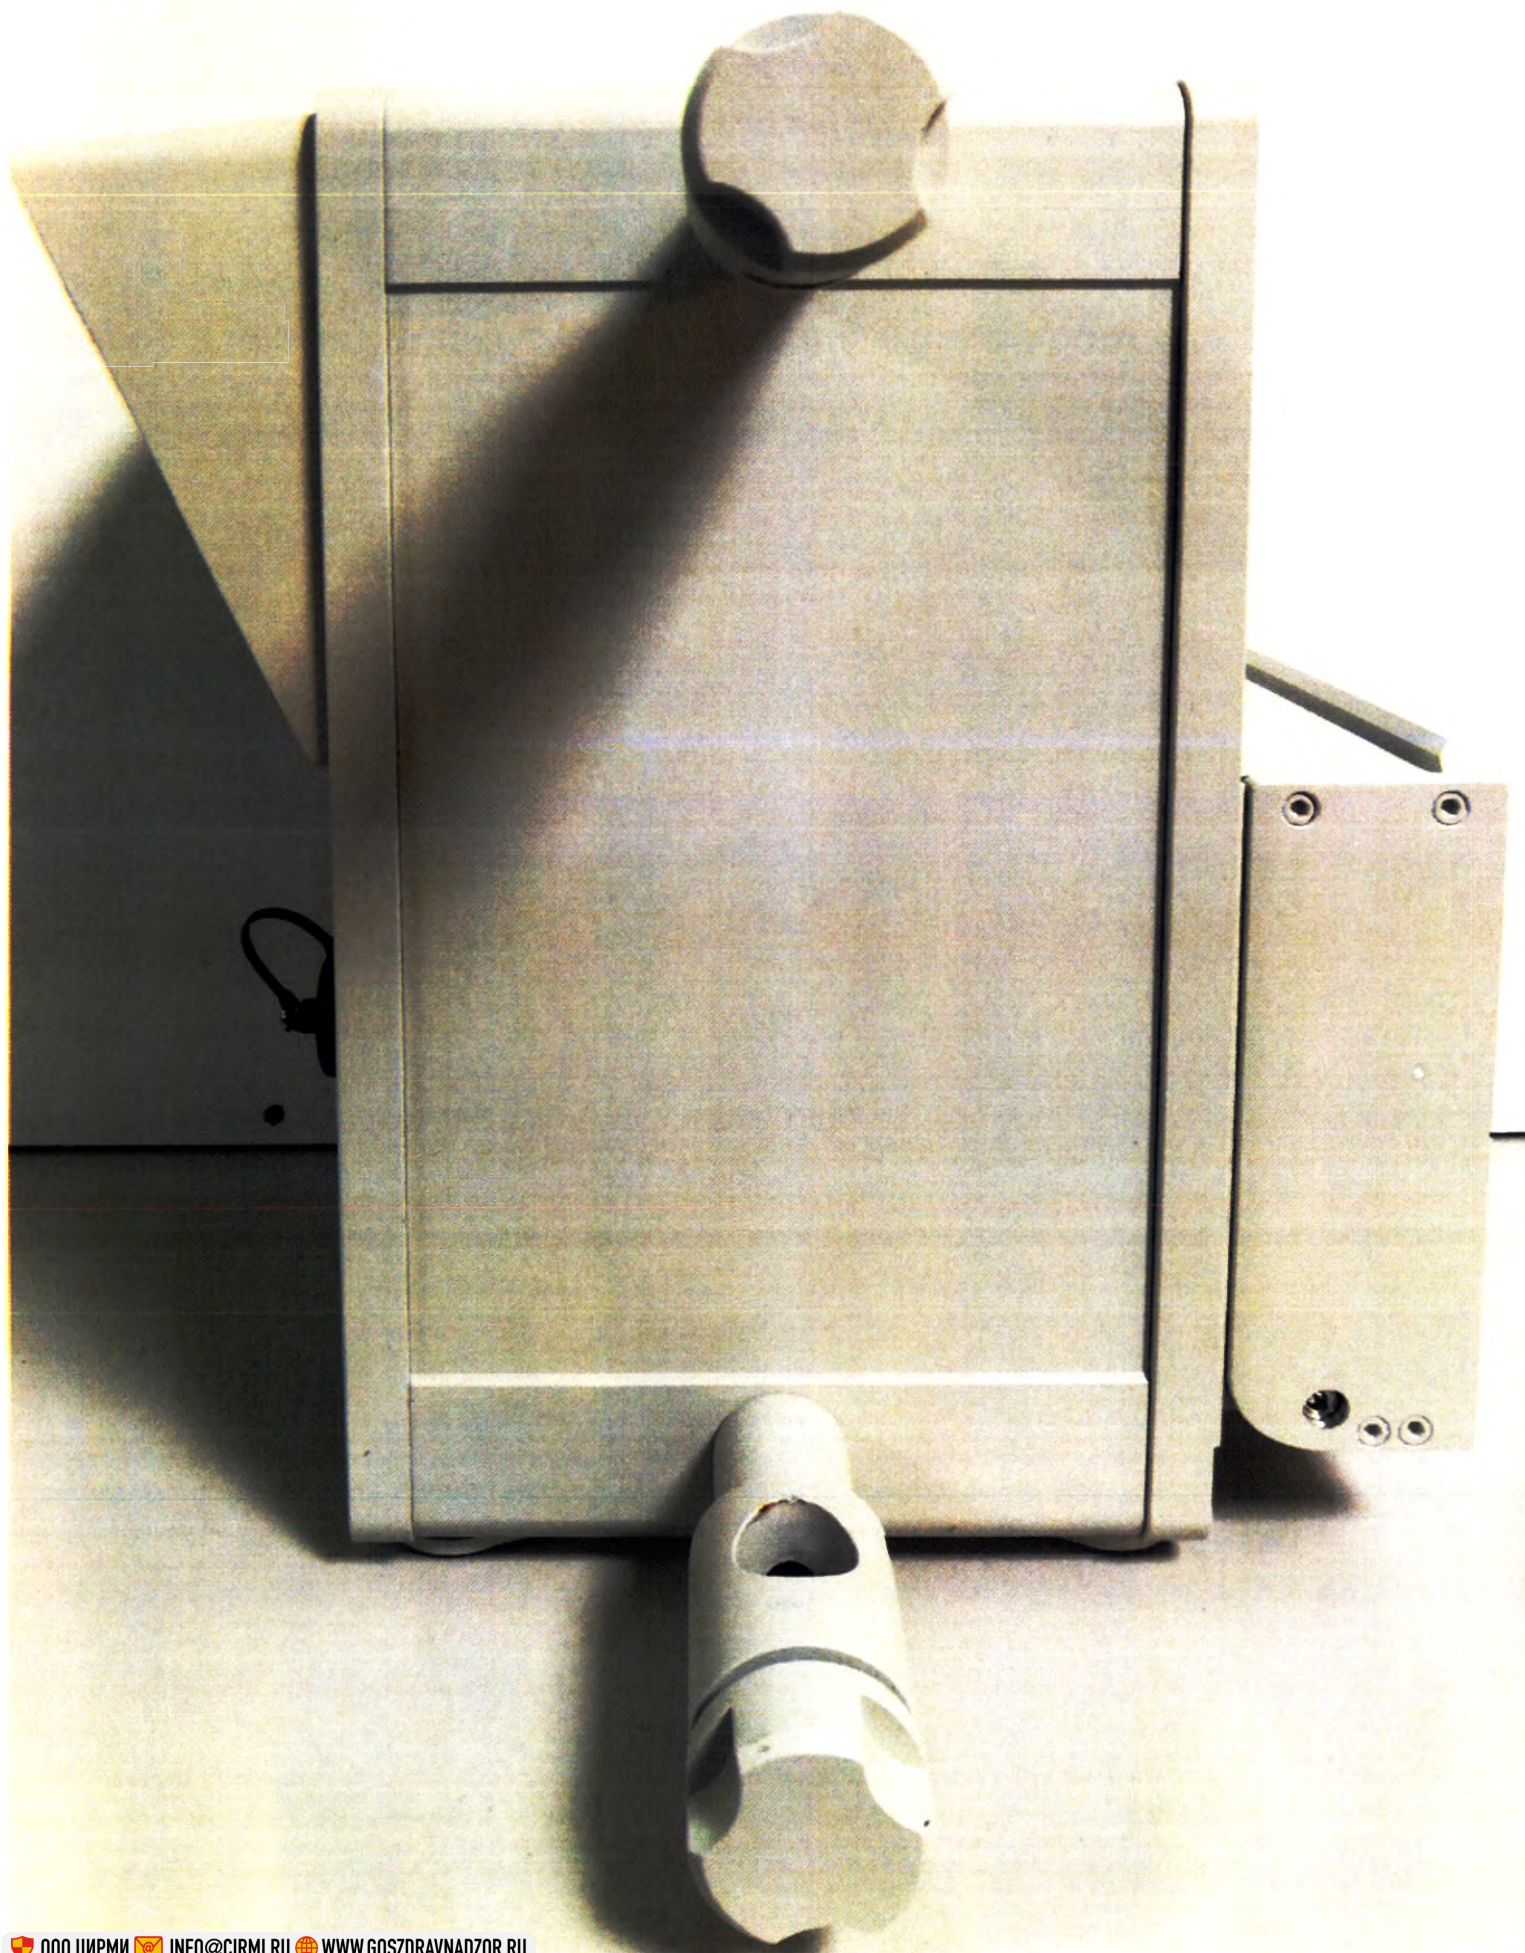

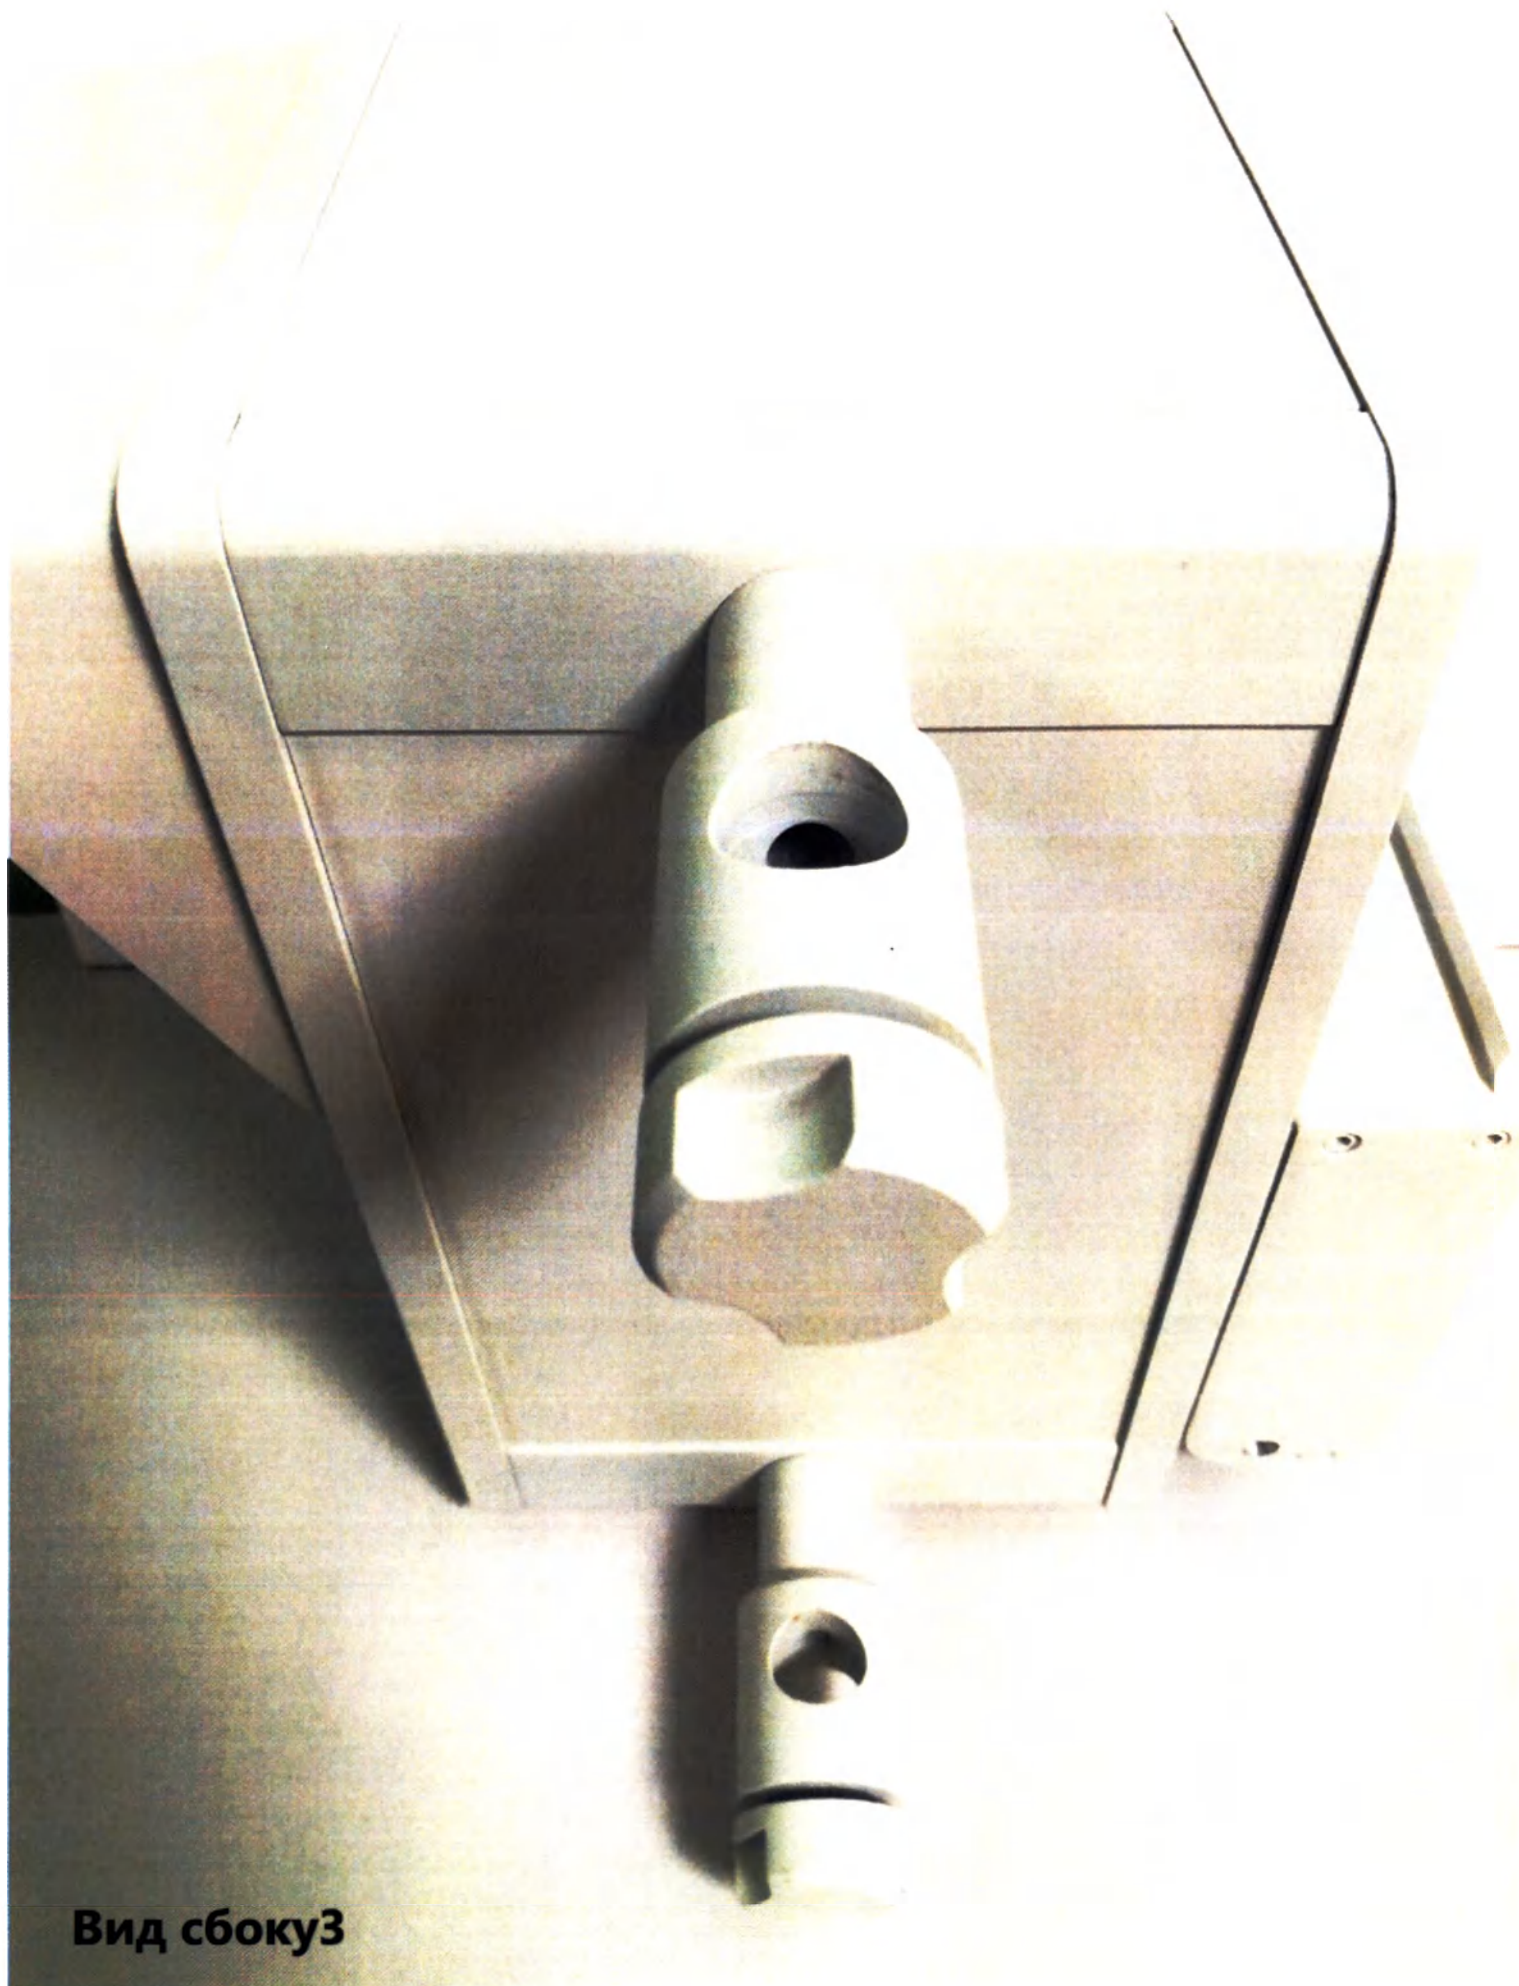

Вид сбоку3

Задняя панель «Биоток ИН-01»





IRRIGATION PUMP

PEDAL / RF GEN



DATA



198-242V / 2A
47-63Hz / 150VA
FUSE 2 x 250V/2A



Задняя панель «Биоток ИН-02»

IRRIGATION PUMP

PEDAL / RF GEN



DATA




198-242V / 2A
47-63Hz / 150VA
FUSE 2 x  250V/2A




Задняя панель

Лицевая панель «Биоток ИН-01»

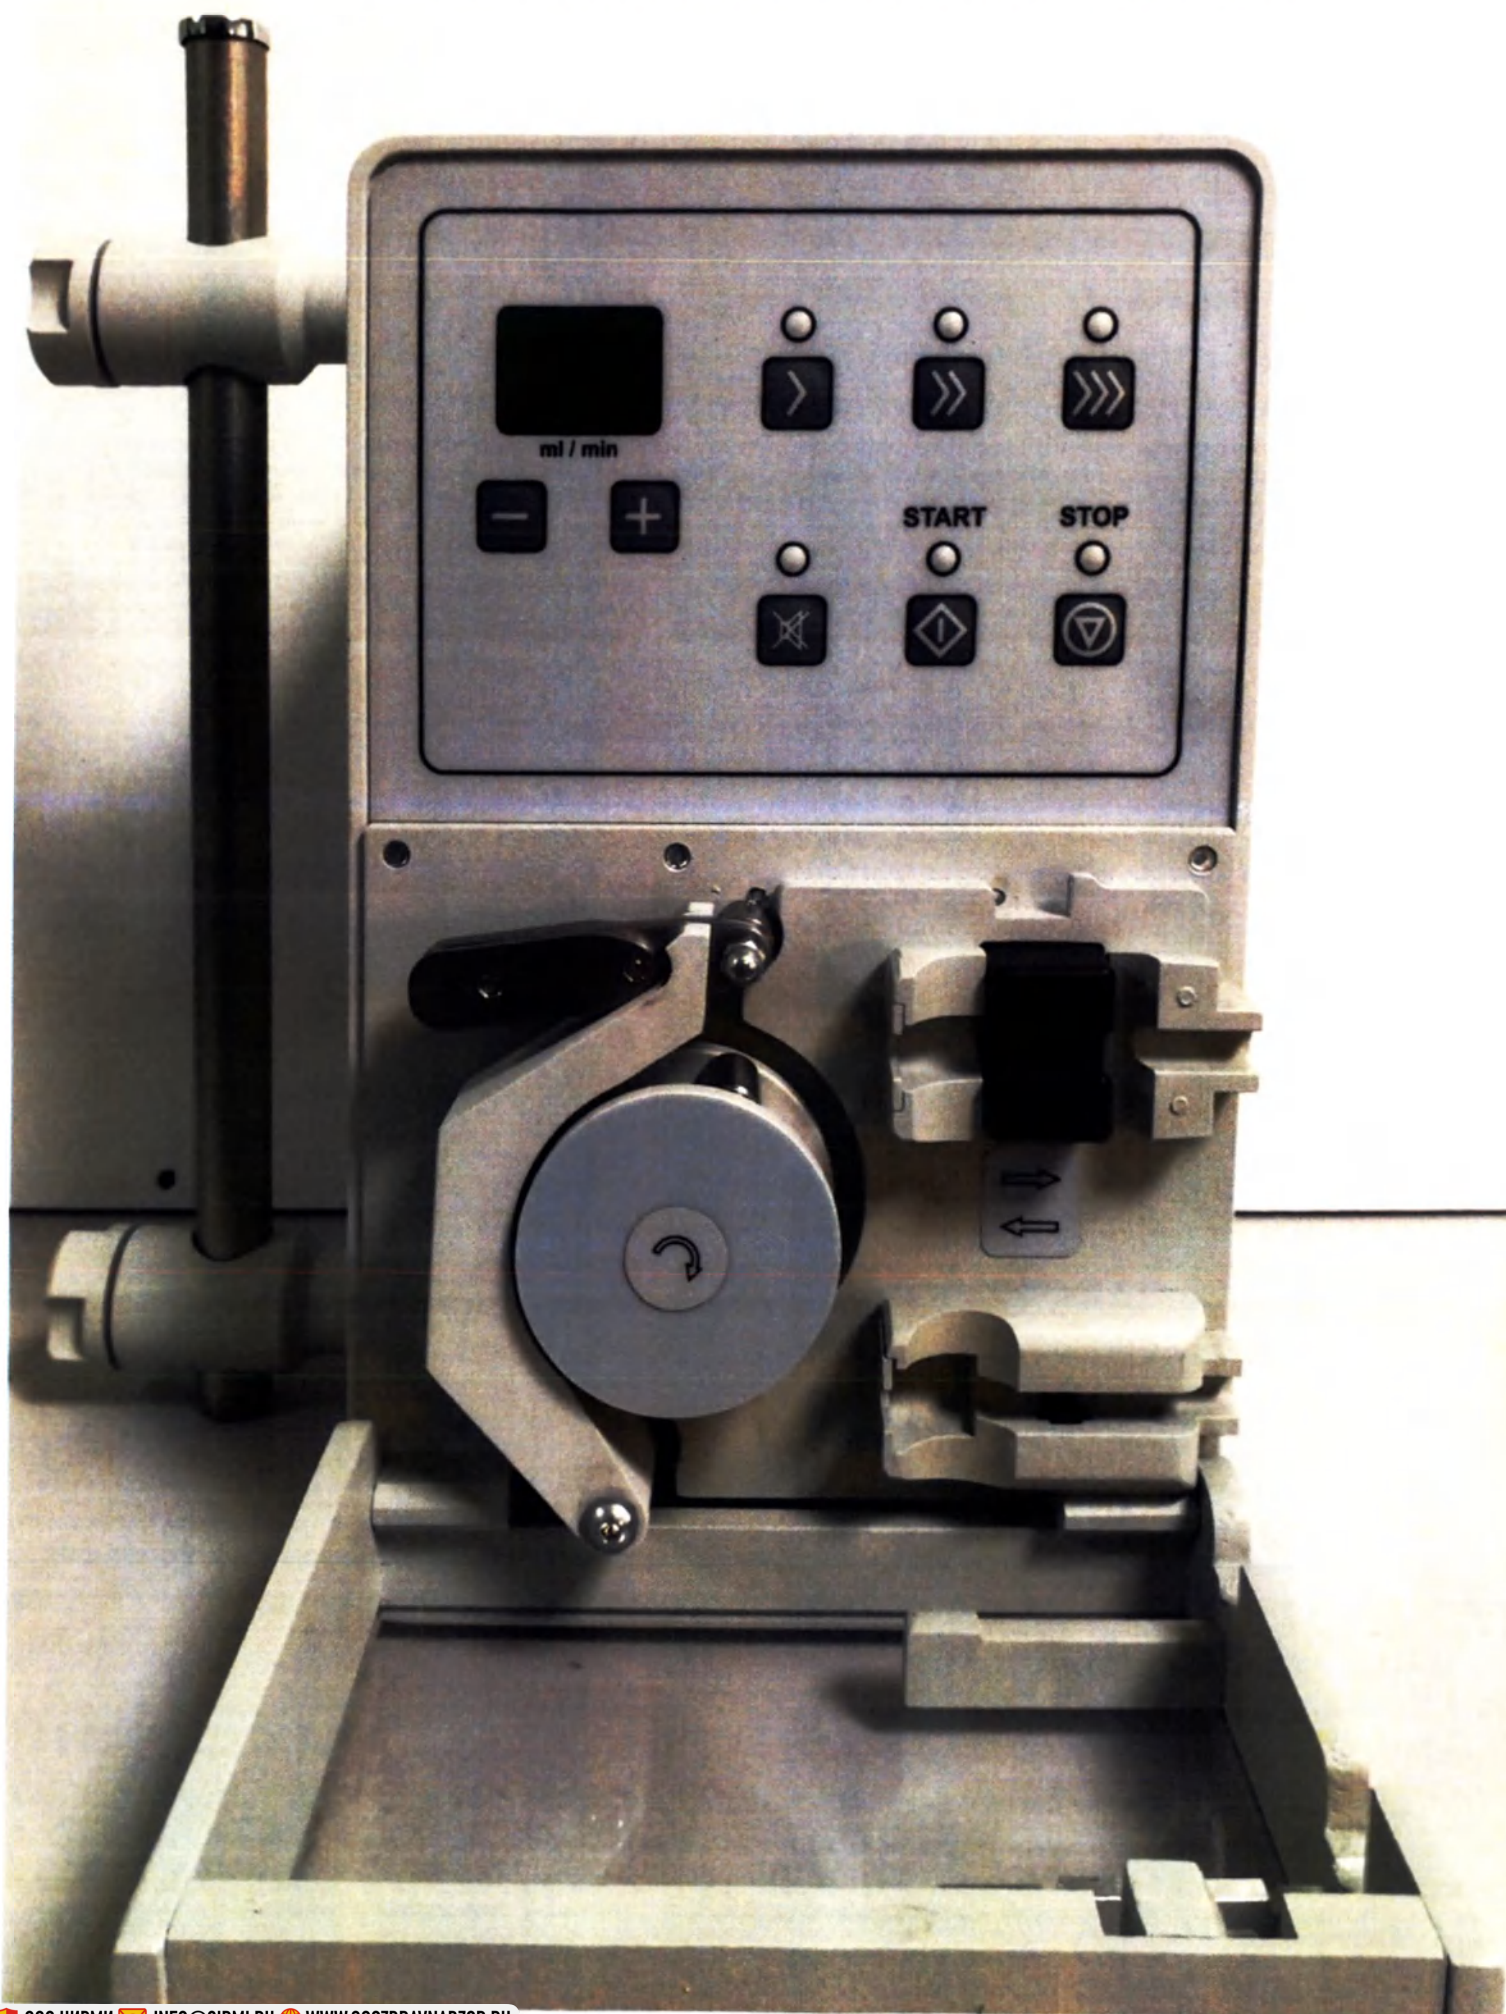

Лицевая панель «Биоток ИН-02»

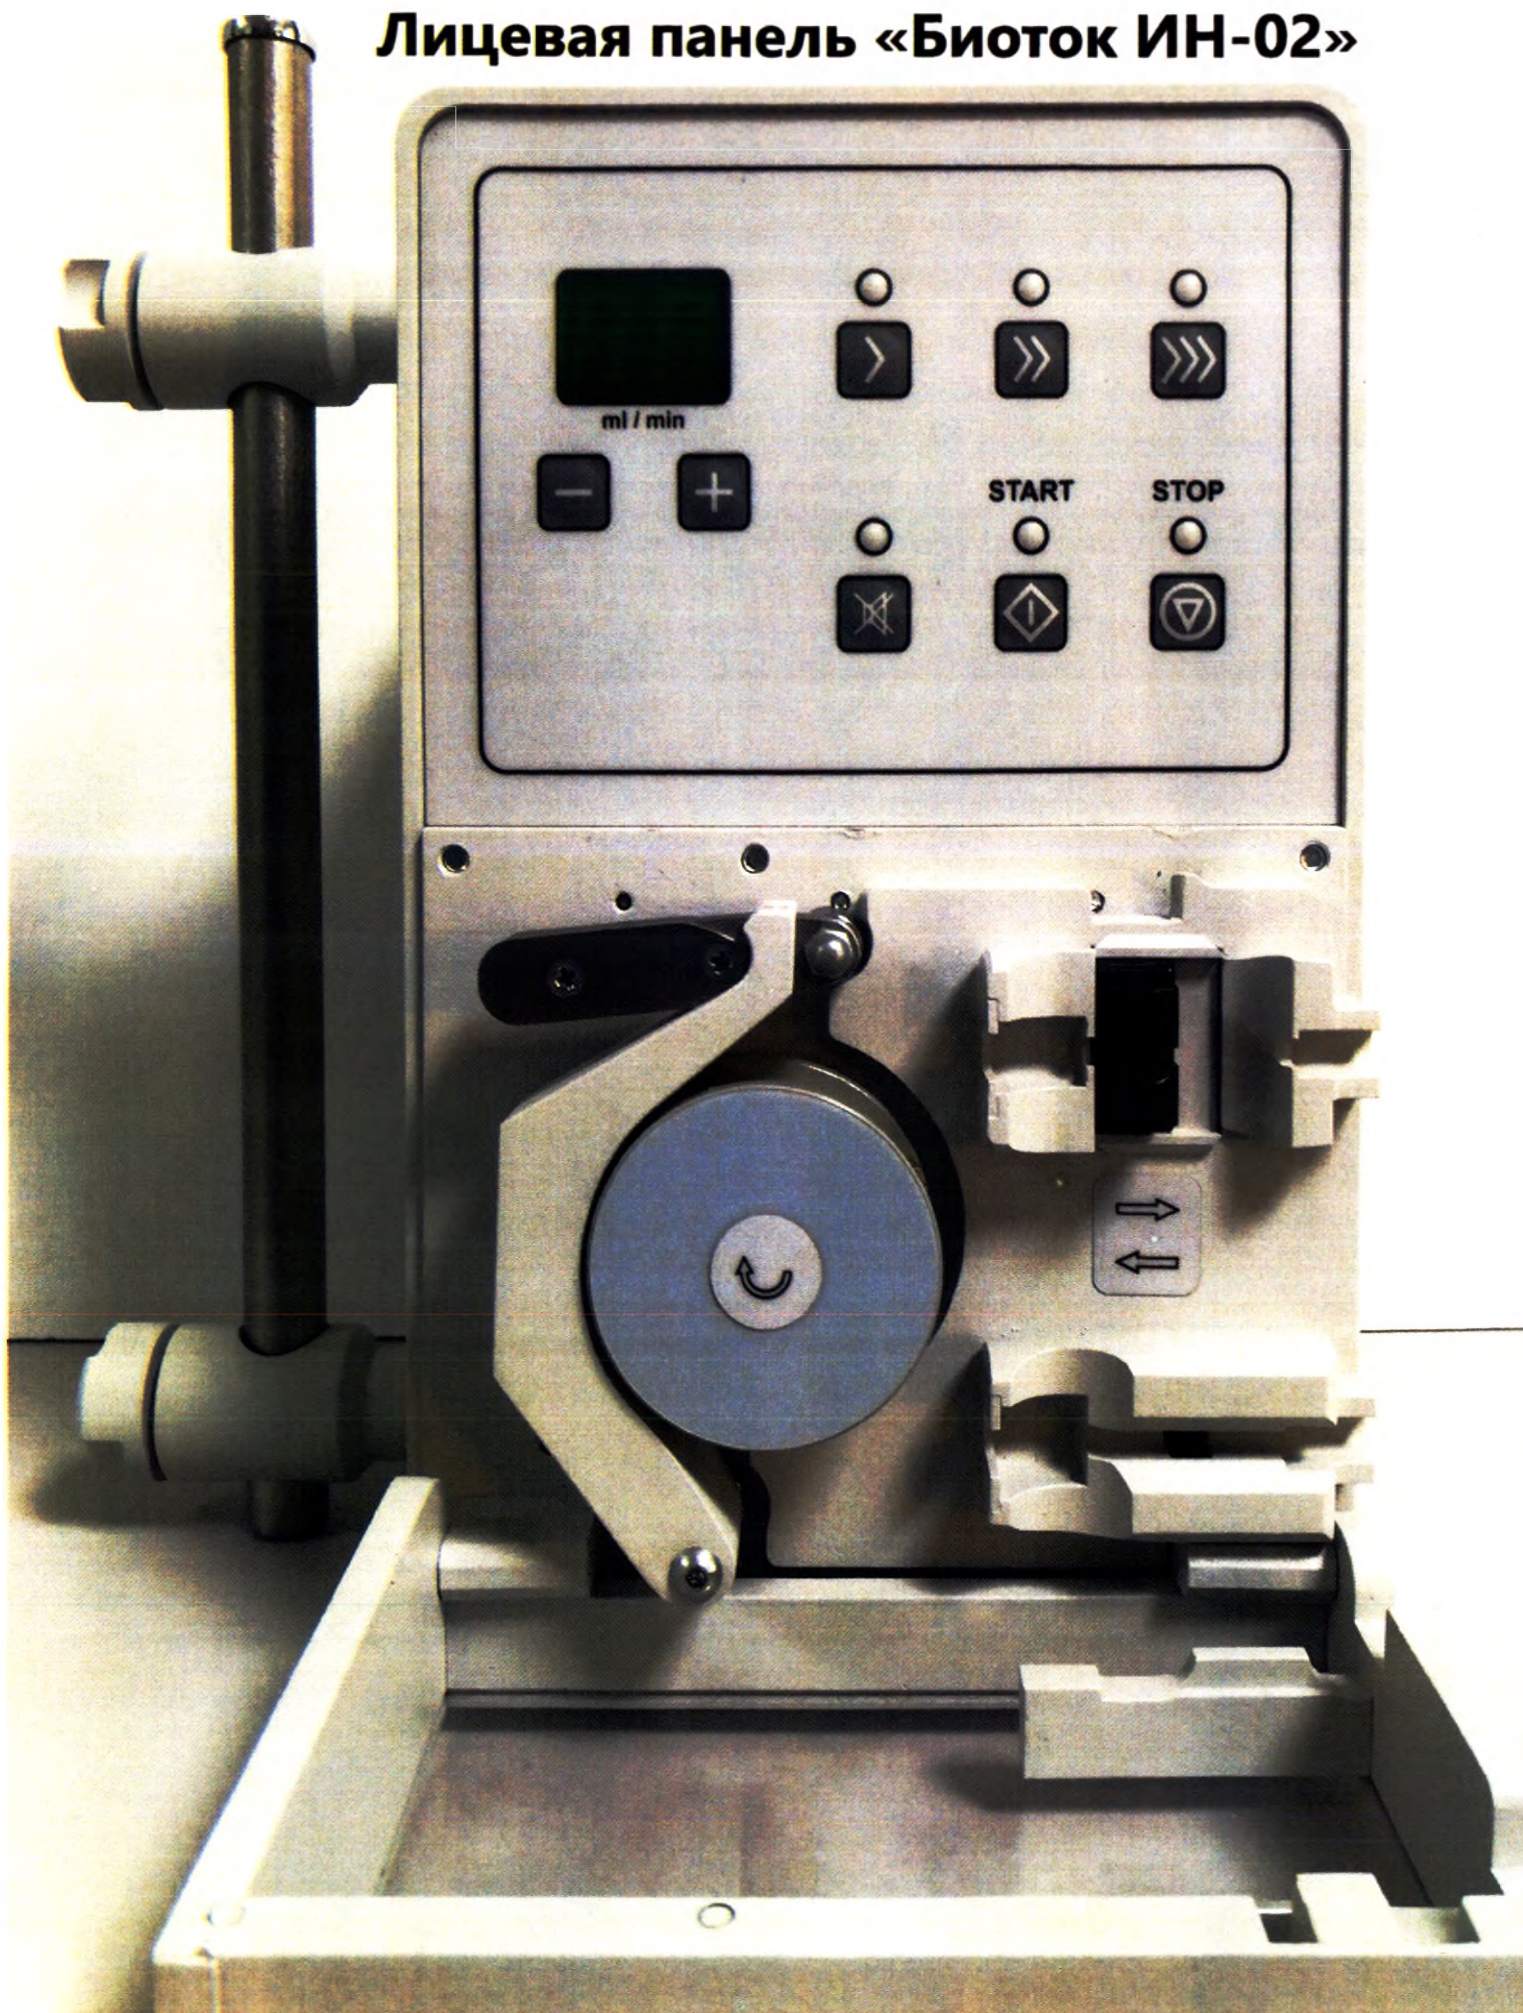

Насосная секция «Биоток ИН-01»




Насосная секция «Биоток ИН-02»





Педаль FS-4, Camsco Electric Co, Ltd

Этикетка Биоток ИН-01

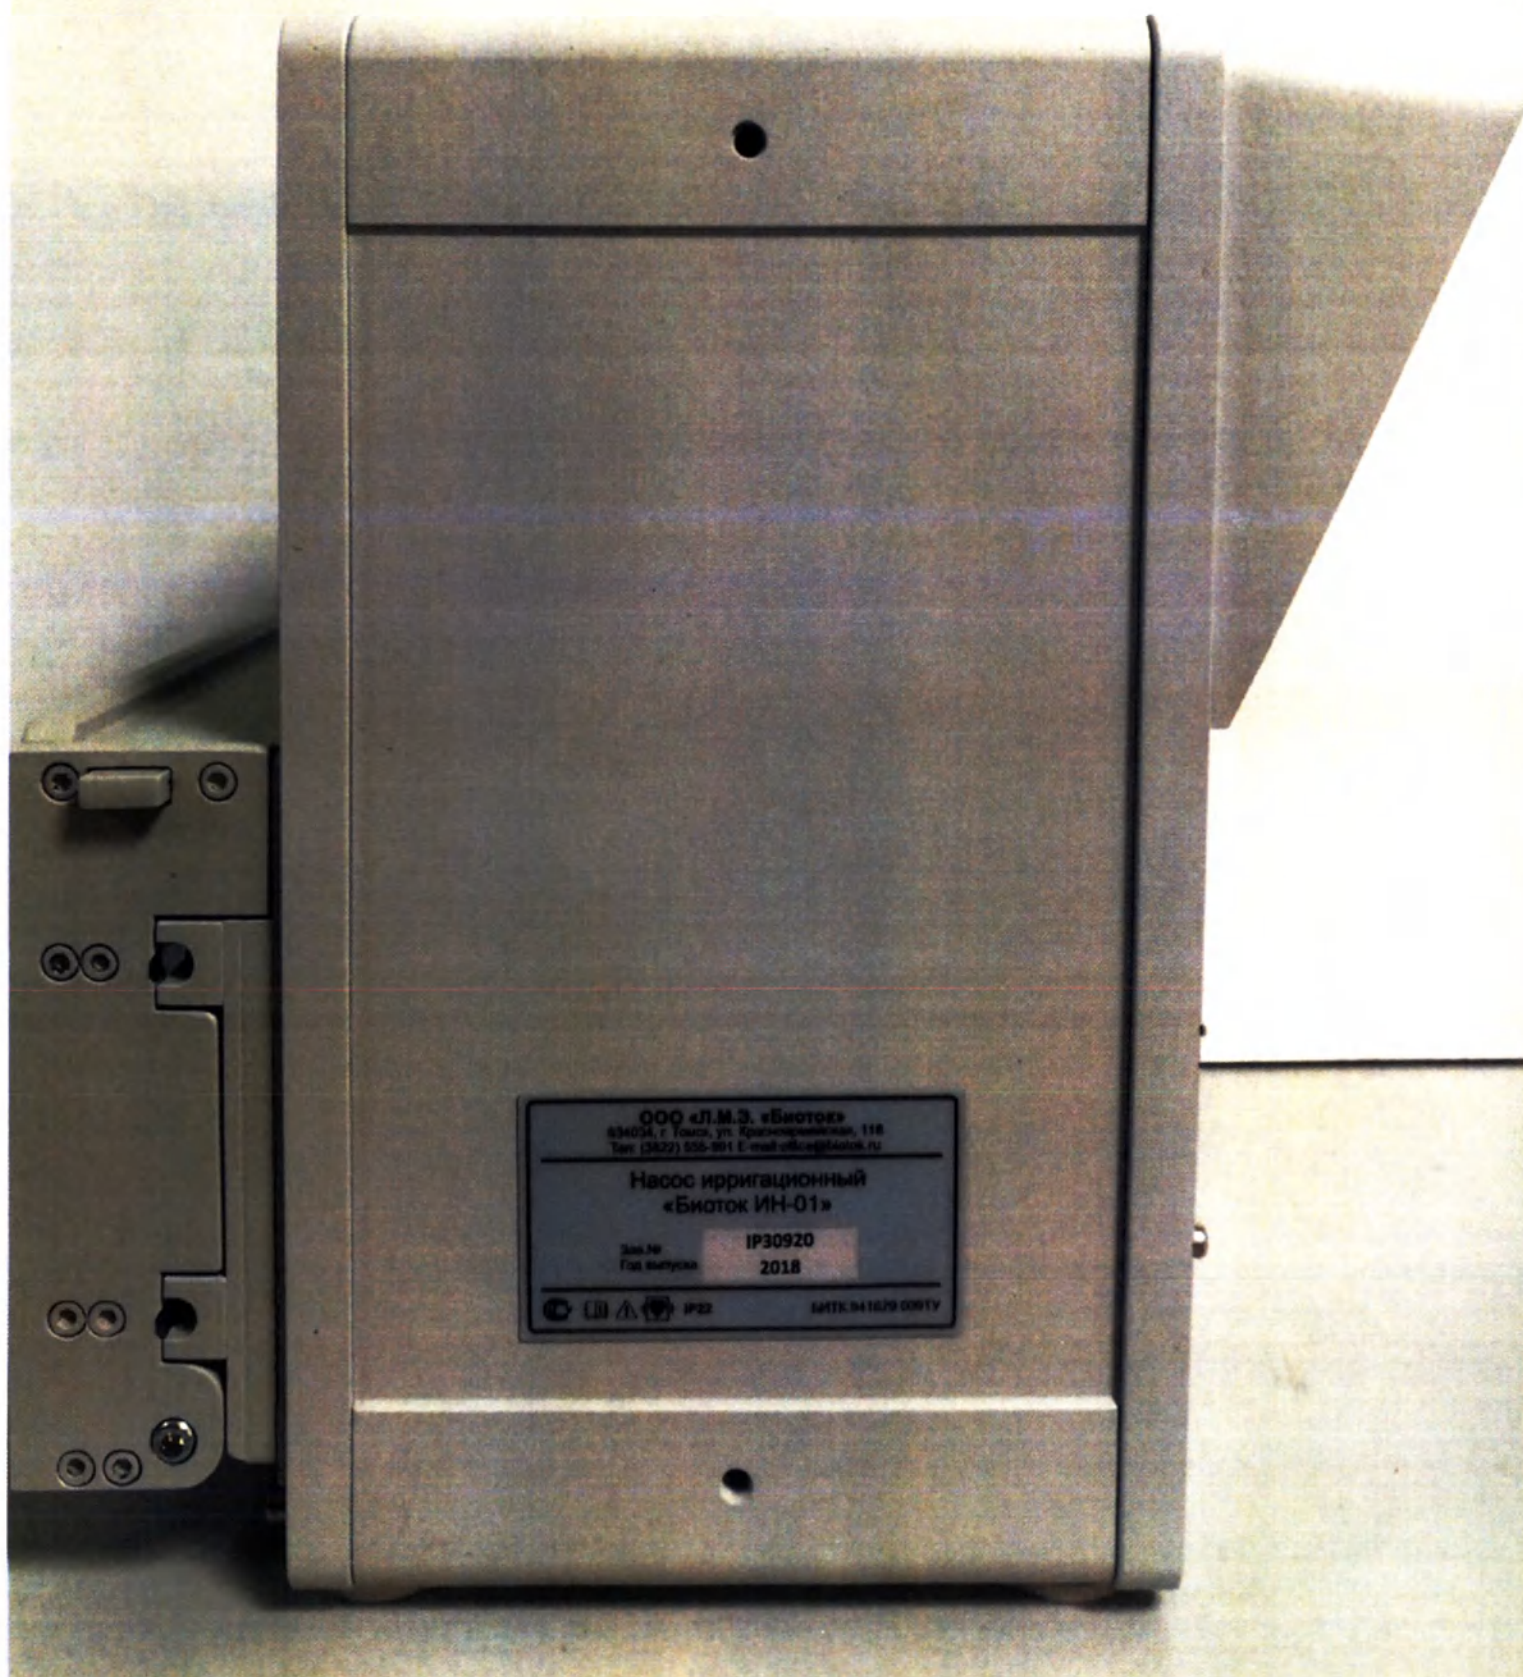


ООО «Л.М.З. «Биоток»
634004, г. Тара, ул. Бригадирский пер., 118
Тел: (3822) 556-801 E-mail: office@biotok.ru

Насос ирригационный
«Биоток ИН-01»

Зав. №	IP30920
Год выпуска	2018

CE CB A IP22 54753 341679 006174

Этикетка Биоток ИН-02

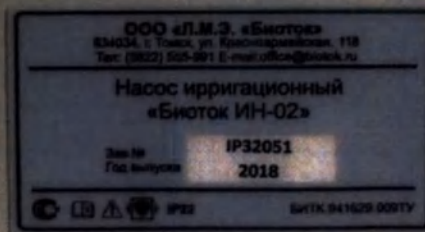

Этикетка

ООО «Л.М.Э. «Биоток»
634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 118
Тел: (3822) 555-991 E-mail: office@biotok.ru

Насос ирригационный
«Биоток ИН-02»




Зав.№
Год выпуска

IP32051
2018




БИТК.941629.009ТУ

Образцы маркировки «Насос ирригационный «Биоток» БИТК.941629.009ТУ

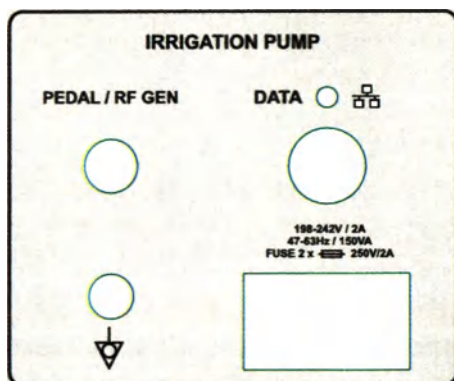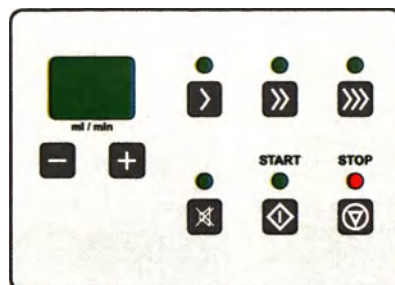

Директор ООО «Л.М.Э. «Биоток»



А.И. Оферкин

Дата 10.09.2019

Образцы упаковки
и транспортной маркировки
«Насос ирригационный «Биоток»
БИТК.941629.009ТУ

Ящик для упаковки



Упаковка



Маркировка транспортной упаковки



Наименование предприятия-изготовителя:

ООО «Лаборатория медицинской электроники «Биоток»
(ООО «Л.М.Э. «Биоток»)

634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 118

Тел./факс: (3822) 55-59-91

E-mail: office@biotok.ru

Наименование или обозначение типа изделия


Обозначение технических условий

Заводской номер

Год и месяц упаковывания

«Насос ирригационный «Биоток ИИ-__»

БИТК.941629.009ТУ



ВЕС БРУТТО _____

ВЕС НЕТТО _____

Условия хранения – 2(С) по ГОСТ 15150-69

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев

Законсервировано до _____

ОТПРАВИТЕЛЬ

ООО «Лаборатория медицинской электроники «Биоток» (ООО «Л.М.Э. «Биоток»)

634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 118

Тел./факс: (3822) 55-59-91

E-mail: office@biotok.ru

ПОЛУЧАТЕЛЬ

Упаковочный лист

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ «БИОТОК»

634034 , г. Томск, ул. Красноармейская, 118
Телефон-факс: (8-3822) 55-59-91, 56-09-23, 56-09-24, 55-96-32
e-mail: office@biotok.ru

Упаковочный лист

Дата 24.01.2019

№	Наименование	Обозначение	Кол-во	Страна	Вес
1	Насос ирригационный «Биоток» «Биоток ИН-01»	БИТК.941629.009-01	1	Россия	6.0
2	Кабель питания	CEE 7/7 - IEC 320 C13	1	Китай	0.28
3	Кабель связи с деструктором радиочастотным	БИТК.685611.600	1	Россия	0.12
4	Кабель связи УТР, 2м.	Конмутационный кабель Ц/УТР категории 5e, 4 пары проводов с разъемами RJ45	1	Россия	0.04
5	Провод выравнивания потенциалов, 5м	БИТК.685611.002-5	1	Россия	0.32
6	Педаль	FS-4, Camso Electric Co, Ltd, Тайвань	1	Россия	1
7	Руководство по эксплуатации	БИТК.941629.009РЭ	1	Россия	0.04

коробка 1/1 страница 1

S/N IP32051

Подпись _____

Размеры коробки (ШхДхВ) _____

Вес брутто _____

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 5
(1976) листов
Директор ООО «Л.М.Э. «Биотек»
Подпись А.И. Офсеркин

