


Фотографическое изображение
Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения
тропонина I в плазме, сыворотке и цельной крови человека методом
иммунохроматографии» (CARDIAC TROPONIN I RAPID TEST)

Внешний вид открытой коробки набора реагентов

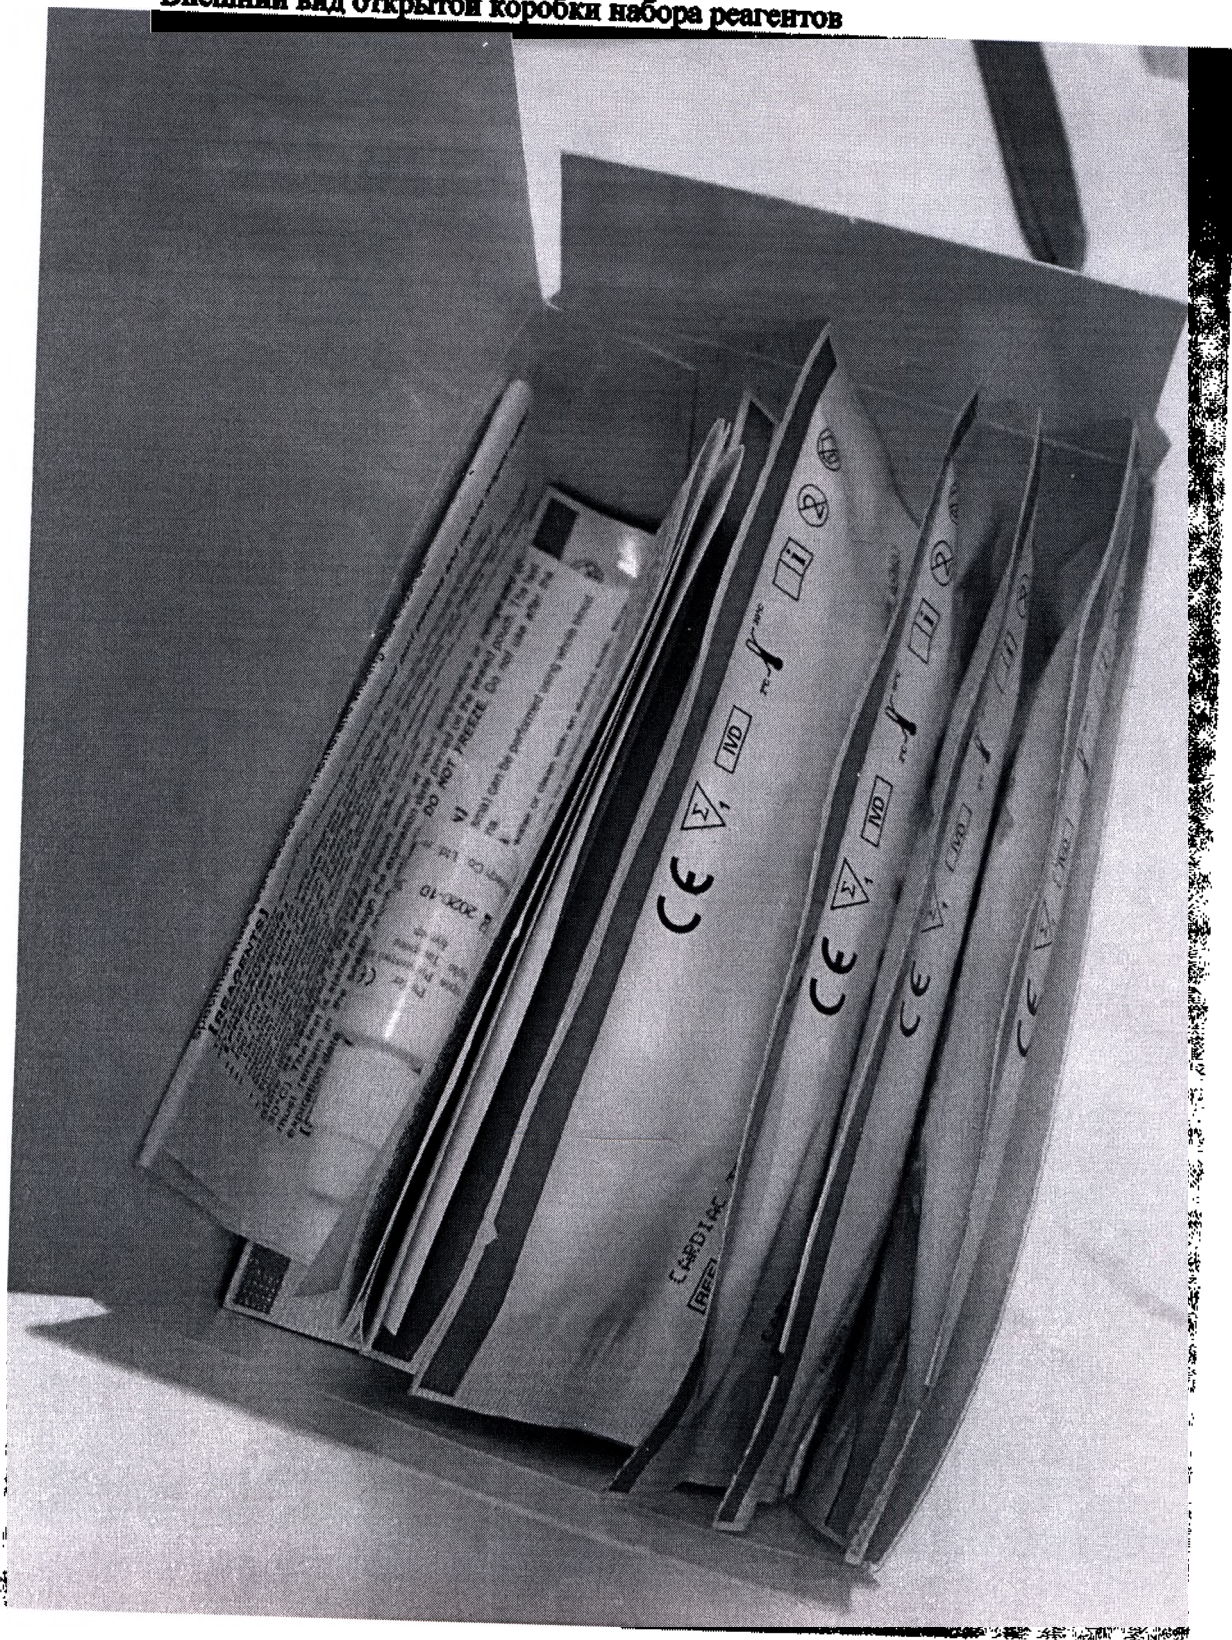

Внешний вид оригинального набора реагентов

RightSign

REF CTNI-C41
Cardiac Troponin I Rapid Test Cassette
(Whole Blood/Serum/Plasma)

LOT CTNI1810003-S  2020-09

 **Biotest**



RightSign

Cardiac Troponin I Rapid Test Cassette
(Whole Blood/Serum/Plasma)
REF CTNI-C41 **LOT** CTNI1810003-S  2020-09

RightSign


 **Biotest**




CARDIAC TROPONIN I RAPID TEST CASSETTE (WHOLE BLOOD/SERUM/PLASMA)
REF CTNI-C41 **LOT** CTNI1810003-S  2020-09

EC REP Shanghai International
Holding Corp. GmbH (Europe)
Elfenstrasse 80,
20537 Hamburg, Germany


 Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd.
17# Futai Road, Zhongtai Street,
Yuhang District, Hangzhou-311121
P. R. China



Внешний вид набора реагентов, для обращения на территории РФ:

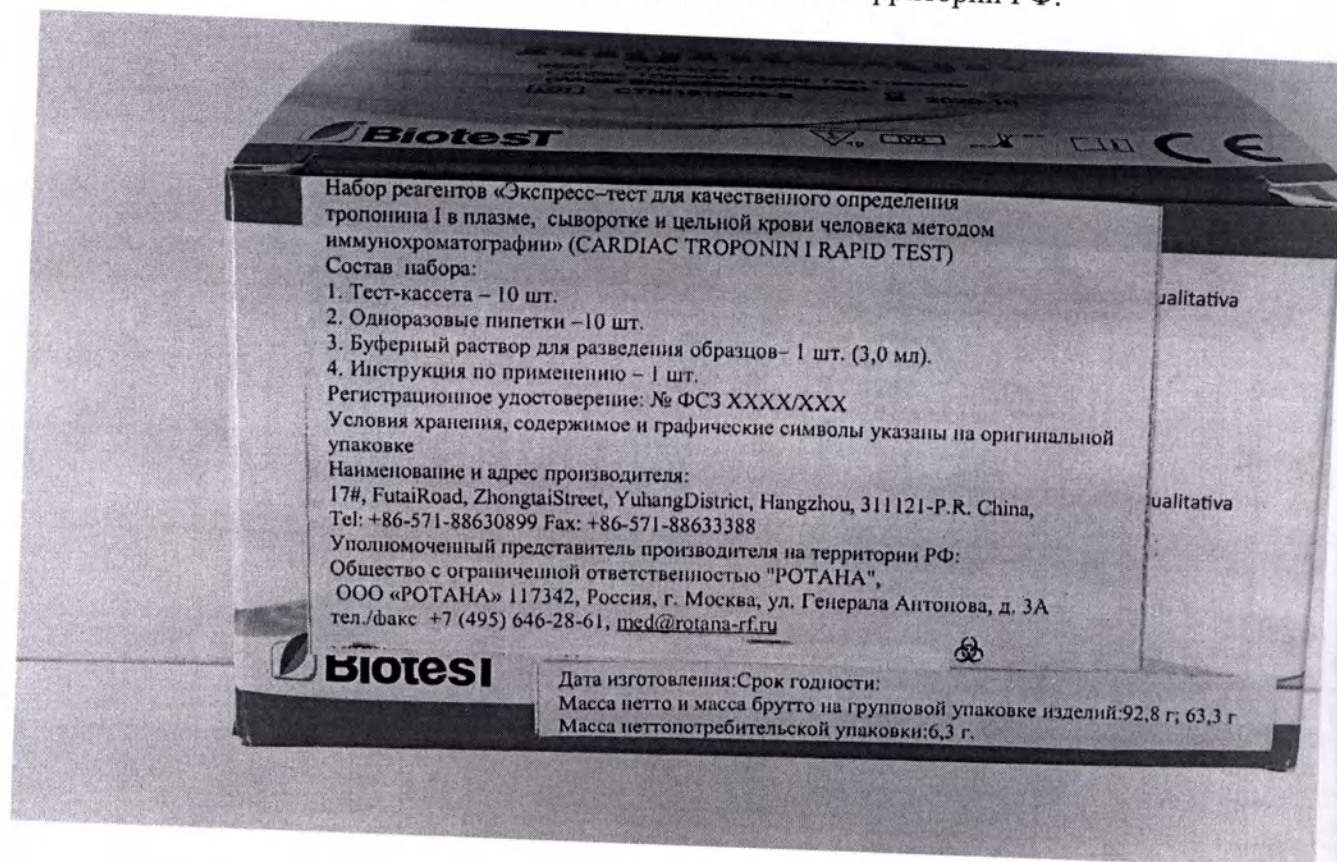

Внутреннее содержимое индивидуальной упаковки из фольги ламинированной с десикантом и буферный раствор

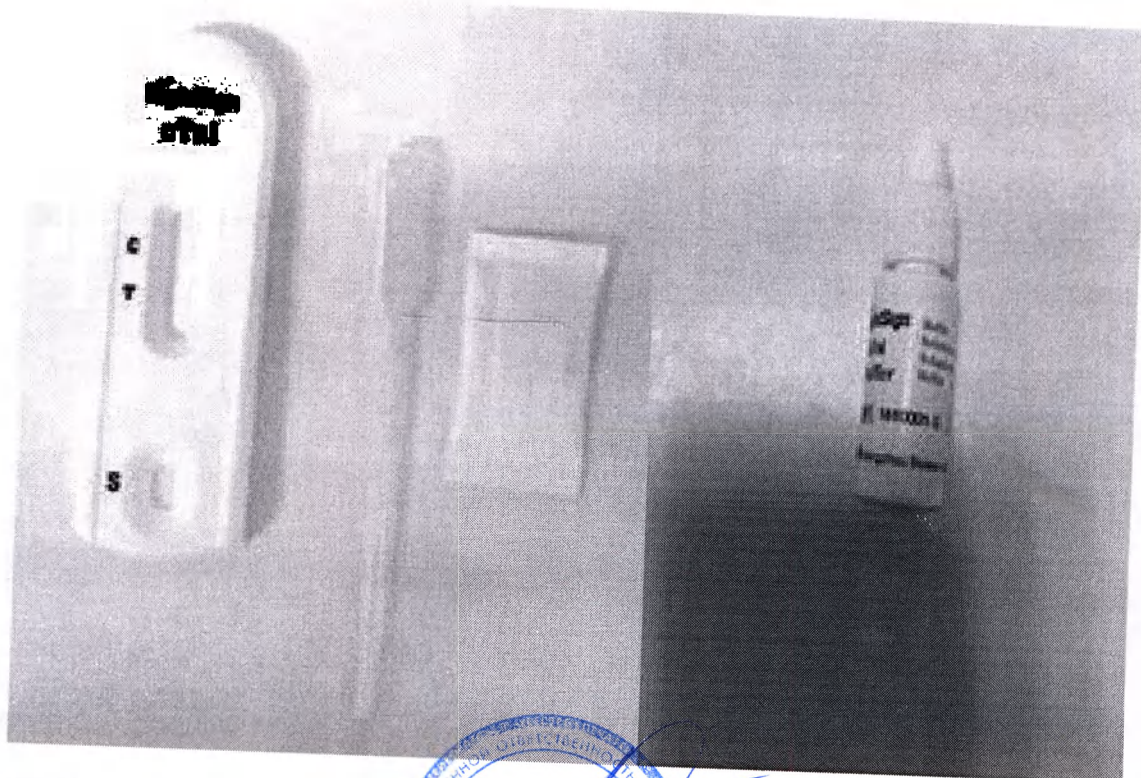

Генеральный директор ООО «Ротана»

В.Г. Фирсов



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

3 лист а


Генеральный директор ООО «РОТАНА»
В.Г. Фирсов

02 09 2019 г.



МАКЕТ КОРОБКИ НАБОРА

Description	RightSign CTNI CE Cassette Box-10T (上海国际)	Part Number	RP4004903	Size	121*76*66mm
Printing Contents		L Number		Size	
Designer	孙加东	Design Date/Version	2015/3/4	Mold Number	
Artwork checked by		Material		Checked by	
Approved by Customer/Date		Approved by Marketing/Date			
Approved by RA/Date		Approved by QA		Effective Date	
Approved by P.M.T.					
PMS 334 C	PMS 2935 C	PMS 361 C	PMS 356 C	90% Black	

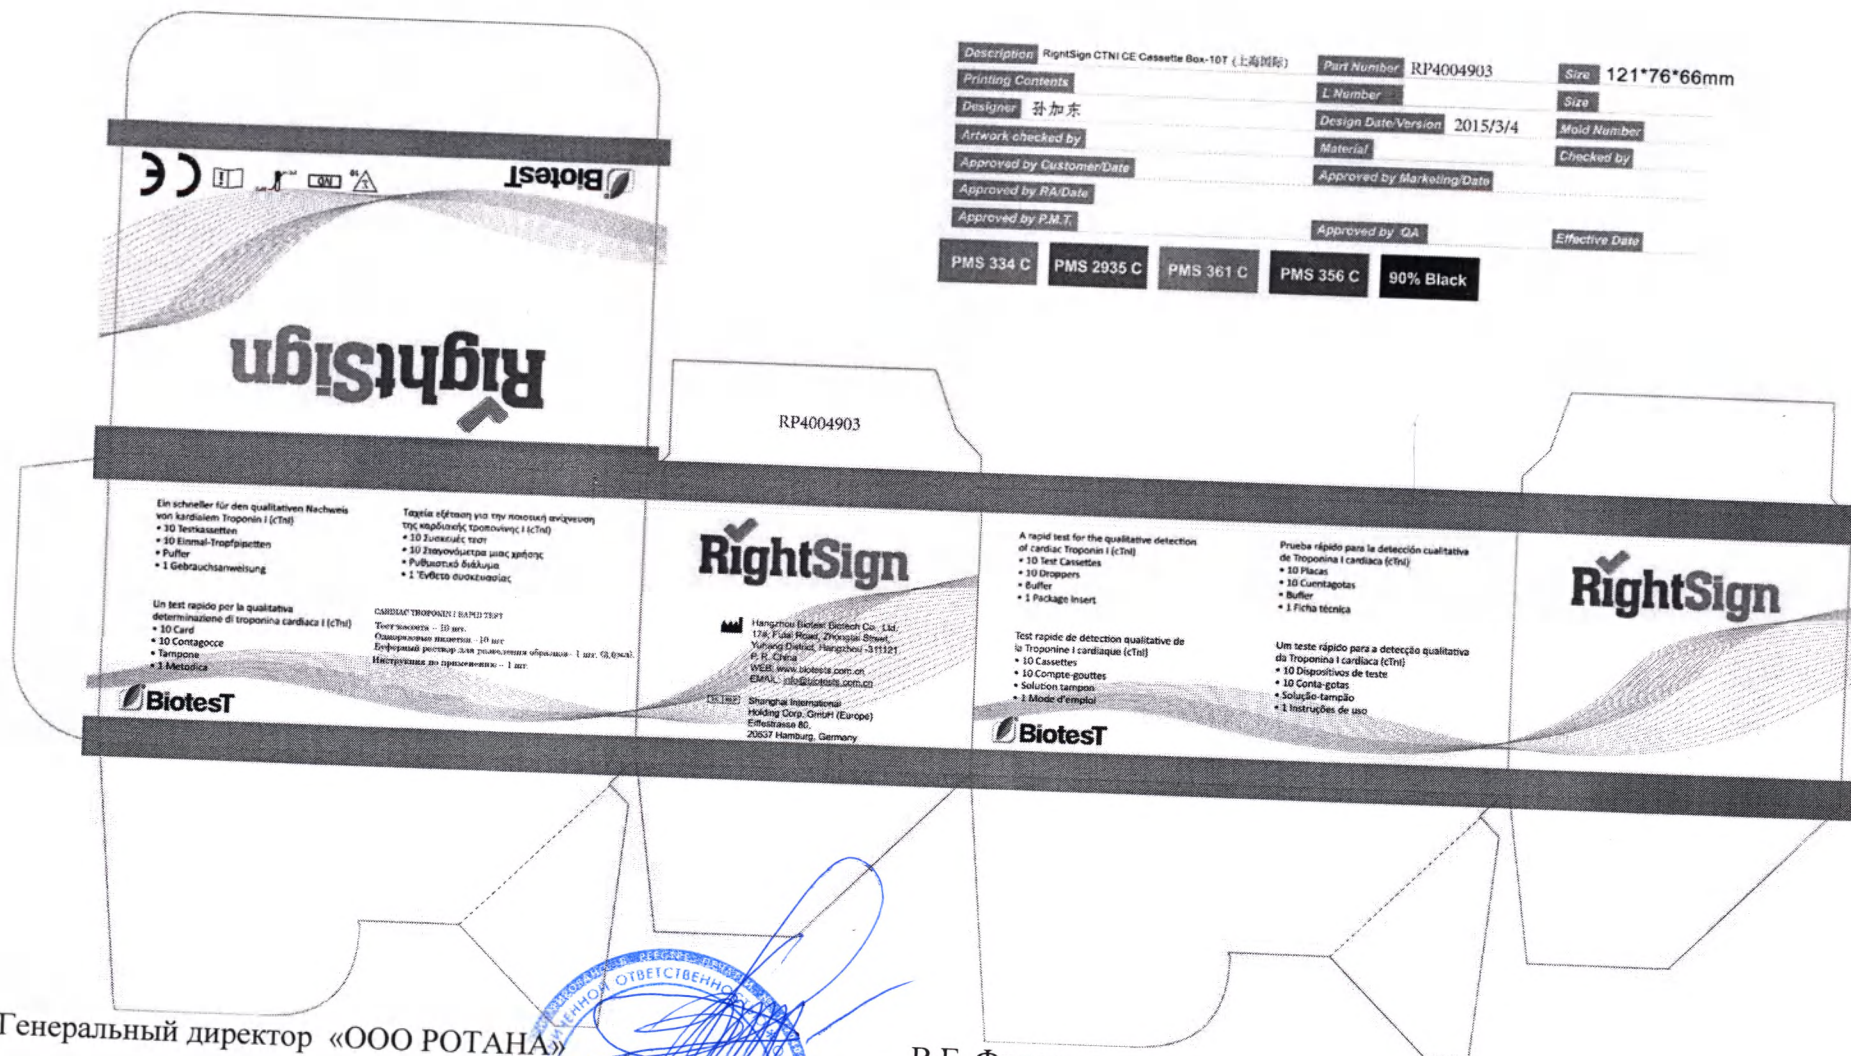

Генеральный директор «ООО РОТНА»

В.Г. Фирсов