



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО "Нобель Биокер Раша"
Ергешев Руслан Розматович


"10" декабря 2018 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ:

«Сканер стоматологический 3D оптический KaVo LS 3»

Сканер стоматологический 3D оптический KaVo LS 3

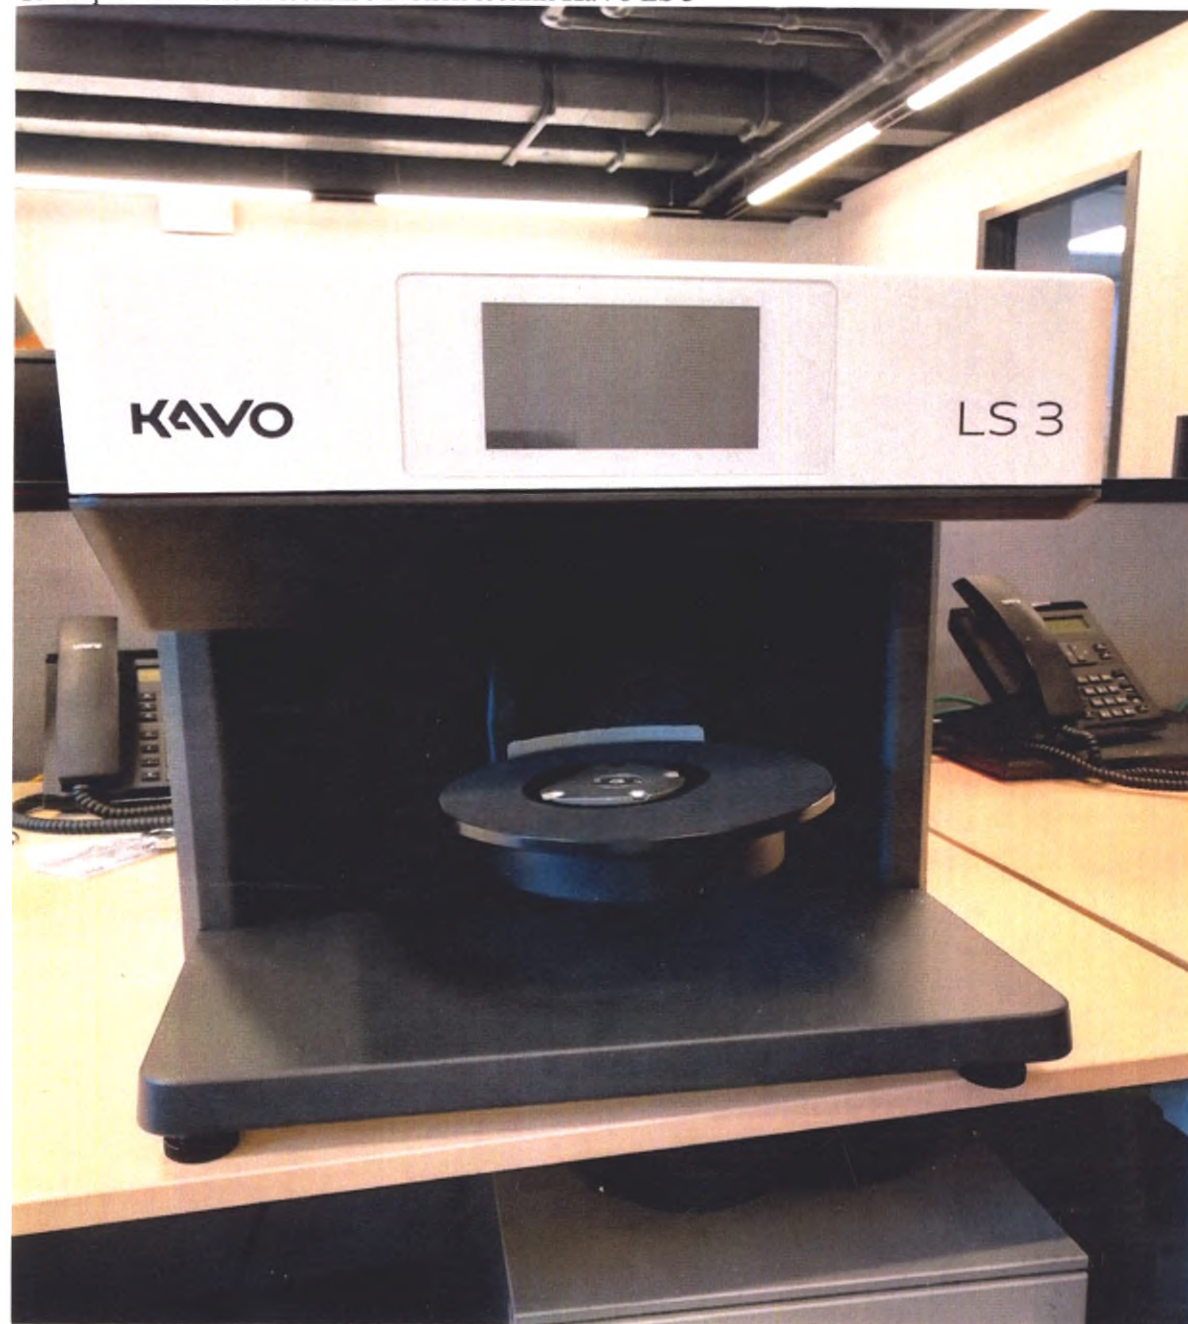


Держатель объектов стоматологических моделей KaVo LS 3 Object Holder






Гибкий держатель объектов KaVo LS 3 Flexible Object Holder



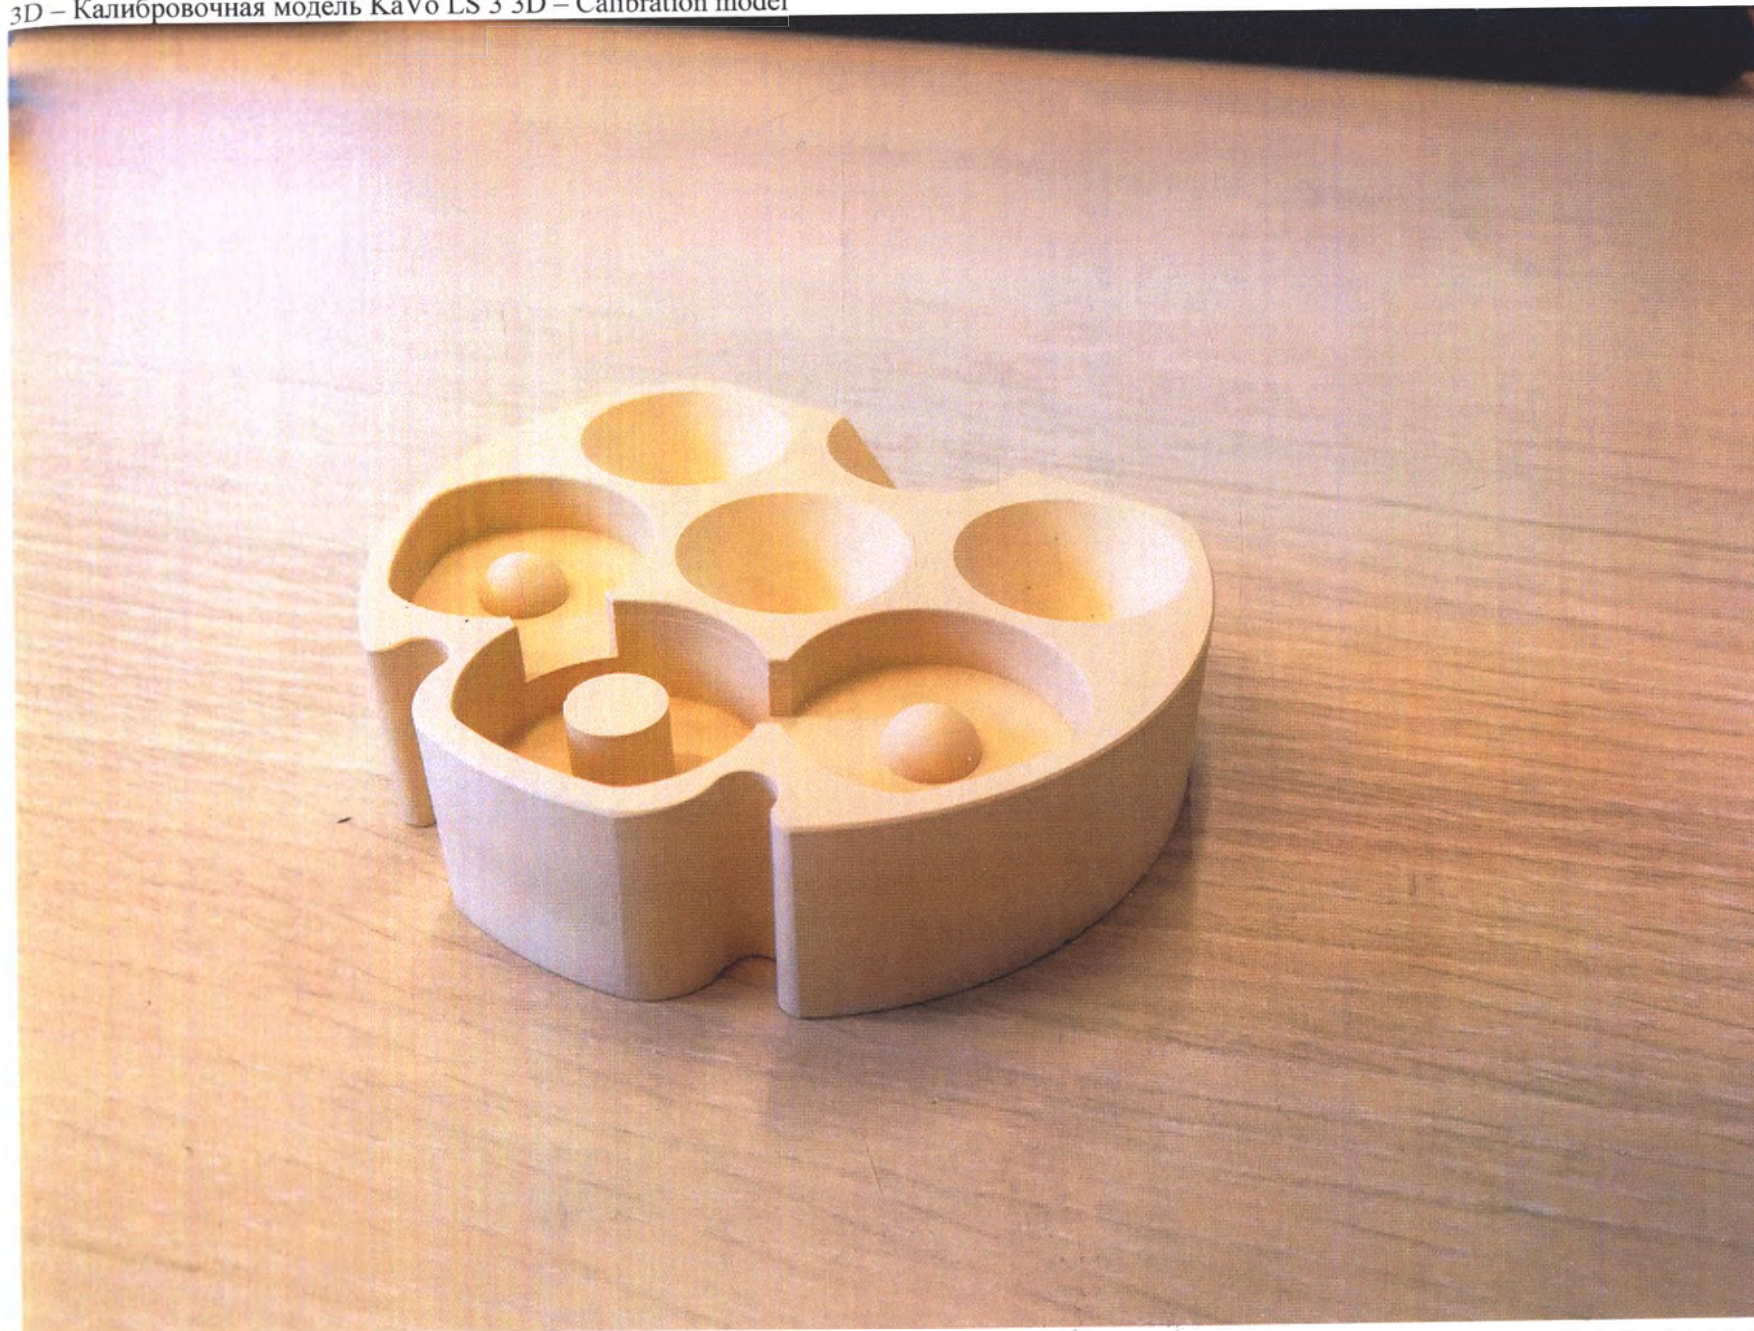

Кабель USB KaVo LS 3 USB-Cable

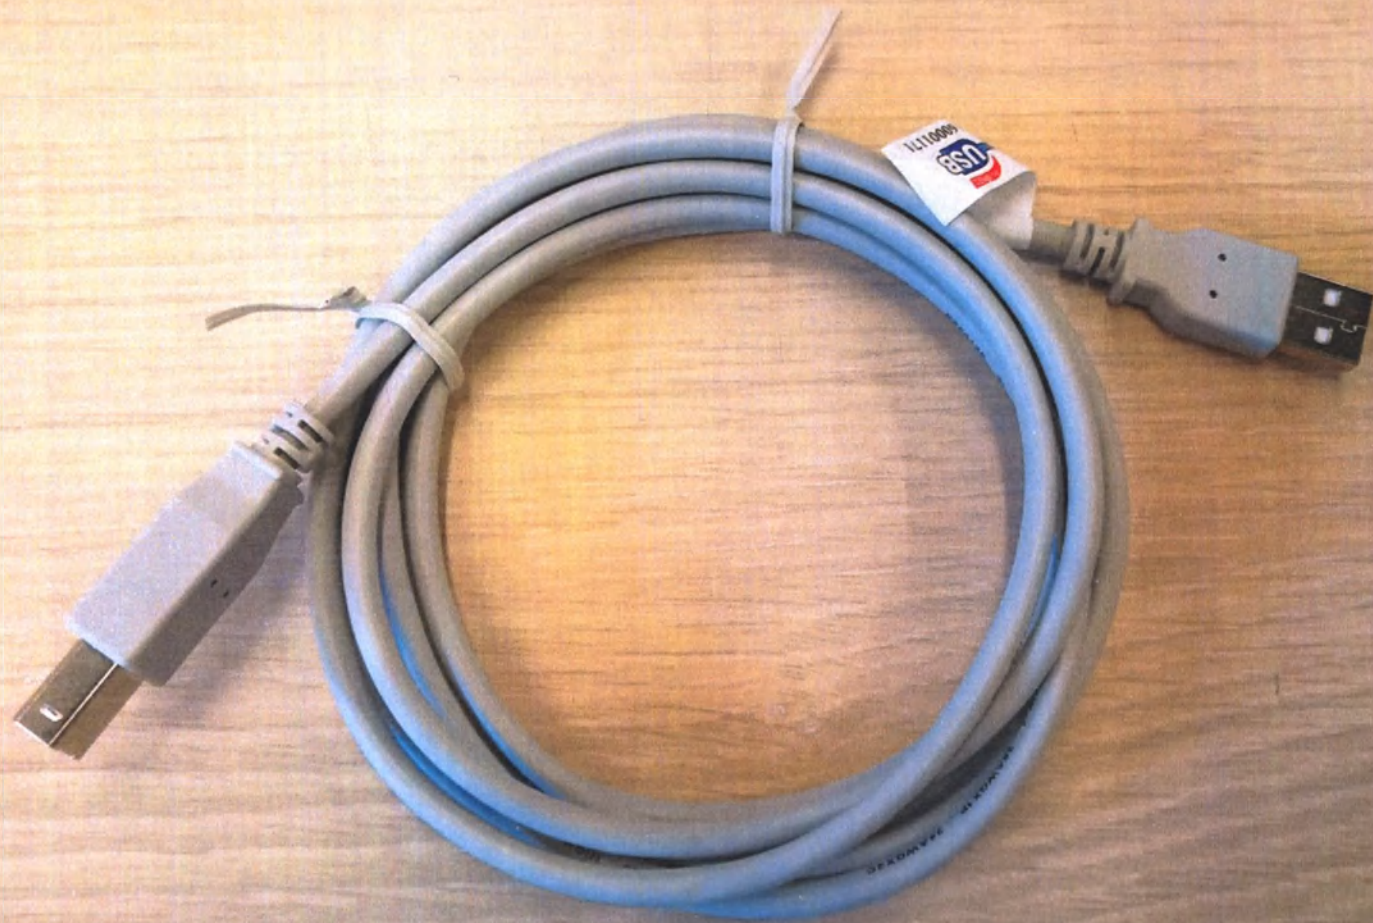

Шнур питания KaVo LS 3 Power Cable (тип вилки E+F)




Шнур питания KaVo LS 3 Power Cable (тип вилки N)




Шнур питания KaVo LS 3 Power Cable (тип вилки B)



Шнур питания KaVo LS 3 Power Cable (тип вилки G)

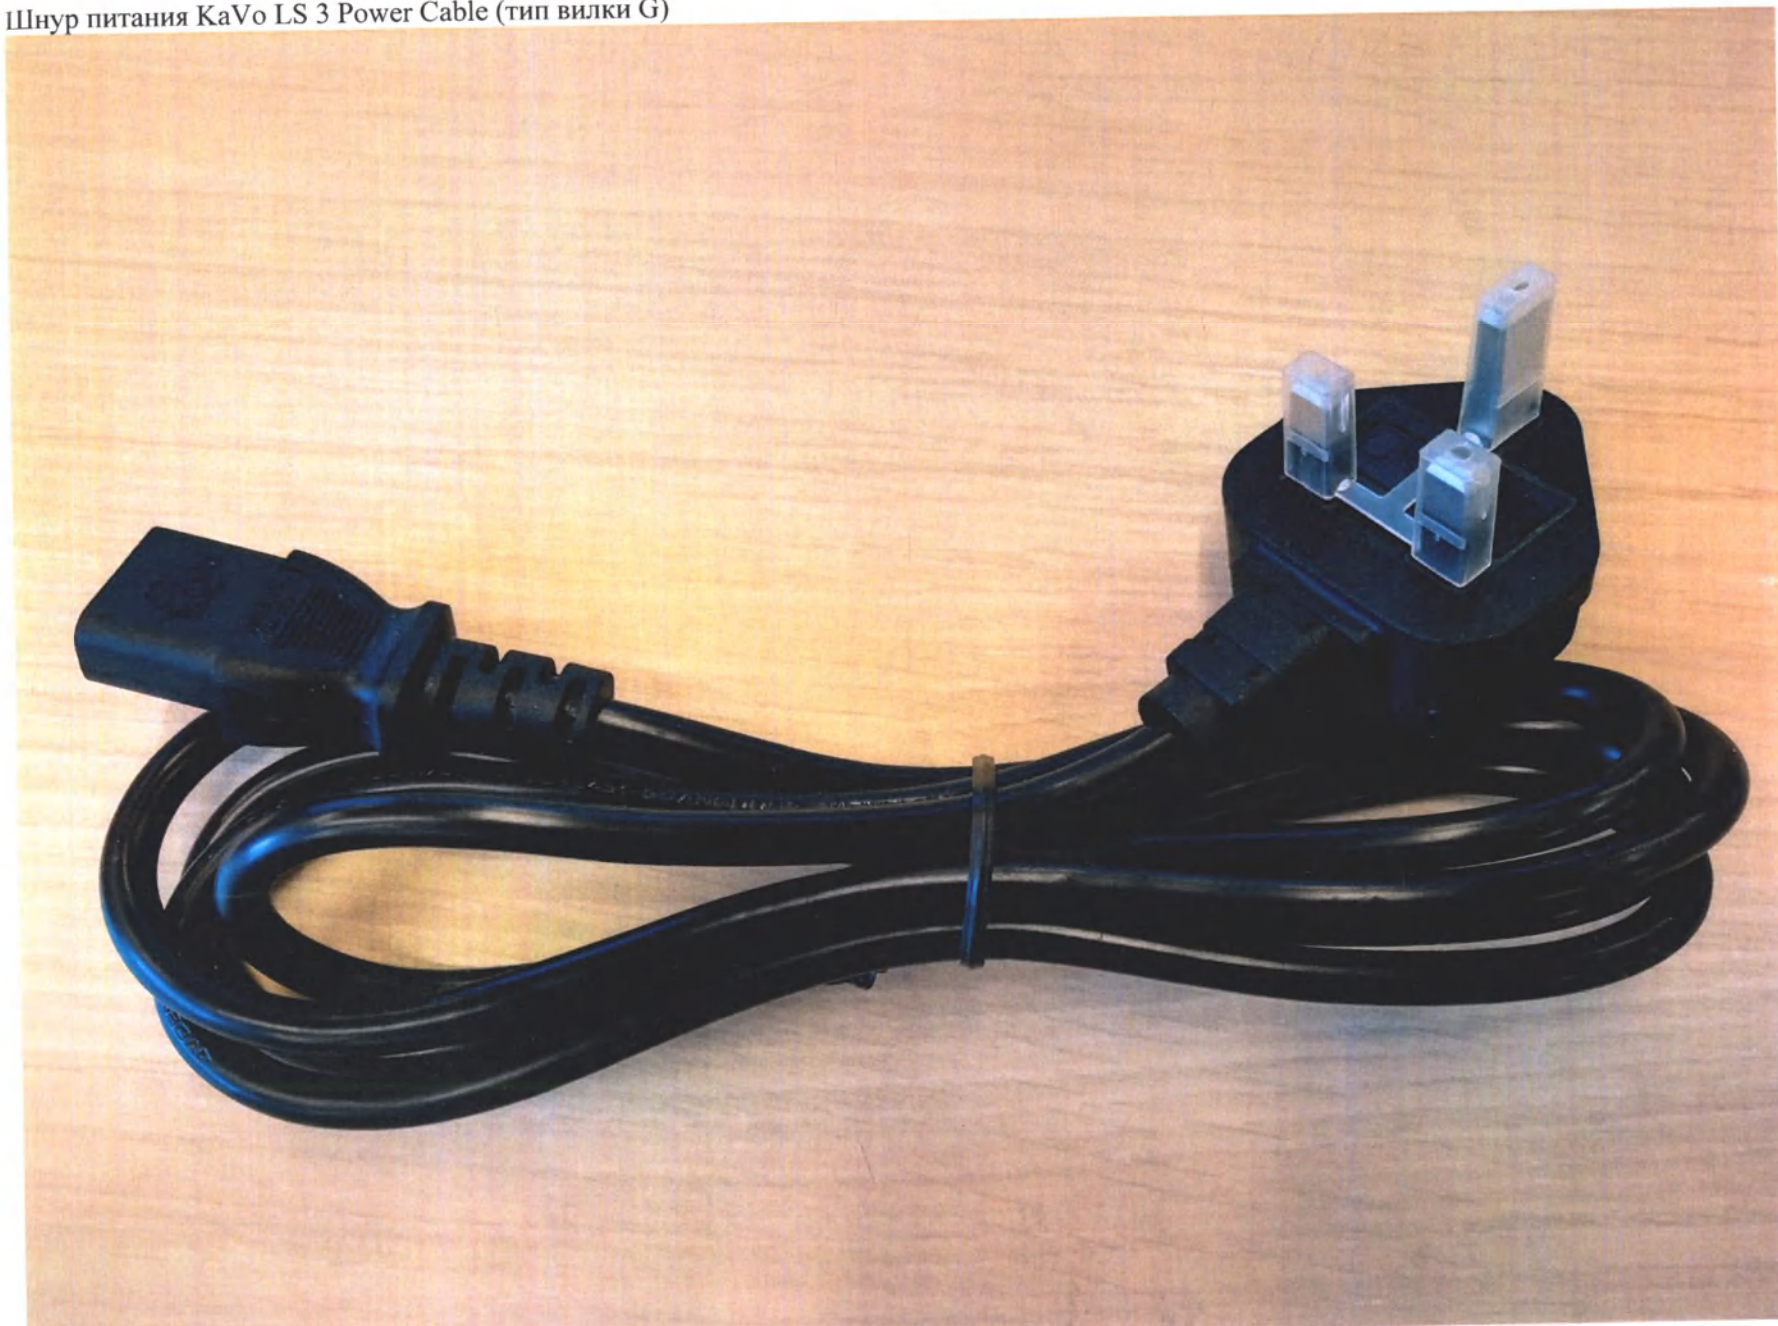

Шнур питания KaVo LS 3 Power Cable (тип вилки I)

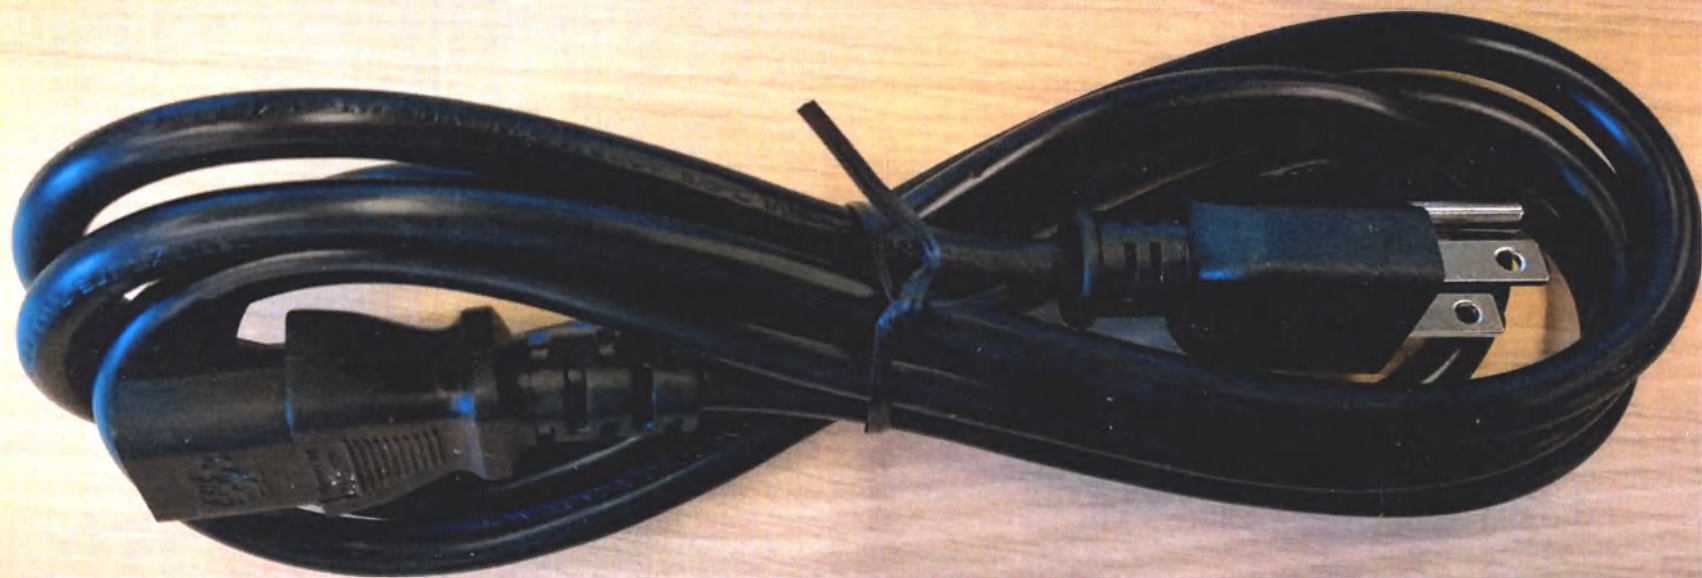

Шнур питания KaVo LS 3 Power Cable (тип вилки L)



Ethernet-кабель KaVo LS 3 Ethernet – Cable



Ethernet-USB адаптер KaVo LS 3 Ethernet to USB Adapter



Пластин для крепления сверхпрочный Adhesive putty pad, ultra strong (2 шт.)



