

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Агрегатор Медикал»

Домнышев Д.В.

«29» августа 2019 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Игла для биопсии одноразовая стерильная

*производства «GEOTEK MEDİKAL VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ (ГЕОТЕК МЕДИКАЛ ВЕ САЛЫК ХИЗМЕТЛЕРИ ТИДЖАРЕТ
САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ)», Турция*

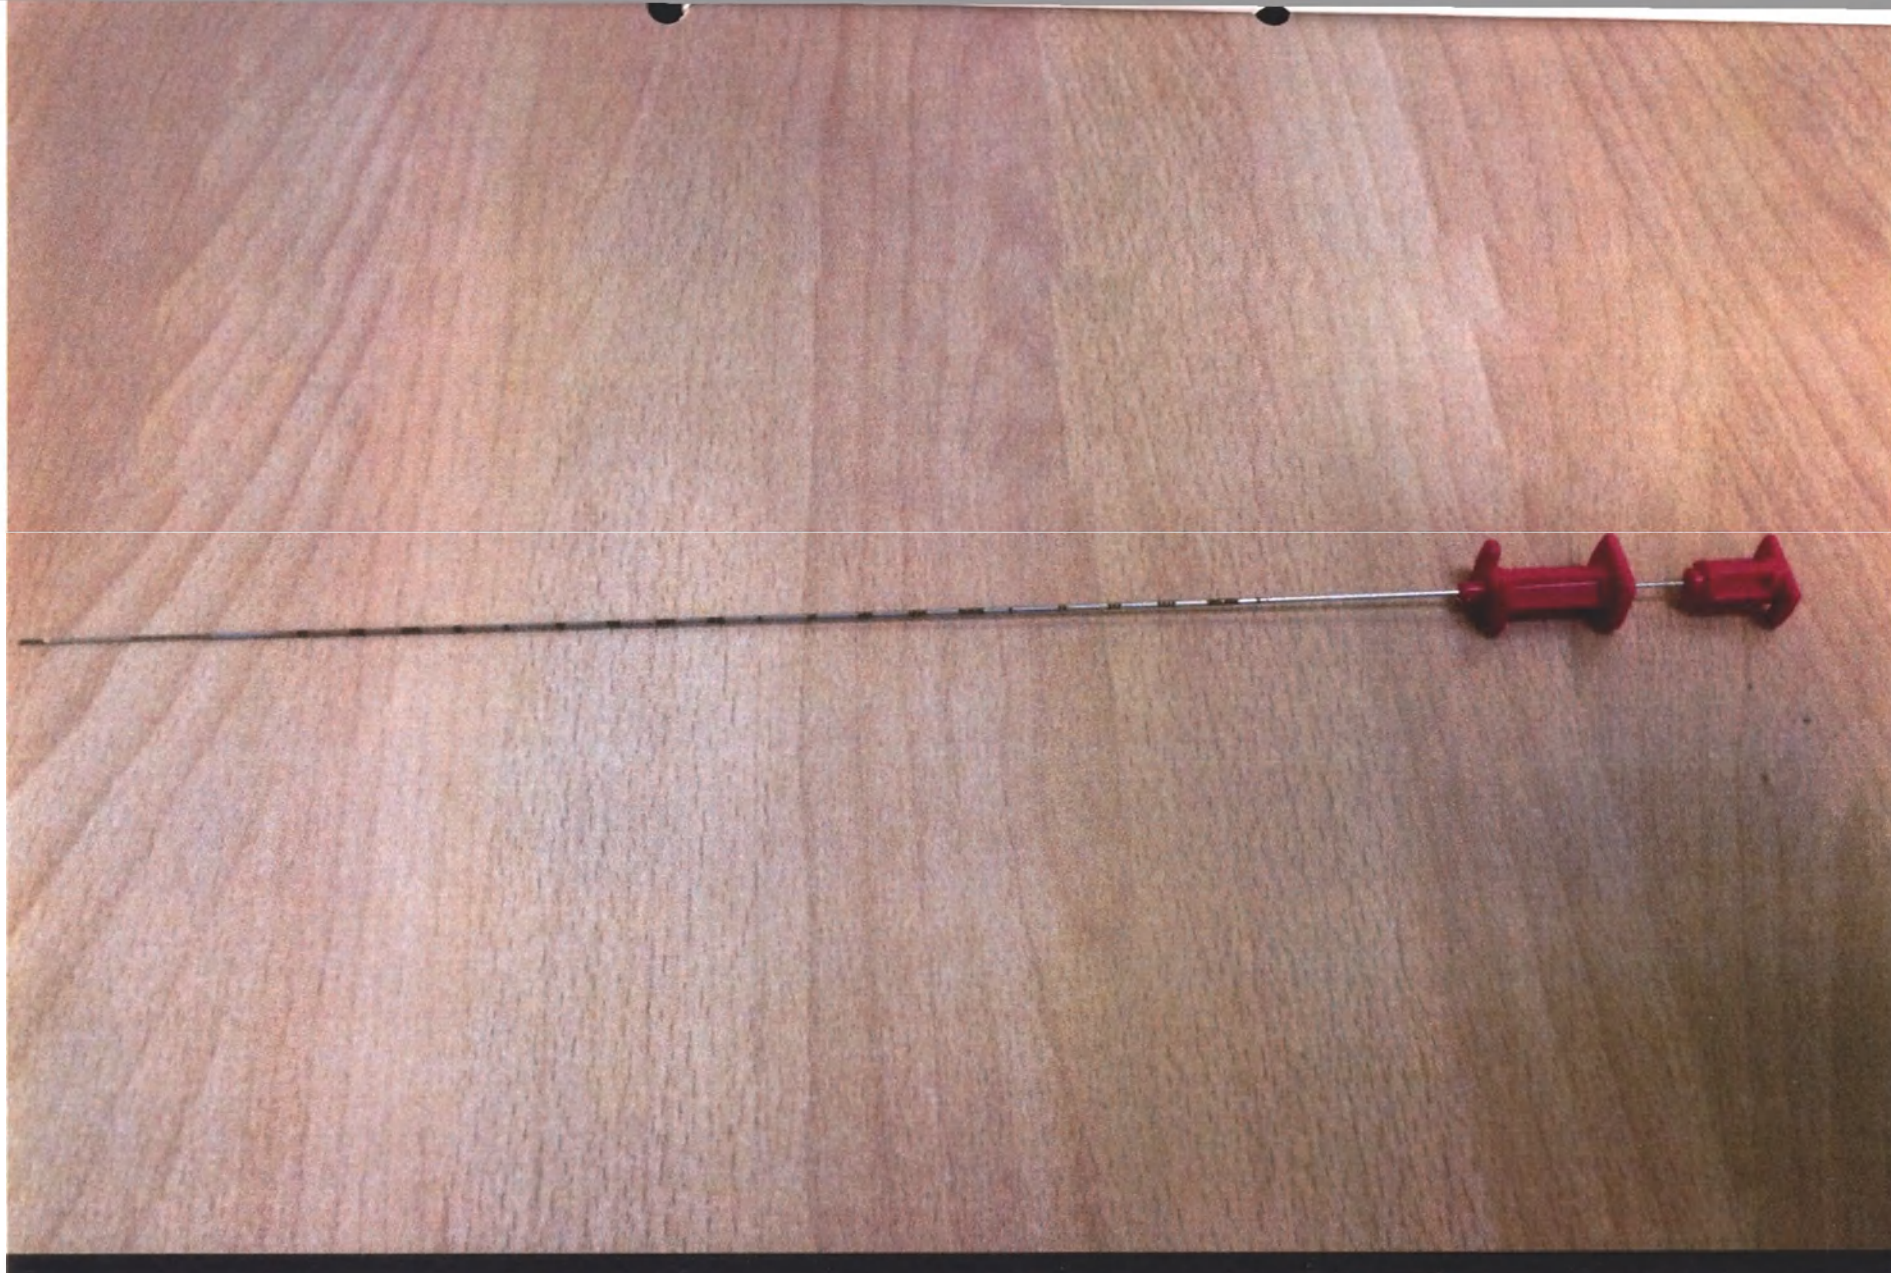


Фото 1. Внешний вид для варианта Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore GPN1420, внешний диаметр канюли 14G (2,10 мм), длина канюли 200 мм. Данный внешний вид на фотографии актуален также для следующих вариантов исполнений:

- Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore GPN1410, внешний диаметр канюли 14G (2,10 мм), длина канюли 100 мм;
- Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore GPN1415, внешний диаметр канюли 14G (2,10 мм), длина канюли 150 мм.

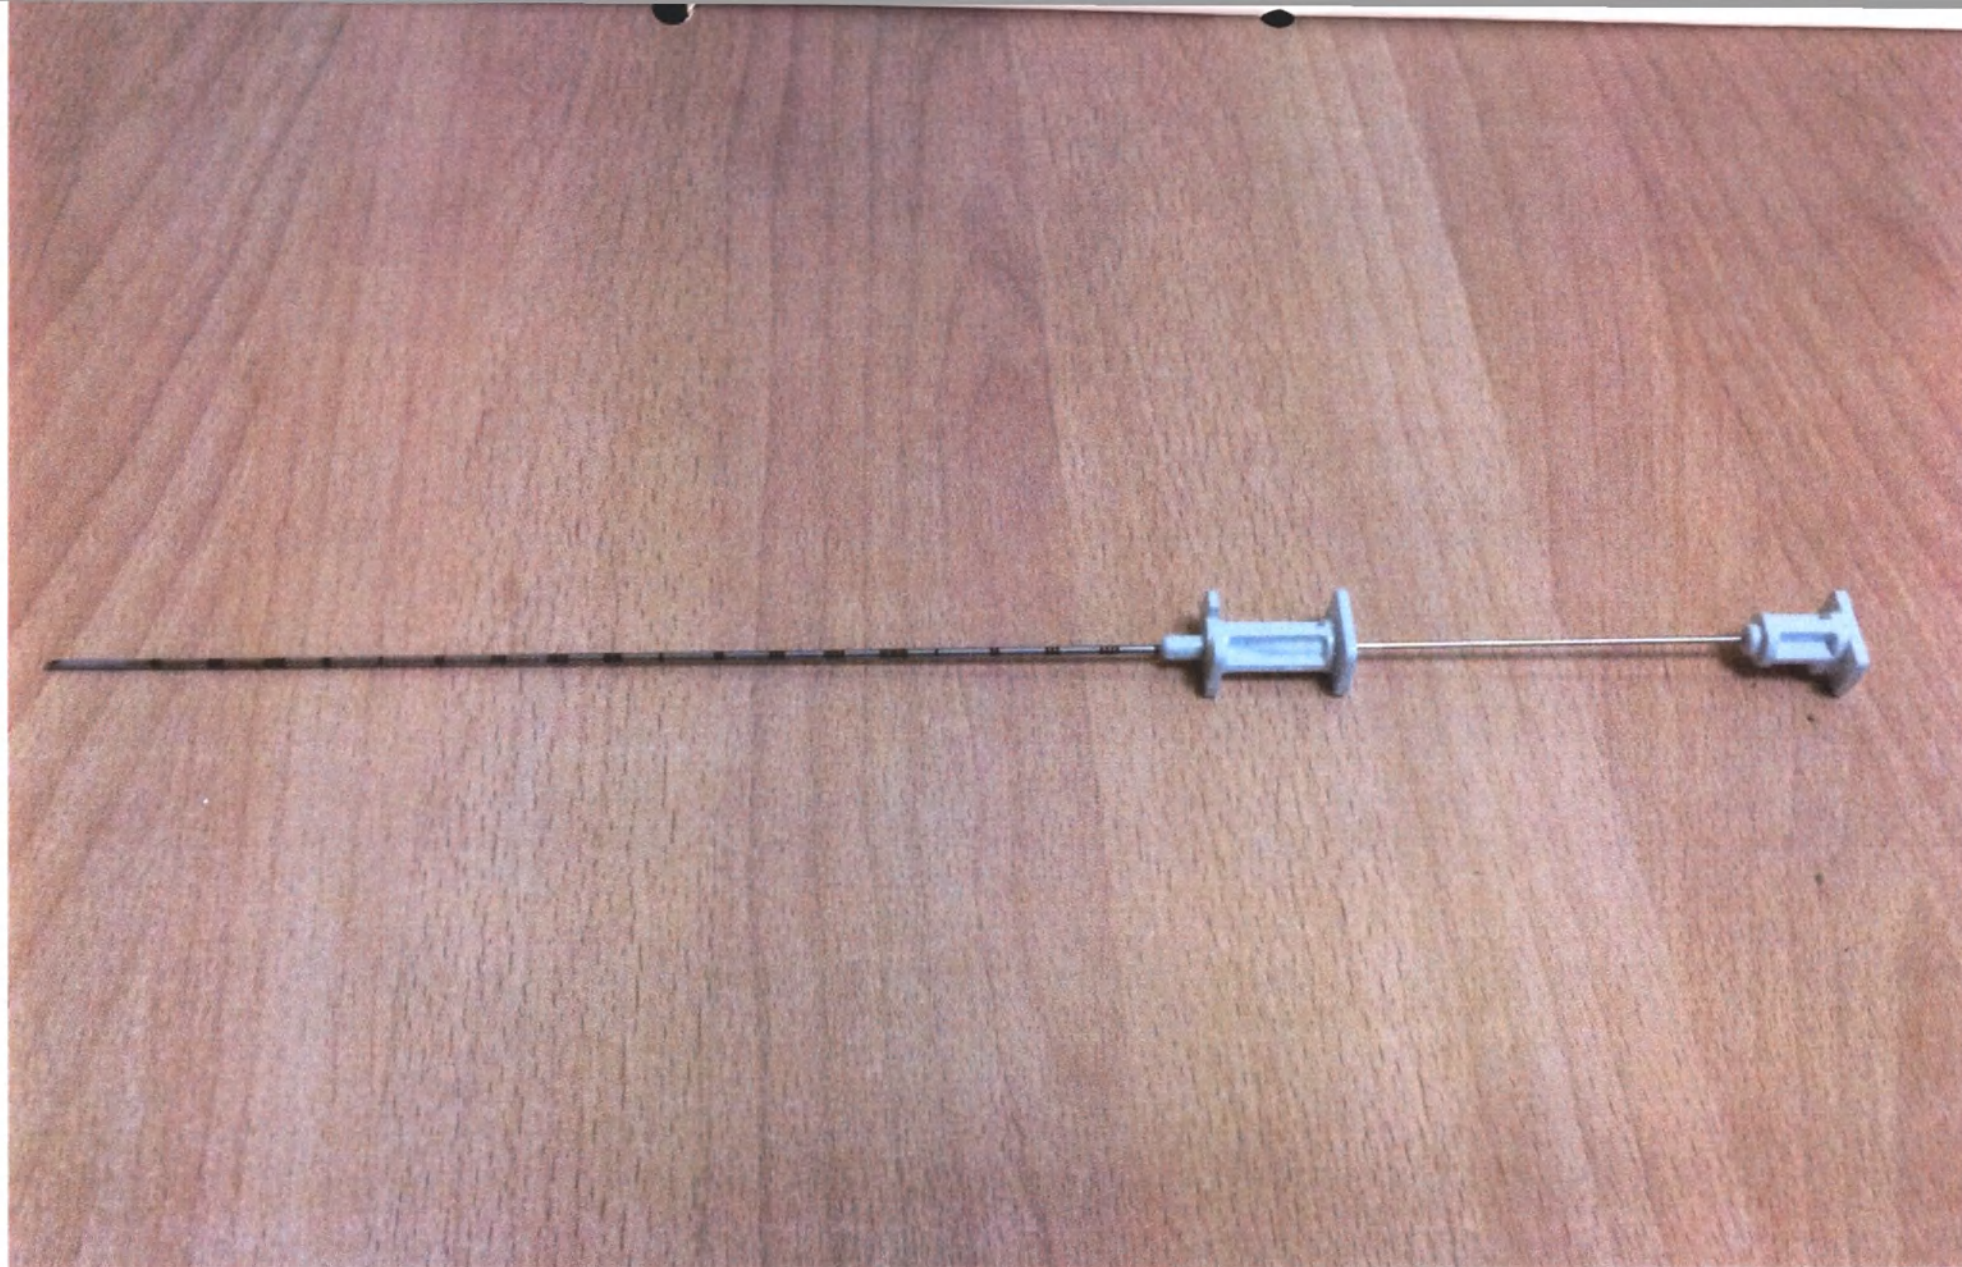


Фото 2. Внешний вид для варианта Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore GPN1620, внешний диаметр канюли 16G (1,65 мм), длина канюли 200 мм. Данный внешний вид на фотографии актуален также для следующих вариантов исполнений:

- Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore GPN1610, внешний диаметр канюли 16G (1,65 мм), длина канюли 100 мм;
- Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore GPN1615, внешний диаметр канюли 16G (1,65 мм), длина канюли 150 мм.

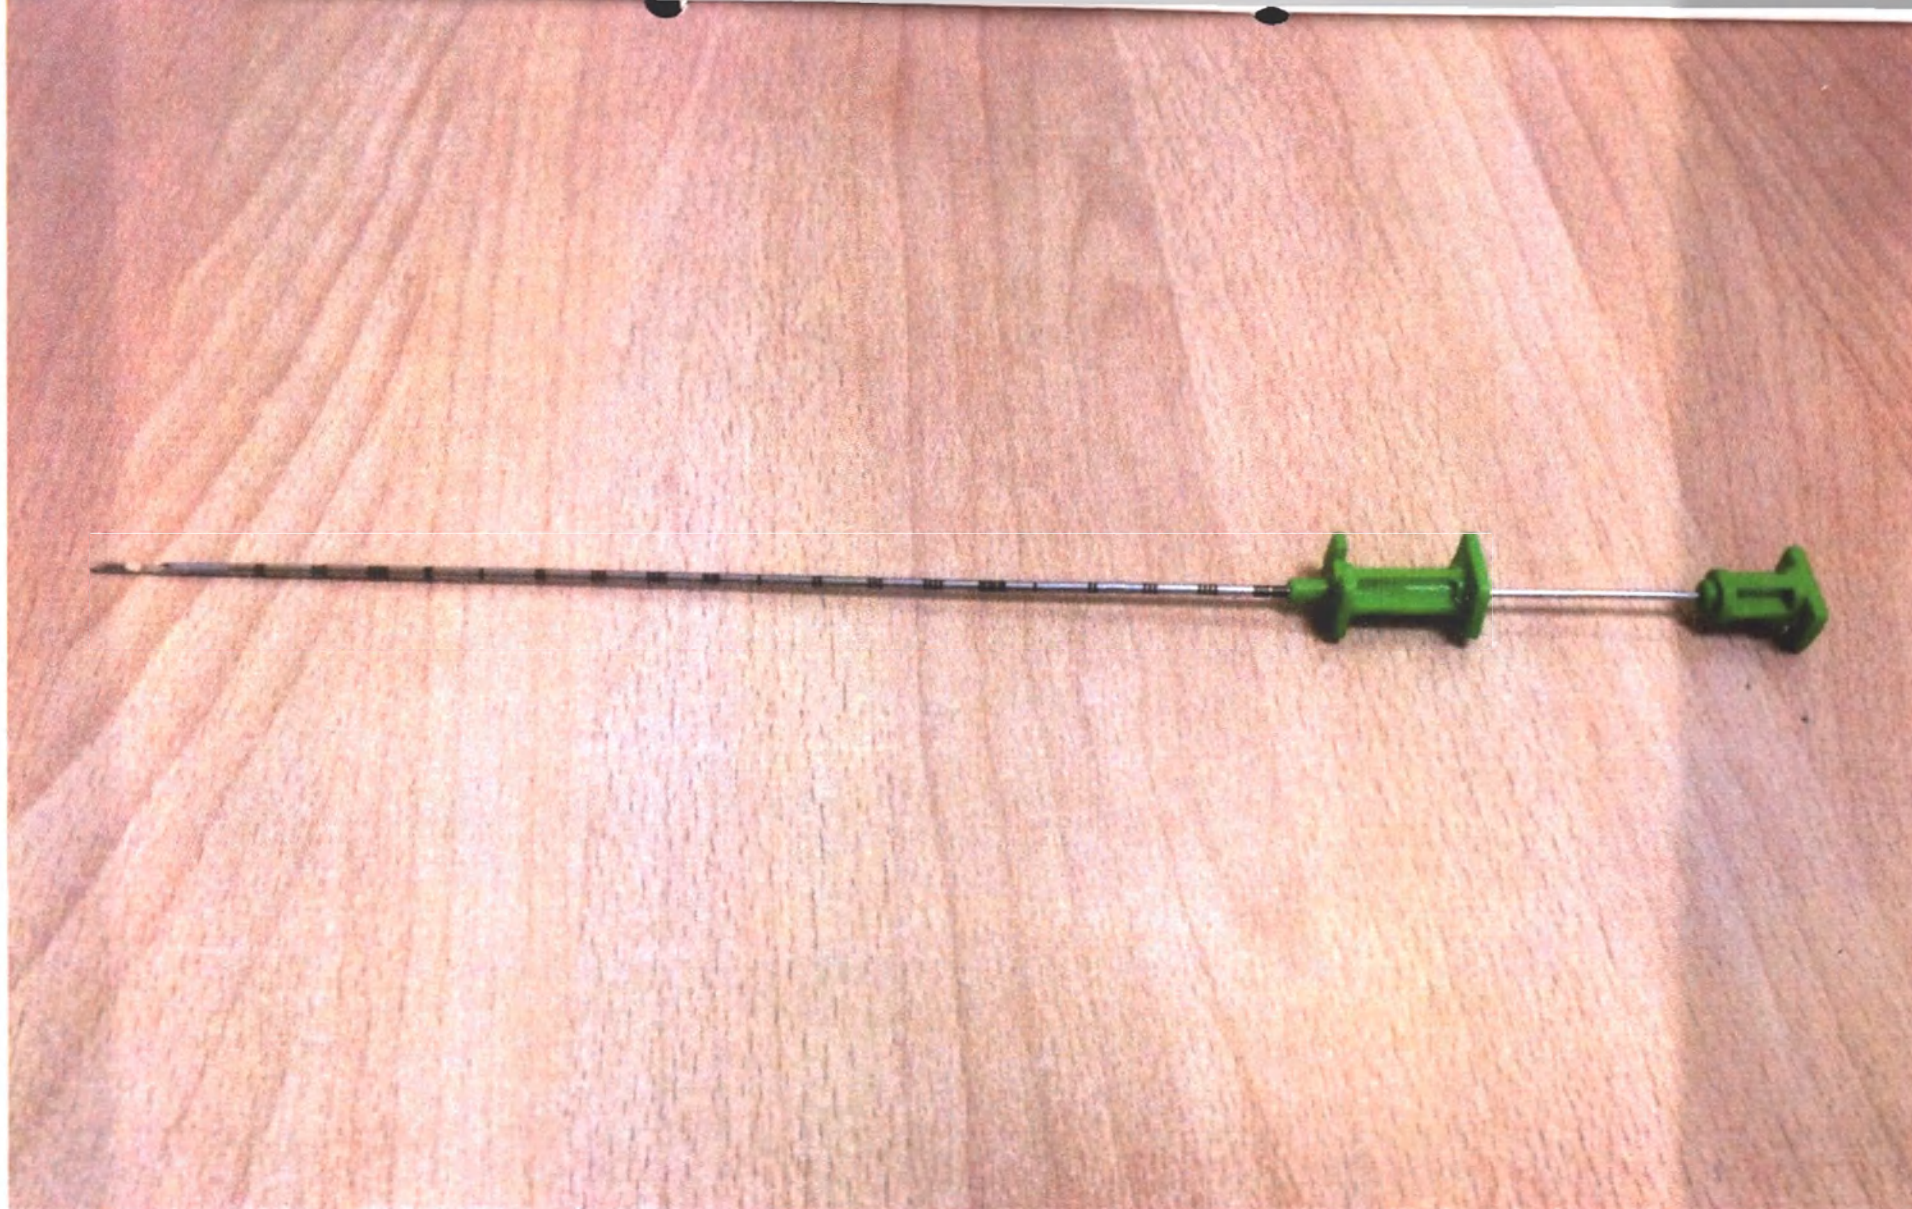


Фото 3. Внешний вид для варианта Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore GPN1825, внешний диаметр канюли 18G (1,26 мм), длина канюли 250 мм. Данный внешний вид на фотографии актуален также для следующих вариантов исполнений:

- Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore GPN 1810, внешний диаметр канюли 18G (1,26 мм), длина канюли 100 мм;
- Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore GPN 1815, внешний диаметр канюли 18G (1,26 мм), длина канюли 150 мм;
- Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore GPN 1820, внешний диаметр канюли 18G (1,26 мм), длина канюли 200 мм;
- Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore GPN 1830, внешний диаметр канюли 18G (1,26 мм), длина канюли 300 мм.

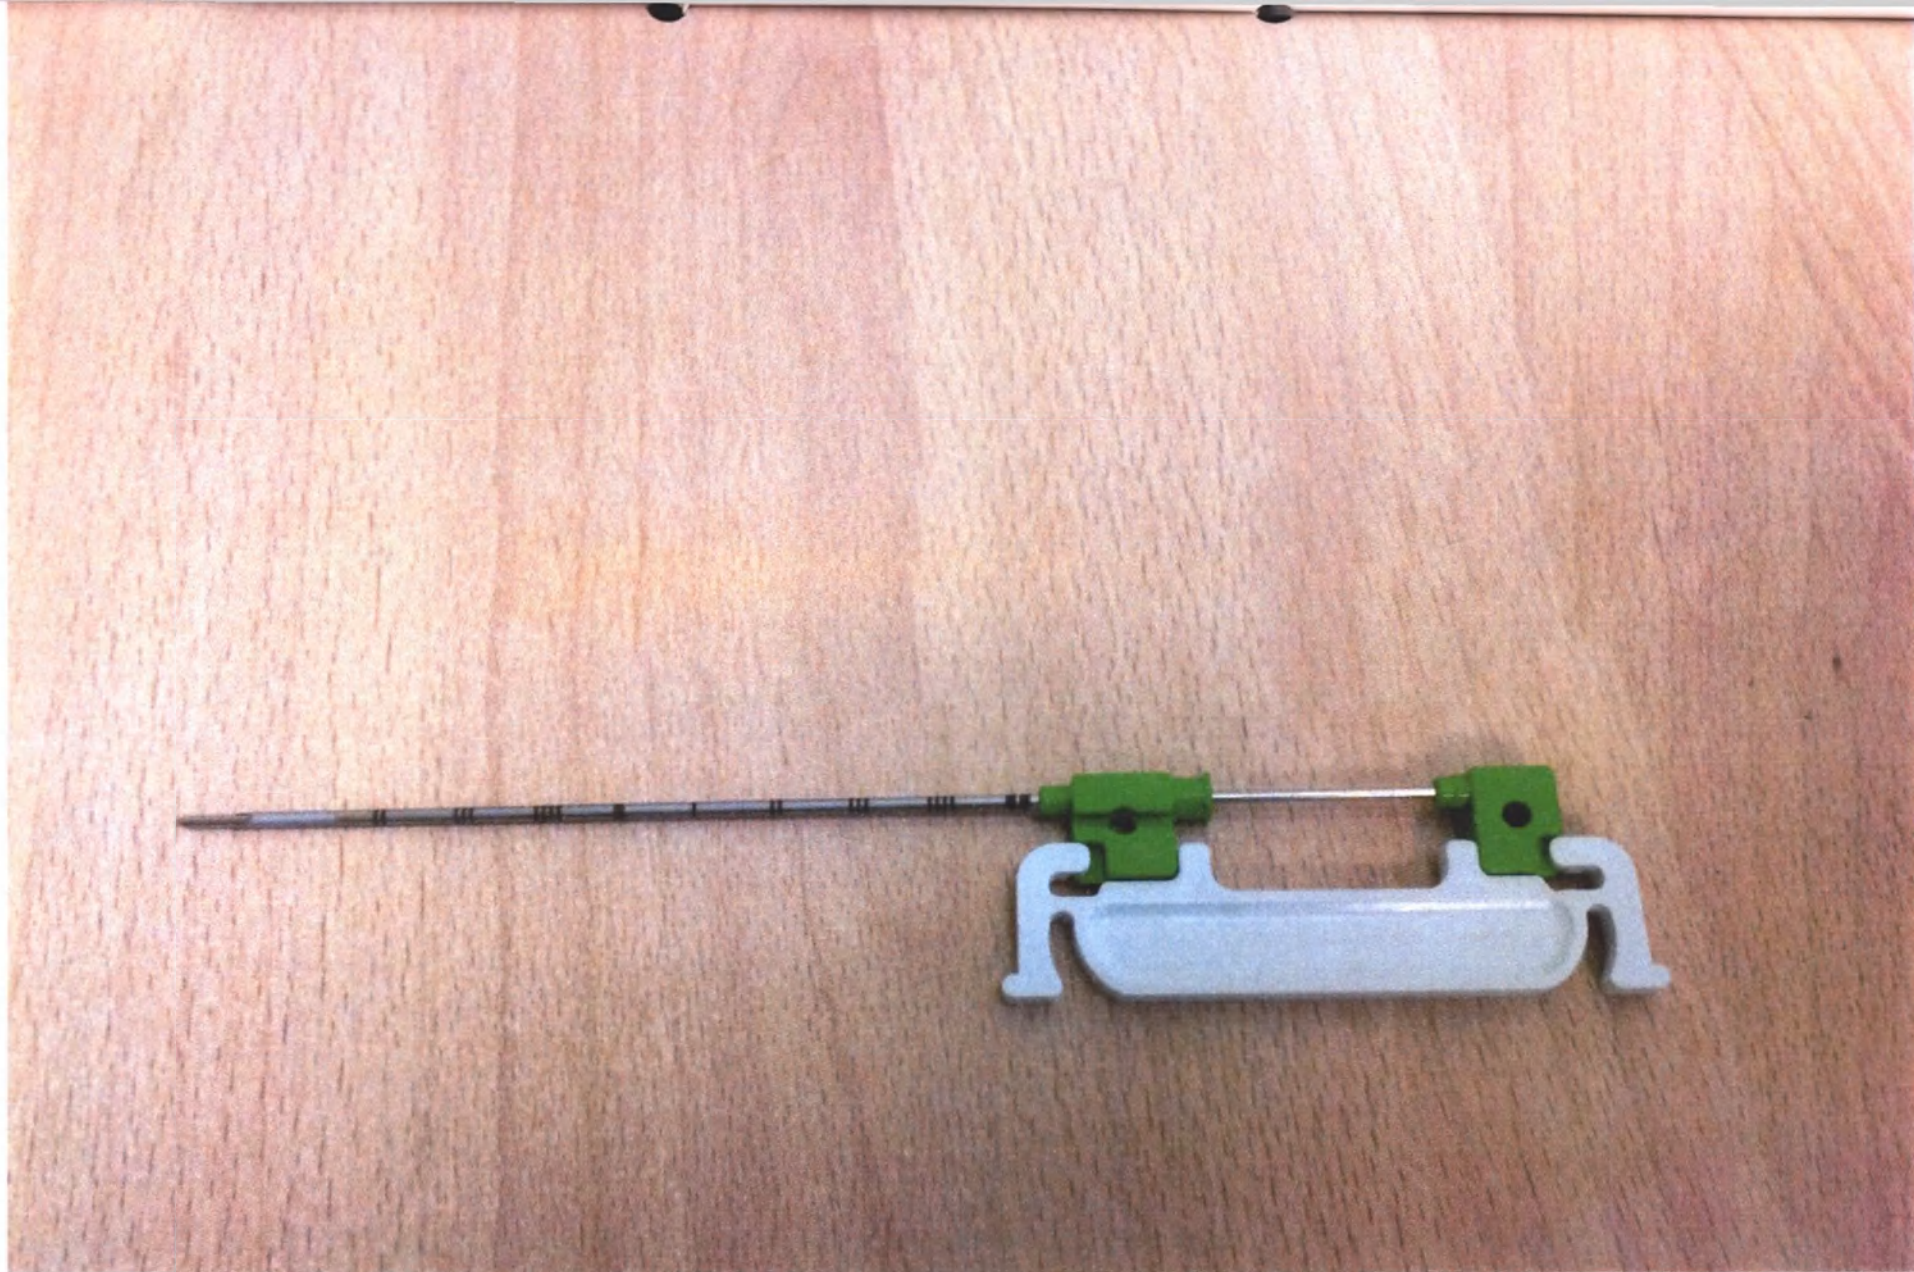


Фото 4. Внешний вид для варианта Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore M GPN1410-M, внешний диаметр канюли 14G (2,10 мм), длина канюли 100 мм.
Данный внешний вид на фотографии актуален также для следующих вариантов исполнений:

- Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore M GPN1415-M, внешний диаметр канюли 14G (2,10 мм), длина канюли 150 мм;
- Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore M GPN1420-M, внешний диаметр канюли 14G (2,10 мм), длина канюли 200 мм

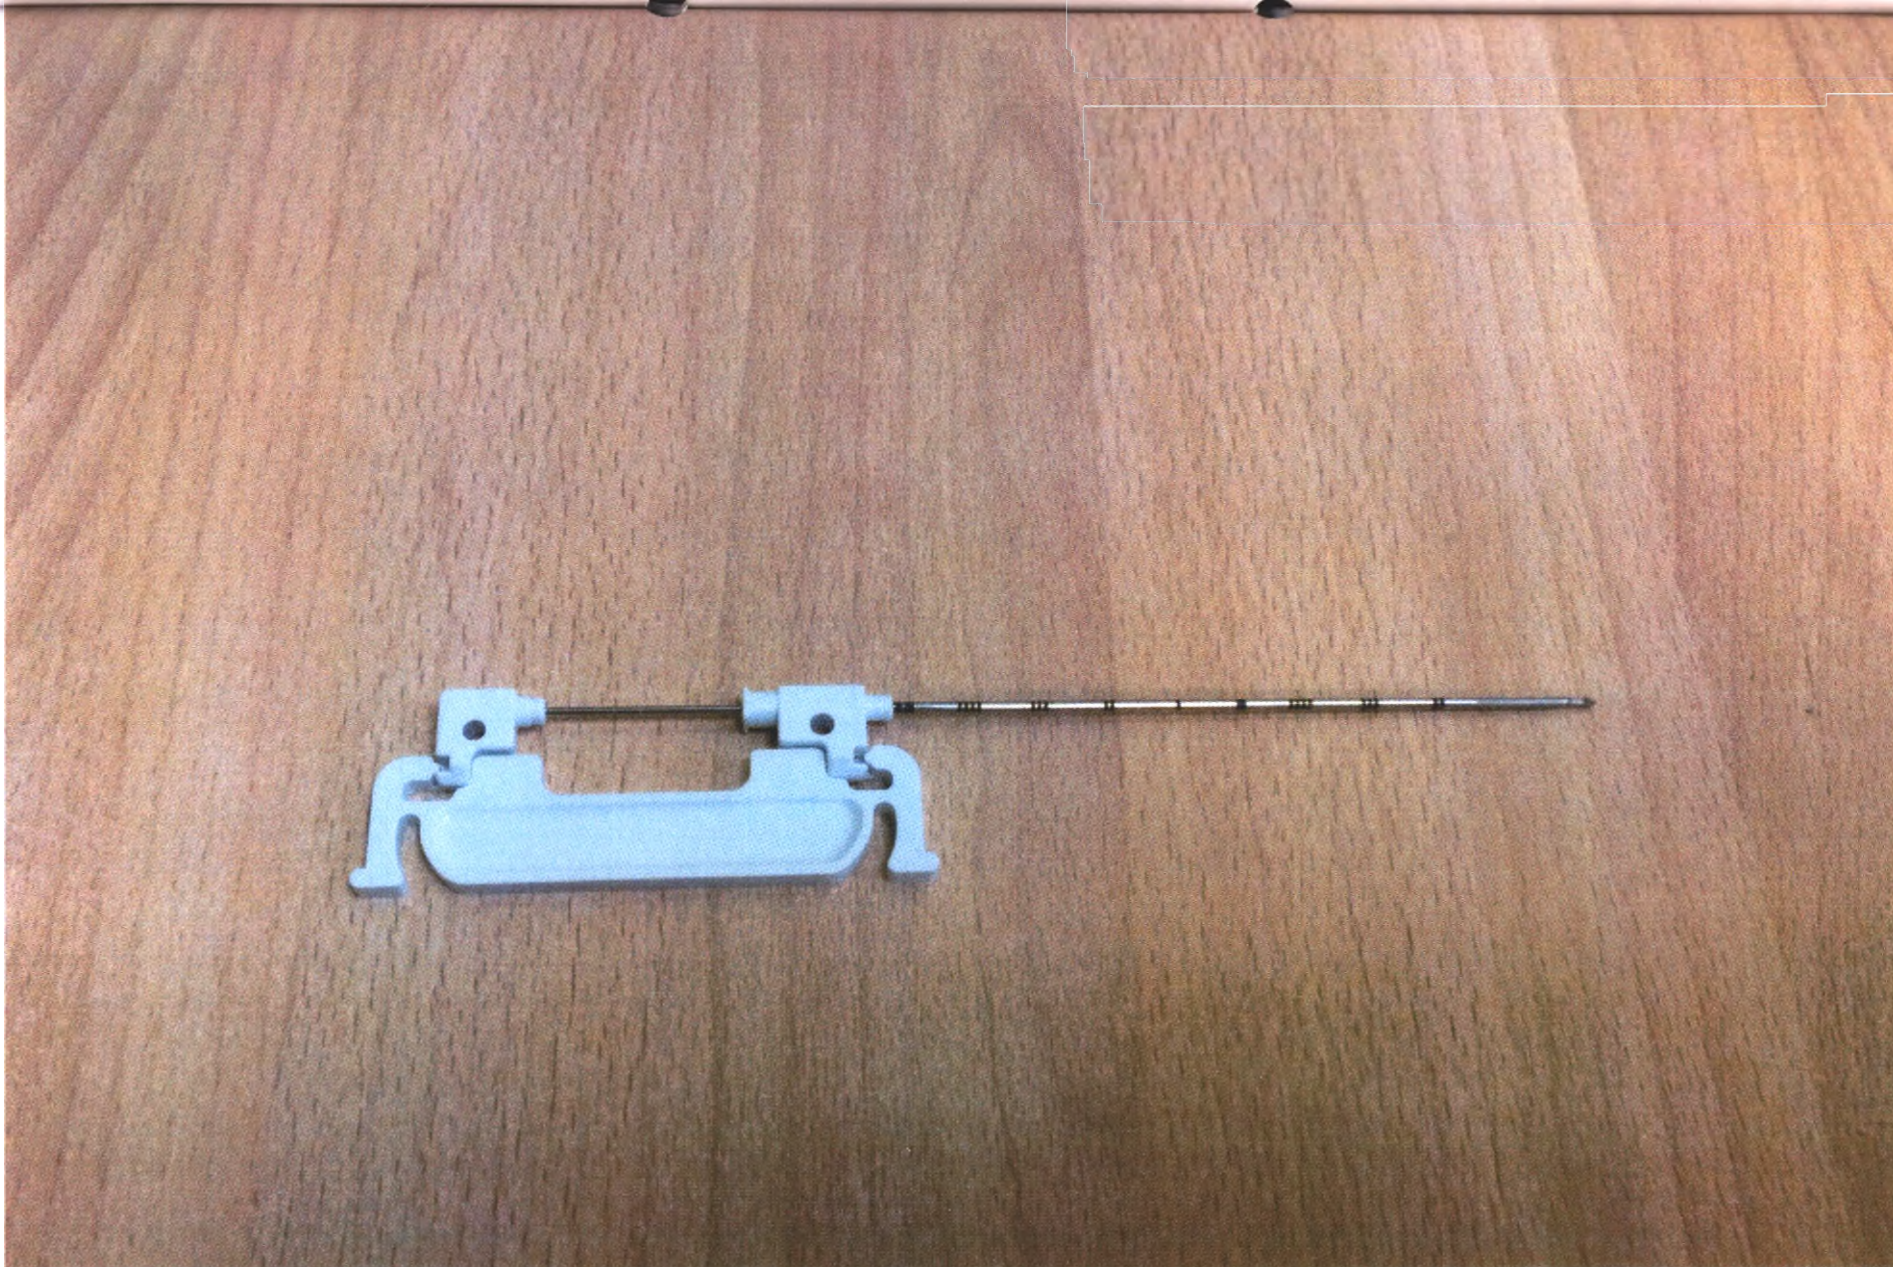


Фото 5. Внешний вид для варианта Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore M GPN1610-M, внешний диаметр канюли 16G (1,65 мм), длина канюли 100 мм.

Данный внешний вид на фотографии актуален также для следующих вариантов исполнений:

- Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore M GPN1615-M, внешний диаметр канюли 16G (1,65 мм), длина канюли 150 мм;

- Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore M GPN1620-M, внешний диаметр канюли 16G (1,65 мм), длина канюли 200 мм

Отличие только в длине канюли.

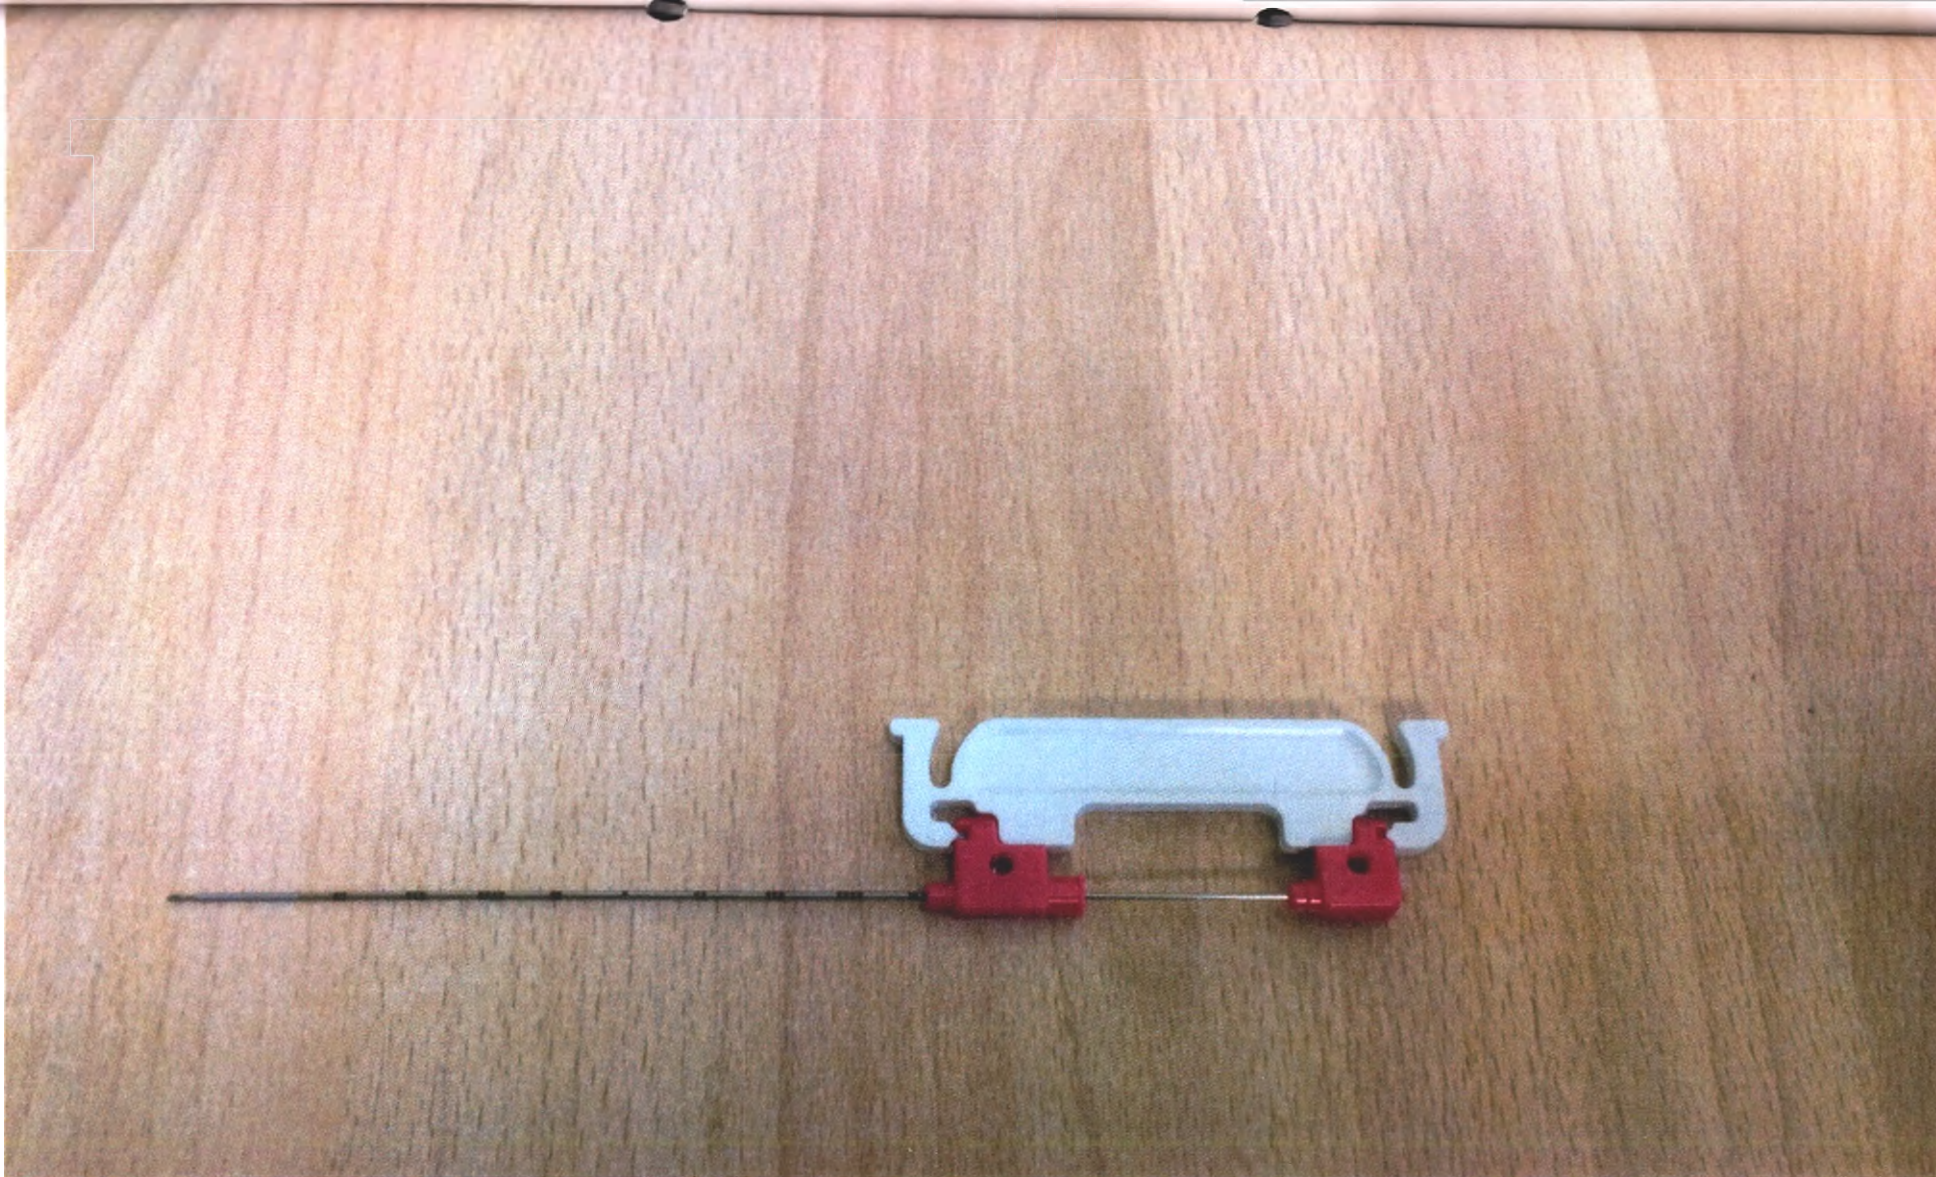


Фото 6. Внешний вид для варианта Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore M GPN1810-M, внешний диаметр канюли 18G (1,26 мм), длина канюли 100 мм.

Данный внешний вид на фотографии актуален также для следующих вариантов исполнений:

- Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore M GPN1815-M, внешний диаметр канюли 18G (1,26 мм), длина канюли 150 мм;
- Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore M GPN1820-M, внешний диаметр канюли 18G (1,26 мм), длина канюли 200 мм;
- Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore M GPN1825-M, внешний диаметр канюли 18G (1,26 мм), длина канюли 250 мм;
- Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore M GPN1830-M, внешний диаметр канюли 18G (1,26 мм), длина канюли 300 мм.

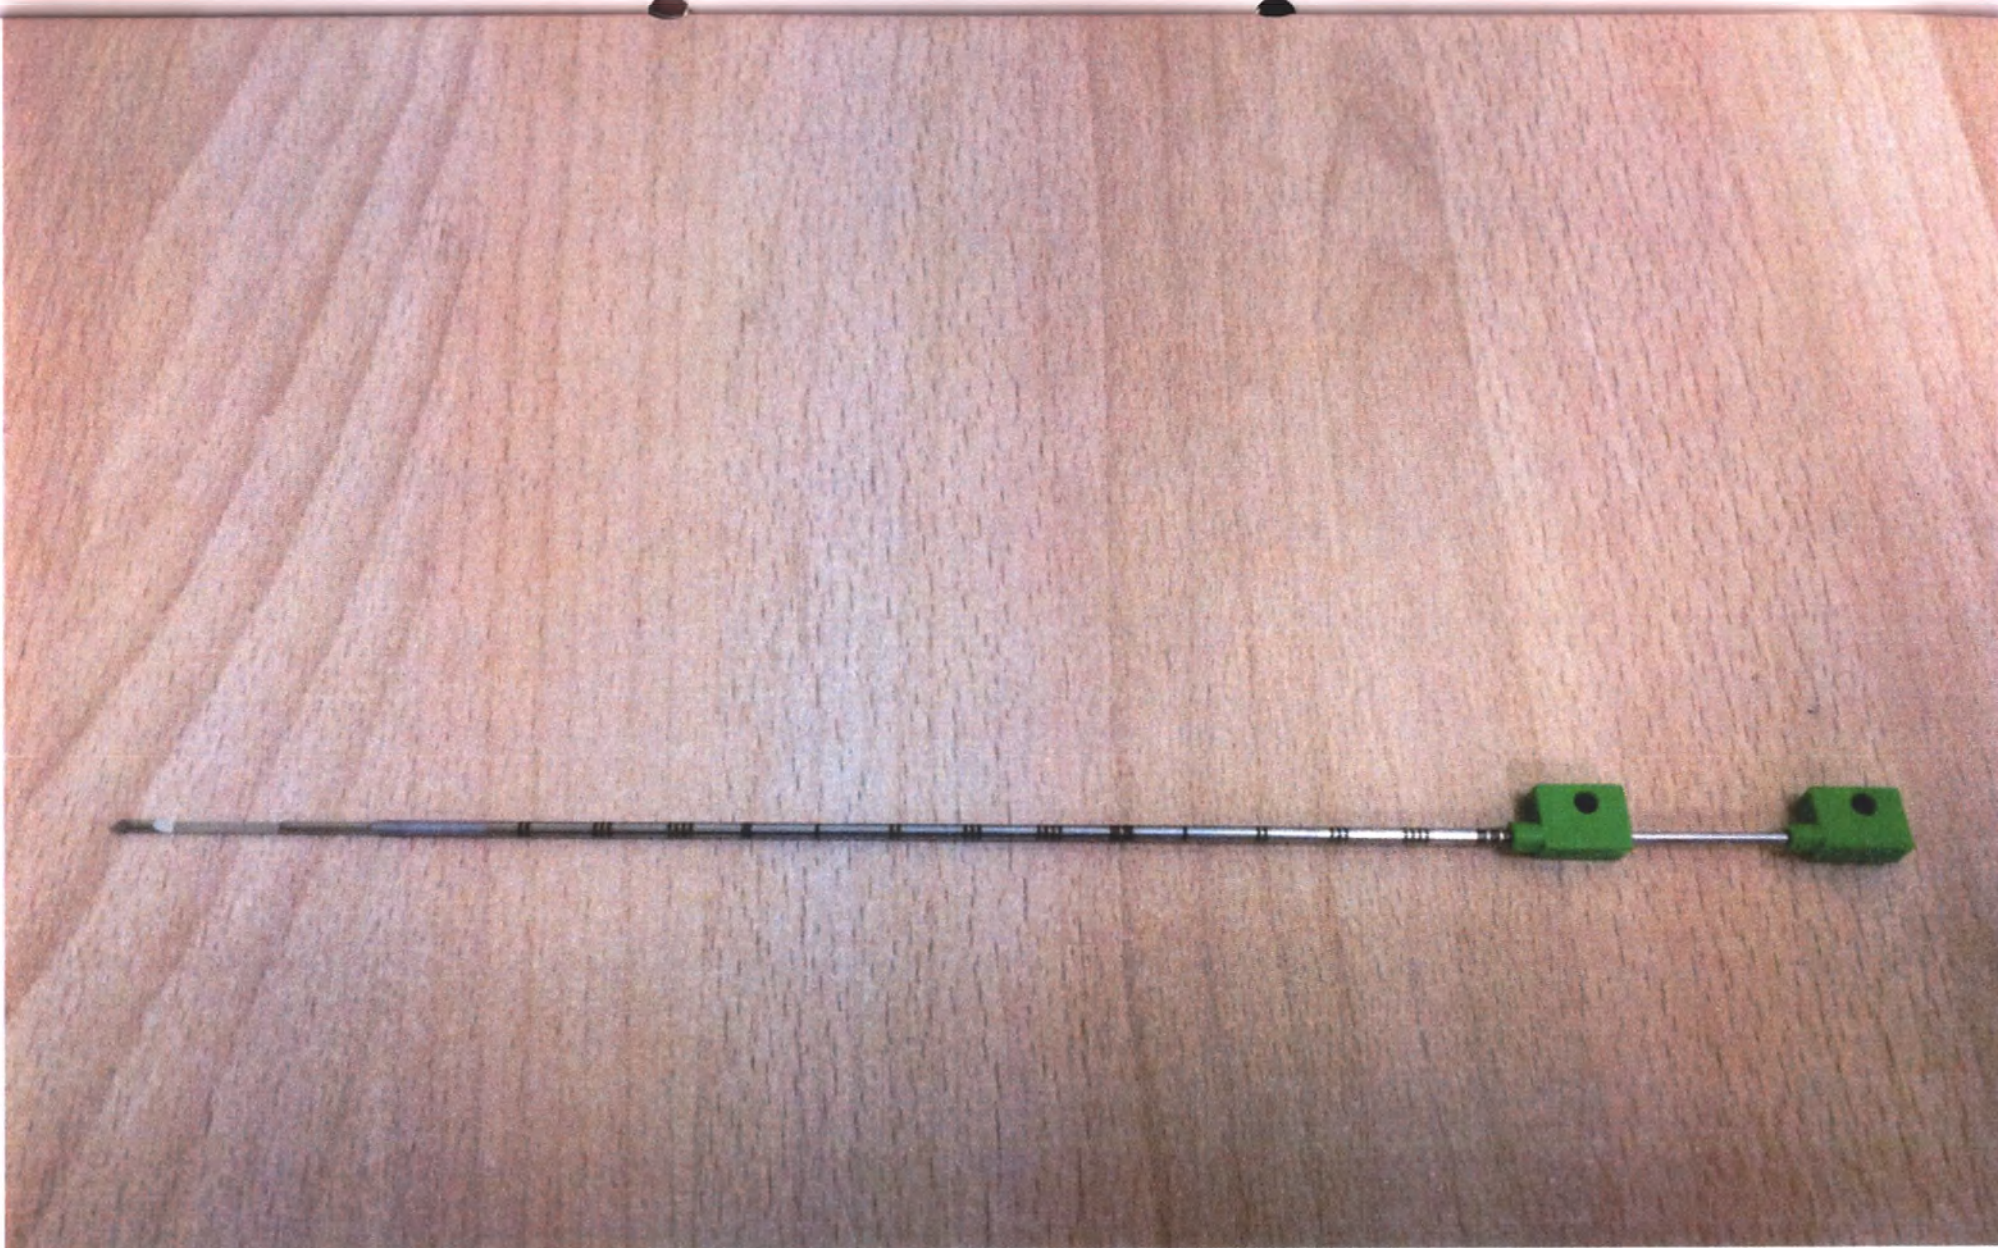


Фото 7. Внешний вид для варианта Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore U GPN1415- U, внешний диаметр канюли 14G (2,10 мм), длина канюли 150 мм. Данный внешний вид на фотографии актуален также для следующих вариантов исполнений:

- Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore U GPN1410- U, внешний диаметр канюли 14G (2,10 мм), длина канюли 100 мм;

- Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore U GPN1420- U, внешний диаметр канюли 14G (2,10 мм), длина канюли 200 мм;

Отличие только в длине канюли.

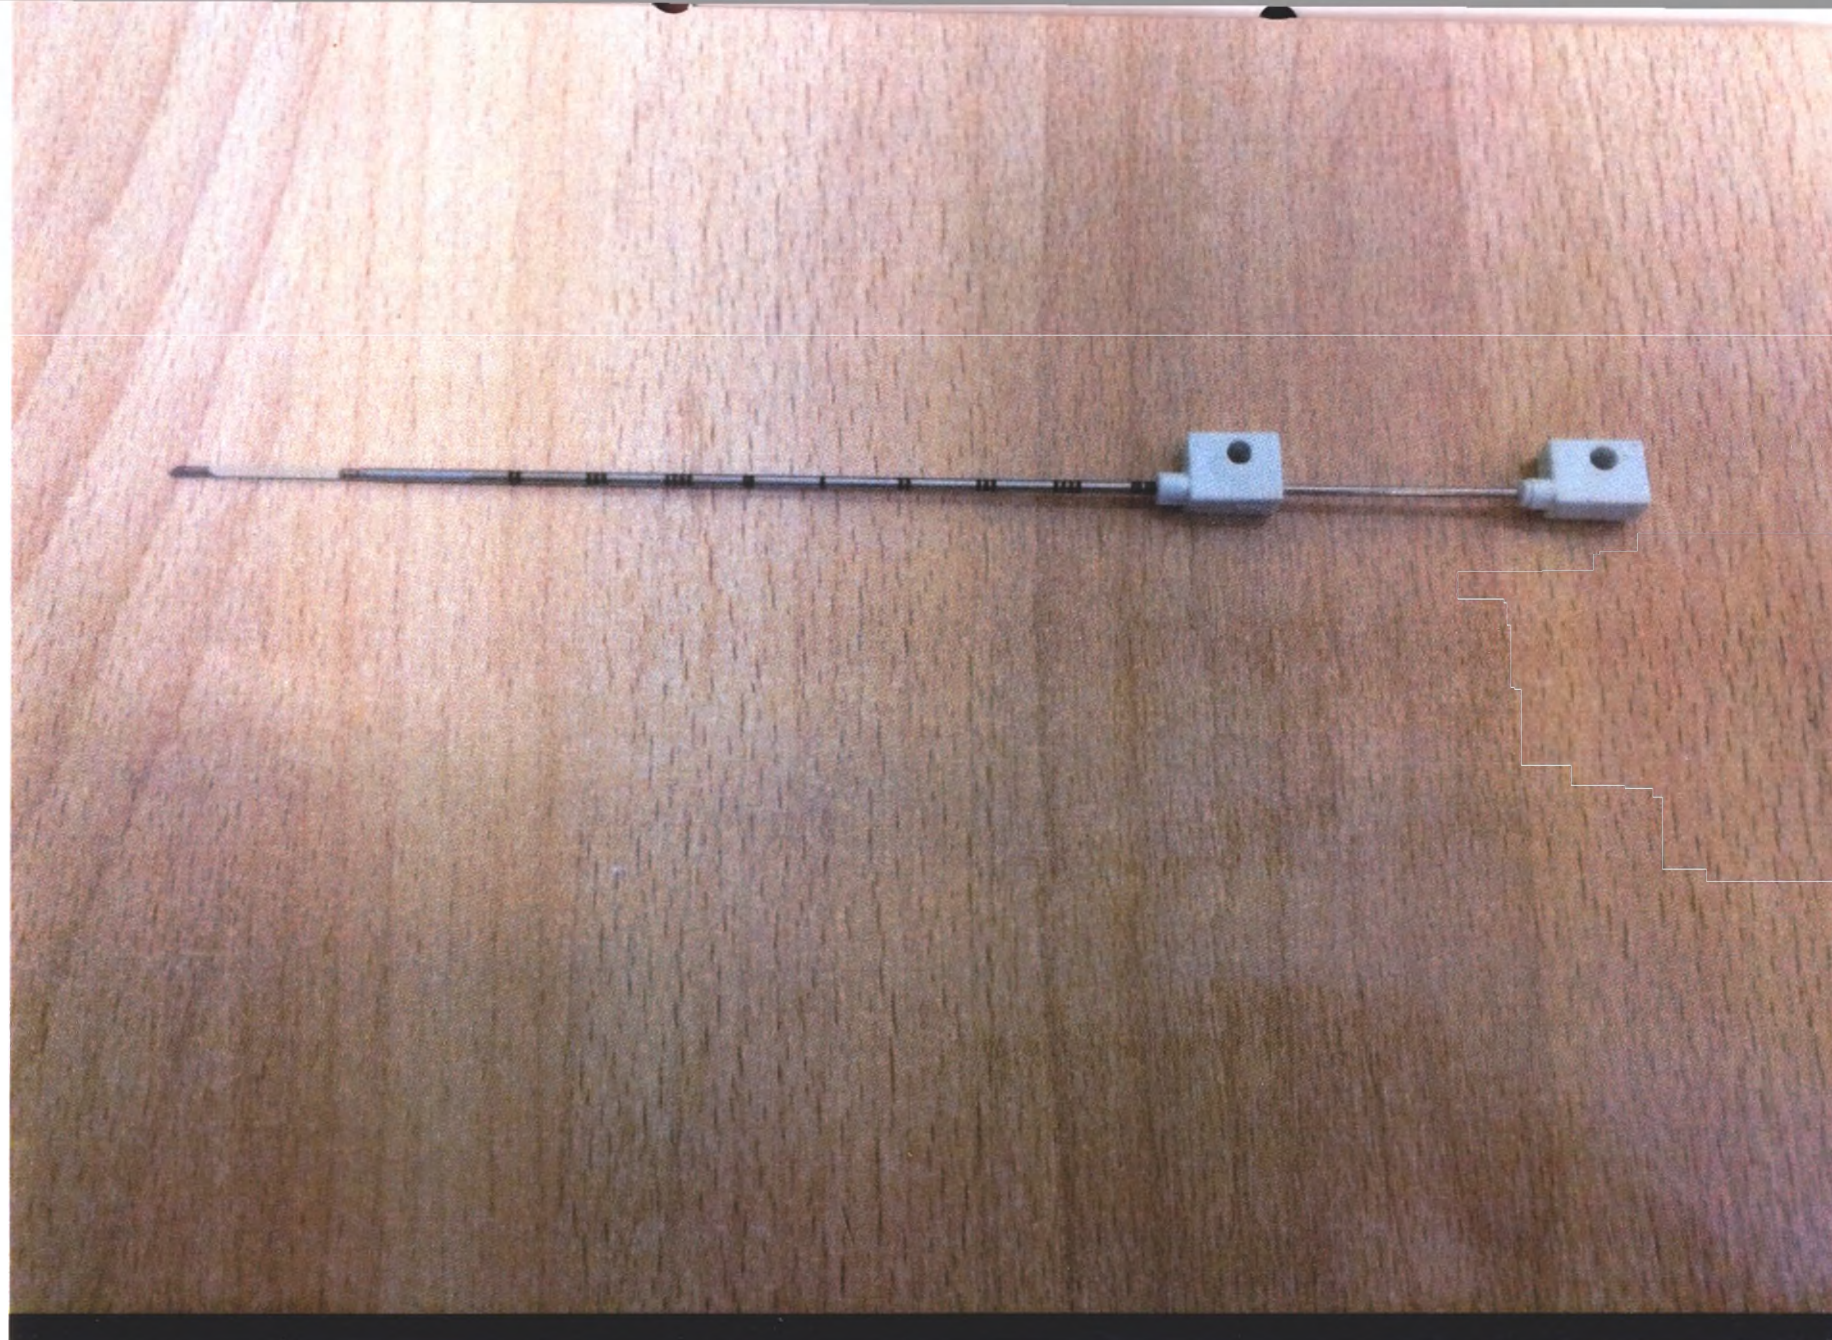


Фото 8. Внешний вид для варианта Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore U GPN1610- U, внешний диаметр канюли 16G (1,65 мм), длина канюли 100 мм.
Данный внешний вид на фотографии актуален также для следующих вариантов исполнений:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU чая MaxiCore U GPN1615- U, внешний диаметр канюли 16G (1,65 мм), длина канюли 150 мм;
- Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore U GPN1620- U, внешний диаметр канюли 16G (1,65 мм), длина канюли 200 мм. Отличие только в длине канюли.


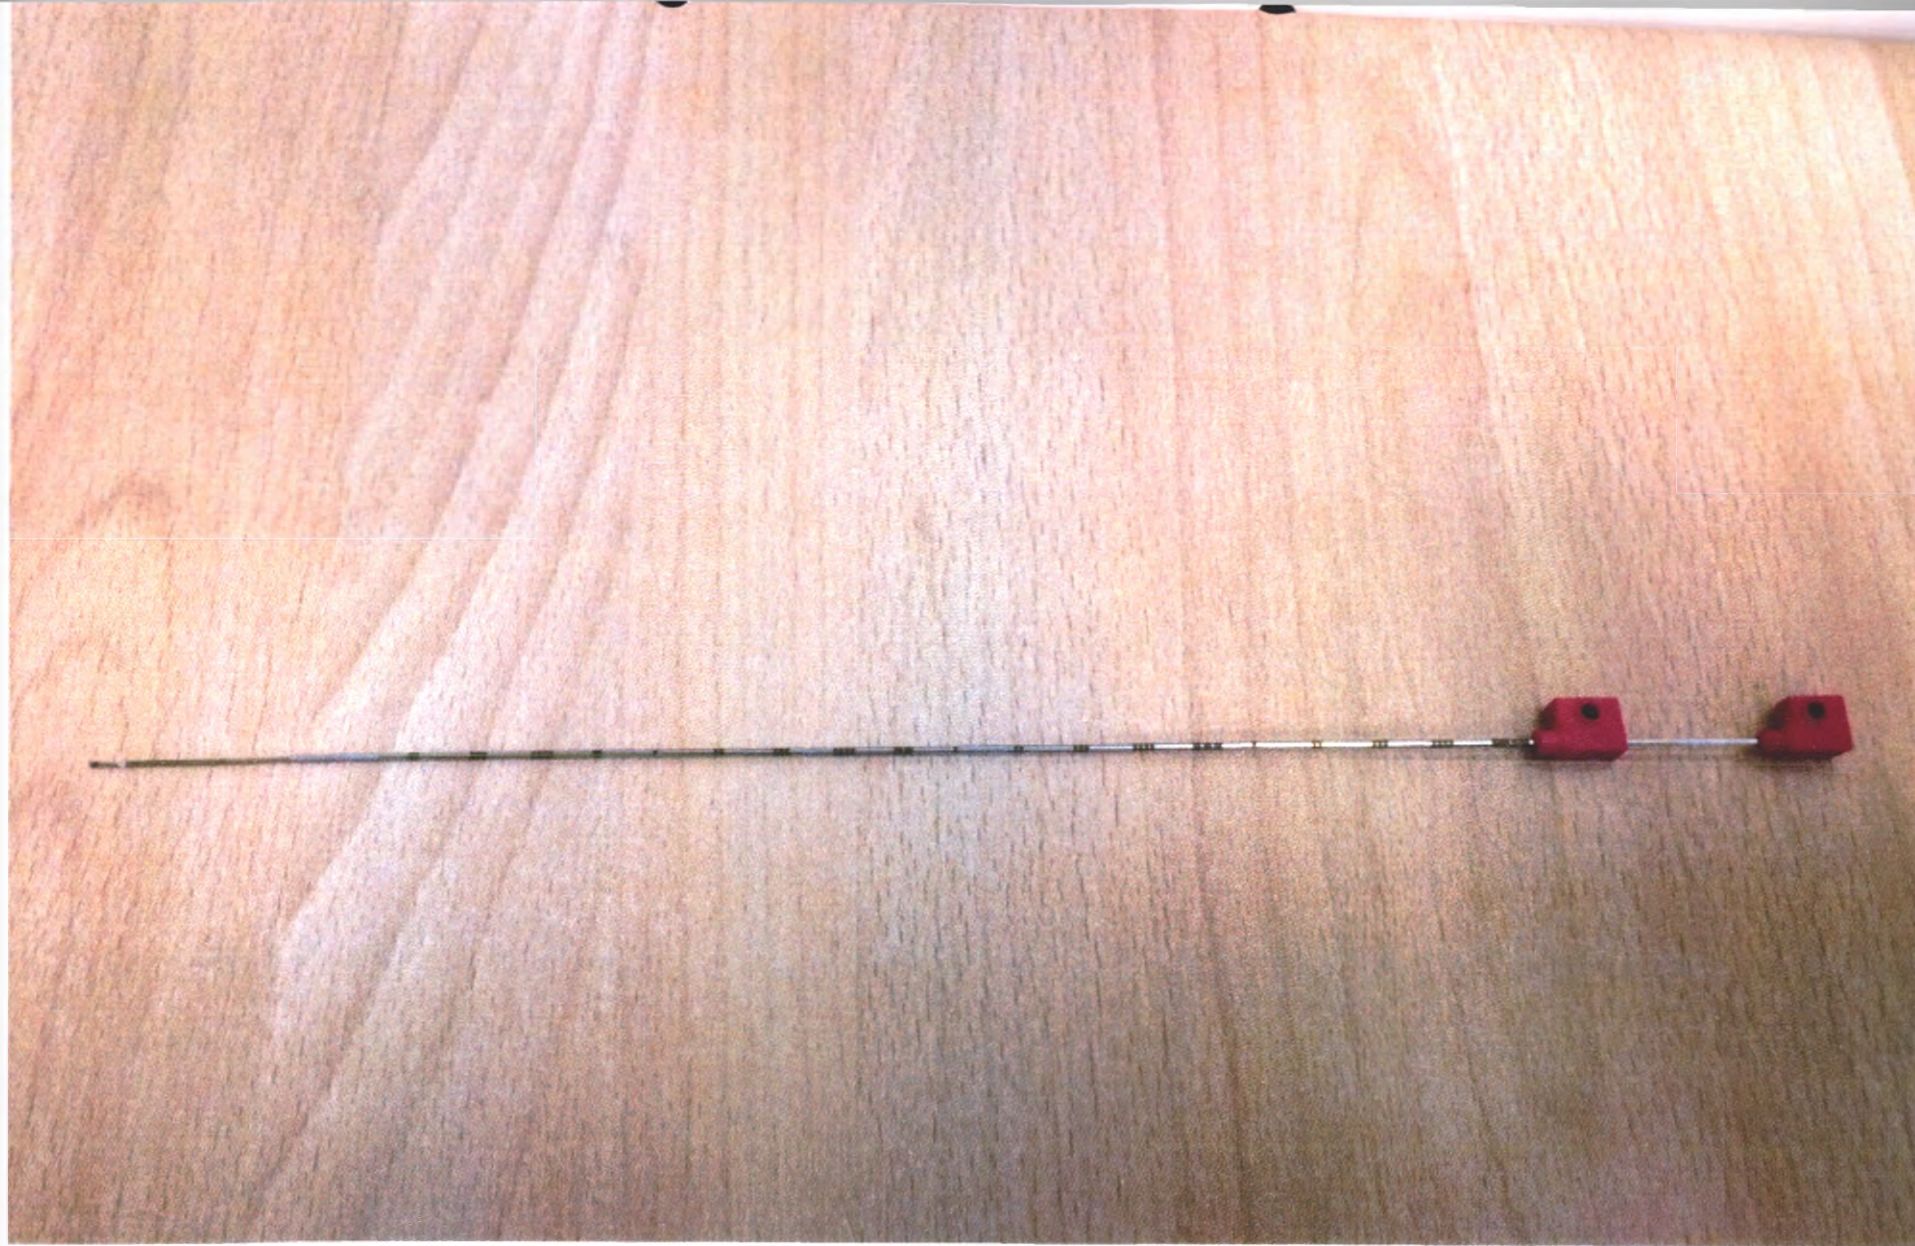


Фото 9. Внешний вид для варианта Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore U GPN1820- U, внешний диаметр канюли 18G (1.26 мм), длина канюли 200 мм.

Данный внешний вид на фотографии актуален также для следующих вариантов исполнений:

- Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore U GPN1810- U, внешний диаметр канюли 18G (1.26 мм), длина канюли 100 мм;
- Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore U GPN1815- U, внешний диаметр канюли 18G (1.26 мм), длина канюли 150 мм;
- Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore U GPN1825- U, внешний диаметр канюли 18G (1.26 мм), длина канюли 250 мм;
- Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore U GPN1830- U, внешний диаметр канюли 18G (1.26 мм), длина канюли 300 мм.

Отличие только в длине канюли

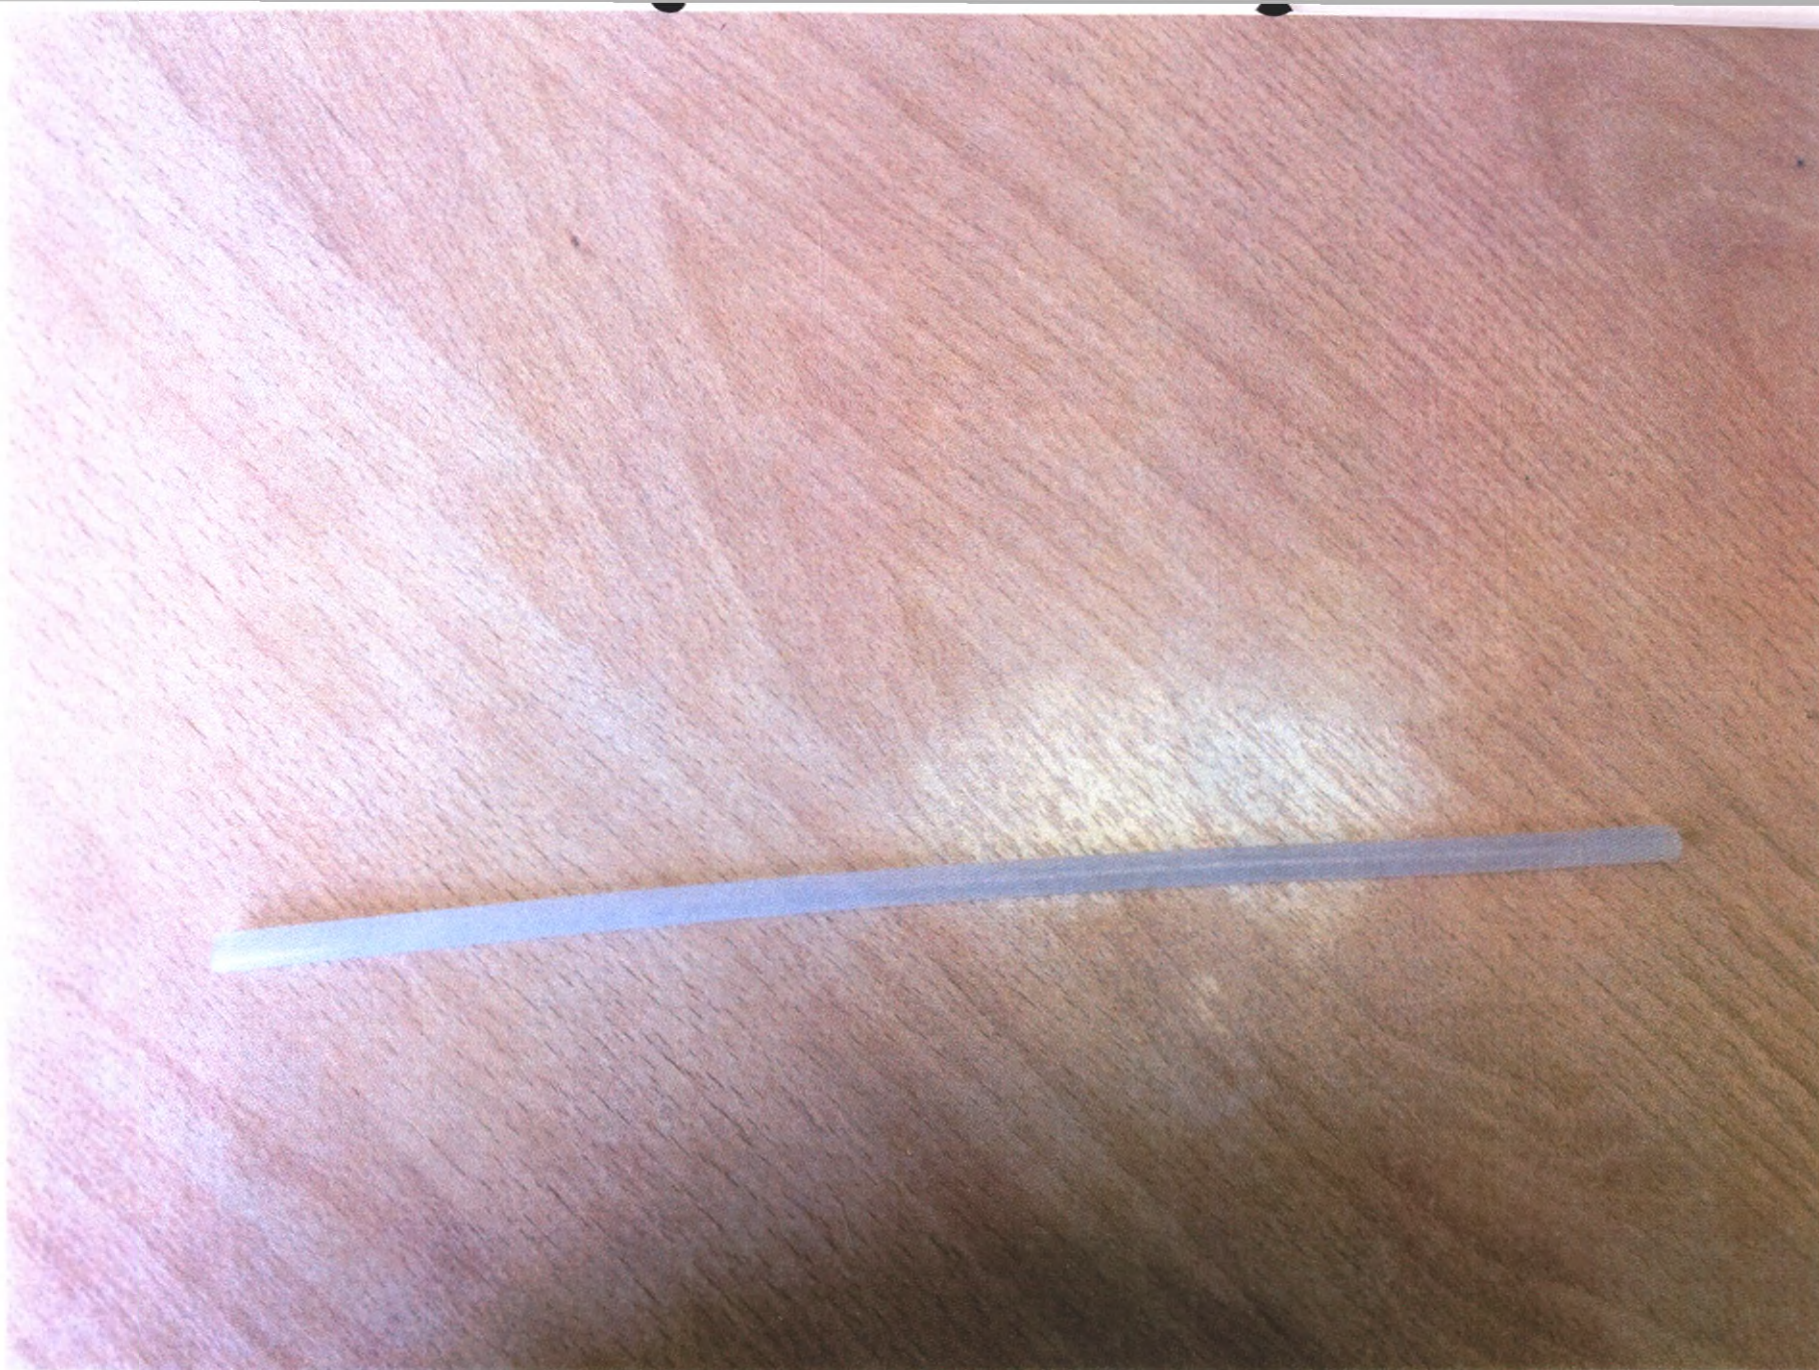

GEOTEK Регистративное удостоверение
№ _____ от _____

Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore M
GPN1410-M, внешний диаметр канюли 14G (2, 10 мм),
длина канюли 100 мм

14G x 100 mm

REF	⊗	✂
LOT	⊗	✂
⏰	ⓘ	⊗
⏰	ⓘ	✂
CE	☔	

GEOTEK MEDİKAL VE SAĞLIK
HİZMETLERİ TİCARET SANAYİ LİMİTED
ŞİRKETİ (GEOTEK MEDİKAL VE SAĞLIK
HİZMETLERİ TİCARET SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ)
TÜRKİYE OSB ALIŞ METAL İŞLERİ STESİ
1436 SOKAK NO: 12, YENİMAHALLE -
ANKARA - TÜRKİYE (Турция)

Уполномоченный представитель на
территории РФ:
ООО «Агрегатор Медики»
115191, г. Москва, ул. Тульская Б., д. 10,
стр. 5, пом/ком/оф XII/3/5310

место для нтрик-ида	место для нтрик- ида
REF	REF
LOT	LOT

ото 11. Пример маркировки для варианта исполнения: Игла для биопсии одноразовая стерильная MaxiCore M GPN1410-M,
внешний диаметр канюли 14G (2,10 мм), длина канюли 100 мм.

анная маркировка также актуальна для всех остальных регистрируемых вариантов исполнений.

Прошито, пронумеровано

скреплено печатью 12 листов

ООО «АГРЕГАТОР МЕДИКАЛ»

Генеральный директор

Д.В. Домнышев

29.08.2019г.

