

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»
Носова Т.А.


2019 г.




Фотографические изображения изделия:

**Кассета с реагентами для количественного определения пролактина (Prolactin (PRL))
иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL
для диагностики *in vitro***

**Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd («Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко.,
Лтд. »), Китай**

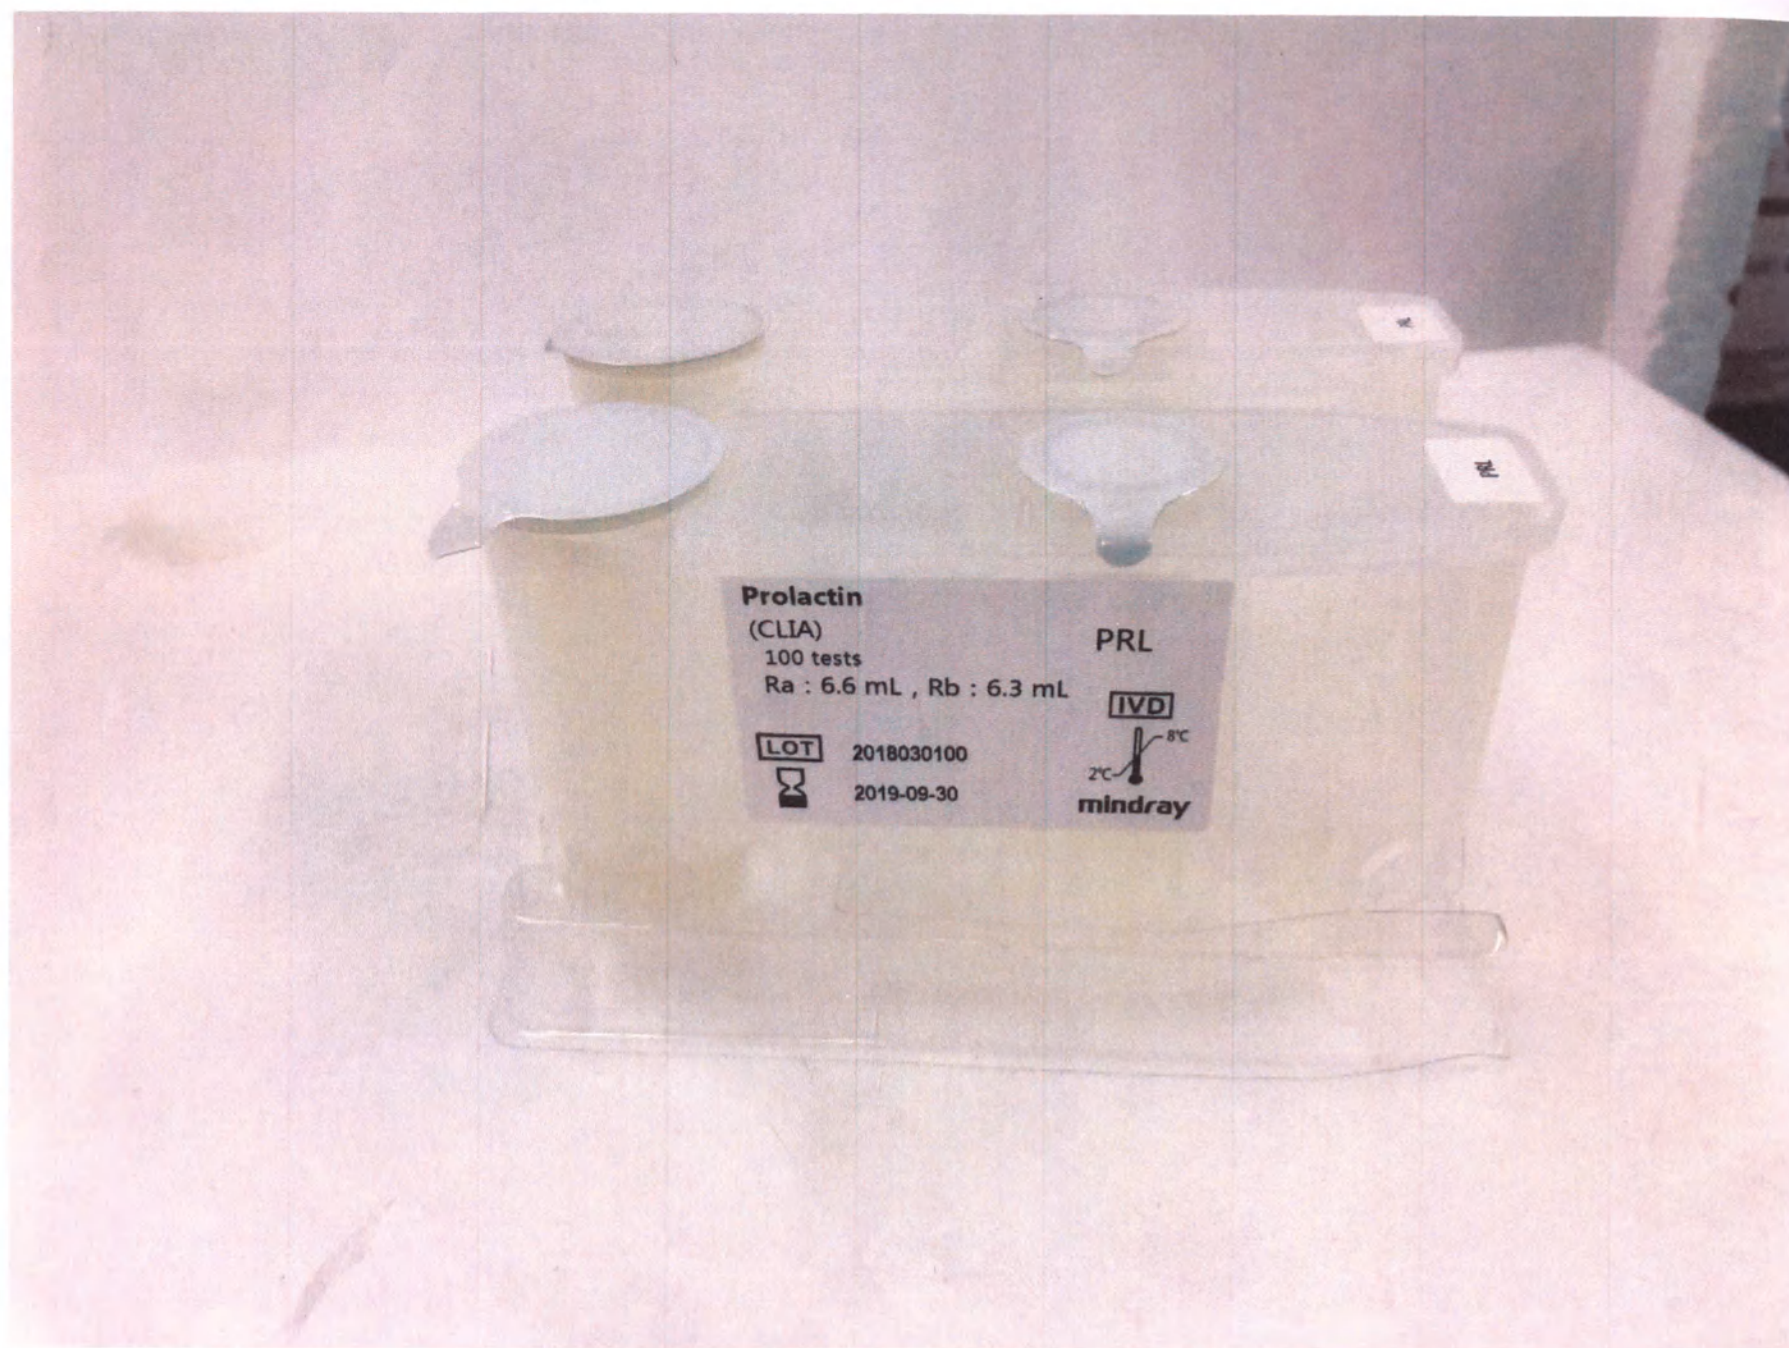

Фотографическое изображение кассеты с реагентами PRL112

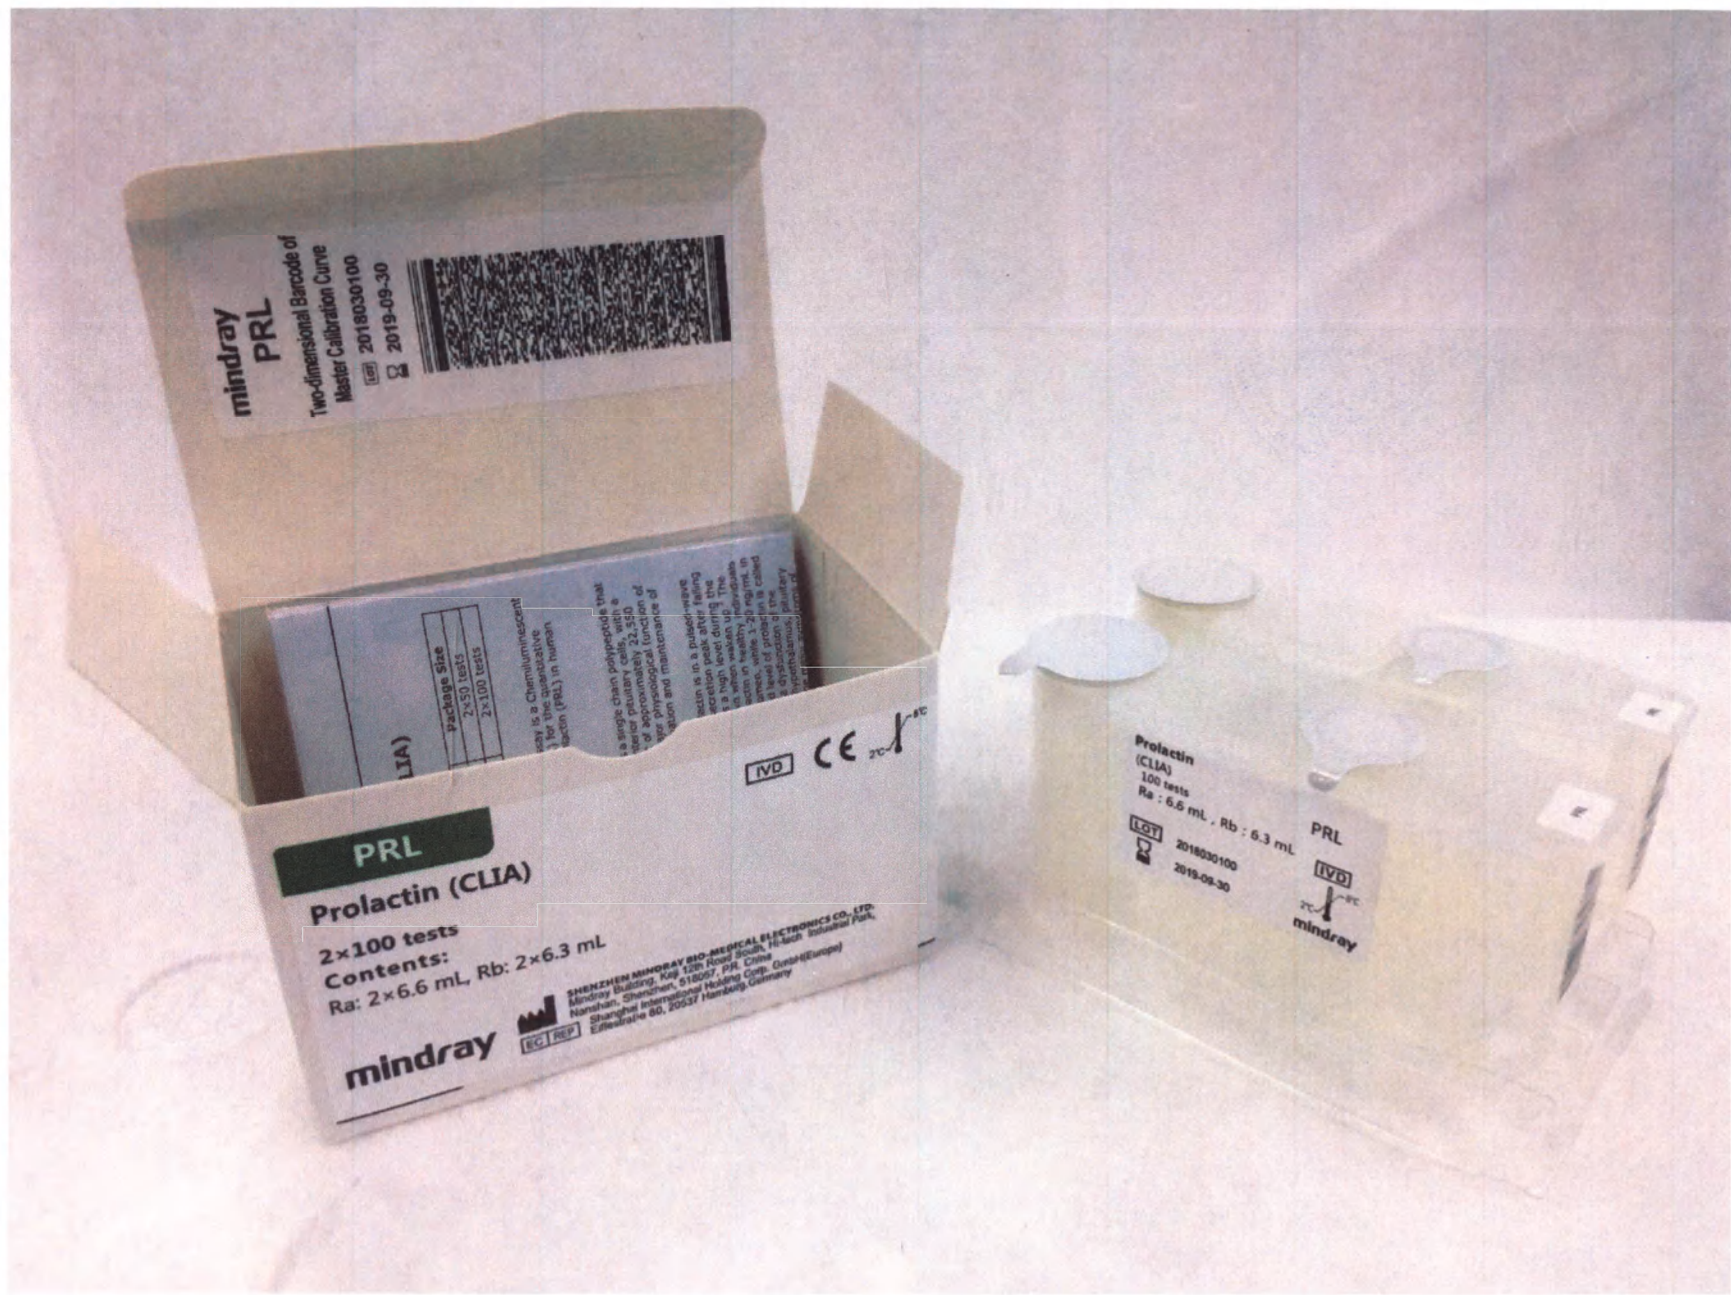

Общий вид медицинского изделия (Кассета с реагентами для количественного определения пролактина (Prolactin (PRL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro PRL112 (2 x 100 тестов))

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 3 листа (-ов)

Генеральный Директор Носова Т.А.
М.П.

