

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор
ООО "ИГДРАСИЛЬ"
«7» апреля 2020 г.
Ангелика Колесова

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для
интрадермального введения, в исполнениях»**


г. Москва

Фотографическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для интрадермального введения в исполнении Revitajal 2

Общий вид





Фотографическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для
интрадермального введения
в исполнении Revitajal 2
Предварительно наполненный шприц

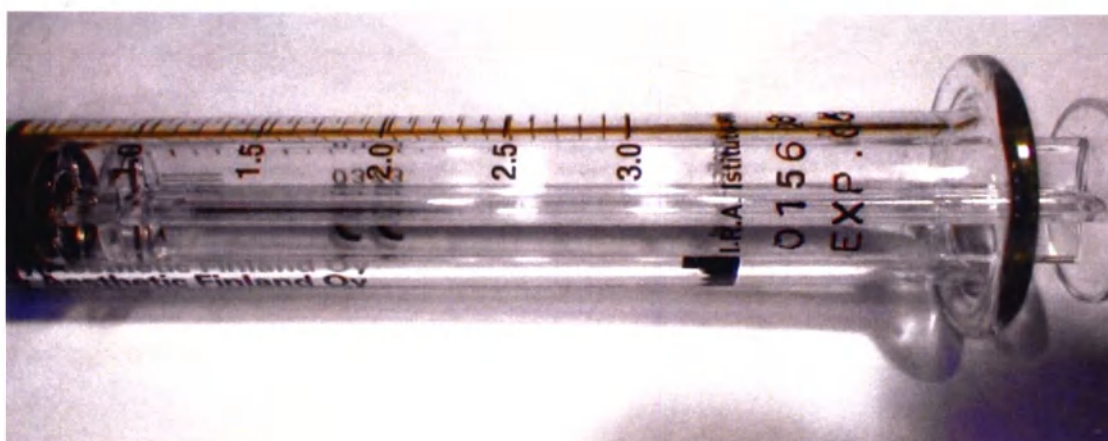

Фотографическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для интрадермального введения в исполнении Revitajal 2

Упор для пальцев

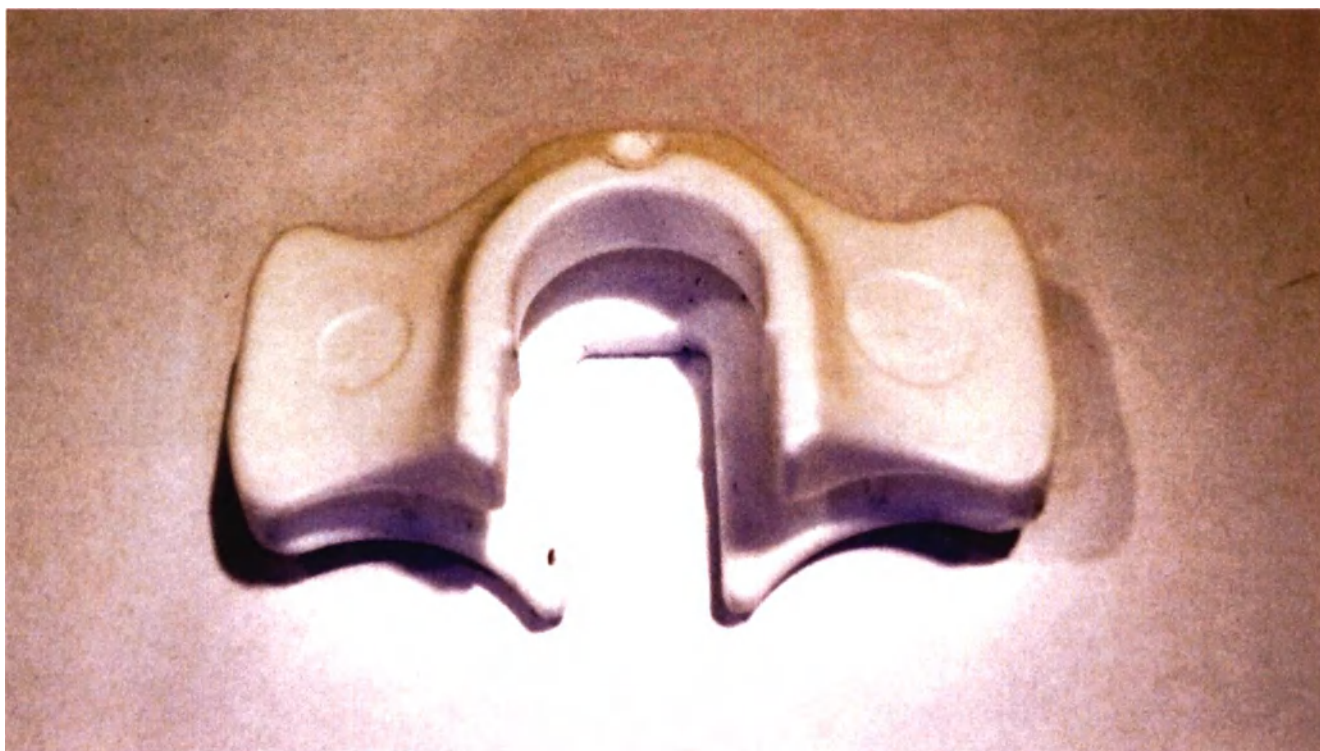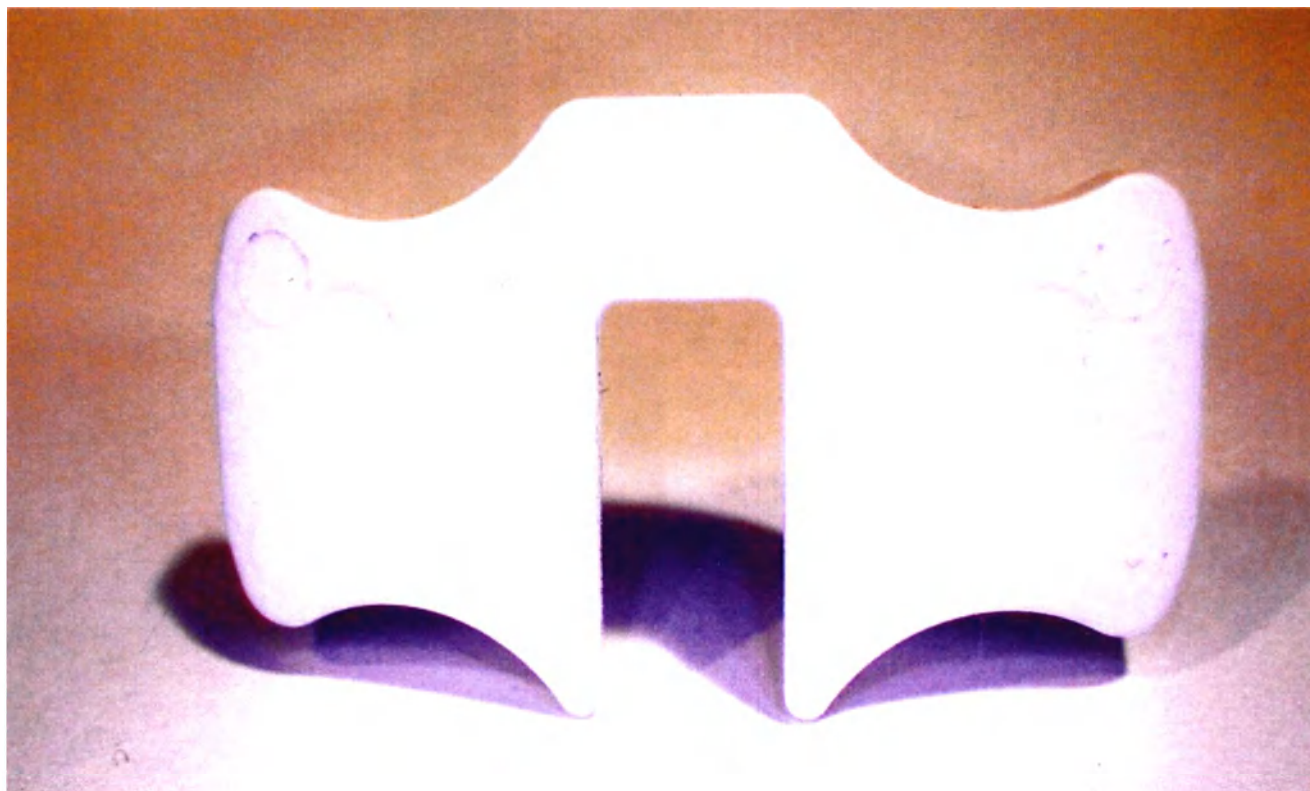

Фотографическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для интрадермального введения в исполнении Revitajal 2





Маркировка самоклеящихся этикеток



Маркировка стерилизационного пакета



Фотографическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для интрадермального введения в исполнении Revitajal 2
Маркировка картонной коробки

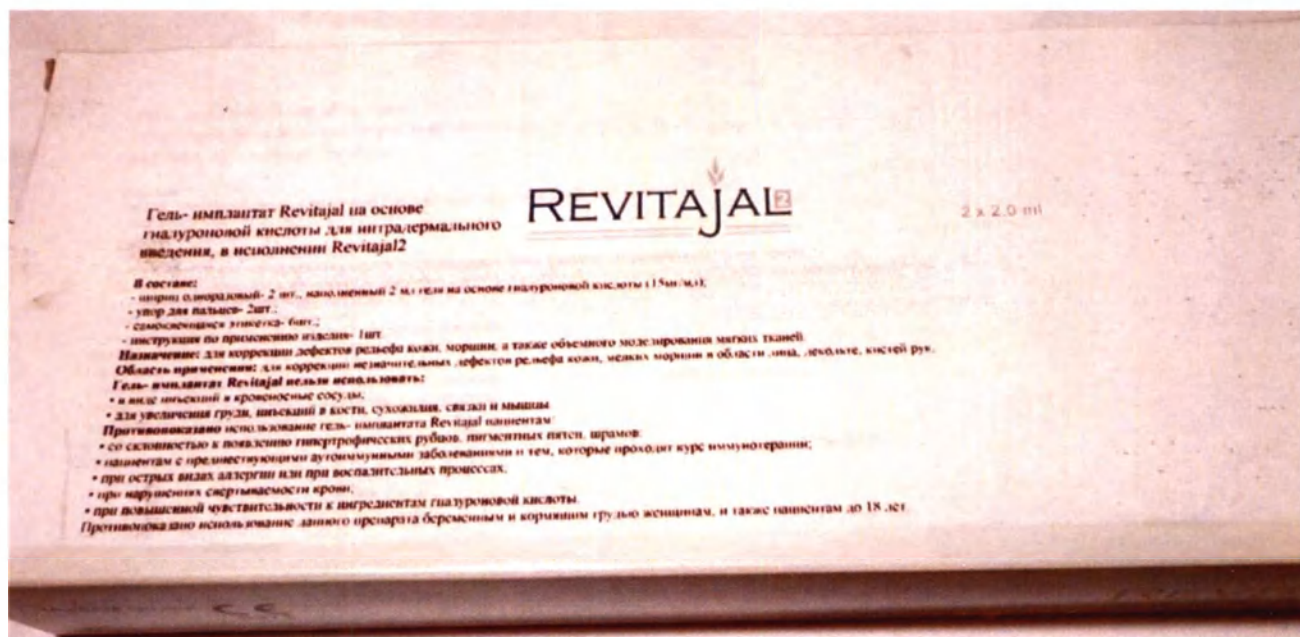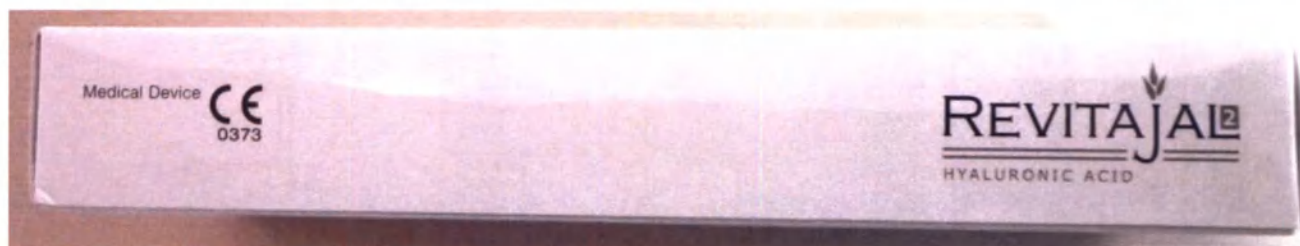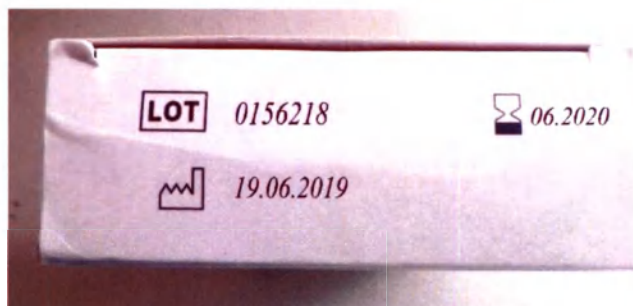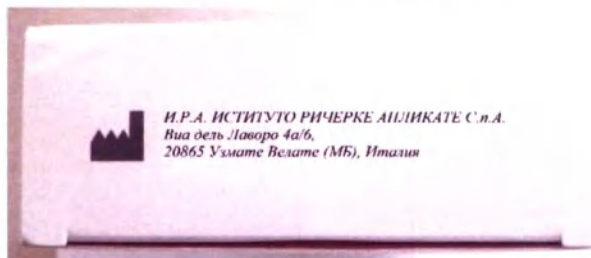


Фотографическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для интрадермального введения в исполнении Revitajal 3

Общий вид





Фотографическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для
интрадермального введения
в исполнении Revitajal 3

Предварительно наполненный шприц

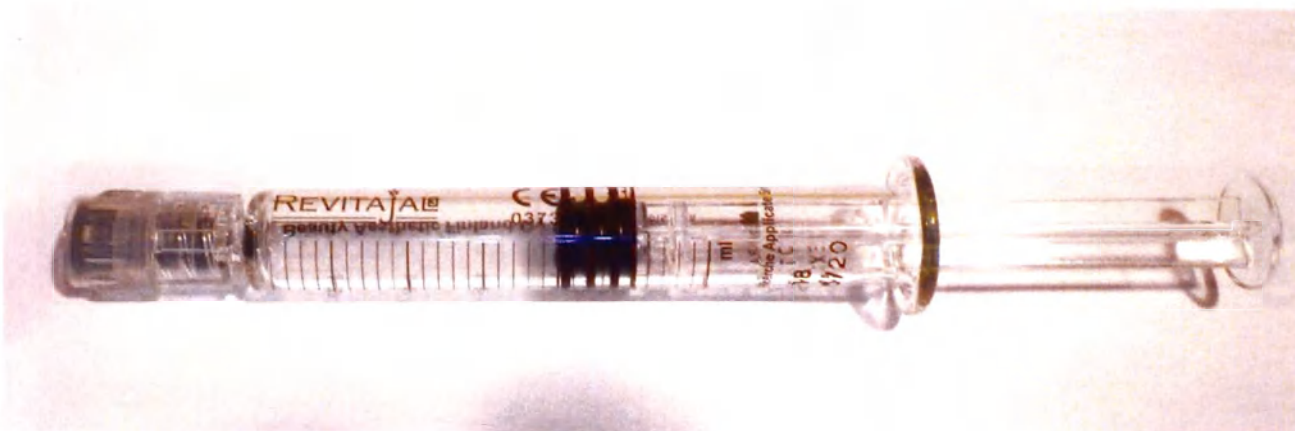

Фотографическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для интрадермального введения в исполнении Revitajal 3

Упор для пальцев

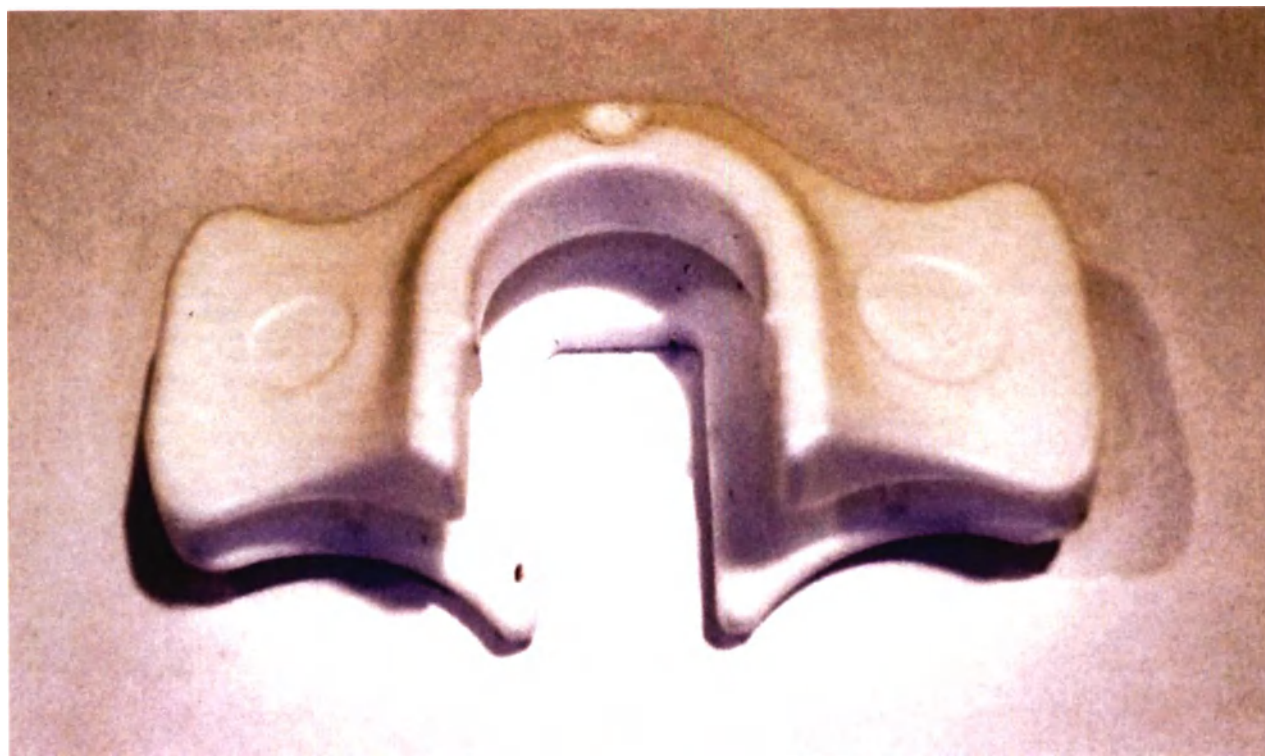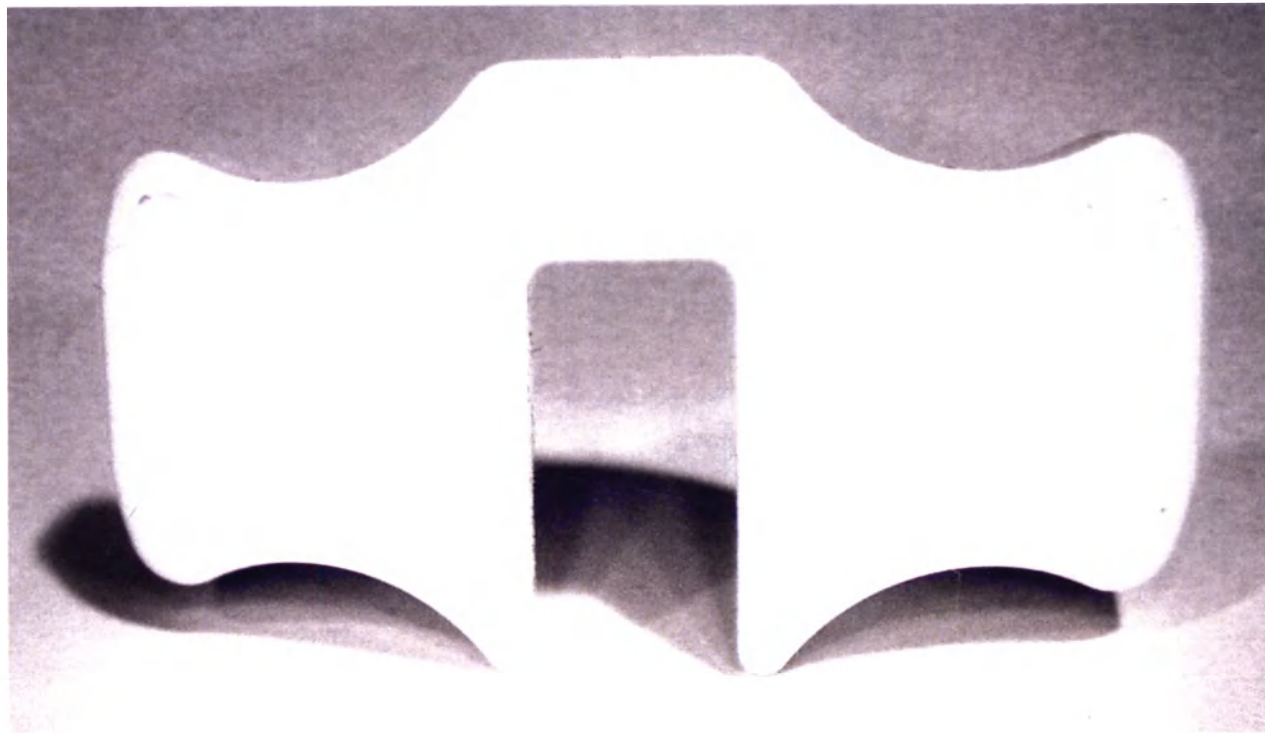

Фотографическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для интрадермального введения в исполнении Revitajal 3

Маркировка самоклеящихся этикеток



Маркировка стерилизационного пакета

Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для интрадермального введения, в исполнении Revitajal3

В составе:

- шприц одноразовый- 2 шт., наполненный 2 мл геля на основе гиалуроновой кислоты (20мг/мл);
- упор для пальцев- 2шт.;
- самоклеящаяся этикетка- 6шт.;
- инструкция по применению изделия- 1шт.

Назначение: для коррекции дефектов рельефа кожи, морщин, а также объемного моделирования мягких тканей

Область применения: для коррекции незначительных дефектов рельефа кожи, мелких морщин в области лица, декольте, кистей рук.

Гель- имплантат Revitajal нельзя использовать:

- в виде инъекций в кровеносные сосуды;
- для увеличения груди, инъекций в кости, сухожилия, связки и мышцы.

Противопоказано использование гель- имплантата Revitajal пациентам:





- со склонностью к появлению гипертрофических рубцов, пигментных пятен, шрамов;
- пациентам с предшествующими аутоиммунными заболеваниями и тем, которые проходят курс иммуноотерапии;
- при острых формах аллергии или при воспалительных процессах;
- при нарушениях свертываемости крови;
- при повышенной чувствительности к ингредиентам гиалуроновой кислоты.

Противопоказано использование данного препарата беременным и кормящим грудью женщинам, и также пациентам до 18 лет.

REVITAJAL

1 x 2,0 ml

Фотографическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для интрадермального введения в исполнении Revitajal 3
Маркировка картонной коробки

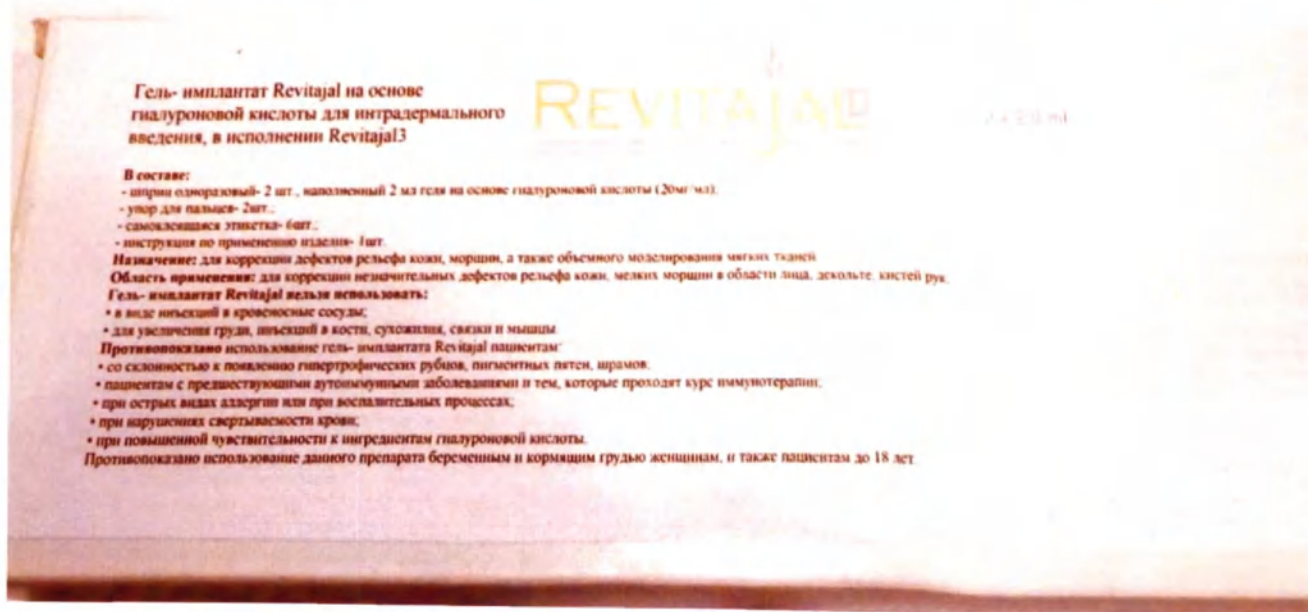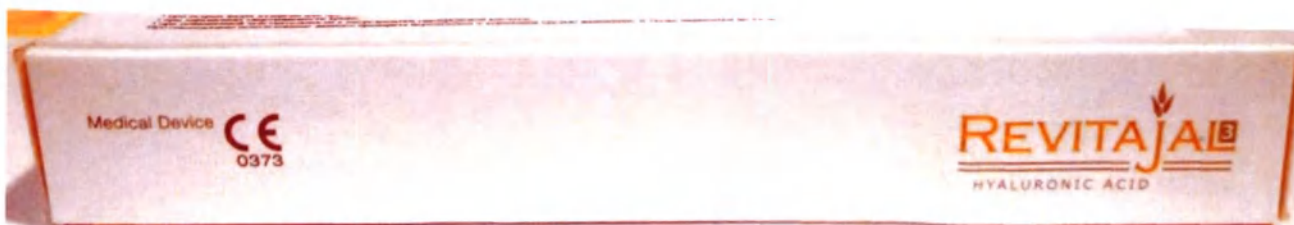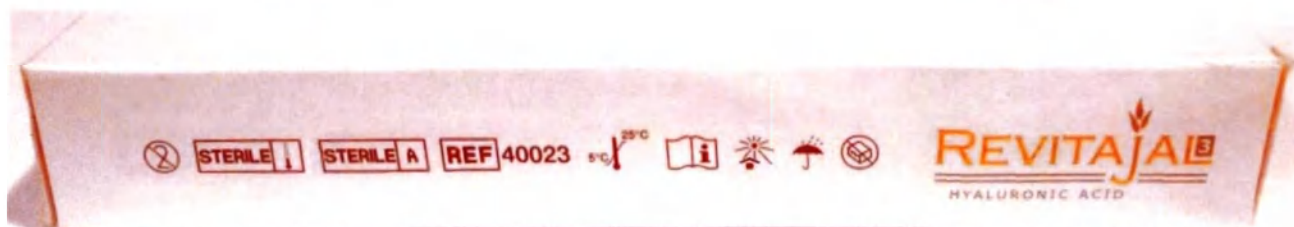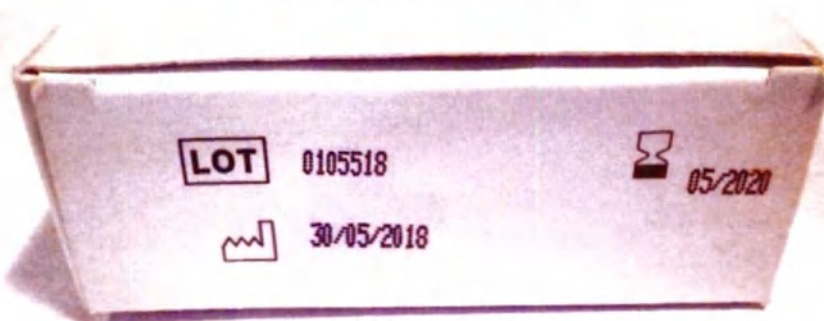


Фотографическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для
интрадермального введения
в исполнении Volume THIN

*Общий вид исполнения Volume THIN
С 1 шприцем*





Фотографическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для
интрадермального введения
в исполнении Volume THIN

Предварительно наполненный шприц

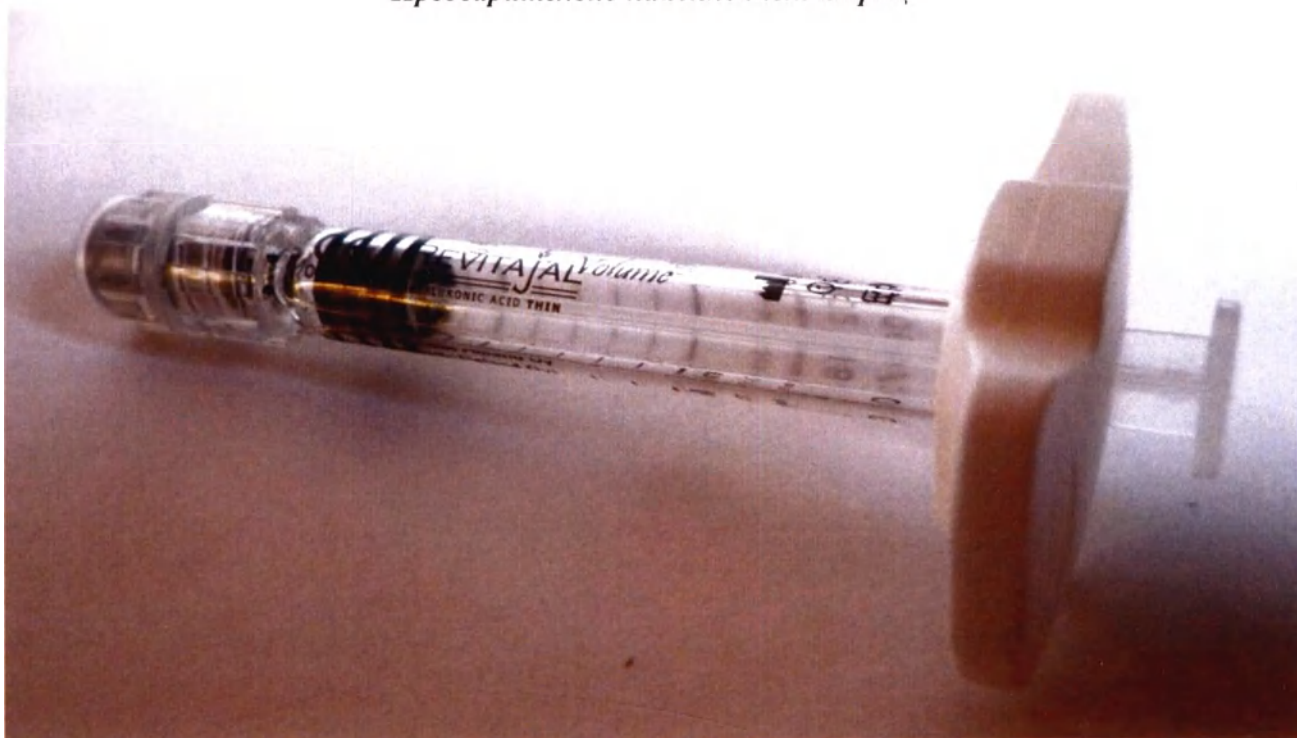

Фотографическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для
интрадермального введения
в исполнении Volume THIN
Упор для пальцев

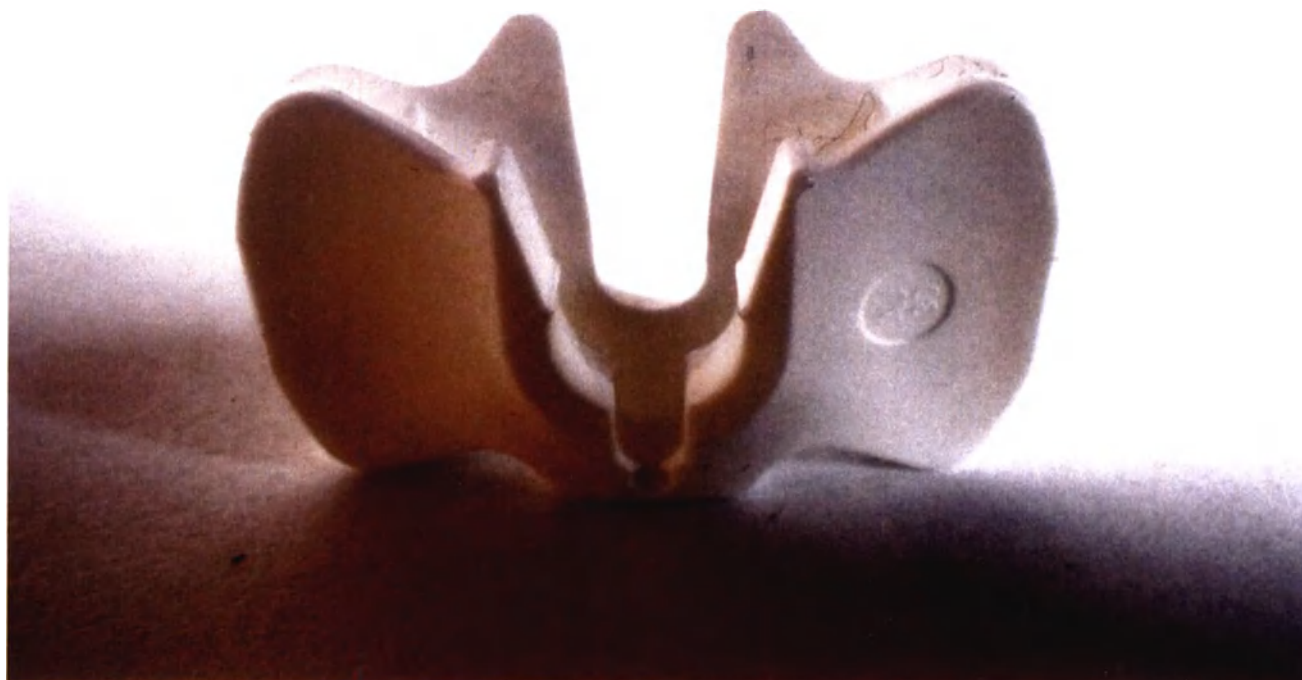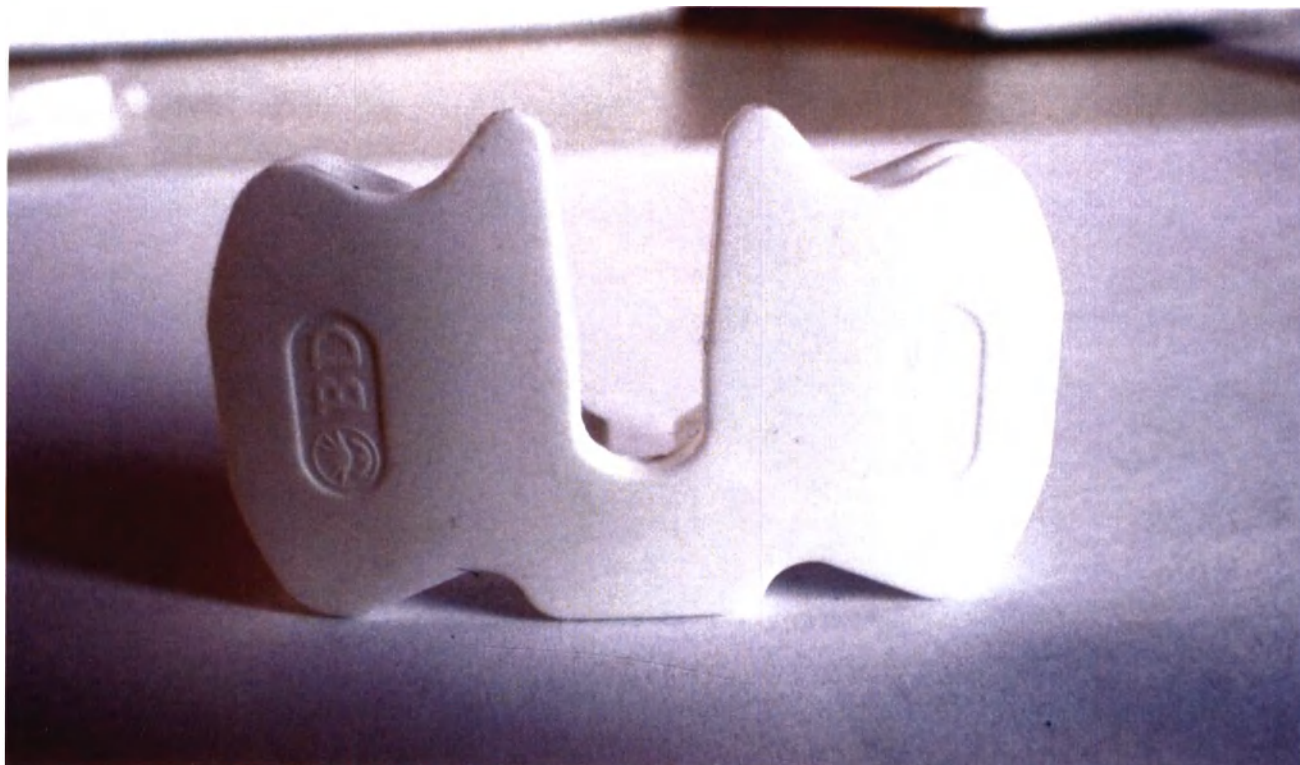


Фотографическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для интрадермального введения в исполнении Volume THIN

Игла 30Gx1/2" (0,3x13мм)



Защитный колпачок иглы 30Gx1/2" (0,3x13мм)

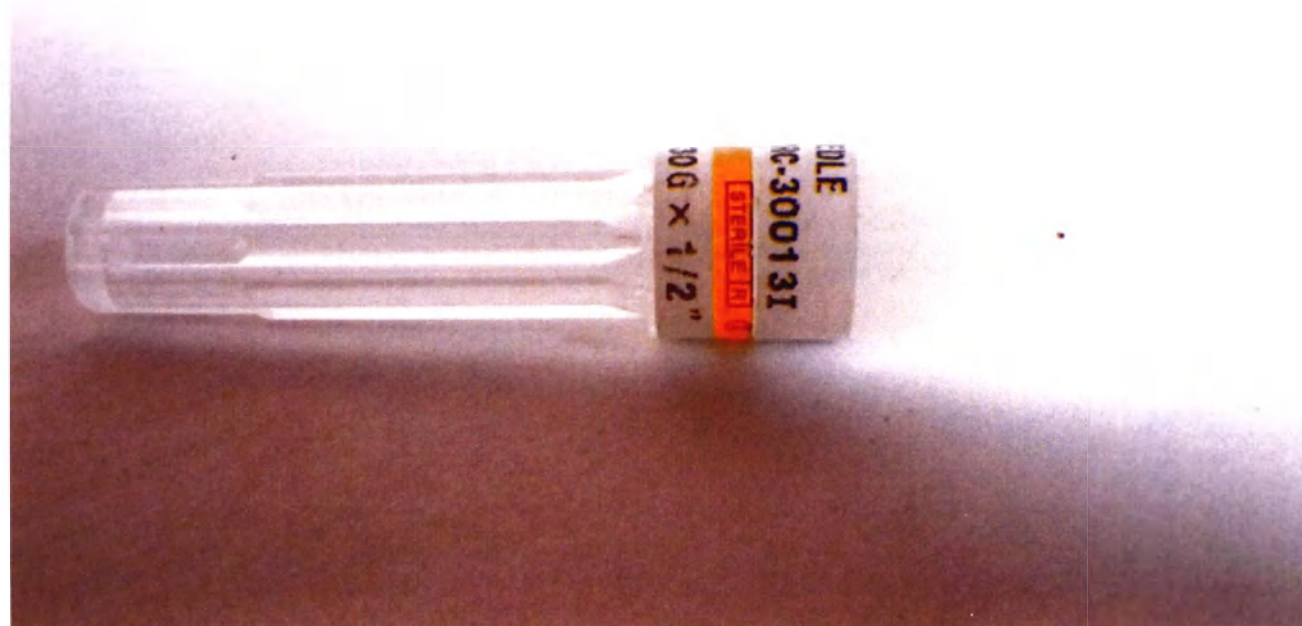

Фотографическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для интрадермального введения в исполнении Volume THIN

Маркировка самоклеящихся этикеток




Маркировка блистера



фотографическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для интрадермального введения в исполнении Volume THIN

Маркировка картонной коробки

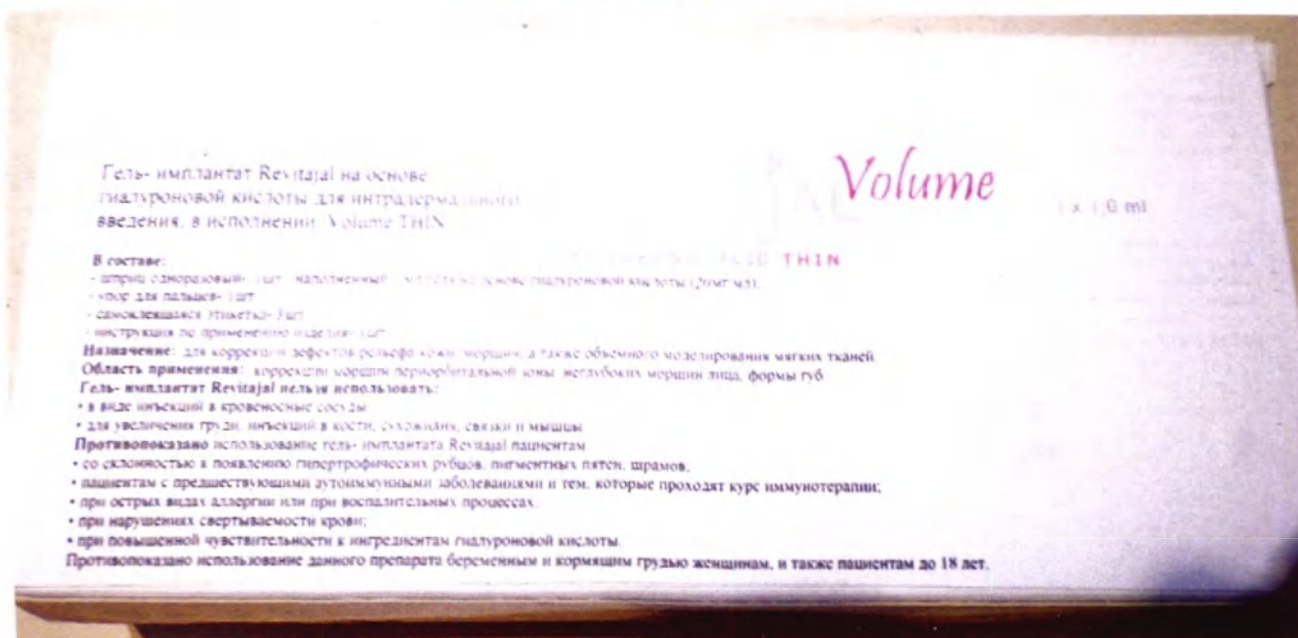

*Общий вид исполнения Volume THIN
с 2 шприцами*



фотографическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для
интрадермального введения
в исполнении Volume THIN

Предварительно наполненный шприц



Упор для пальцев



Фотографическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для
интрадермального введения
в исполнении Volume THIN
Игла 30Gx1/2" (0,3x13мм)



Защитный колпачок иглы 30Gx1/2" (0,3x13мм)



фотографическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для интрадермального введения в исполнении Volume THIN

Маркировка самоклеящихся этикеток



Маркировка блистера



Фотографическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для интрадермального введения в исполнении Volume THIN

Маркировка картонной коробки



Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для интрадермального введения, в исполнении Volume THIN

REVITAJAL Volume
HYALURONIC ACID THIN

В составе:

- шприц одноразовый- 1шт., наполненный 1 мл геля на основе гиалуроновой кислоты (20мг/мл);
- упор для пальца- 1шт.;
- игла одноразовая 30Gx1/2" (0,3x13мм)- 1шт.
- самоклеящаяся этикетка-3шт.;
- инструкция по применению изделия- 1шт.

Назначение: для коррекции дефектов рельефа кожи, морщин, а также объемного моделирования мягких тканей.

Область применения: коррекция морщин перiorбитальной зоны, неглубоких морщин лица, формы губ

Гель- имплантат Revitajal нельзя использовать:

- в виде инъекций в кровеносные сосуды;
 - для увеличения груди, инъекций в кости, сухожилия, связки и мышцы.
- Противопоказано использование гель- имплантата Revitajal пациентам:**
- со склонностью к появлению гипертрофических рубцов, пигментных пятен, шрамов;
 - пациентам с предшествующими аутоиммунными заболеваниями и тем, которые проходят курс иммунотерапии;
 - при острых видах аллергии или при воспалительных процессах;
 - при нарушениях свертываемости крови;
 - при повышенной чувствительности к ингредиентам гиалуроновой кислоты.

Противопоказано использование данного препарата беременным и кормящим грудью женщинам, и также пациентам до 18 лет.

графическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для
интрадермального введения
в исполнении Volume MEDIUM

*Общий вид исполнения Volume MEDIUM
с 1 шприцем*




Графическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для
интрадермального введения
в исполнении Volume MEDIUM


Предварительно наполненный шприц



Графическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для
интрадермального введения
в исполнении Volume MEDIUM
Упор для пальцев

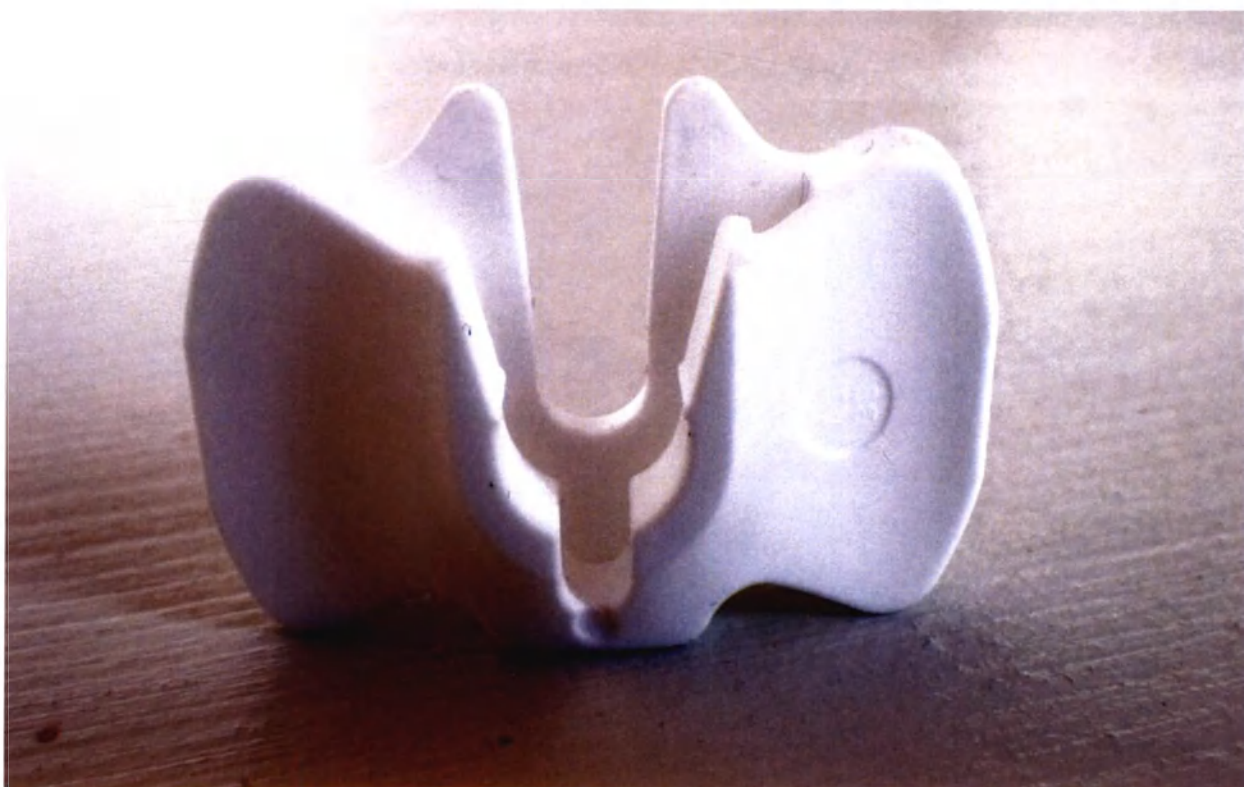

графическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для
интрадермального введения
в исполнении Volume MEDIUM
Игла 27G1/2" (0,4x13мм)

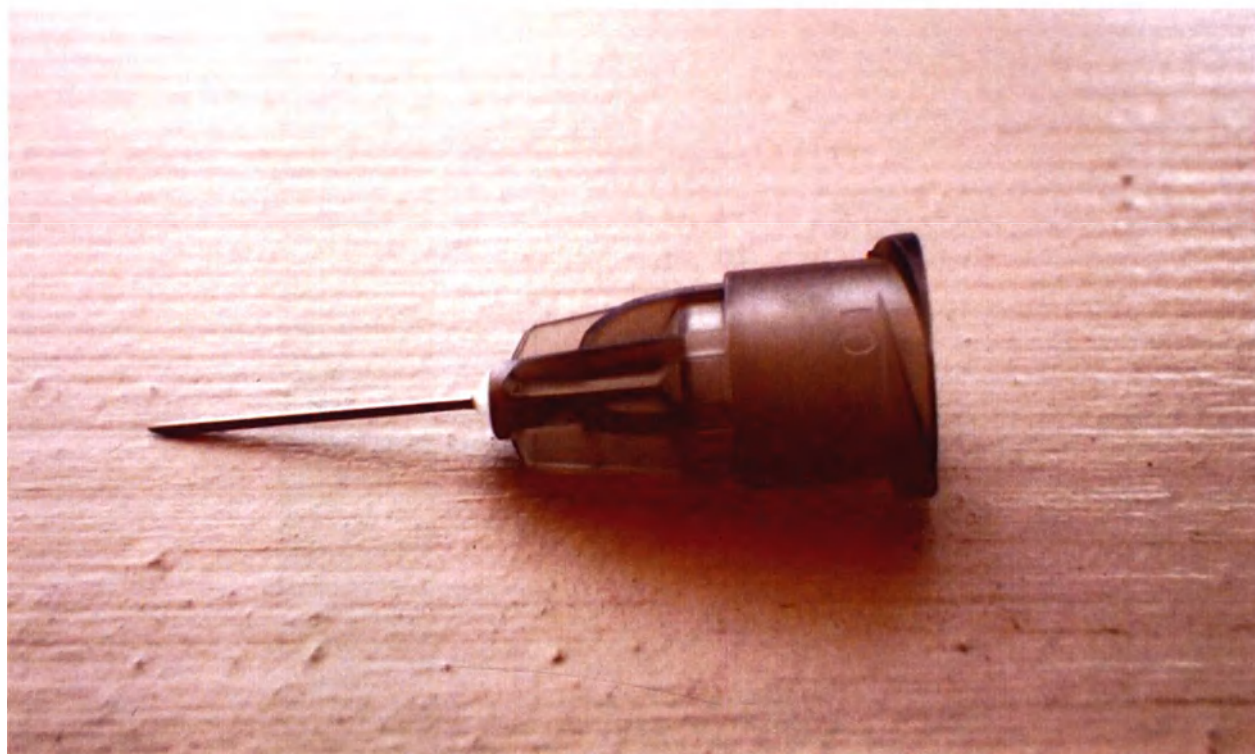

Защитный колпачок иглы 27G1/2" (0,4x13мм)




графическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для интрадермального введения в исполнении Volume MEDIUM

Маркировка самоклеящихся этикеток



Маркировка блистера

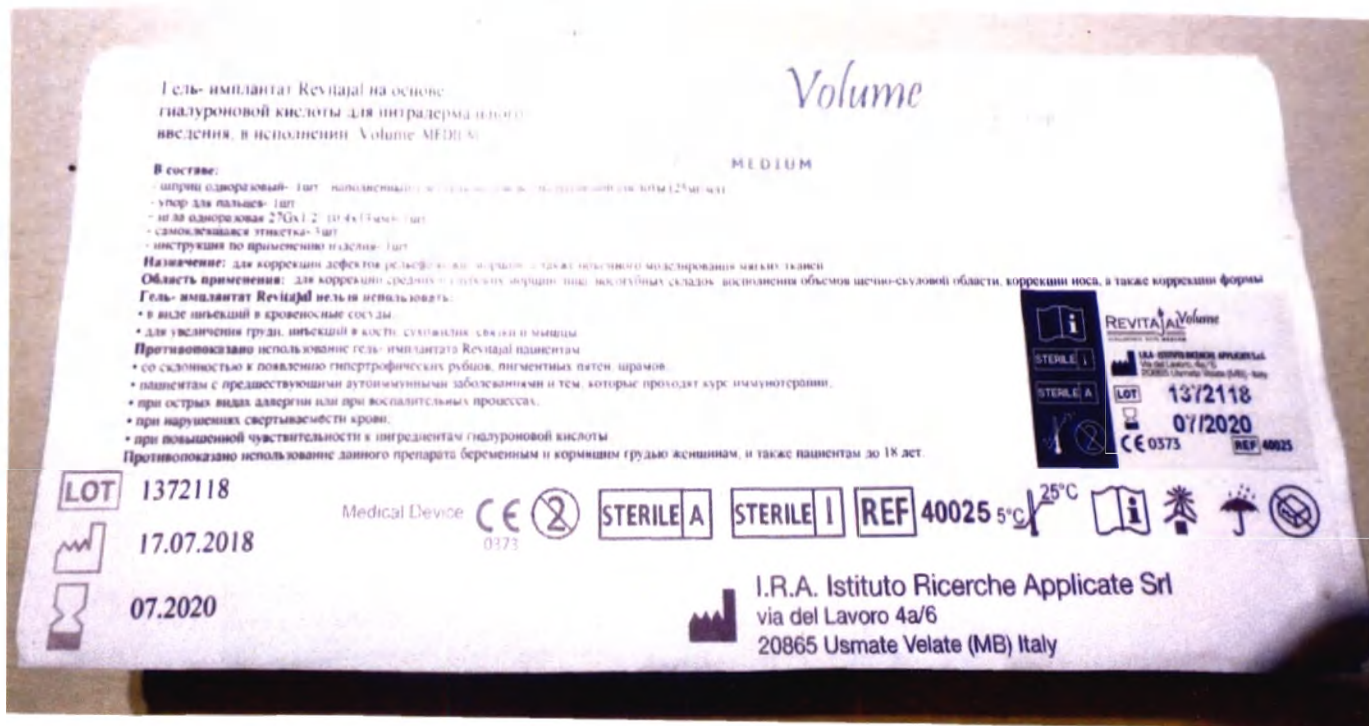

Графическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для интрадермального введения в исполнении Volume MEDIUM

Маркировка картонной коробки




графическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для
интрадермального введения
в исполнении Volume MEDIUM
*Общий вид исполнения Volume MEDIUM
с 2 шприцами*



Графическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для интрадермального введения в исполнении Volume MEDIUM
Маркировка самоклеящихся этикеток



Маркировка блистера

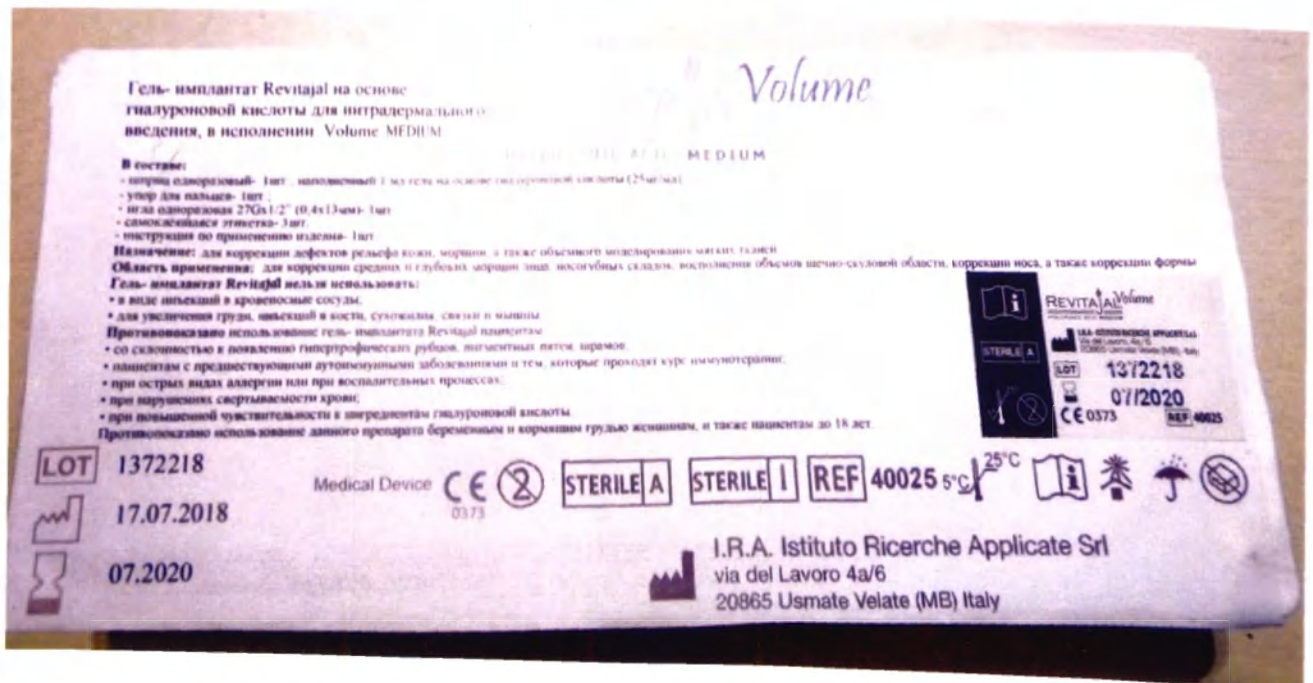

Маркировка картонной коробки



графическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для интрадермального введения в исполнении Volume MEDIUM




графическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для
интрадермального введения
в исполнении Volume STRONG

Общий вид исполнения *Volume STRONG*
с 1 шприцем



графическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для
интрадермального введения
в исполнении Volume STRONG

Предварительно наполненный шприц

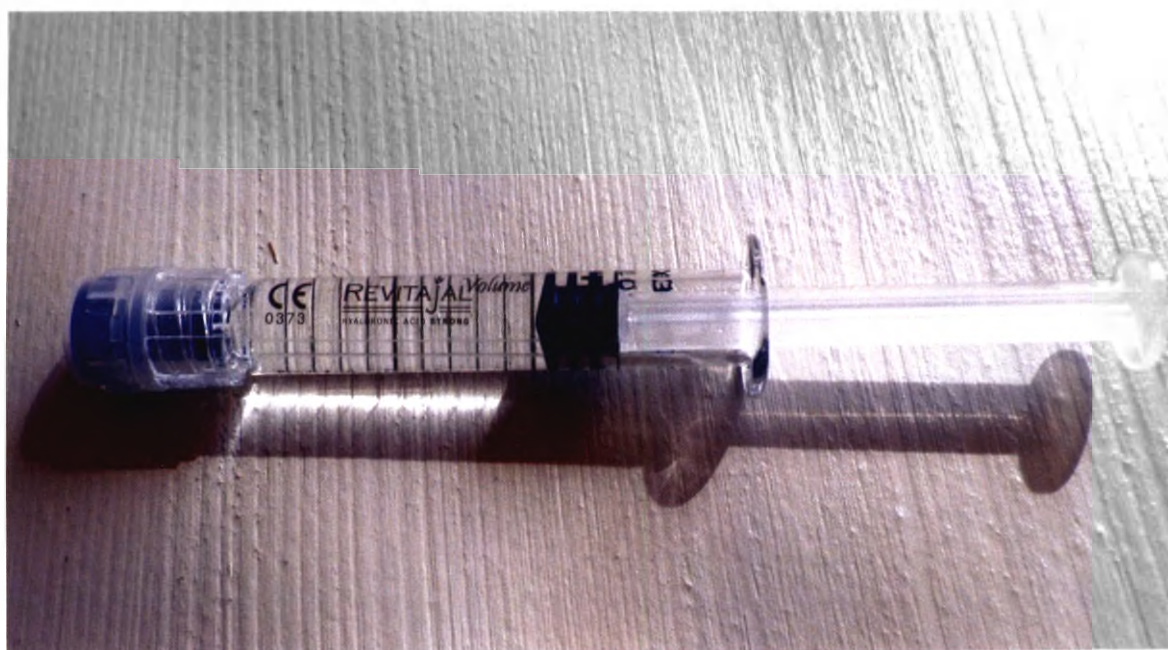

графическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для
интрадермального введения
в исполнении Volume STRONG

Упор для пальцев



афическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для
интрадермального введения
в исполнении Volume STRONG

Игла 27G1/2" (0,4x13мм)



Защитный колпачок иглы 27G1/2" (0,4x13мм)



графическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для интрадермального введения в исполнении Volume STRONG

Маркировка самоклеящихся этикеток



Маркировка блистера



графическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для
интрадермального введения
в исполнении Volume STRONG
Общий вид исполнения Volume STRONG
с 2 шприцами



графическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для
интрадермального введения
в исполнении Volume STRONG

Предварительно наполненный шприц




Графическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для интрадермального введения в исполнении Volume STRONG

Упор для пальцев



Графическое изображение МИ Гель- имплантат Revitalal на основе гиалуроновой кислоты для
интрадермального введения
в исполнении Volume STRONG

Игла 27G1/2"(0,4x13мм)

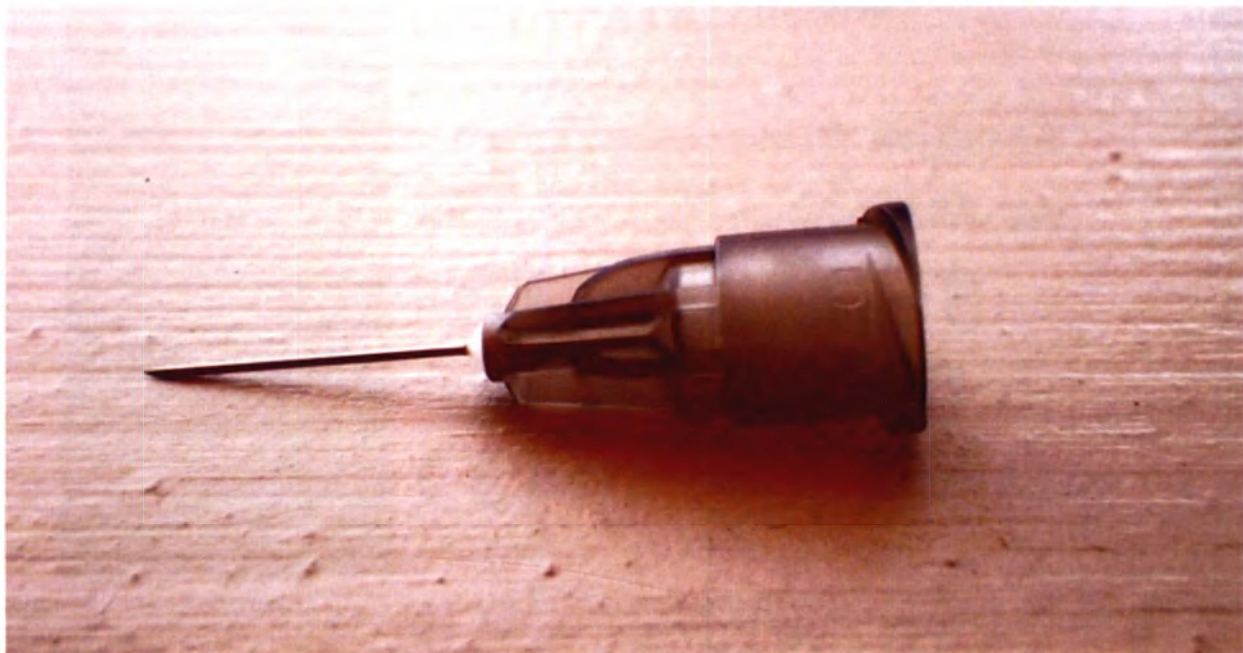

Защитный колпачок иглы 27G1/2"(0,4x13мм)



графическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для
интрадермального введения
в исполнении Volume STRONG

Маркировка самоклеящихся этикеток



REVITAJAL *Volume*
HYALURONIC ACID STRONG


STERILE **STERILE A**

LOT **1374218**
07.2020

CE 0373 **REF** 40026

I.R.A. - ISTITUTO RICERCHE APPLICATE S.r.l.
Via del Lavoro, 4a/6
20865 Usmate Velate (MB) - Italy

Маркировка блистера

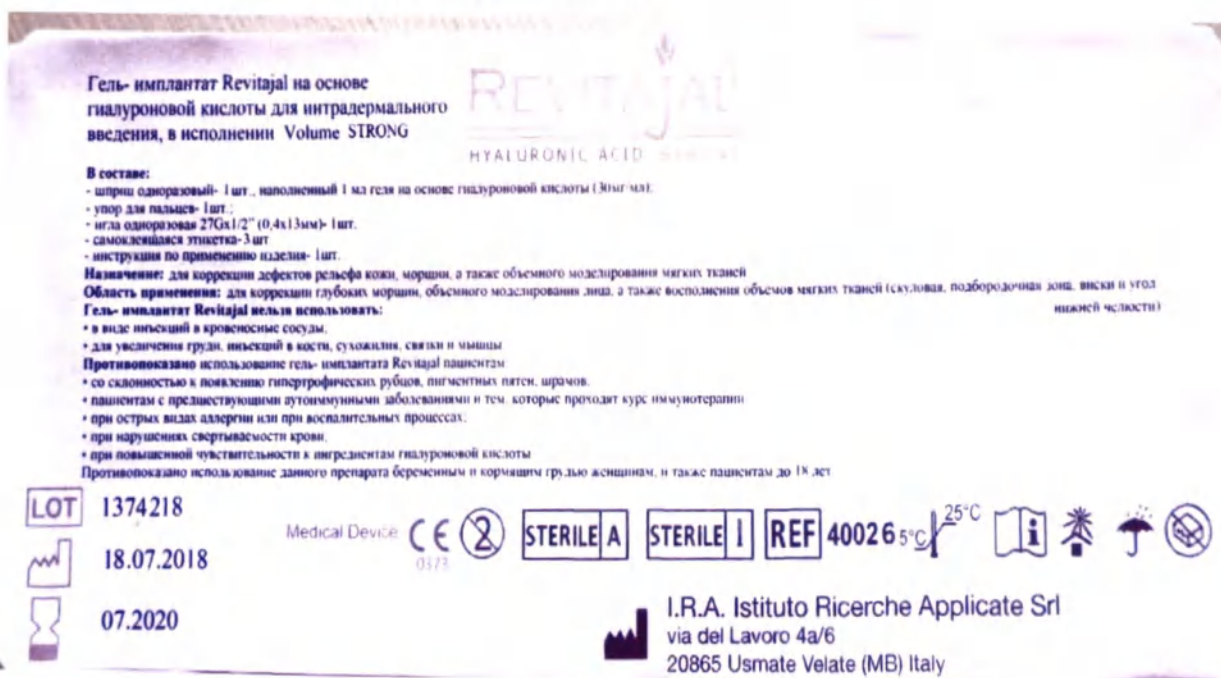

Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для интрадермального введения, в исполнении Volume STRONG

В составе:

- шприц одноразовый- 1 шт., наполненный 1 мл геля на основе гиалуроновой кислоты (30мг/мл).
- упор для пальцев- 1шт.
- игла одноразовая 27Gx1/2" (0,4x13мм)- 1шт.
- самоклеящаяся этикетка- 3 шт.
- инструкция по применению изделия- 1шт.

Назначение: для коррекции дефектов рельефа кожи, морщин, а также объемного моделирования мягких тканей

Область применения: для коррекции глубоких морщин, объемного моделирования лица, а также восполнения объемов мягких тканей (скуловая, подбородочная зона, виски и угол нижней челюсти)

Гель- имплантат Revitajal нельзя использовать:

- * в виде инъекций в кровеносные сосуды;
- * для увеличения груди, инъекций в кости, сухожилия, связки и мышцы

Противопоказано использование геля- имплантата Revitajal пациентам:

- * со склонностью к появлению гипертрофических рубцов, пигментных пятен, шрамов.
- * пациентам с предшествующими аутоиммунными заболеваниями и тем, которые проходят курс иммунодепрессивной терапии
- * при острых видах аллергии или при воспалительных процессах;
- * при нарушениях свертываемости крови;
- * при повышенной чувствительности к ингредиентам гиалуроновой кислоты

Противопоказано использование данного препарата беременным и кормящим грудью женщинам, и также пациентам до 18 лет


LOT 1374218
18.07.2018
07.2020

Medical Device **CE** 0373 **STERILE A** **STERILE I** **REF** 40026 **5°C** **25°C**

I.R.A. Istituto Ricerche Applicate Srl
via del Lavoro 4a/6
20865 Usmate Velate (MB) Italy

графическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для
интрадермального введения
в исполнении Volume STRONG

Маркировка картонной коробки

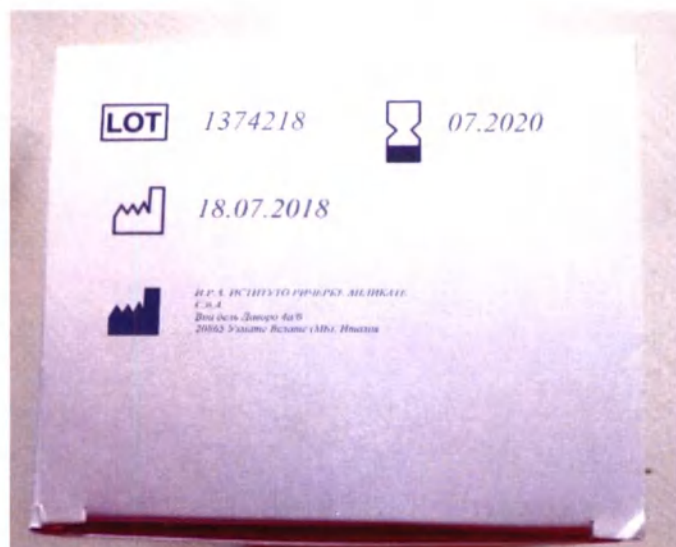

рафическое изображение МИ Гель- имплантат Revitajal на основе гиалуроновой кислоты для интрадермального введения в исполнении Volume STRONG





И. Кисель

[Handwritten signature]

Служба и продукция
44/срок 4 е. 0611
100 дирекция