


«УТВЕРЖДЕНО»

Генеральный директор

ООО «СИМКО БИОТЕК»



Баулина С.А.

3 декабря 2019 г.

Фотографические изображения

медицинского изделия


**«Одноразовое сверло для пина для
фиксации мембран**

Frios Disposable Drill for Membrane Tacks»


Изображение изделия



Изображение изделия в первичном стерильном и вторичной нестерильном блистере

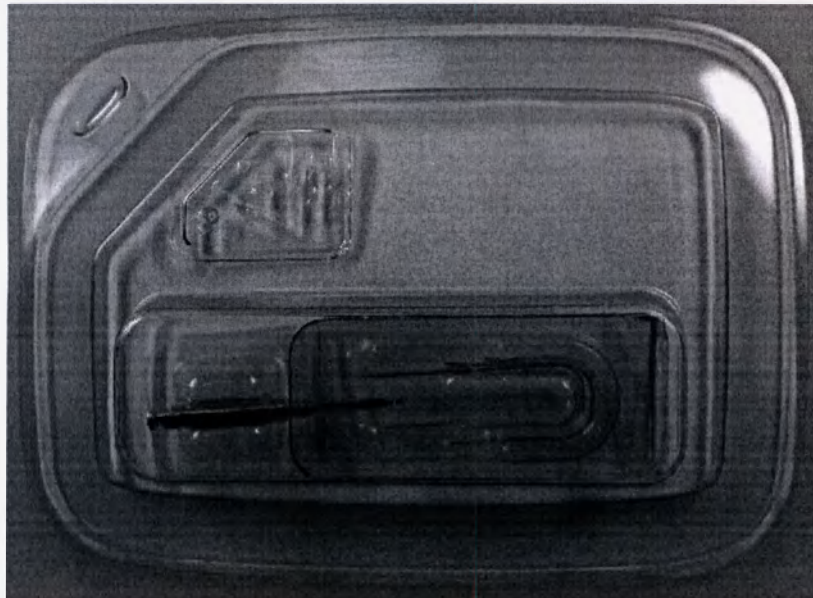


Коробка

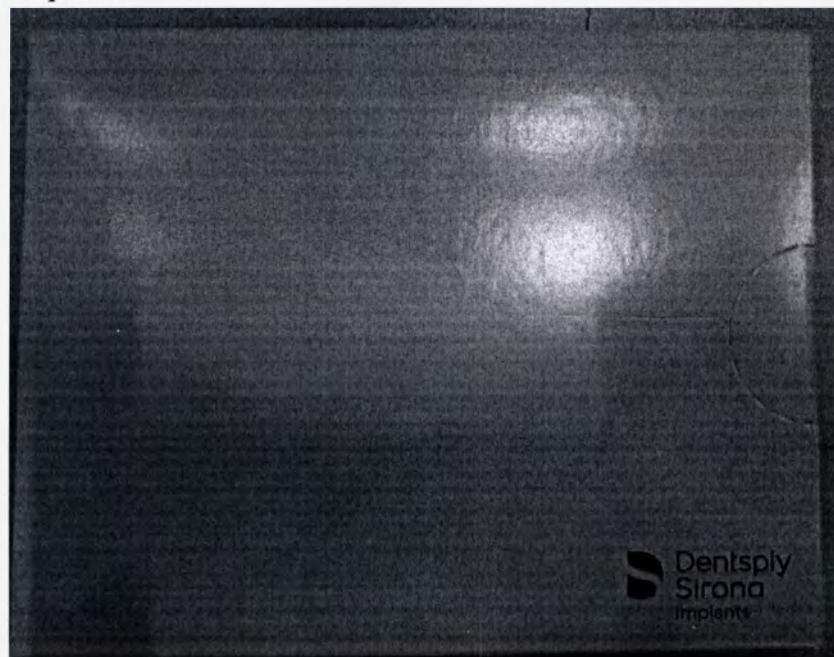

Макет основной маркировки медицинского изделия (наносится на оборотную сторону вторичного блистера и на коробку).



Макет маркировки медицинского изделия, содержащий информацию на русском языке:

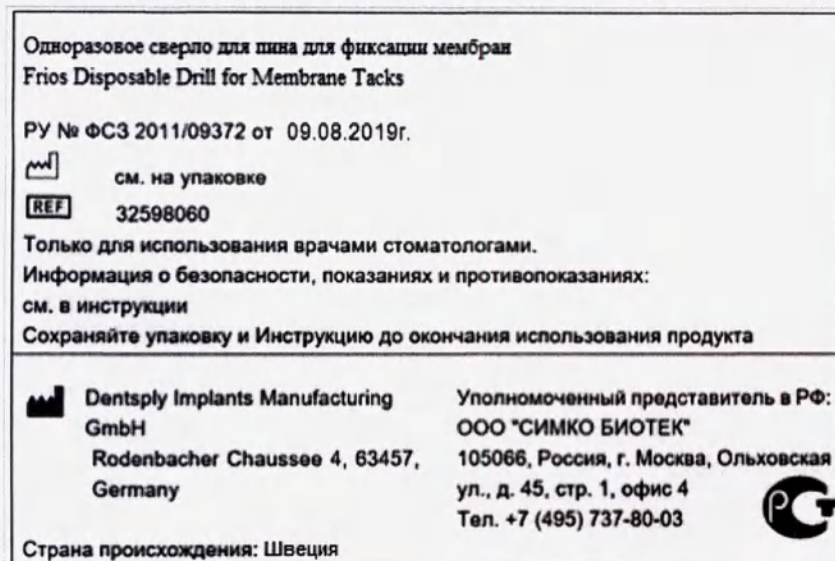

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
3 листов.

Дата 03.12.2019.

Генеральный директор

Байраков С.А.
С.И.

