

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
«ООО» ДИКСИОН




Фотографические изображения
медицинского изделия
Стол операционный офтальмологический с принадлежностями,
варианты исполнения DIXION ET200, DIXION MT500

1. Стол операционный. 2. Подголовник (при необходимости).


Подголовник


Стол операционный

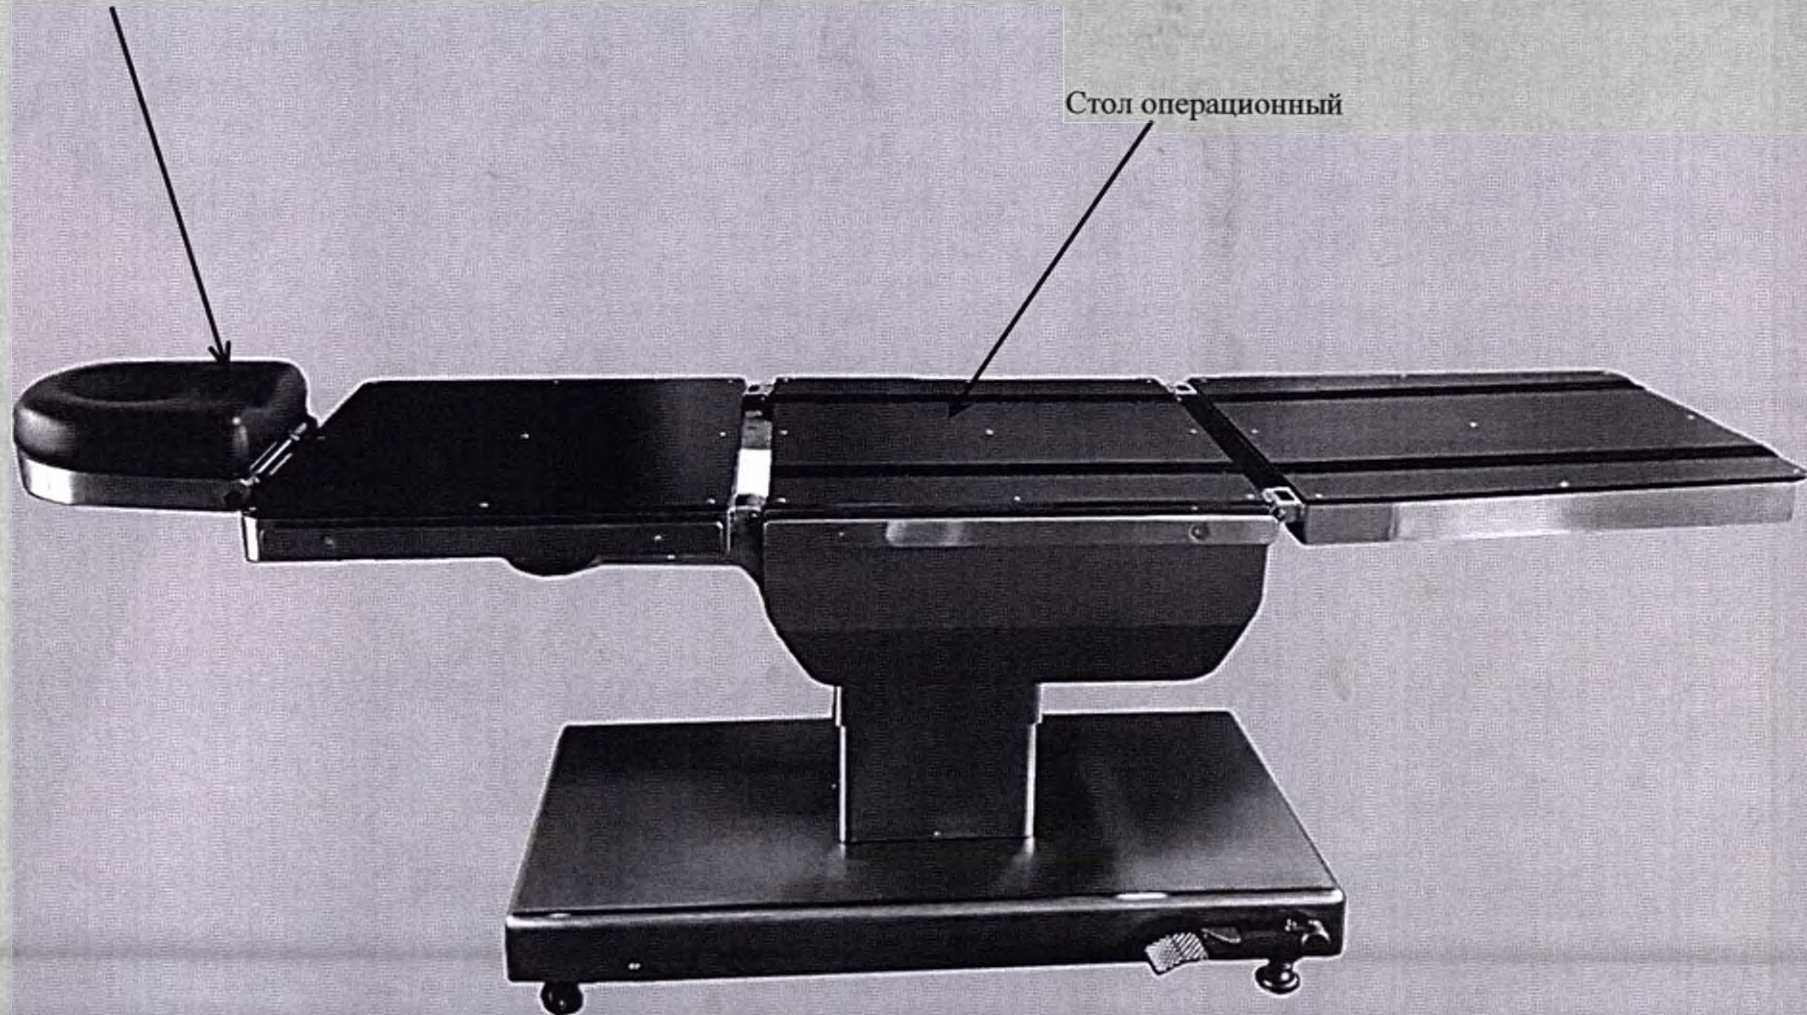








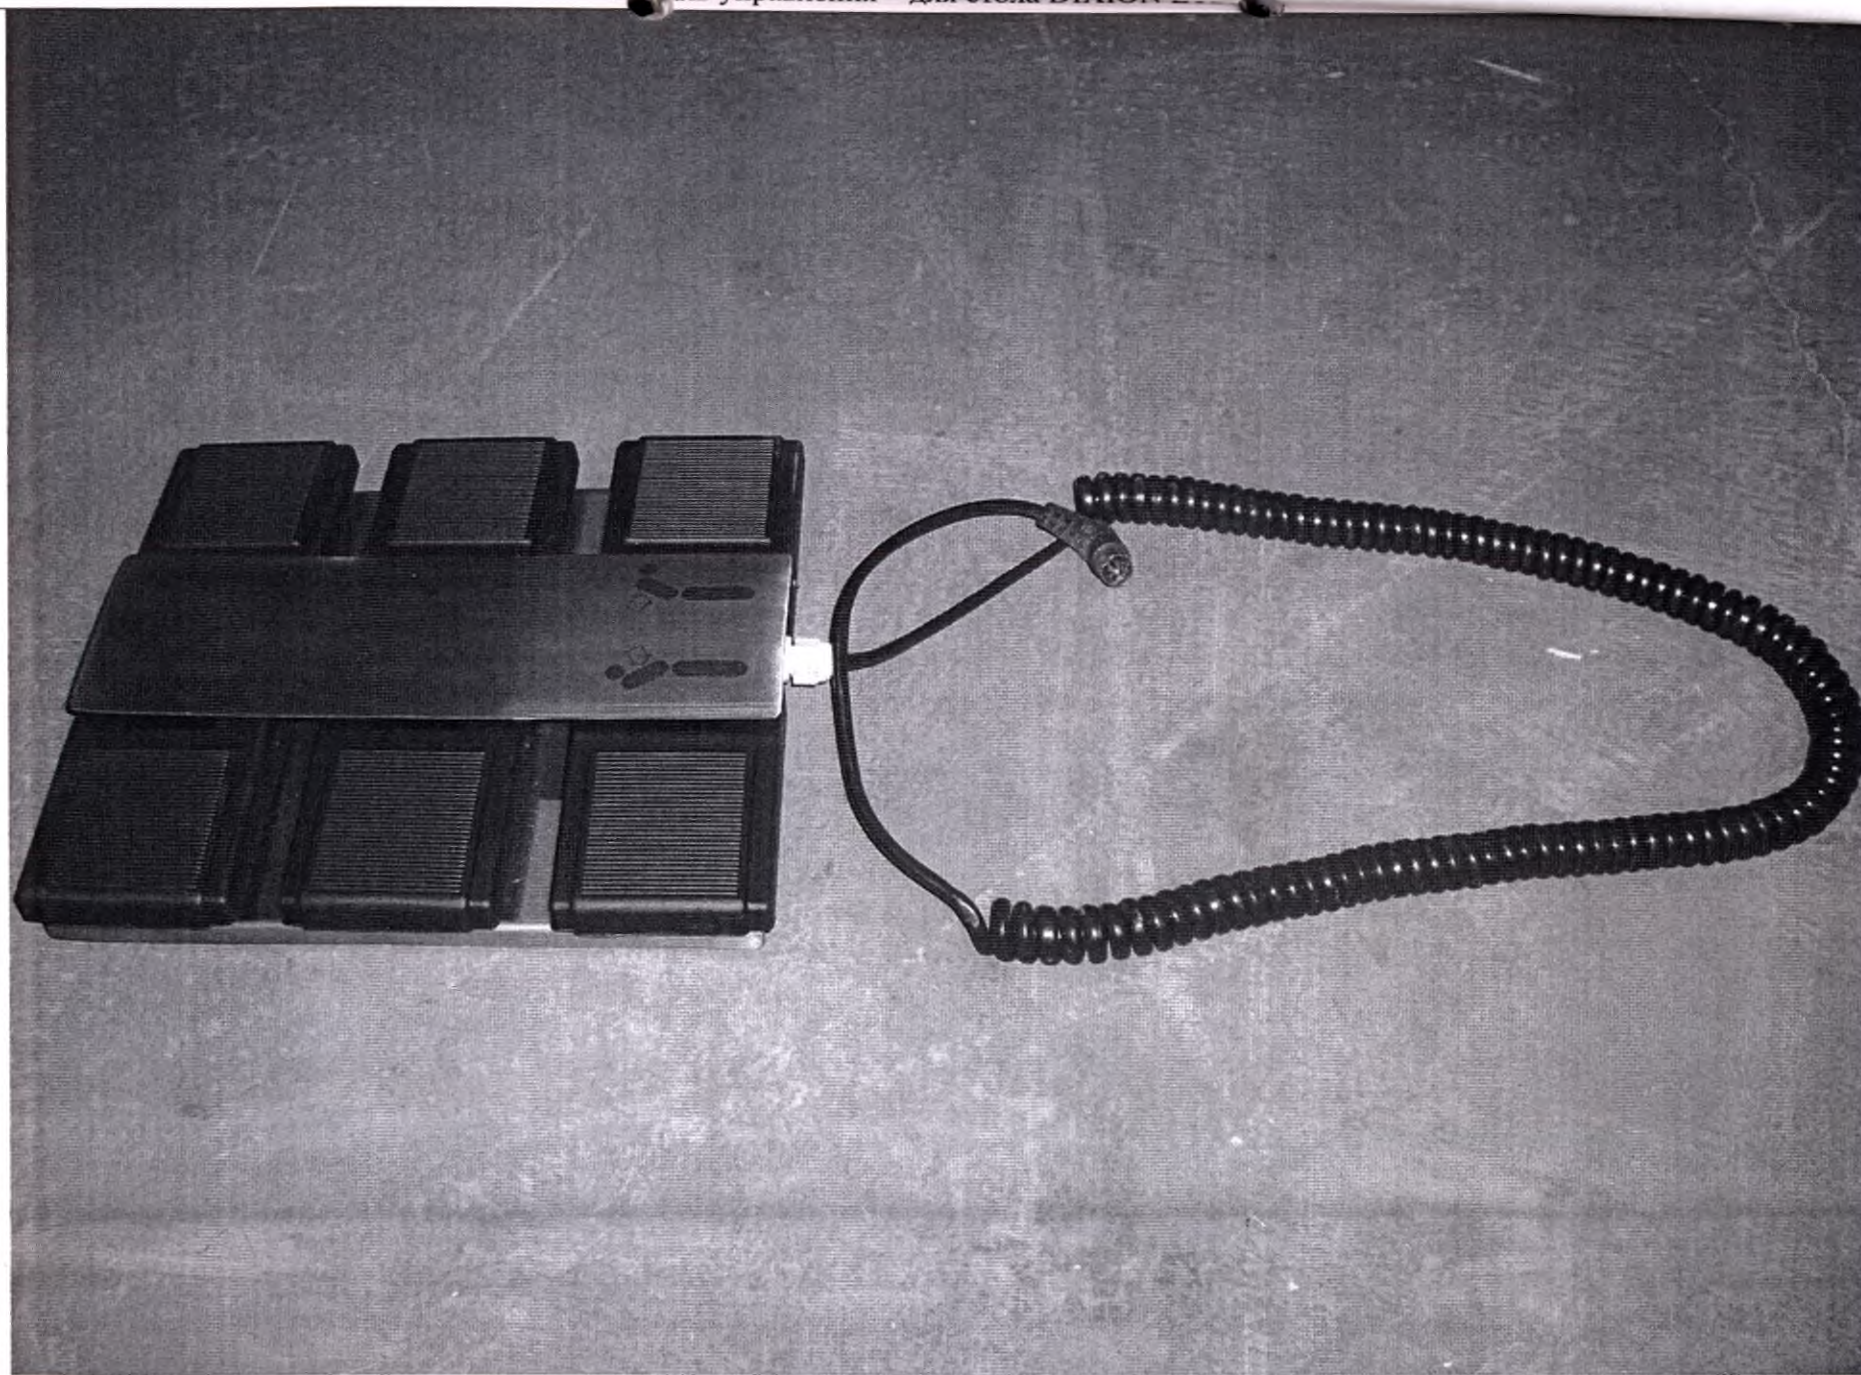

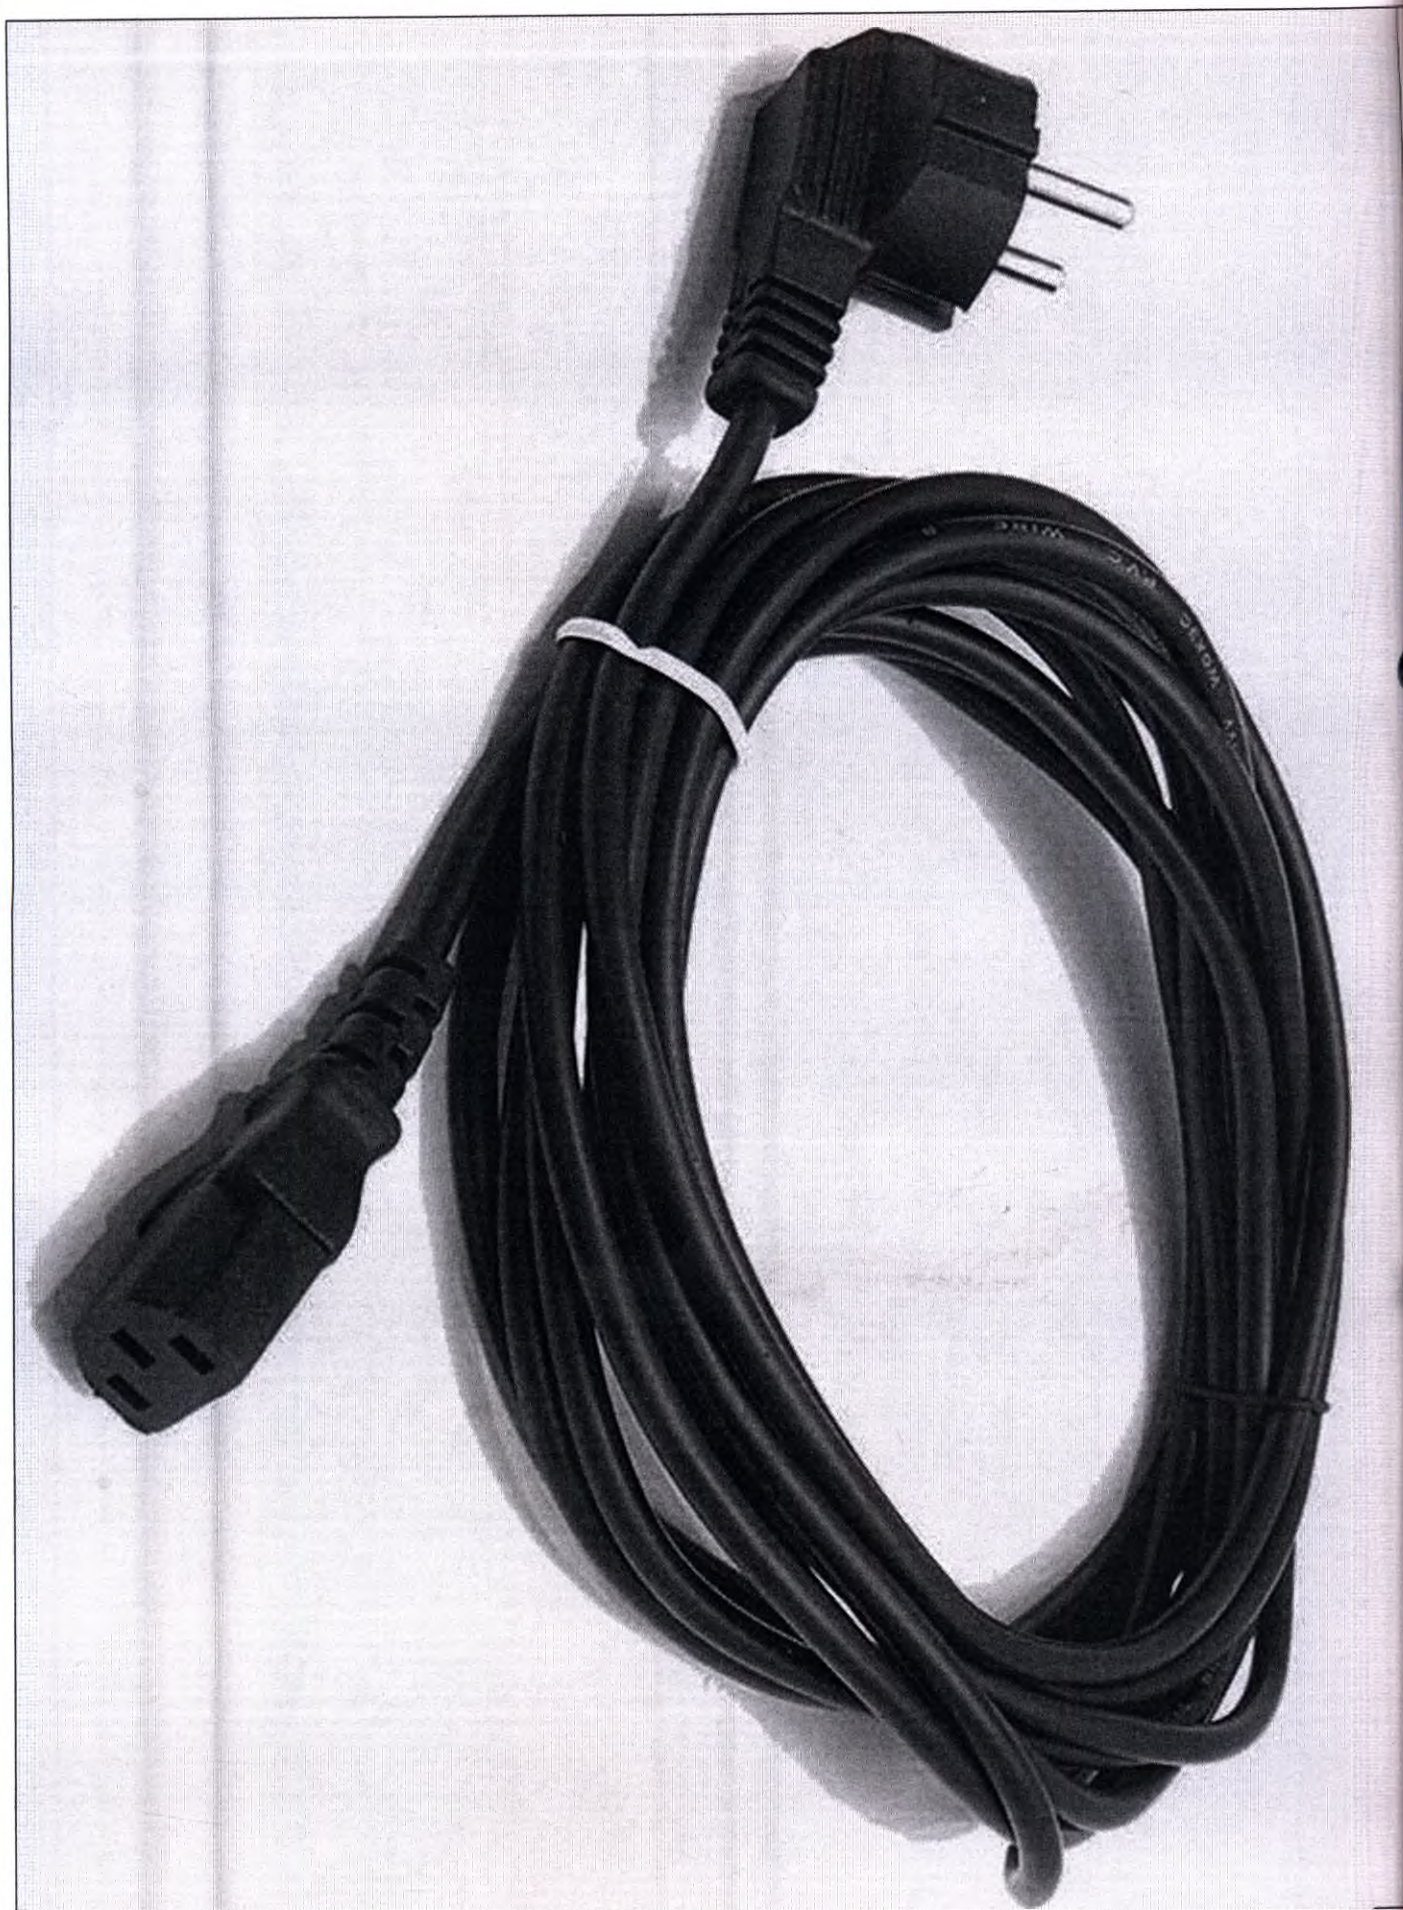


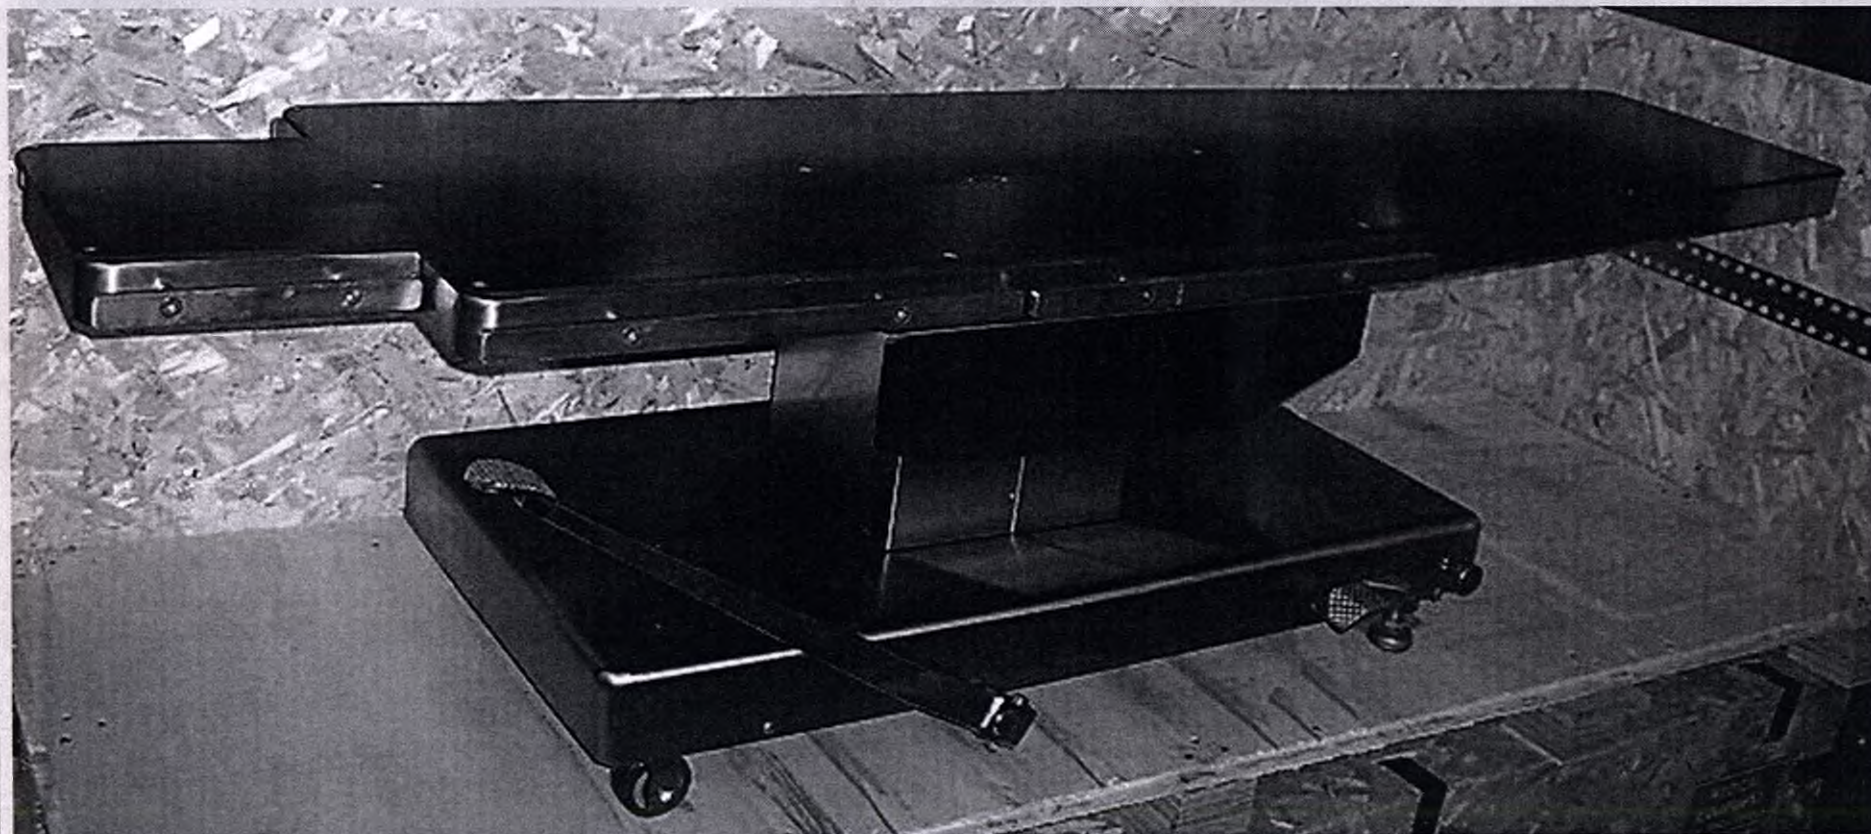

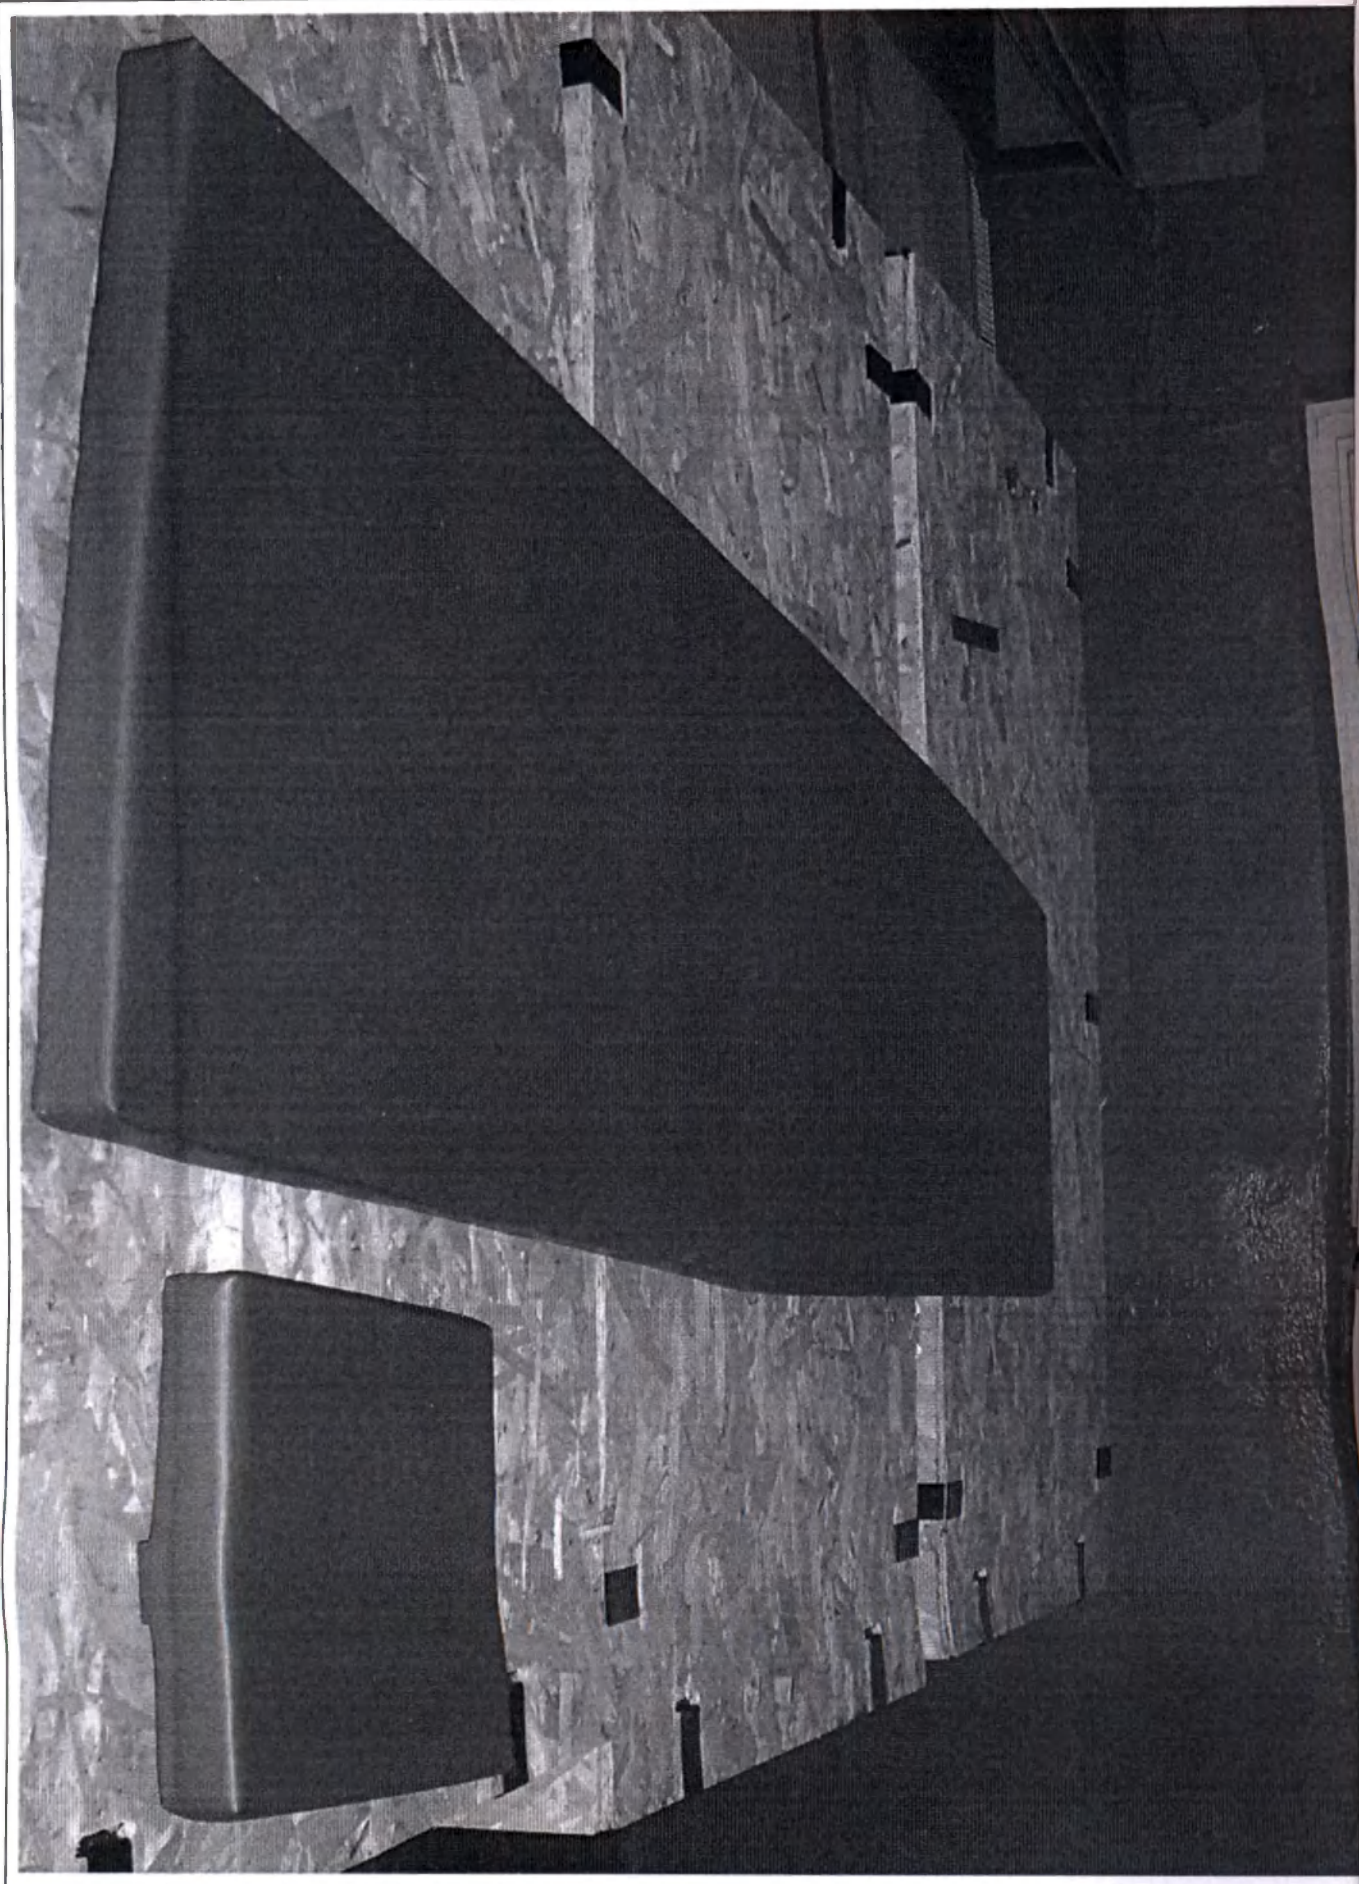

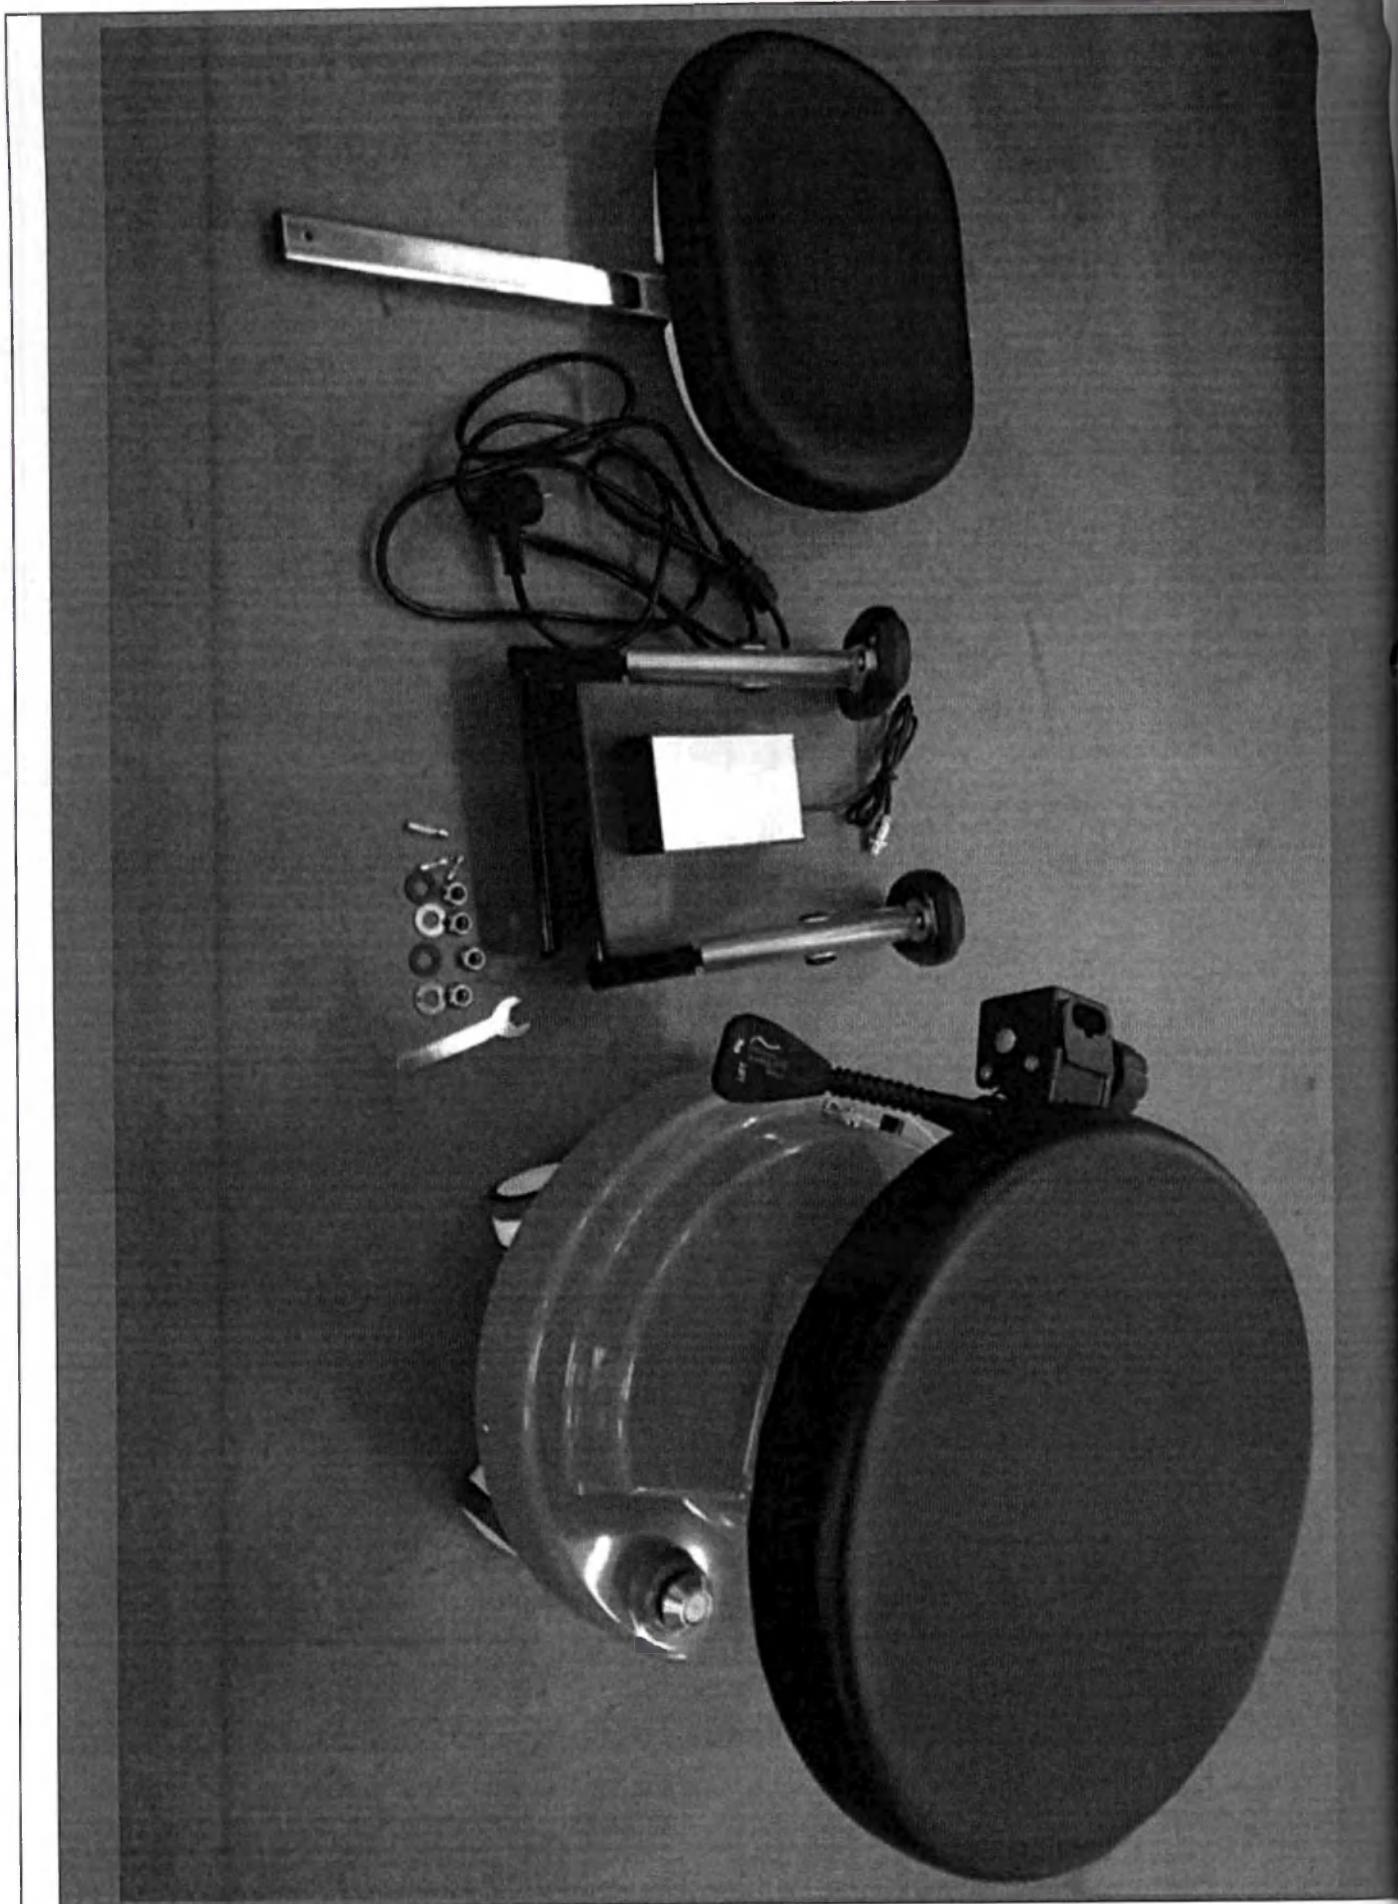





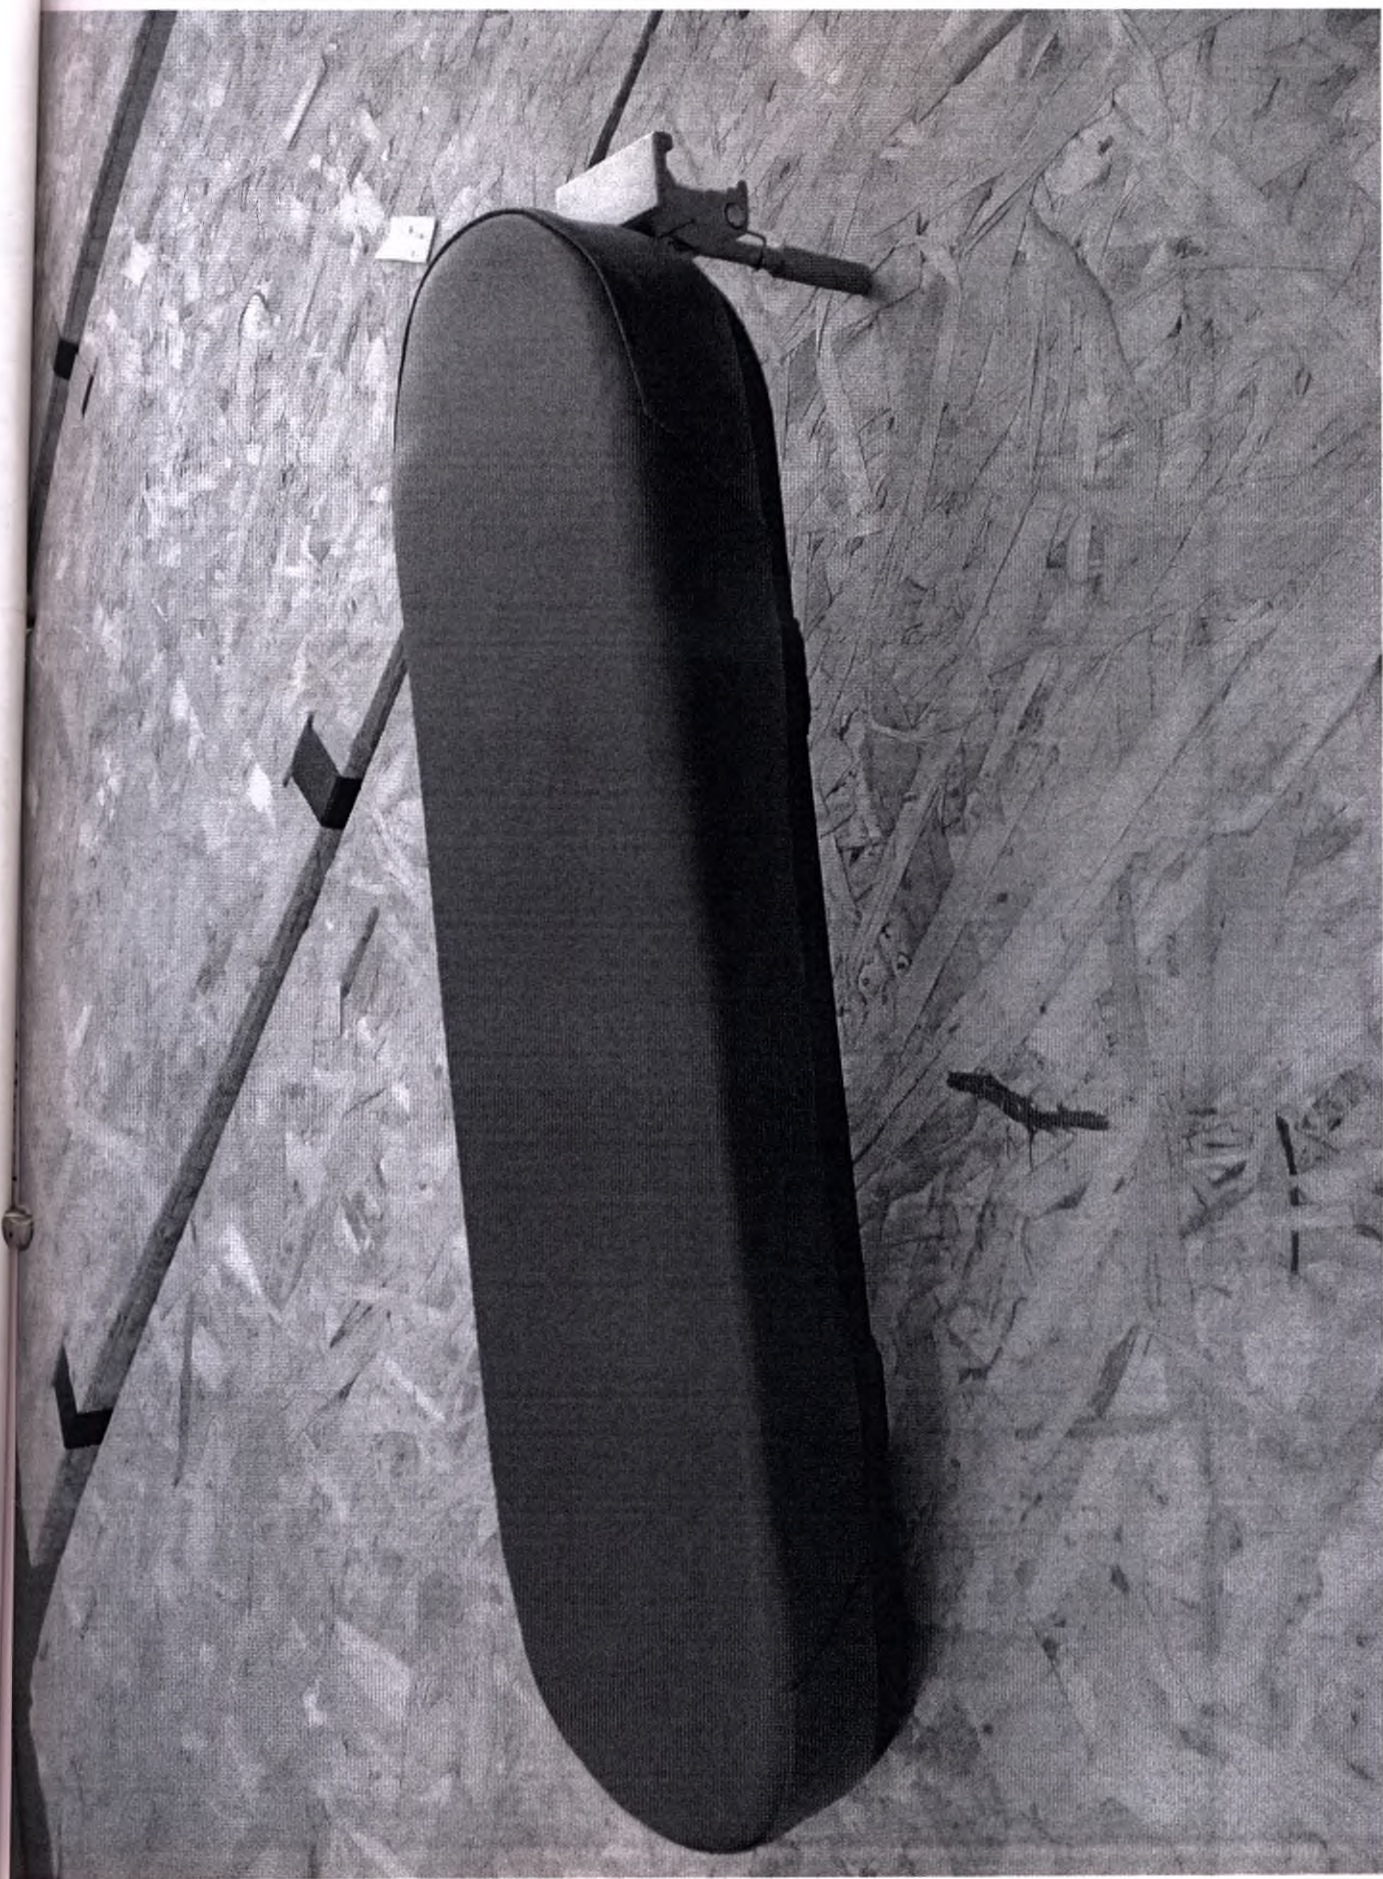








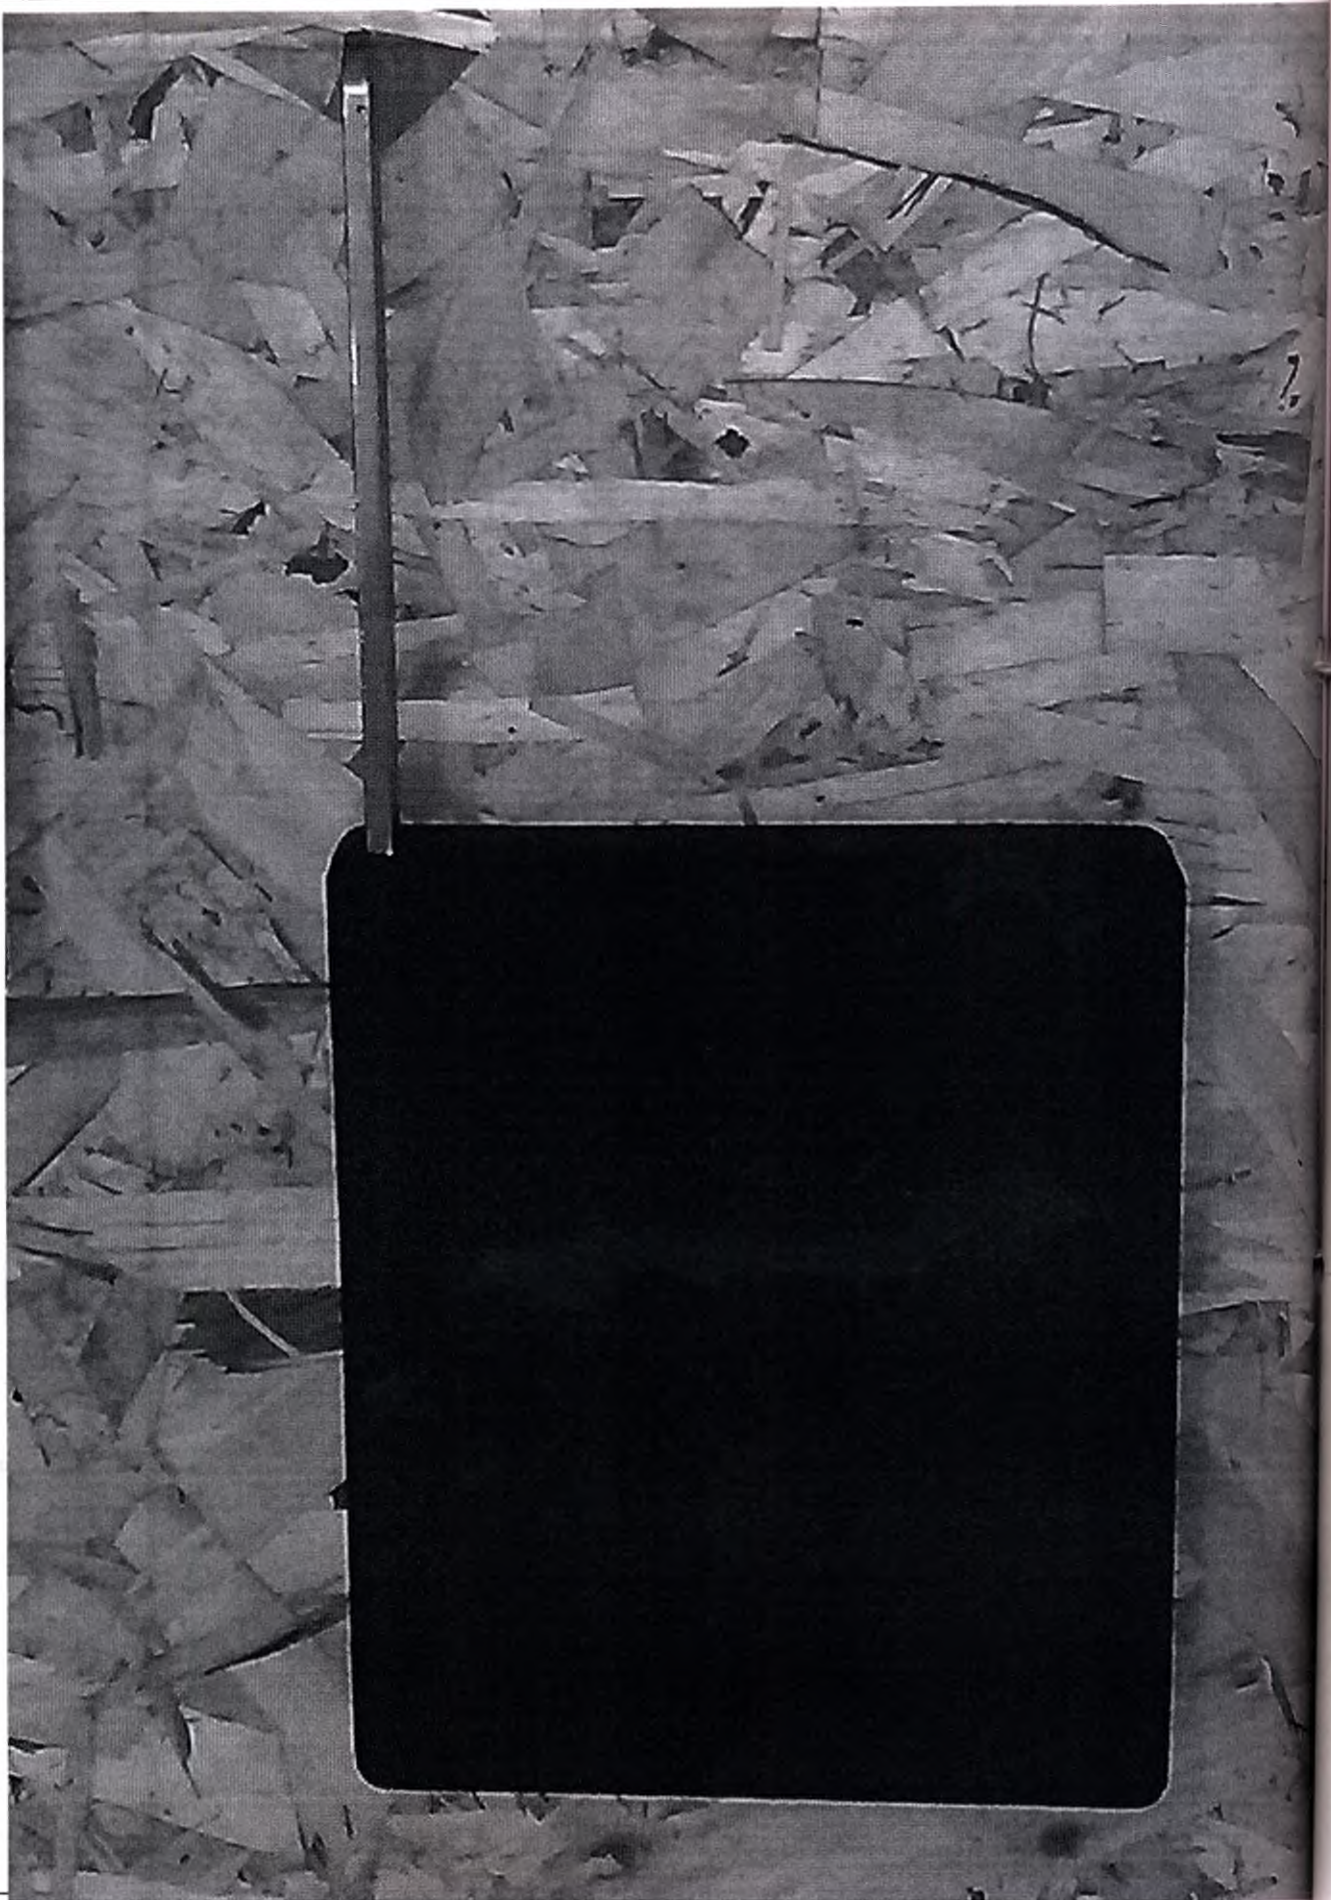

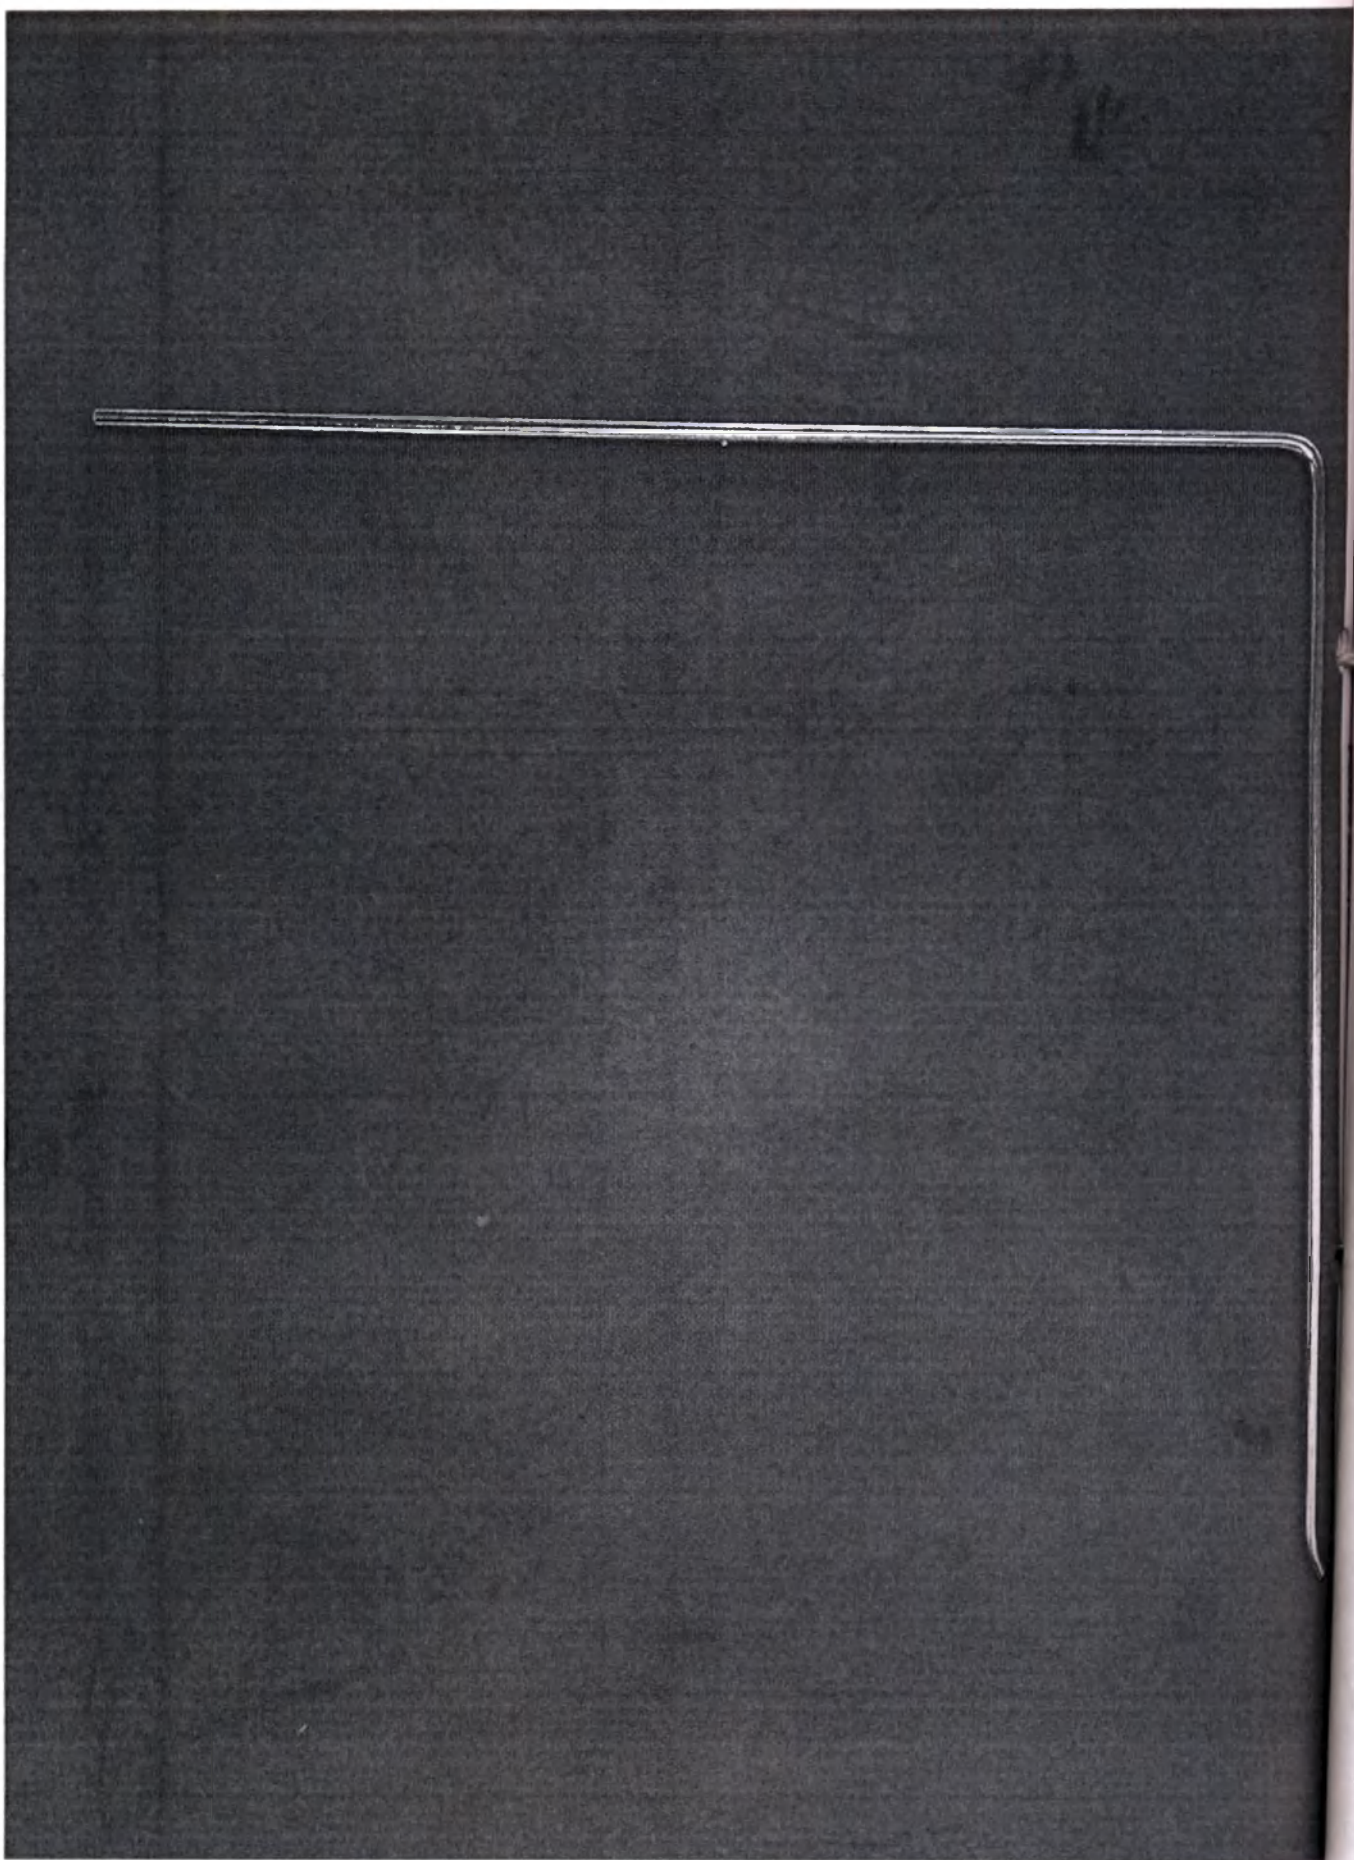

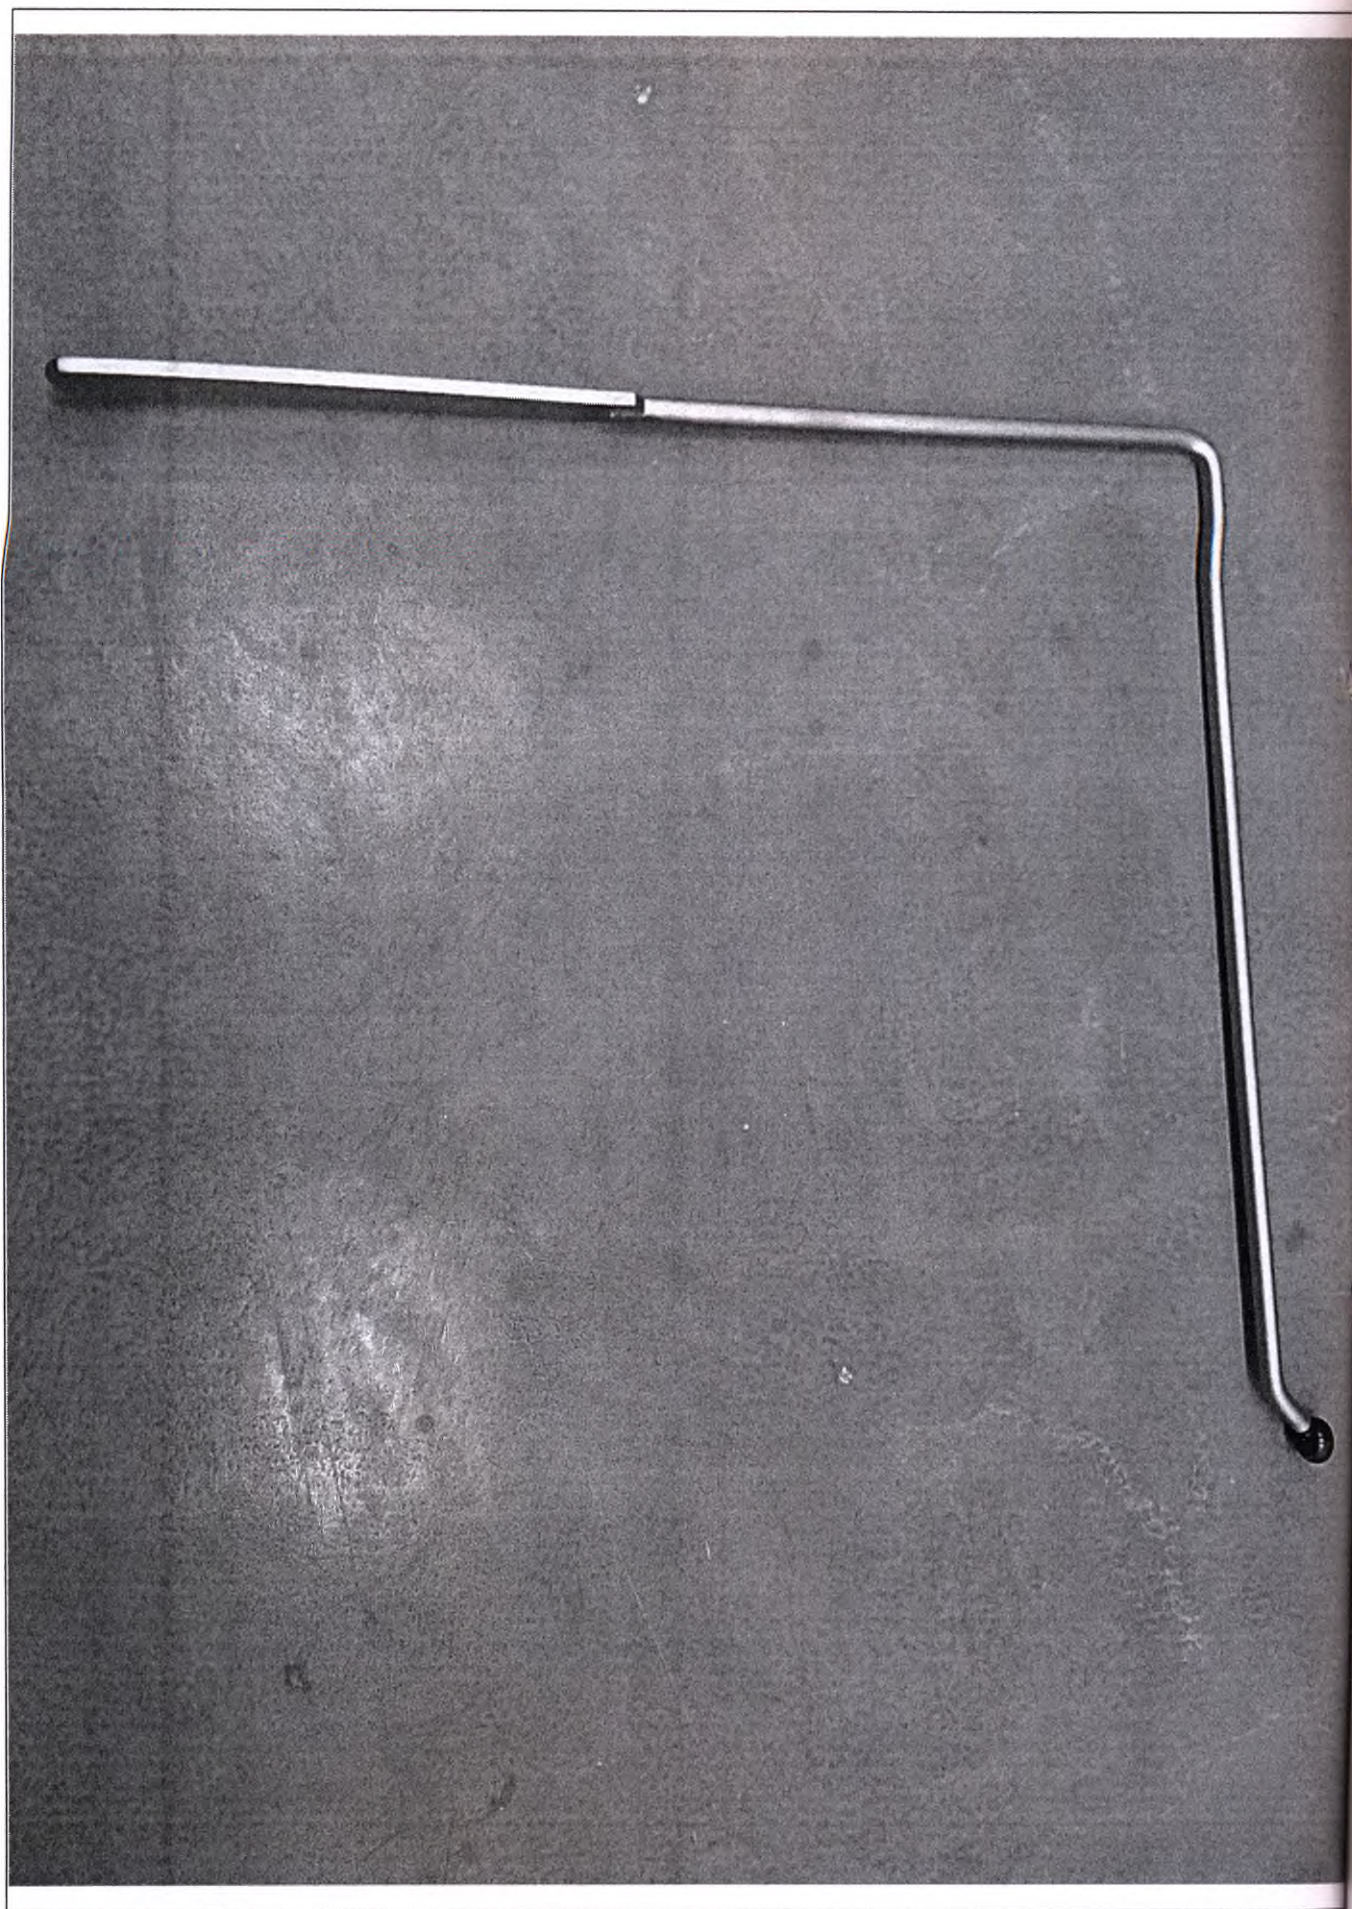

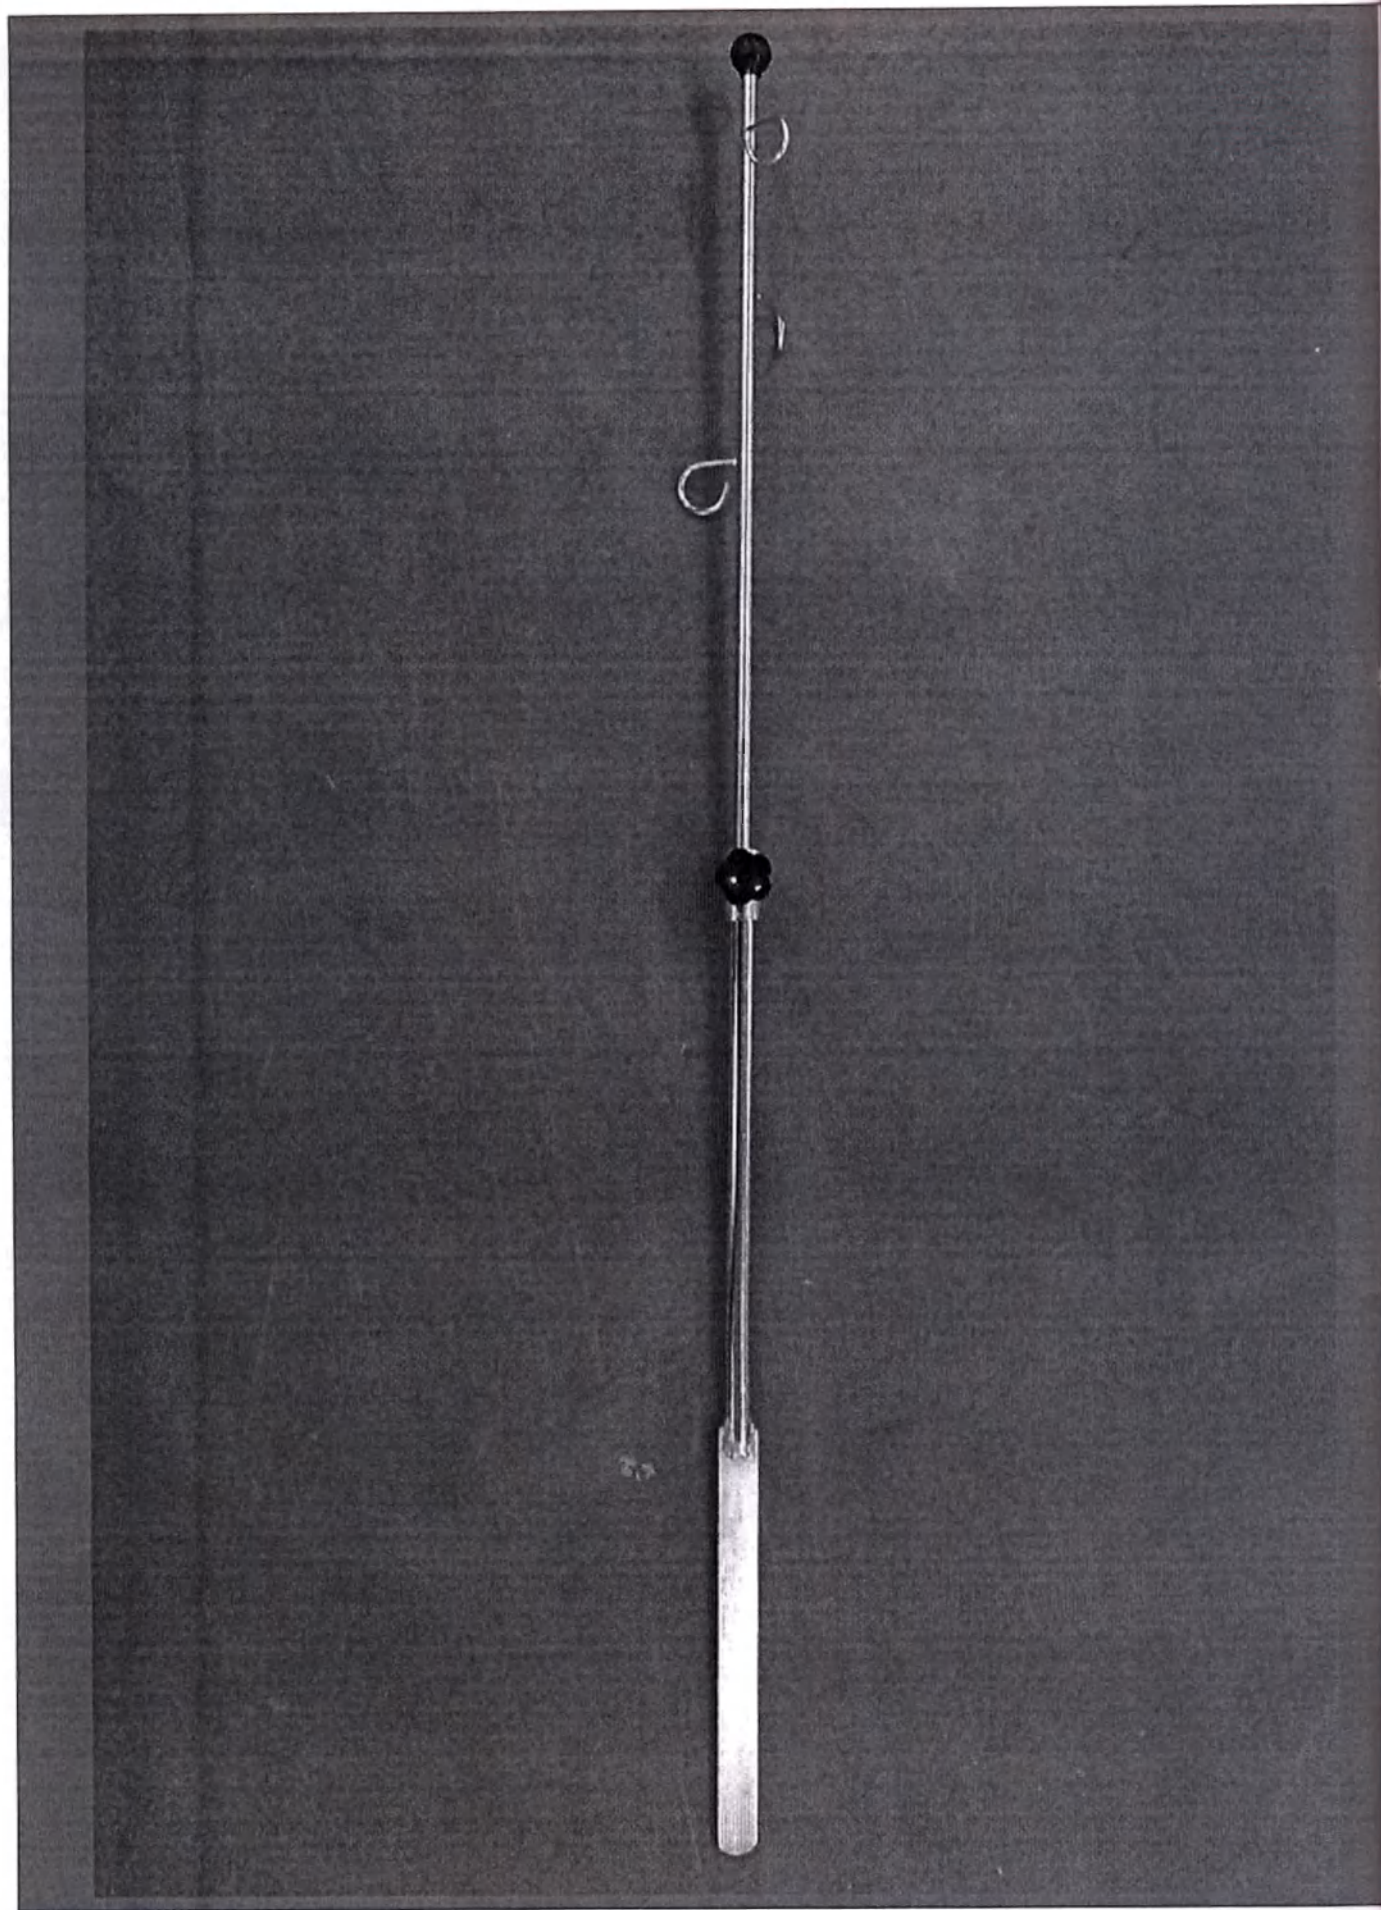

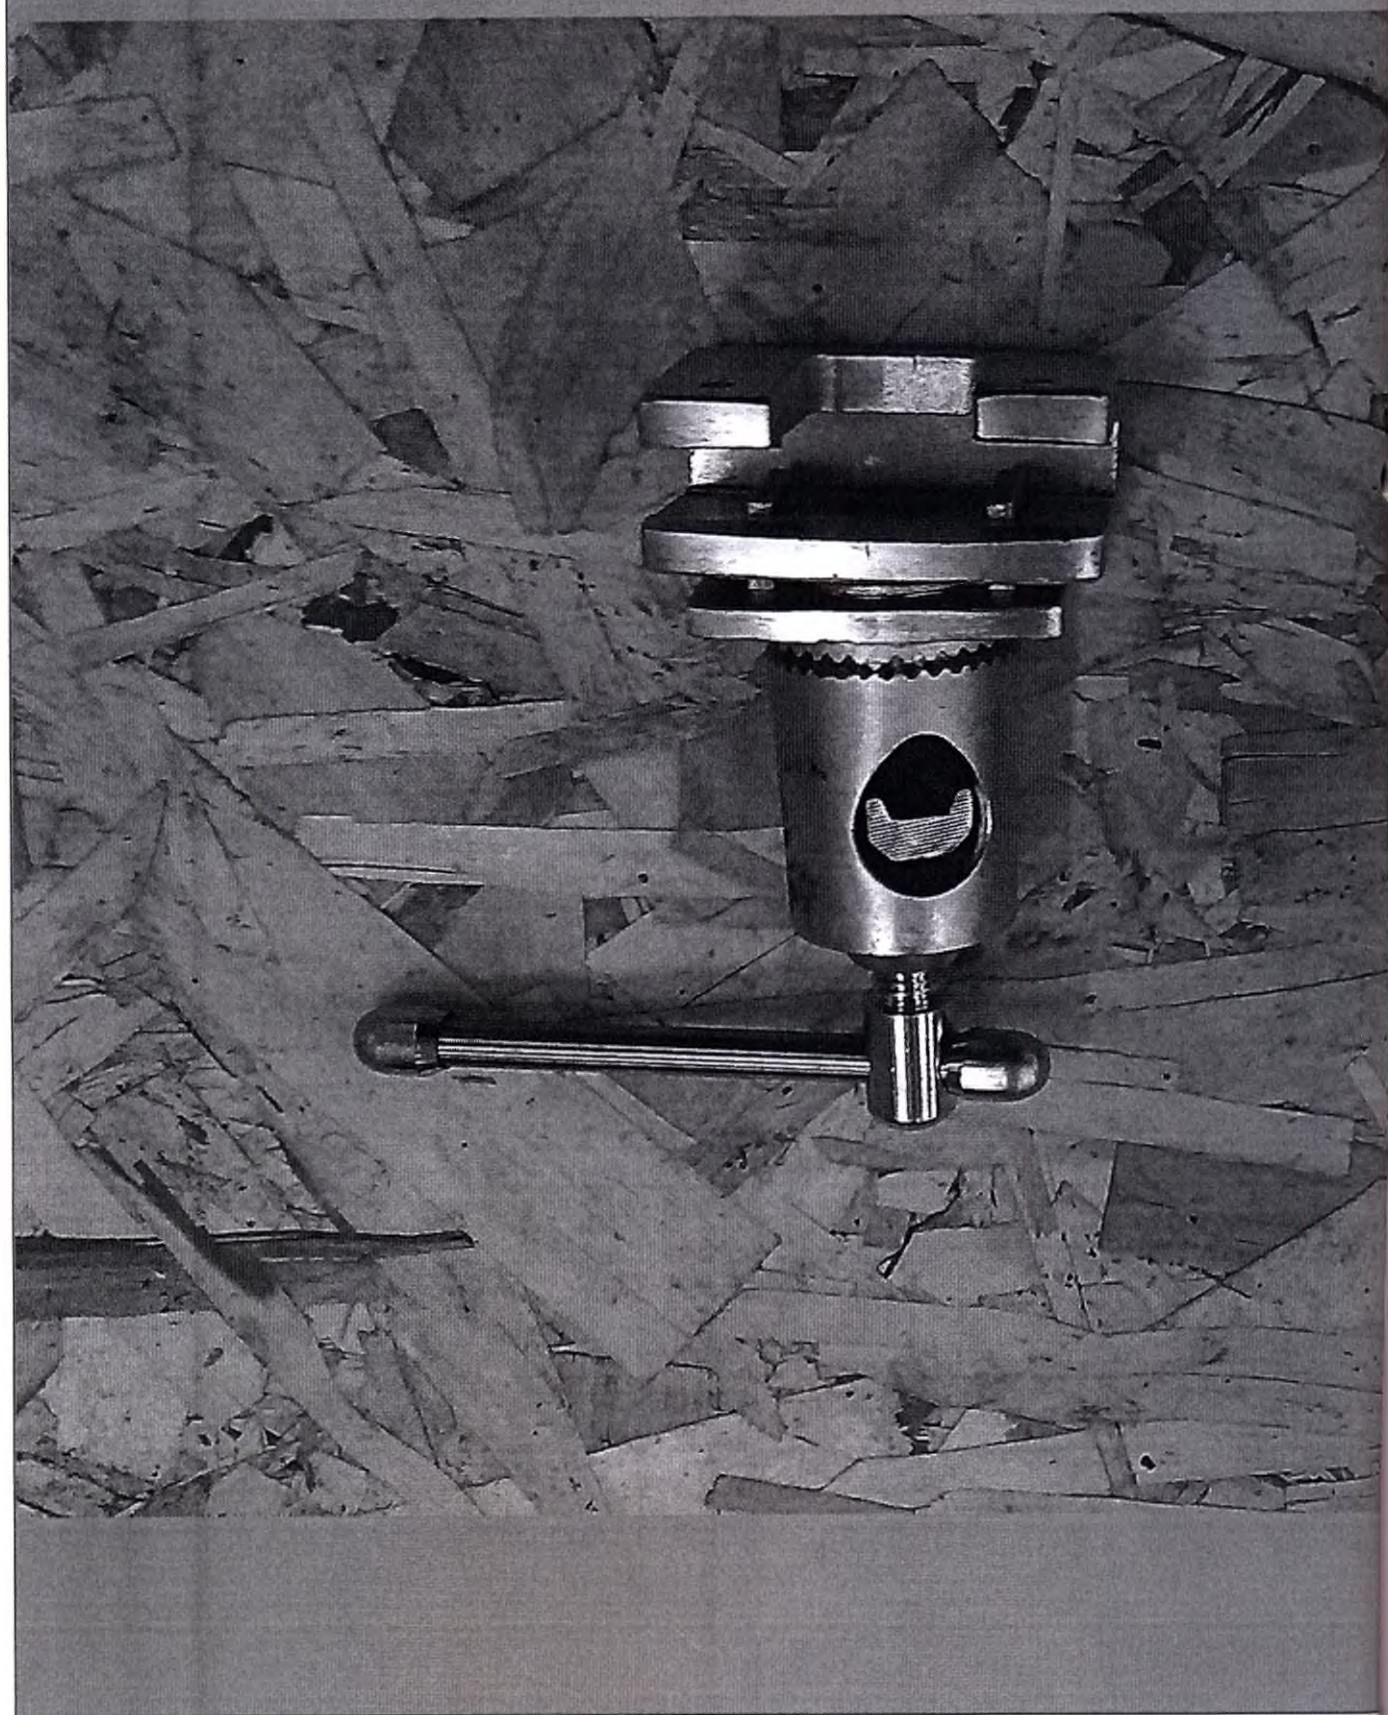

















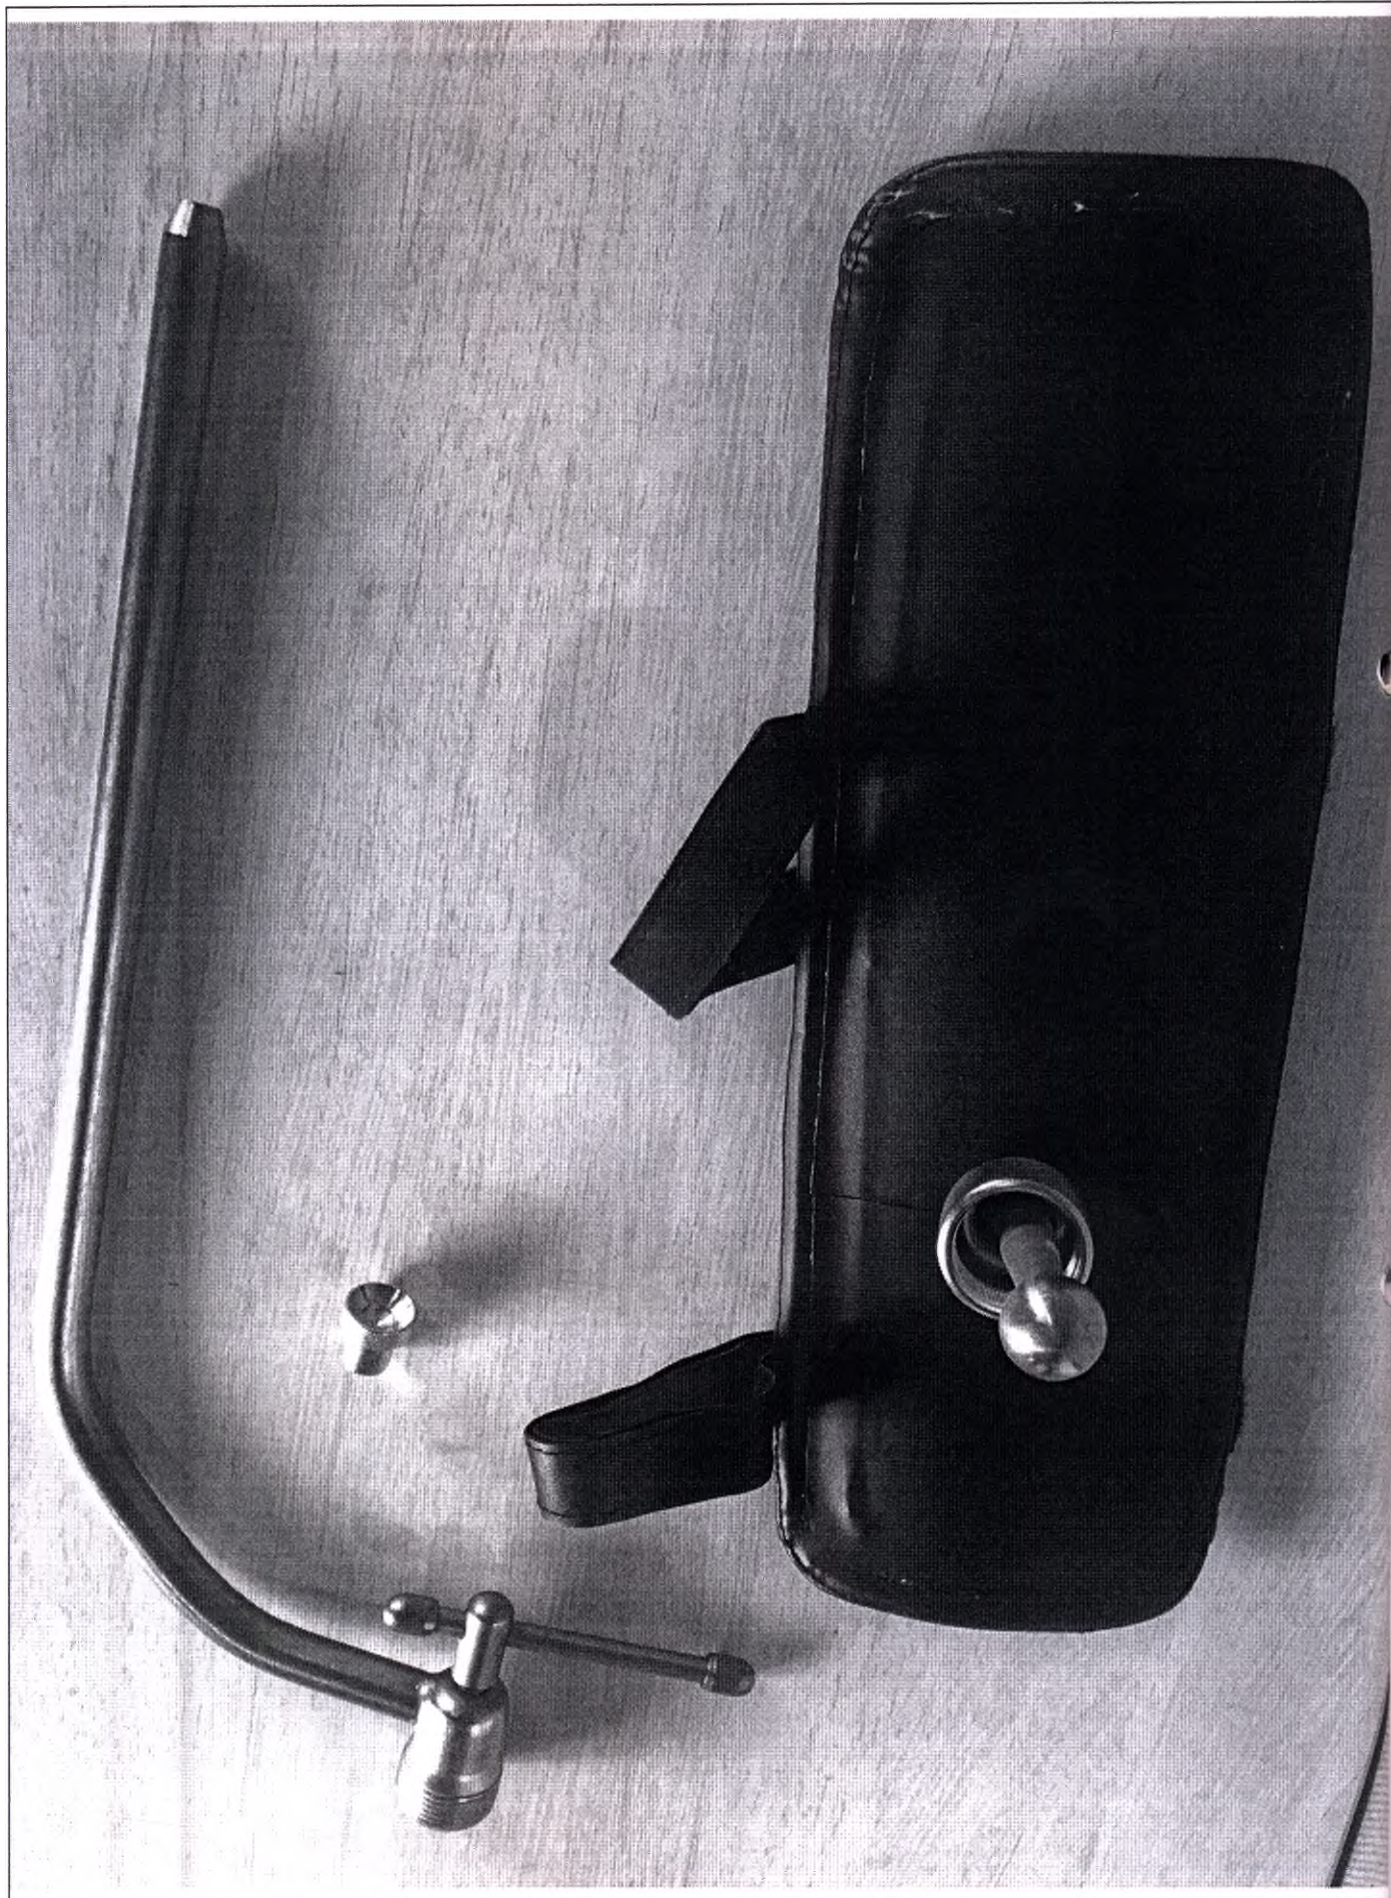








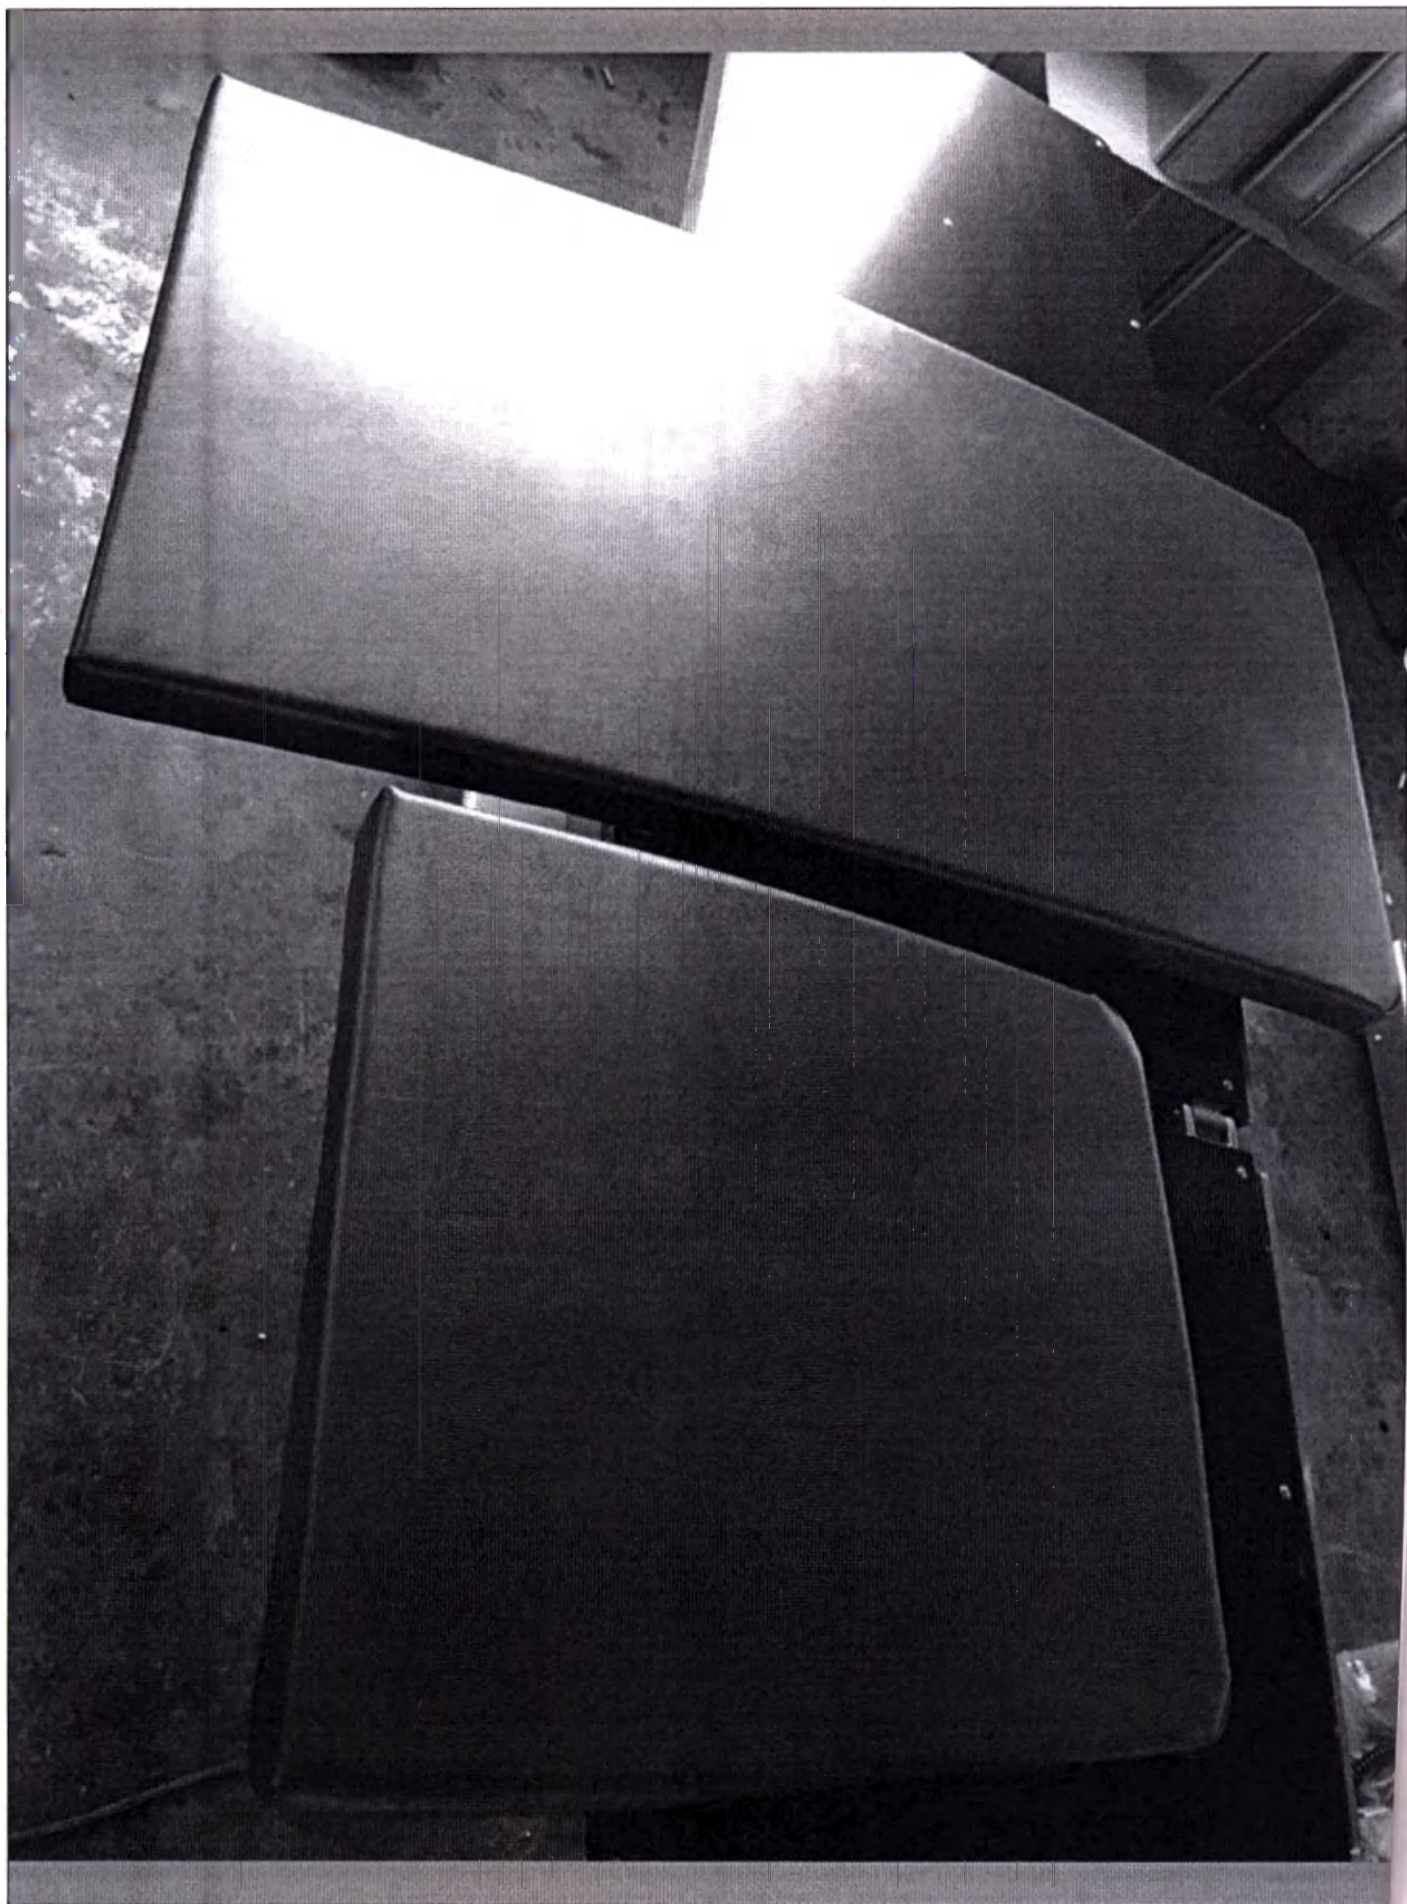

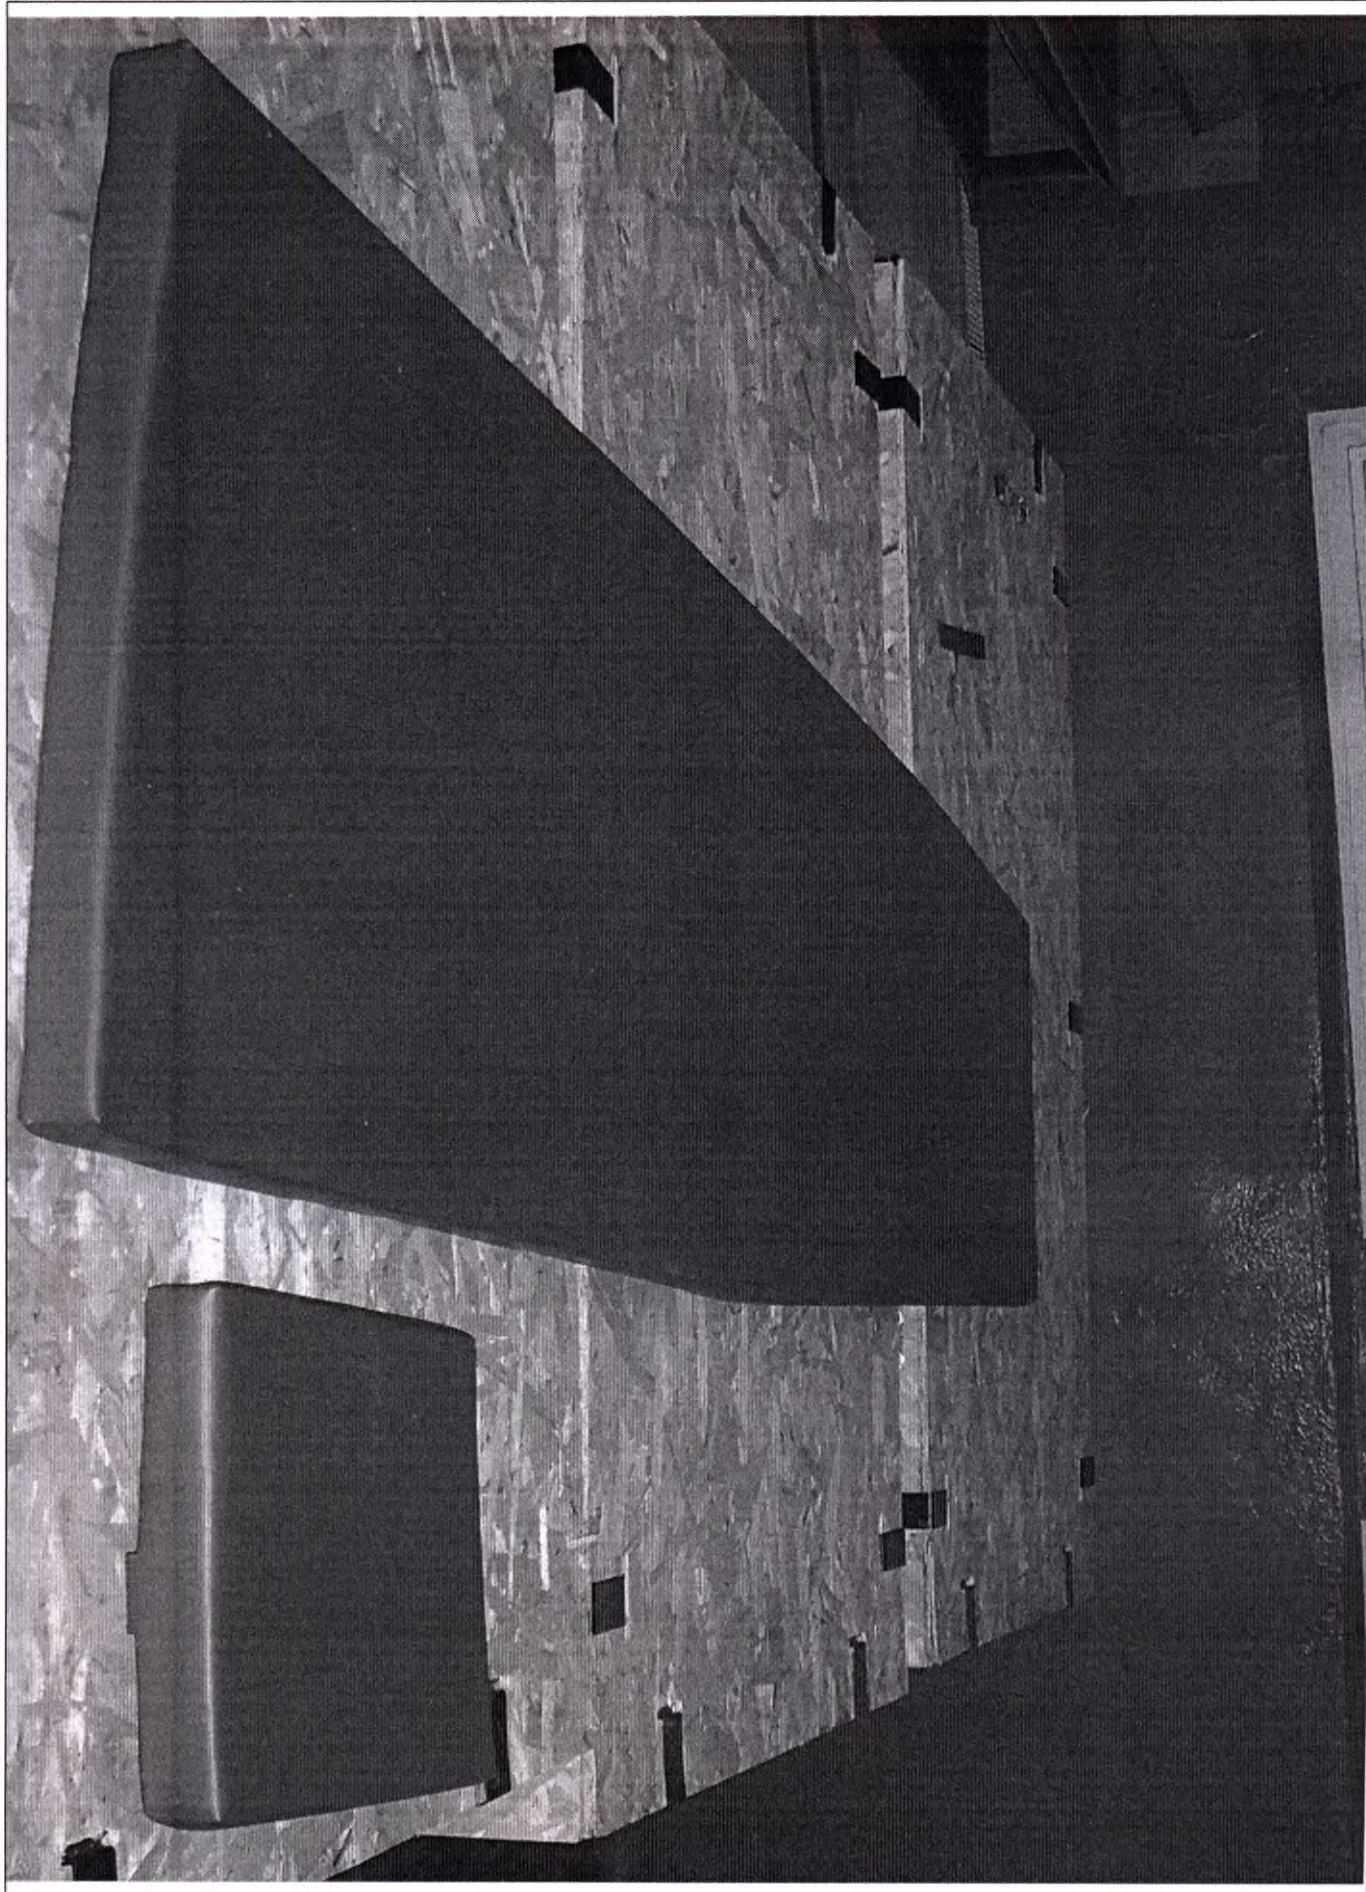



OT3.3-12
(12V3.3Ah/20HR)



Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery


CHARGING INSTRUCTION

AT 25°C

Application	Voltage Regulation	Initial Current
Floating use	13.6-13.8V	Less than 0.99A
Cycle use	14.5-14.9V	

WARNING

- Risk of fire, explosion, or burns.
- Do not short the battery terminal.
- Do not disassemble, heat above 40°C, or incinerate.



ZHANGZHOU HUAWEI POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.

Panasonic

阀控式铅酸蓄电池

Valve Regulated Lead-Acid Battery

Model No. **UP-RW1245ST1** (12V, 7.8Ah/20HR)

定电压充电电压值

Constant Voltage Charge Voltage regulation

涓流用 Standby use: 13.6V~13.8V (25°C)


注意 CAUTION

- 不可在密闭容器中充电
Do not charge in a gas tight container.
- 电池各端子间不可短路
Do not short the battery terminals.
- 不可放入火中等 Do not incinerate.
- 如身体不慎附着电解液(酸)的话, 请用水冲洗
Flush with water at once if contact is made with electrolyte (Acid).
- 不可对本蓄电池进行分解、改造
Do not attempt to disassemble the battery.

松下蓄电池(沈阳)有限公司


原产地: 中国

Panasonic Storage Battery (Shenyang) Co., Ltd.
Made in China

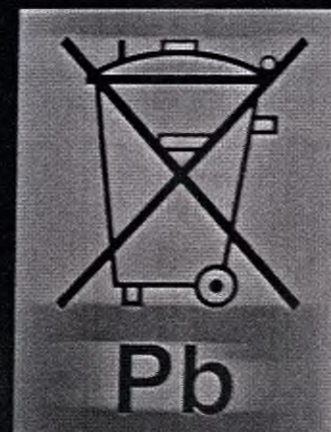

工业产品生产许可证编号:
XK06-006-00420



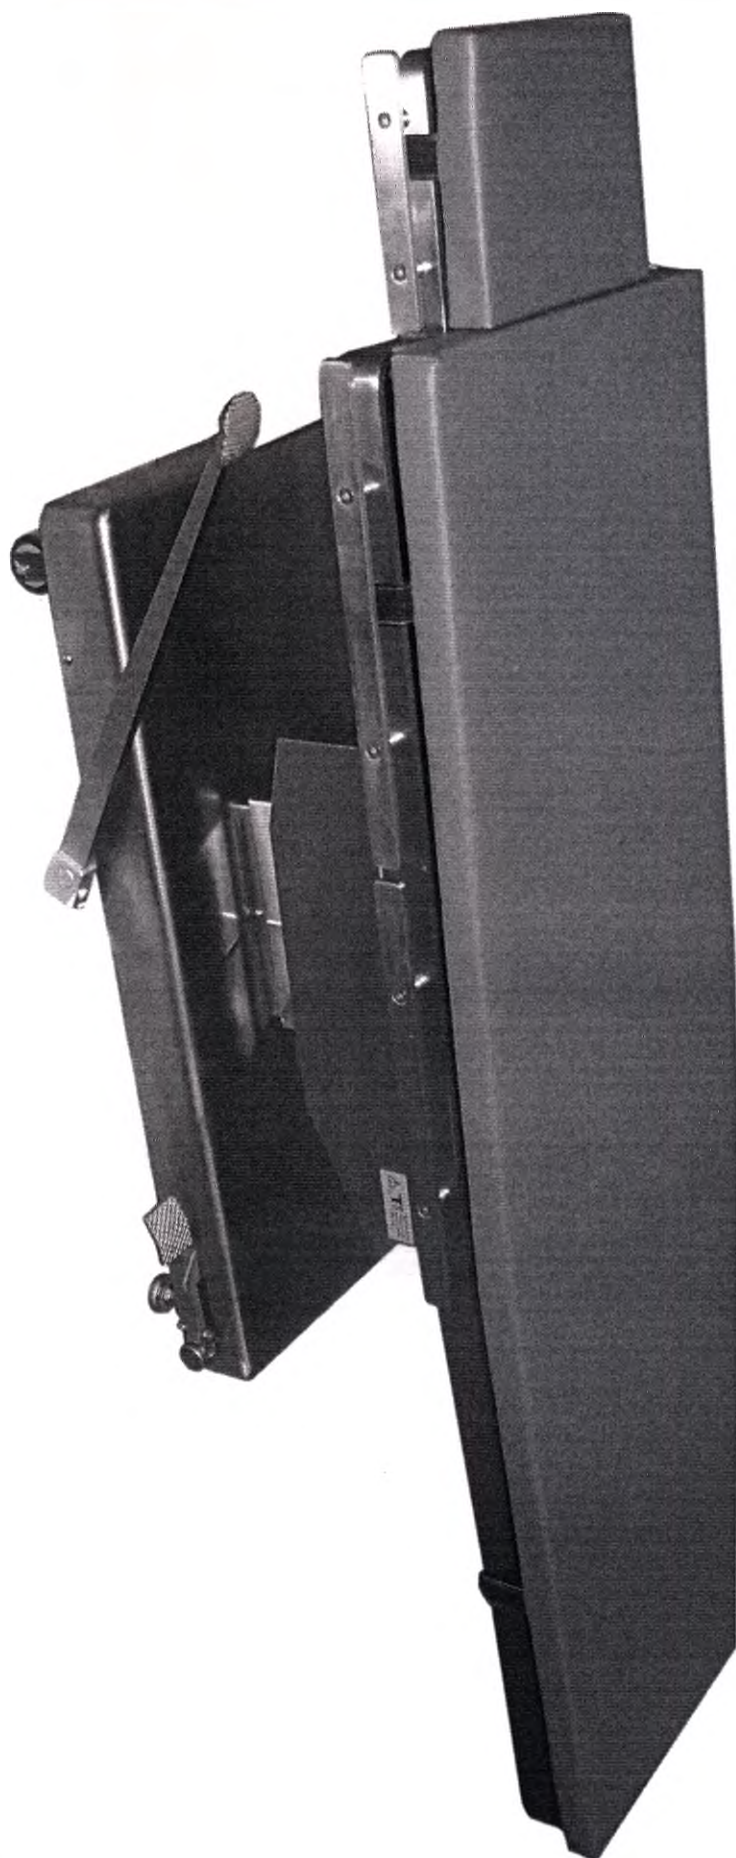

Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено подписью и
печатью. 35 листов

ООО «ДИКСИОН»
Яковлев Алексей
Александрович

