

Фотографические изображения медицинского изделия:
«Центрифуга лабораторная медицинская настольная «Armed» в вариантах исполнения»

производство: Zenith Lab (Jiangsu) Co., Ltd., China («Зенит Лаб (Цзянсу) Ко., Лтд.», Китай)

Генеральный директор
(должность)

(подпись и печать)

(А.М. Леонтьев)
(И.О. Фамилия)

от имени Общества с ограниченной ответственностью «МЕДИМПОРТ» (ООО «МЕДИМПОРТ»)
(наименование организации-заявителя)



Содержание:

- I. Центрифуга лабораторная медицинская настольная «Armed», вариант исполнения LC-04B, в составе;
- II. Центрифуга лабораторная медицинская настольная «Armed», вариант исполнения LC-04A, в составе;
- II. Центрифуга лабораторная медицинская настольная «Armed», вариант исполнения HC-12C, в составе.

I. Центрифуга лабораторная медицинская настольная «Atmed», вариант исполнения LC-04B, в составе:

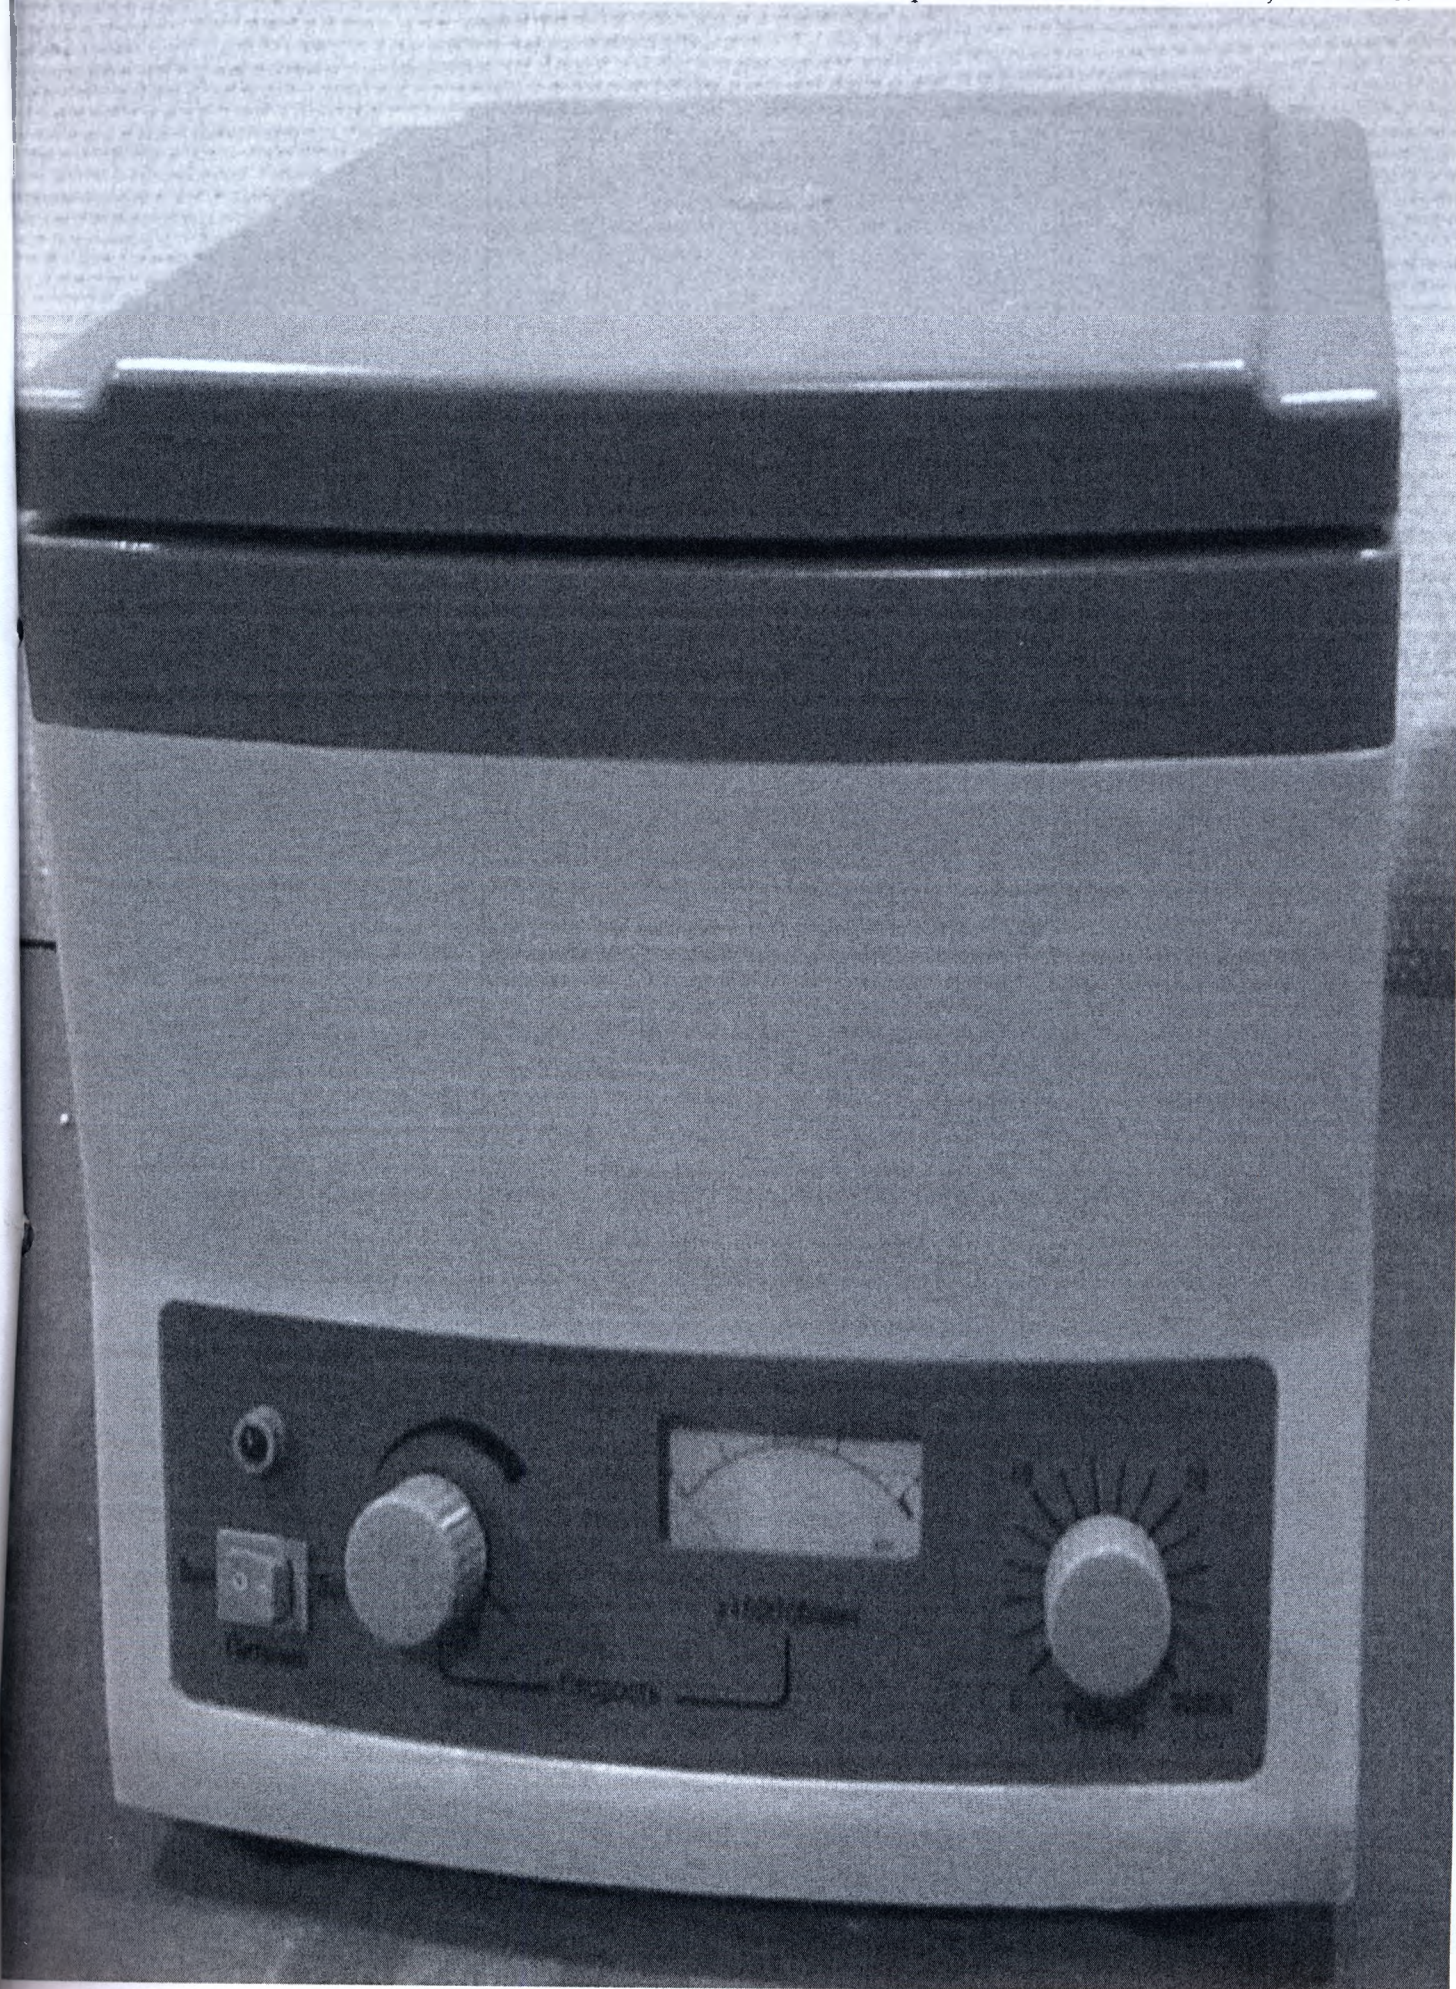




Рис. 2 – Центрифуга (вид сбоку 1)




Центрифуга лабораторная медицинская настольная
Автомат
 Барометр, измерительный LC-048
 Р/У № _____ от _____ г.
 Производители: Zhenli Lab (Dongpu) Co., Ltd., No. 12
 Hongshan Road, Industrial Zone, Jincheng Town, Jiebei
 District, Changzhou, Jiangsu, China («Зенли Лаб (Шаньси)»)
 Кд: Р/Д, № 12, ул. Хуншань, Промышленная зона,
 район Цзиньчэн, район Цзиньчэн, г. Чанчжоу,
 провинция Шаньси, Китай
 Дистрибутор: ООО «МЕДИУПОРТ», 630011,
 Московская область, г. Истринский, ул. Сельская,
 д/п 52, пом. 34, офис 211
 Допустимая влажность: не более 50%
 Напряжение питания: ~220 В (± 5%)
 Частота тока: 50 Гц (± 5%)
 Дата выпуска: 03.2018
 Серийный номер: 30437003



IVD IP34



Рис. 4 – Центрифуга (вид сзади)

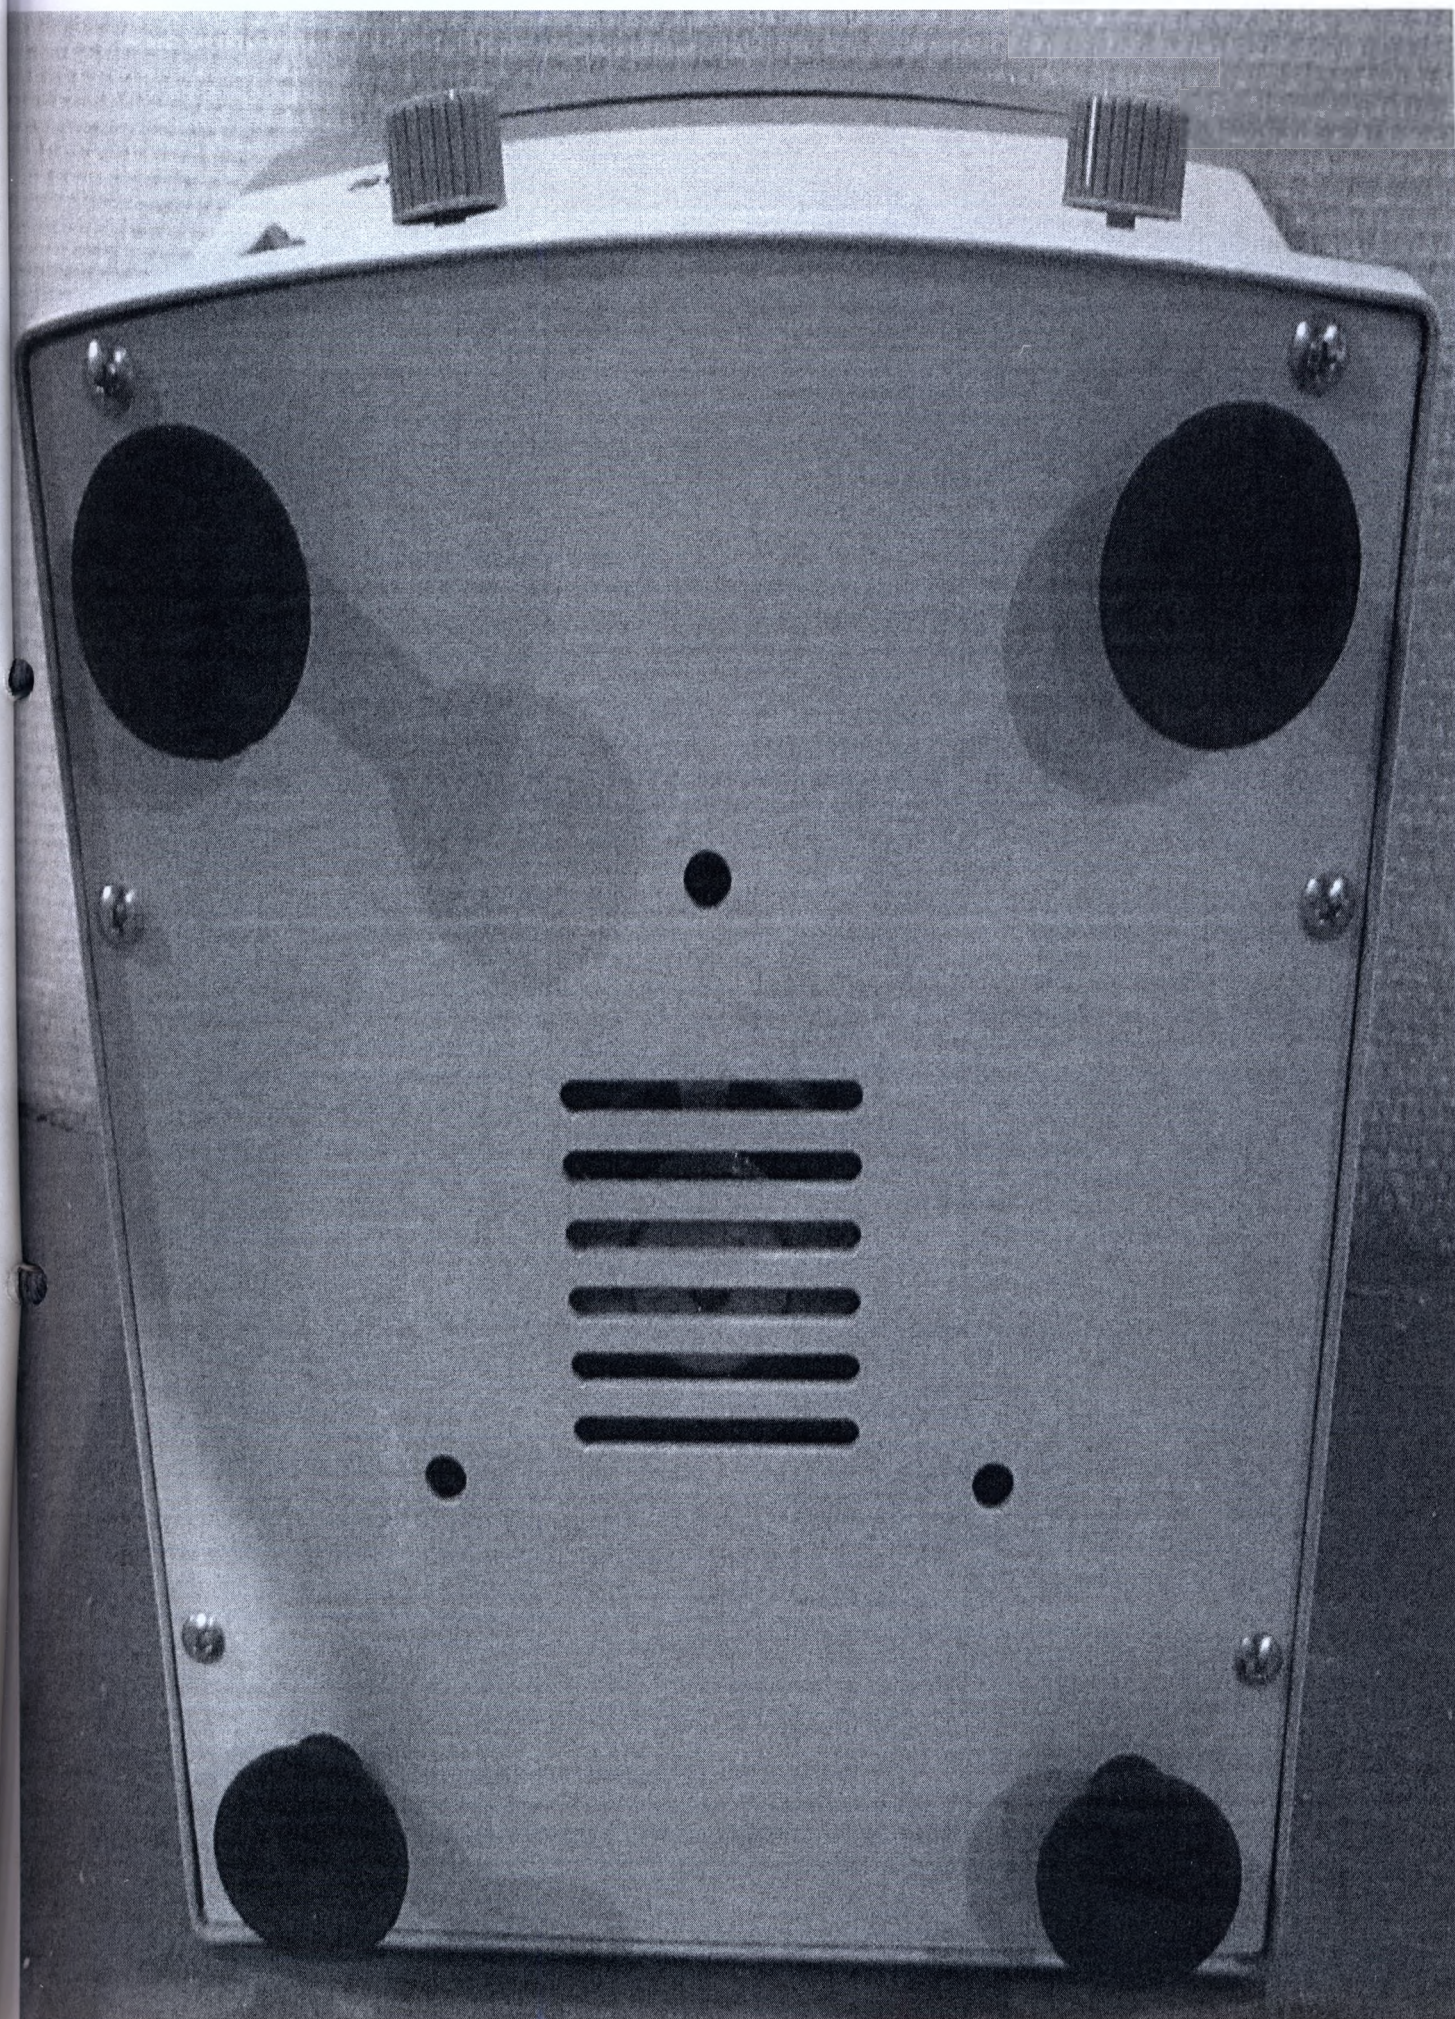



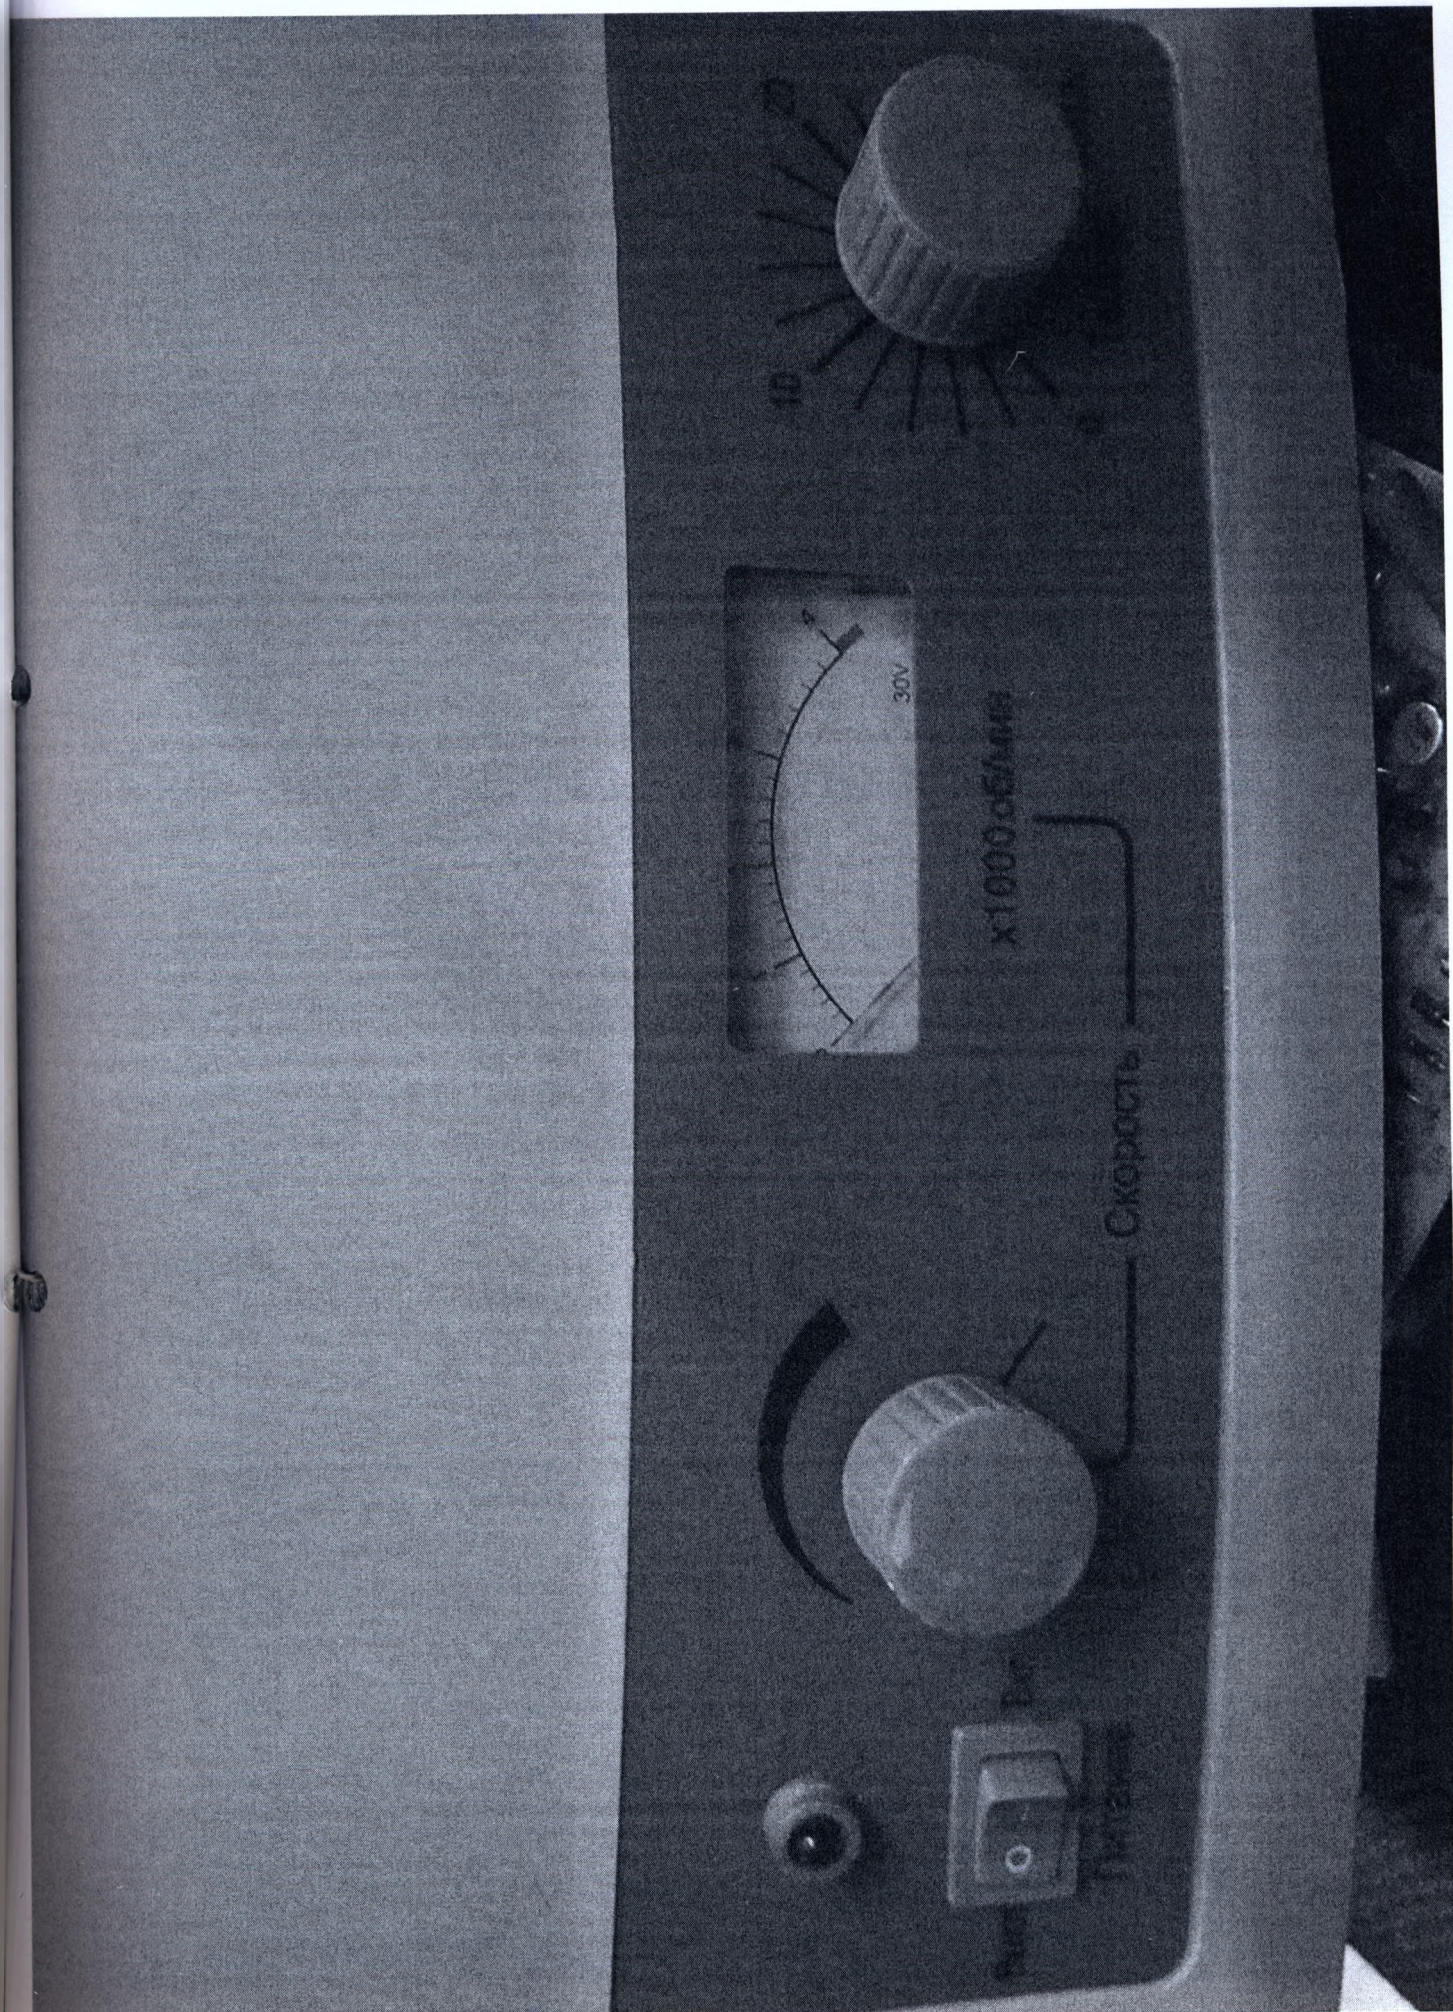


Рис. 7 – Панель управления центрифуги

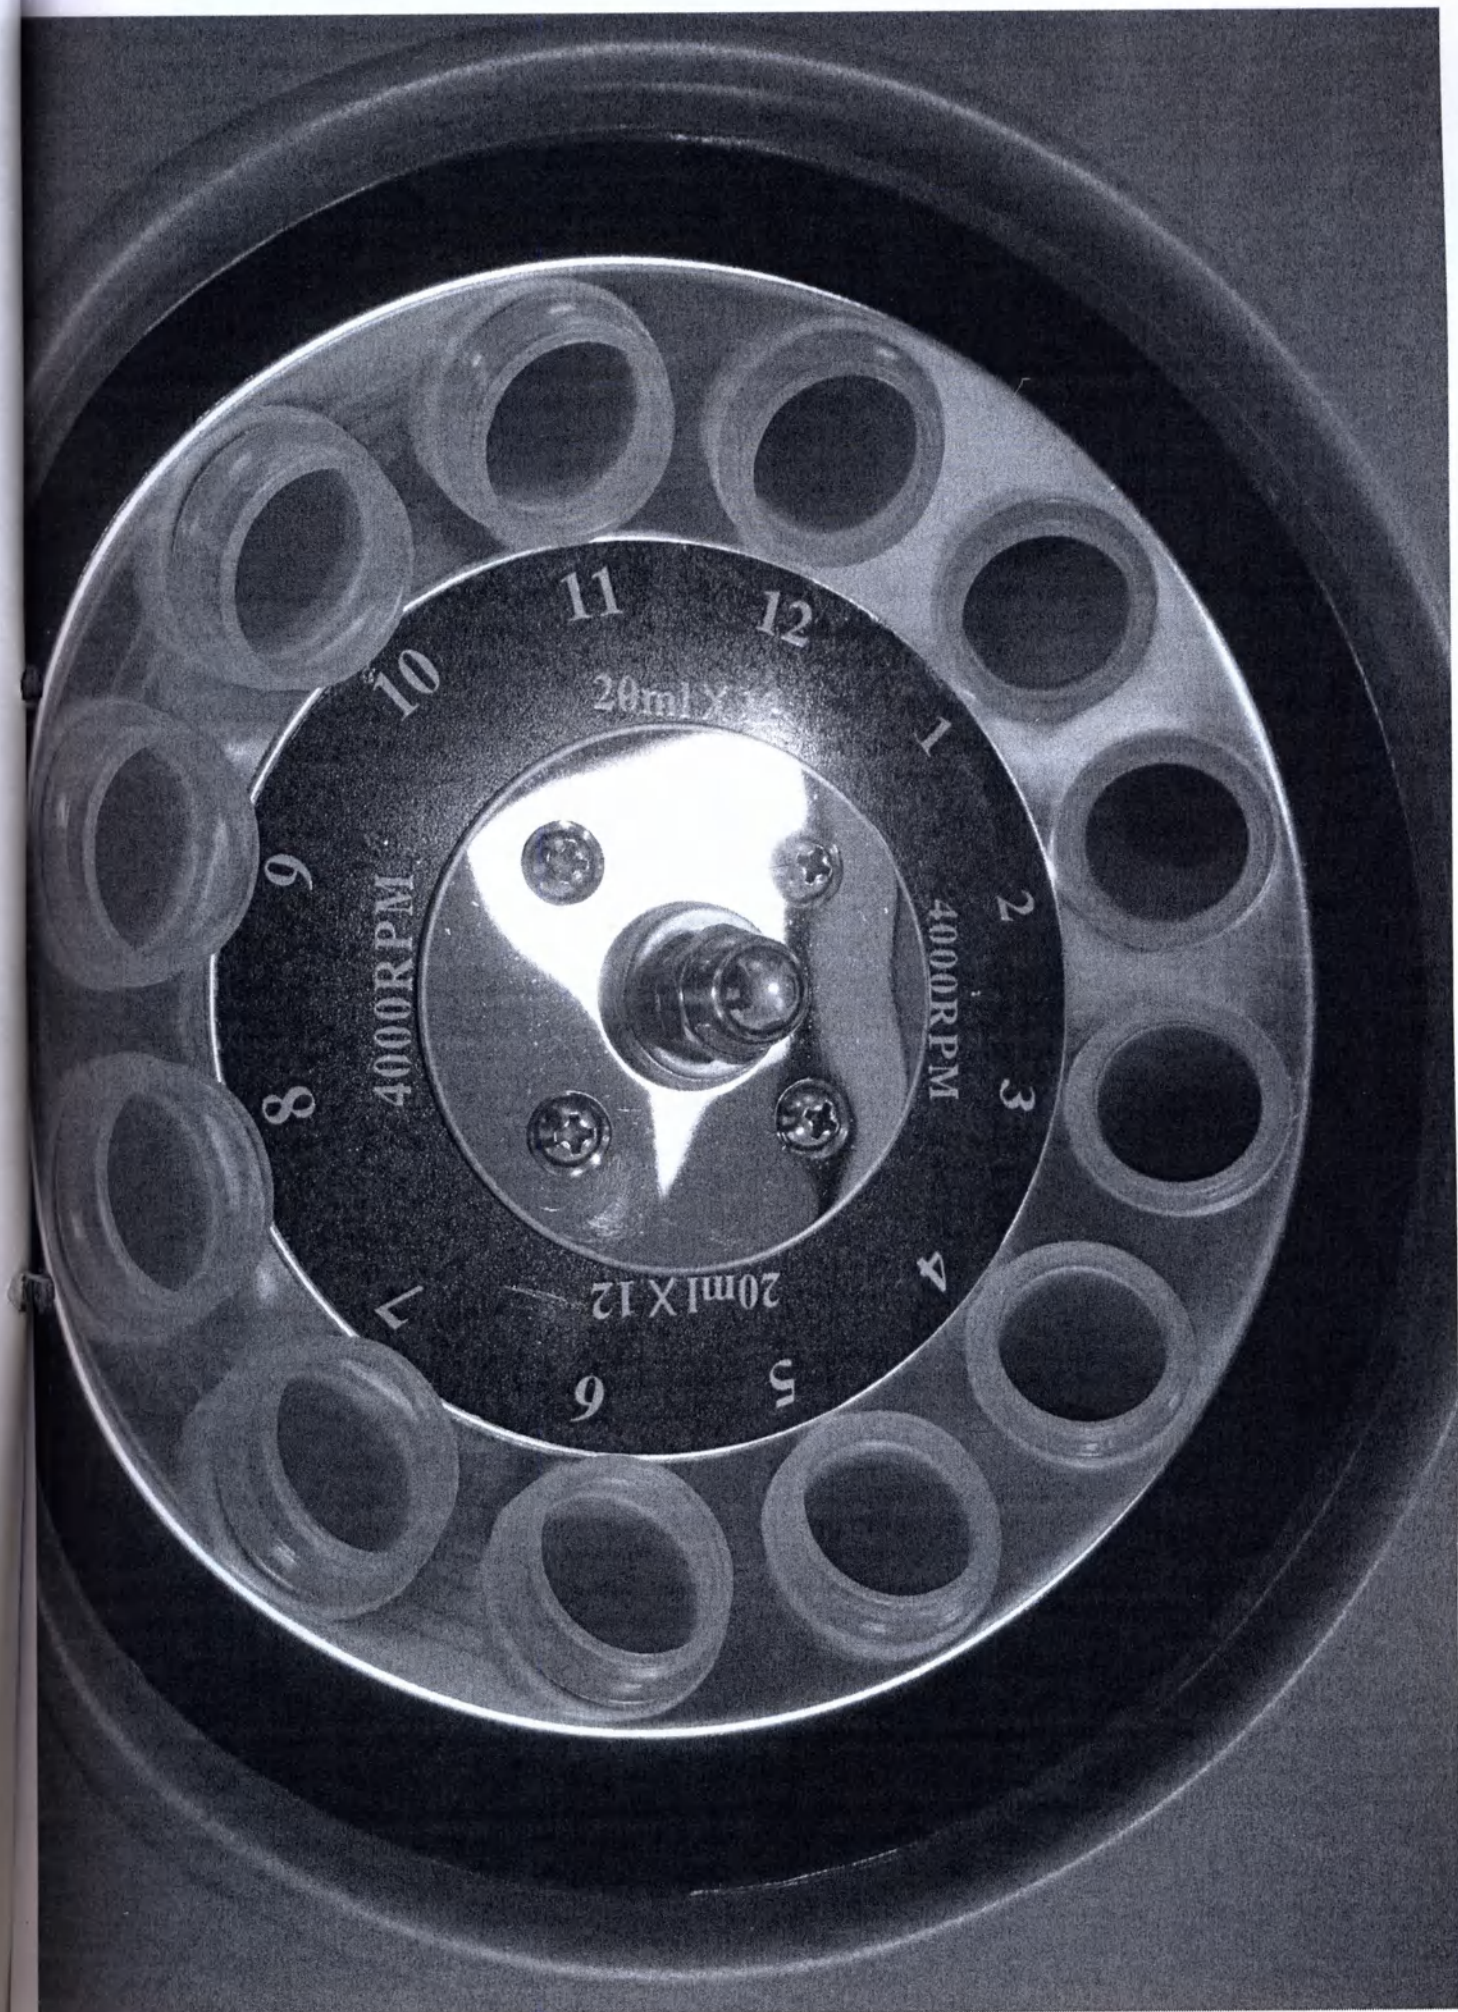


Рис. 8 – Маркировка ротора

31684
14.05.2020



Вкл

Питание

Выкл

Центрифуга лабораторная медицинская настольная
«Armed»

Вариант исполнения: LC-04B

РУ № _____ от _____ г.

Производитель: Zenith Lab (Jiangsu) Co., Ltd., No. 12
Hongshan Road, Industrial Zone, Jincheng Town, Jintan
District, Changzhou, Jiangsu, China («Зенит Лаб (Цзянсу)
Ко., Лтд.», № 12, ул. Хуншань, Промышленная зона,
городок Цзиньчен, район Цзиньтань, г. Чанчжоу,
провинция Цзянсу, Китай)

Дистрибьютер: ООО «МЕДИМПОРТ», 630091
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская,
дом 52, пом. 14, офис 211

Потребляемая мощность: не более 200 В*А


Напряжение питания: ~ 220 В (± 10%)

Частота сети: 50 Гц (± 2%)


Дата выпуска: 03.2018

Серийный номер: 30470903


IVD



IP34

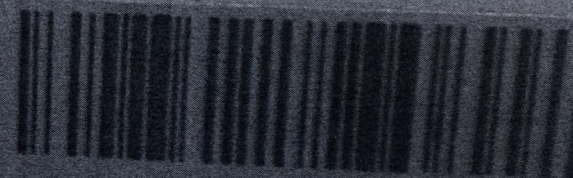

4640011899666

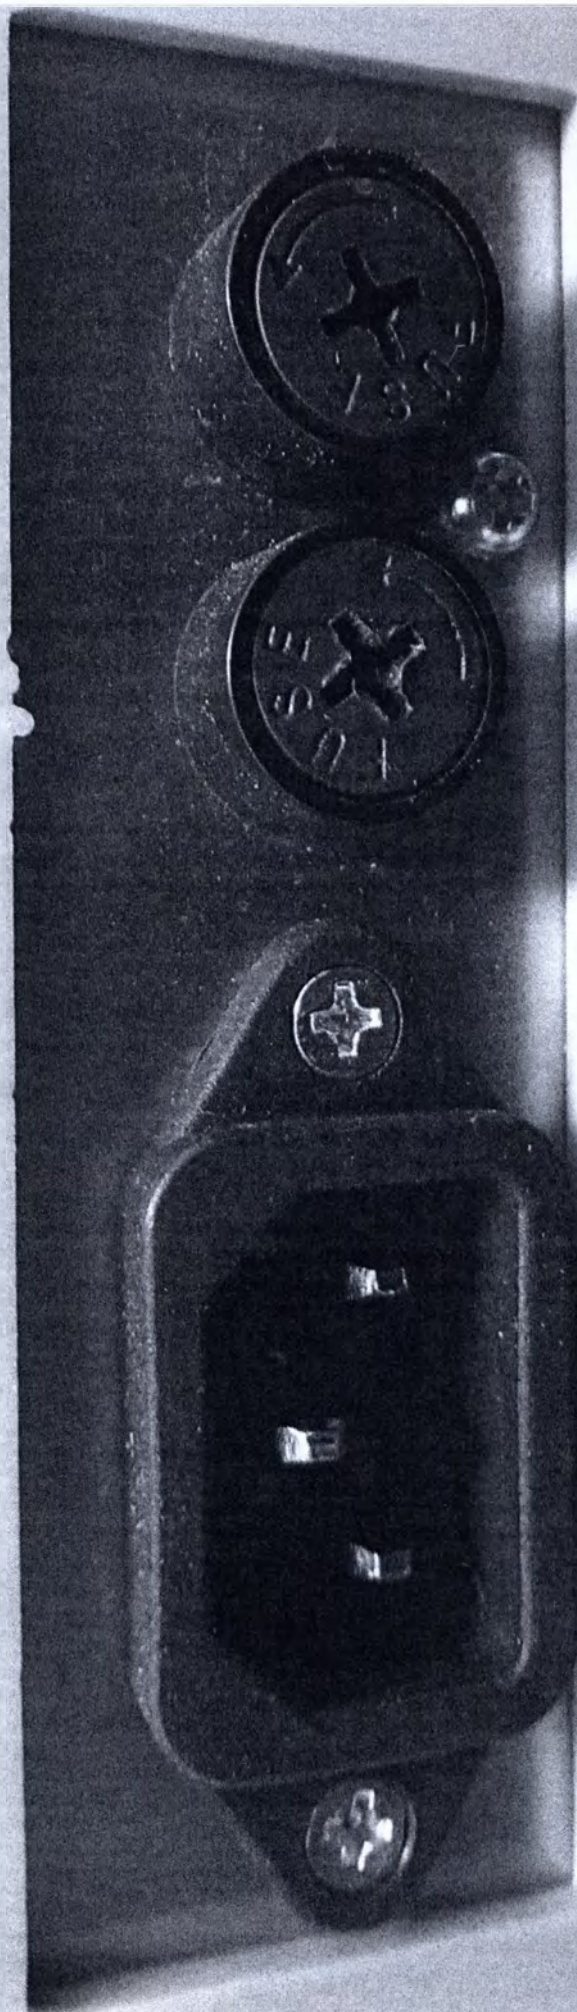


31684
14.05.2020





Рис. 12 – Маркировка клеммы заземления (земля) на корпусе центрифуги



Рис. 13 – Шнур питания (общий вид)

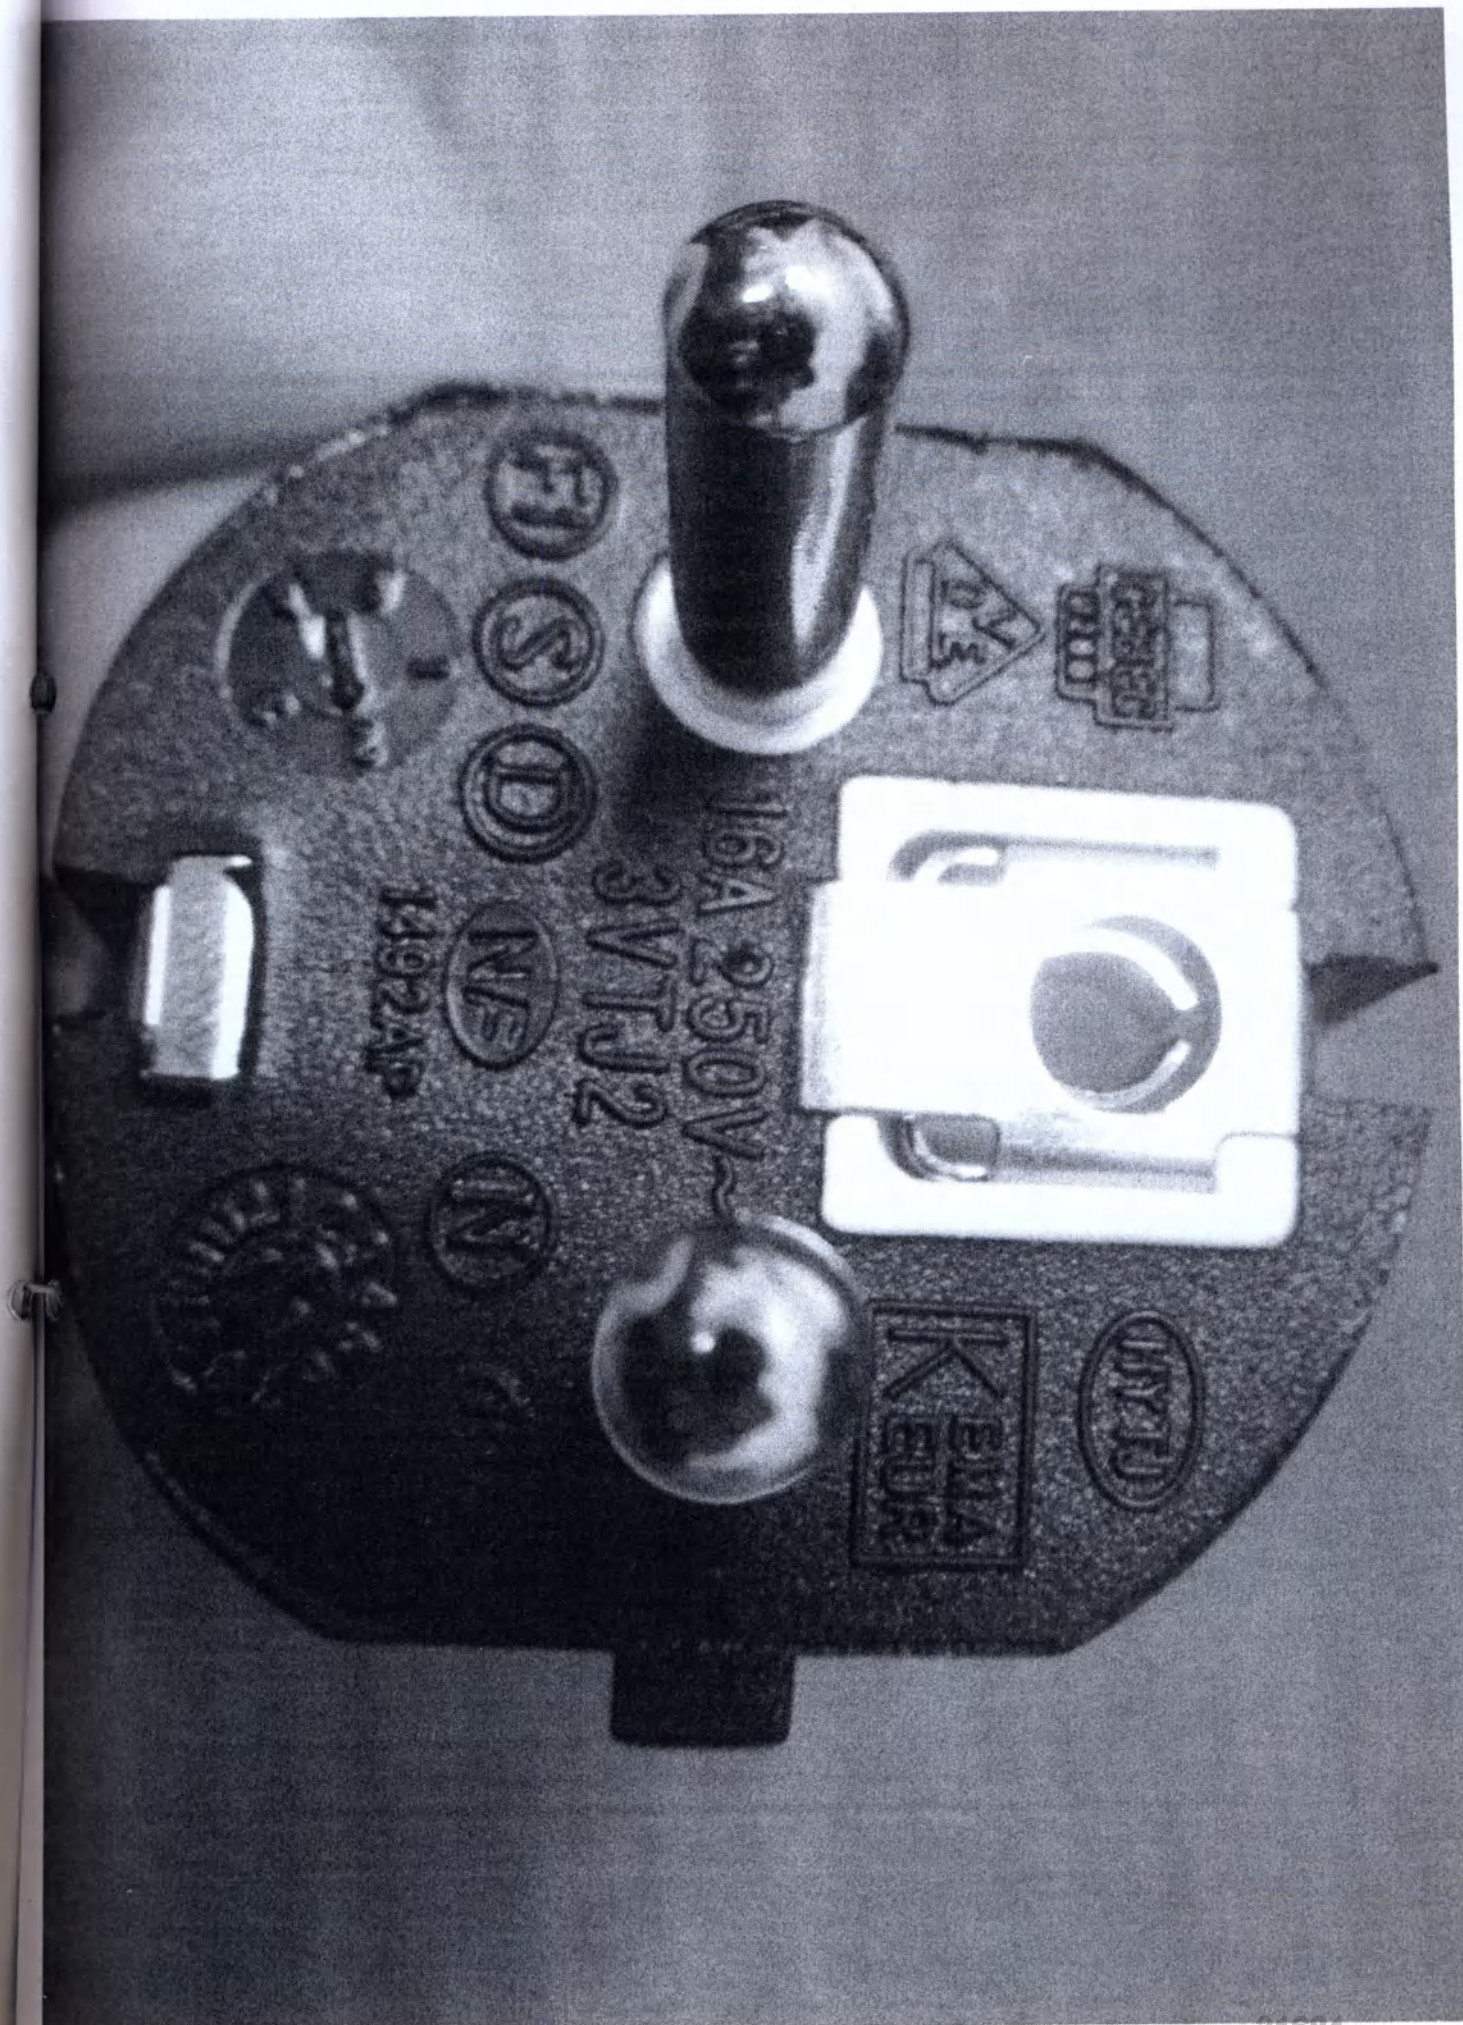

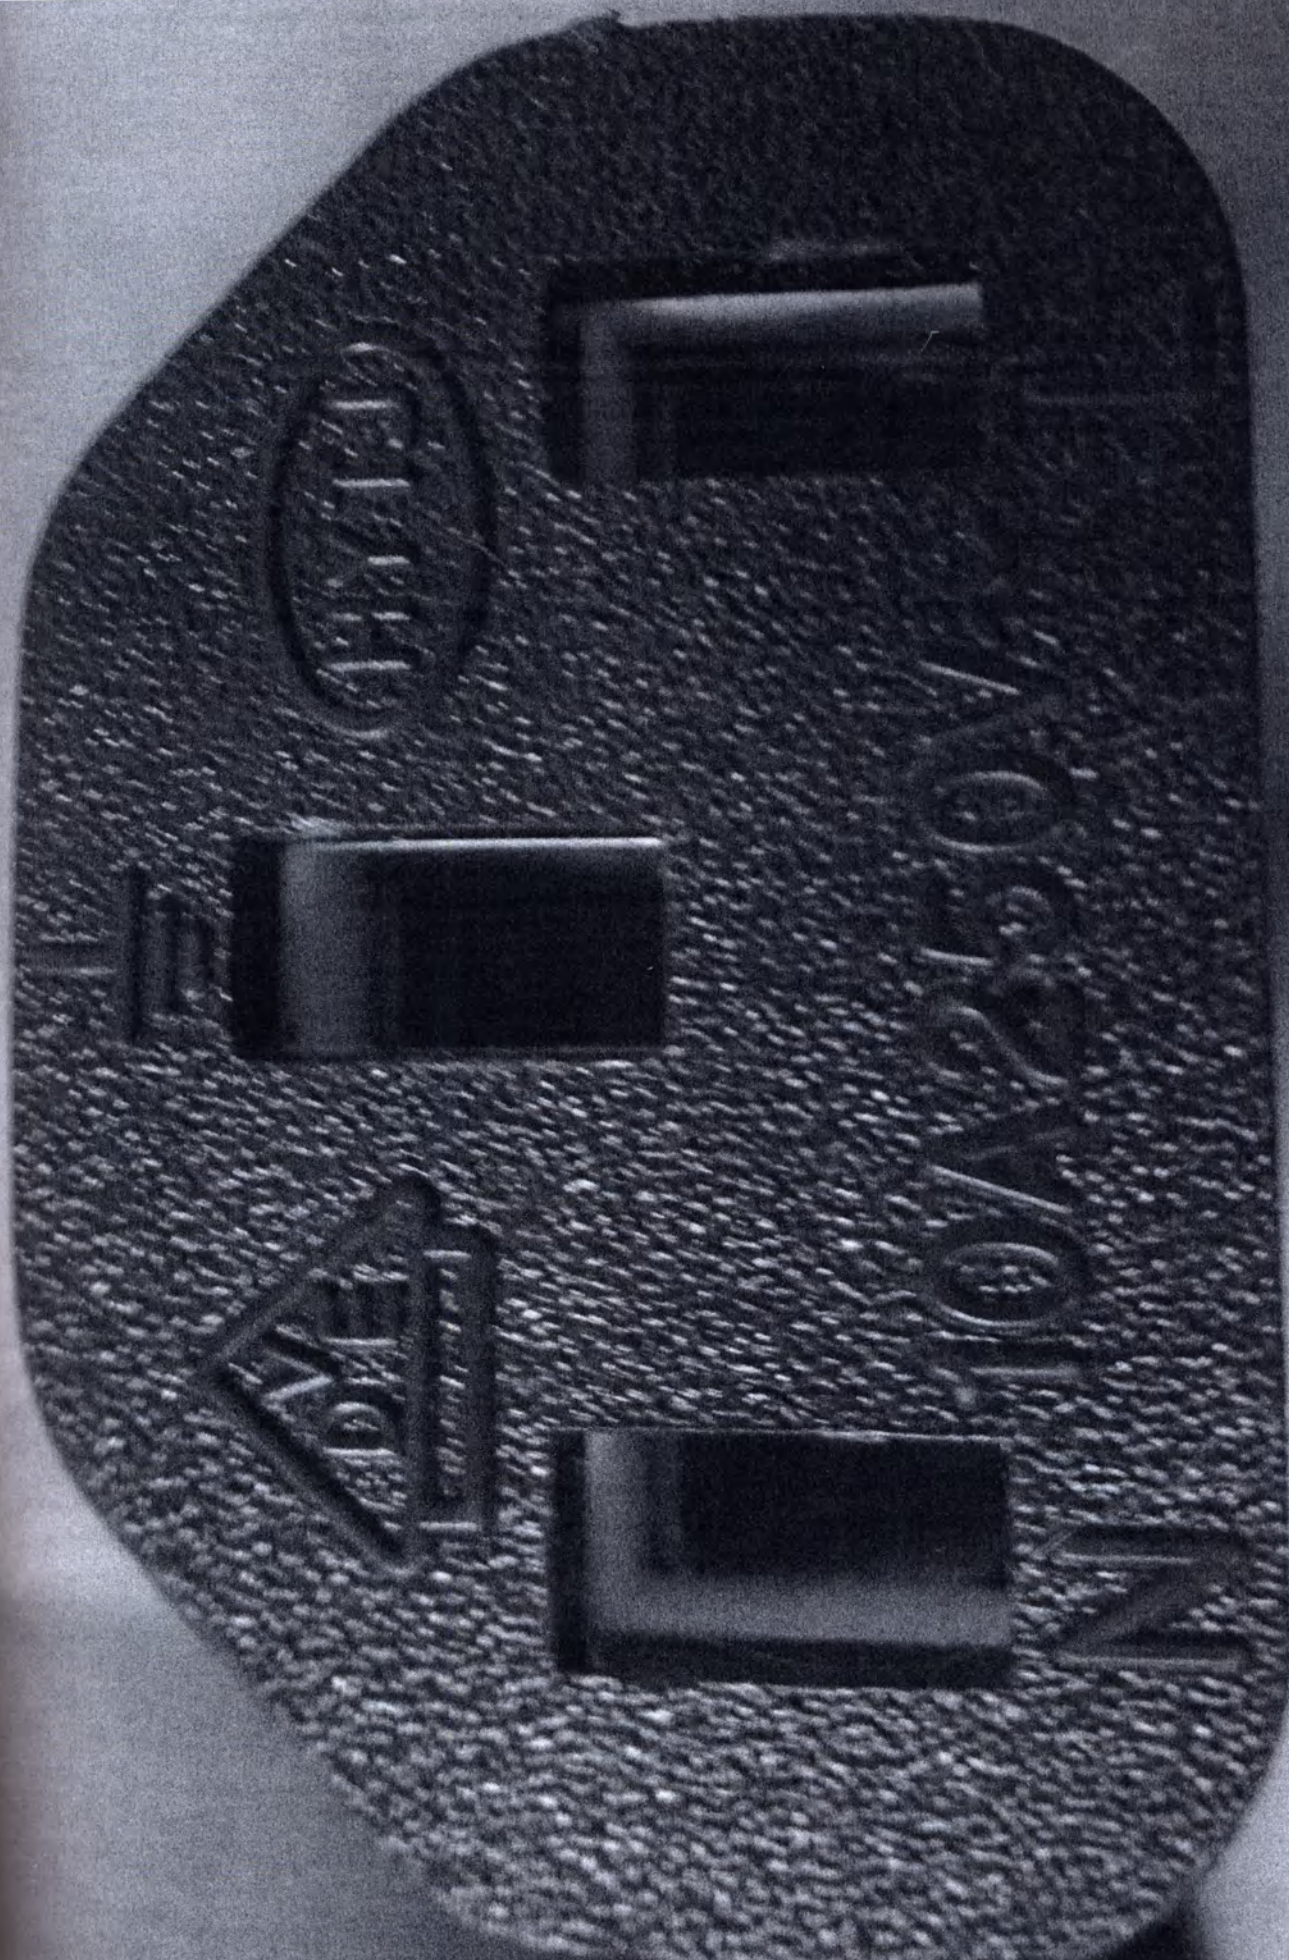

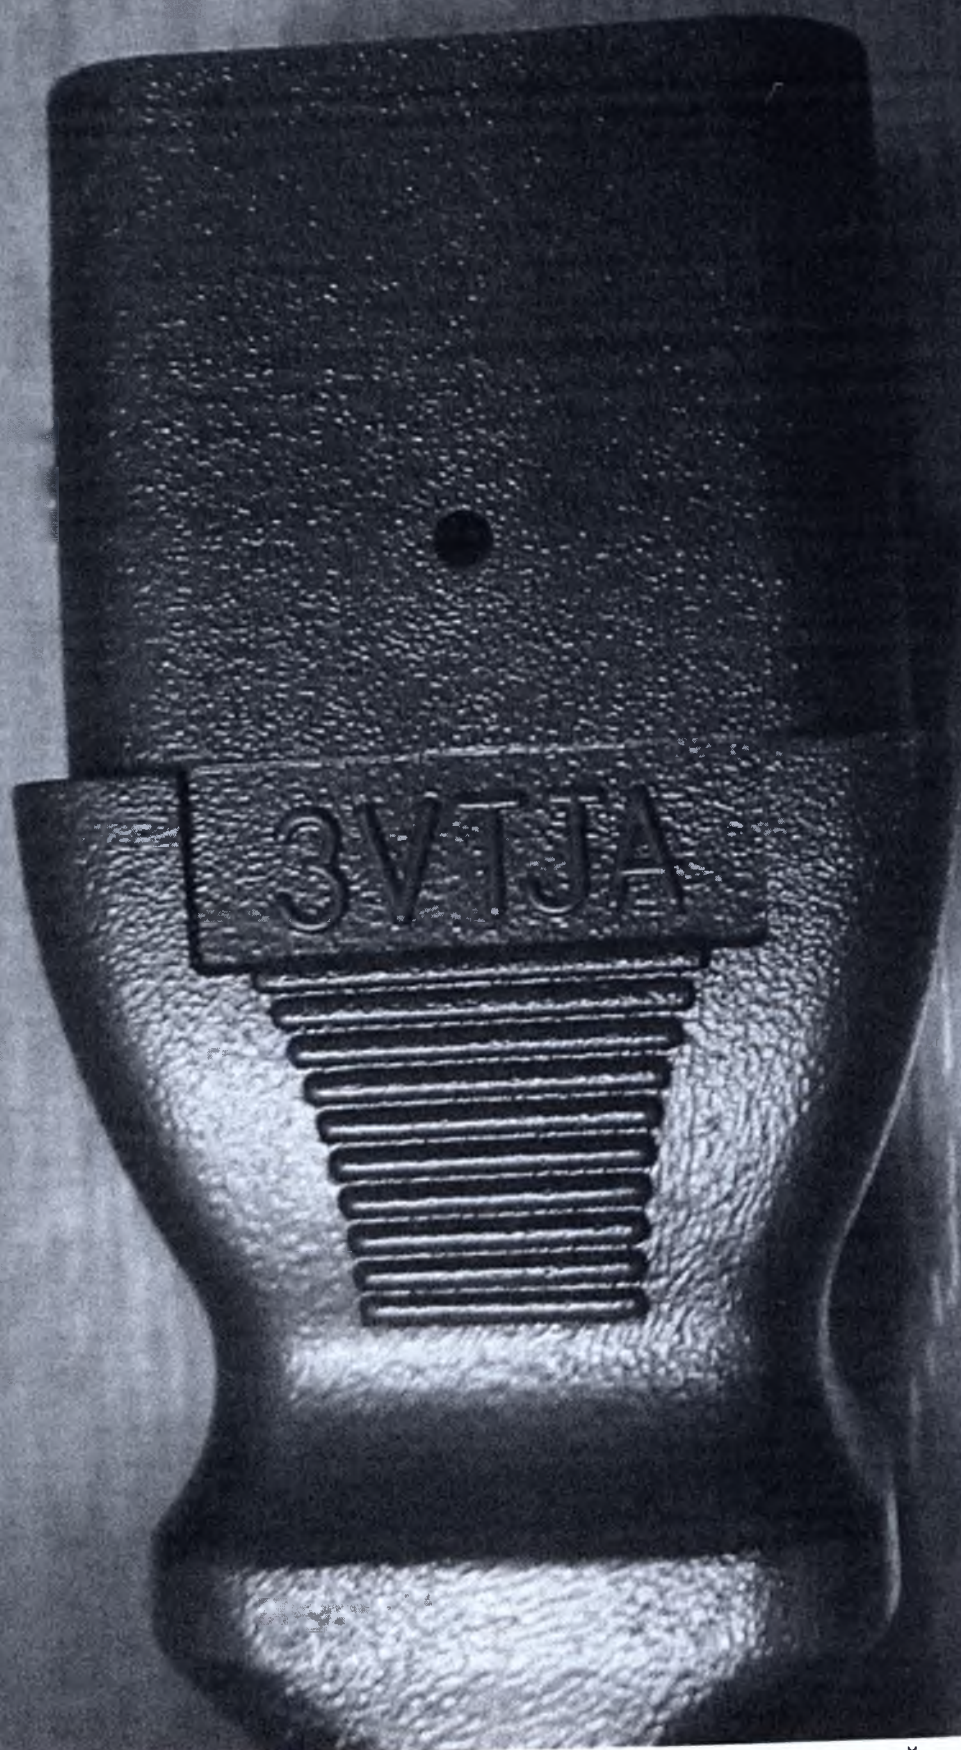

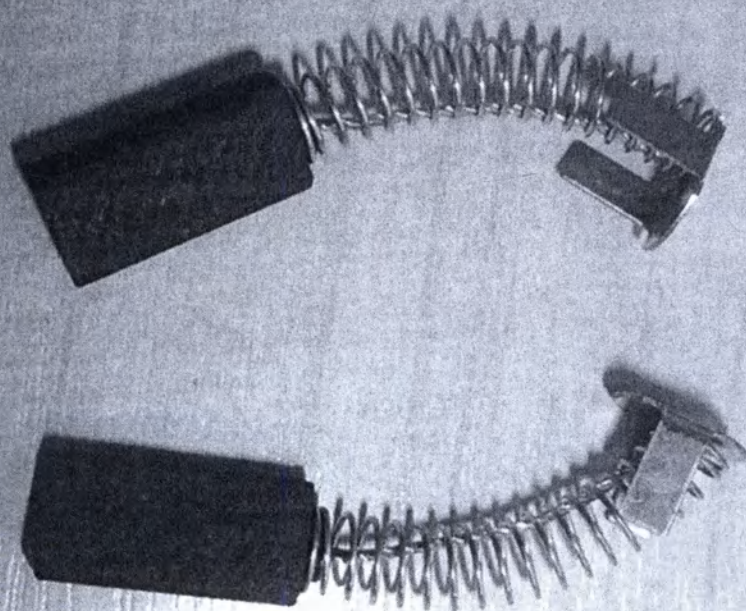


Рис. 17 – Щетка электродвигателя (2 шт.)

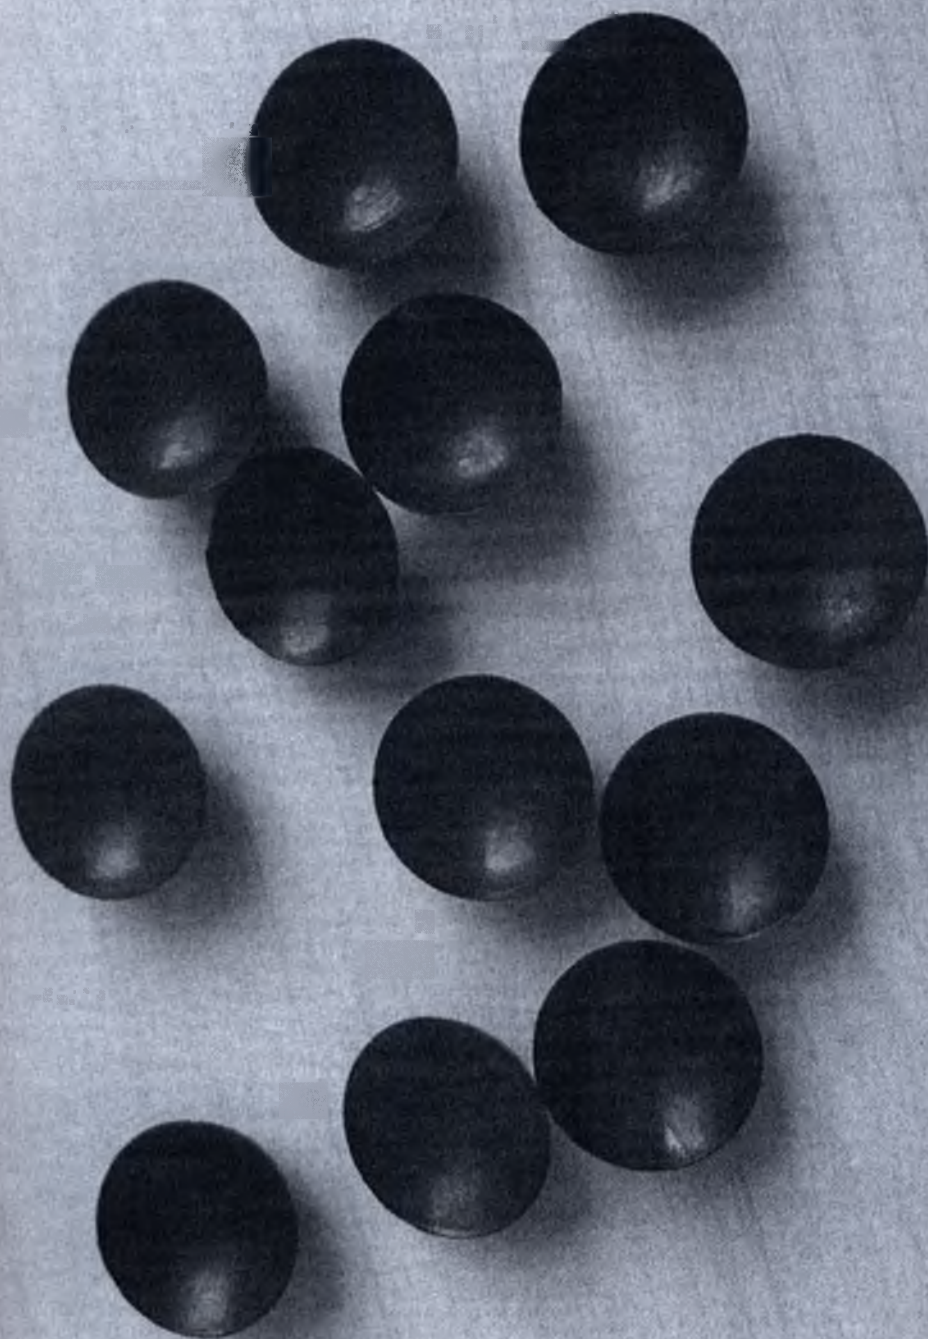


Рис. 18 – Уплотнитель (12 шт.)



Рис. 10 – Предохранитель плавкий F2AL 250 В (2 шт.)

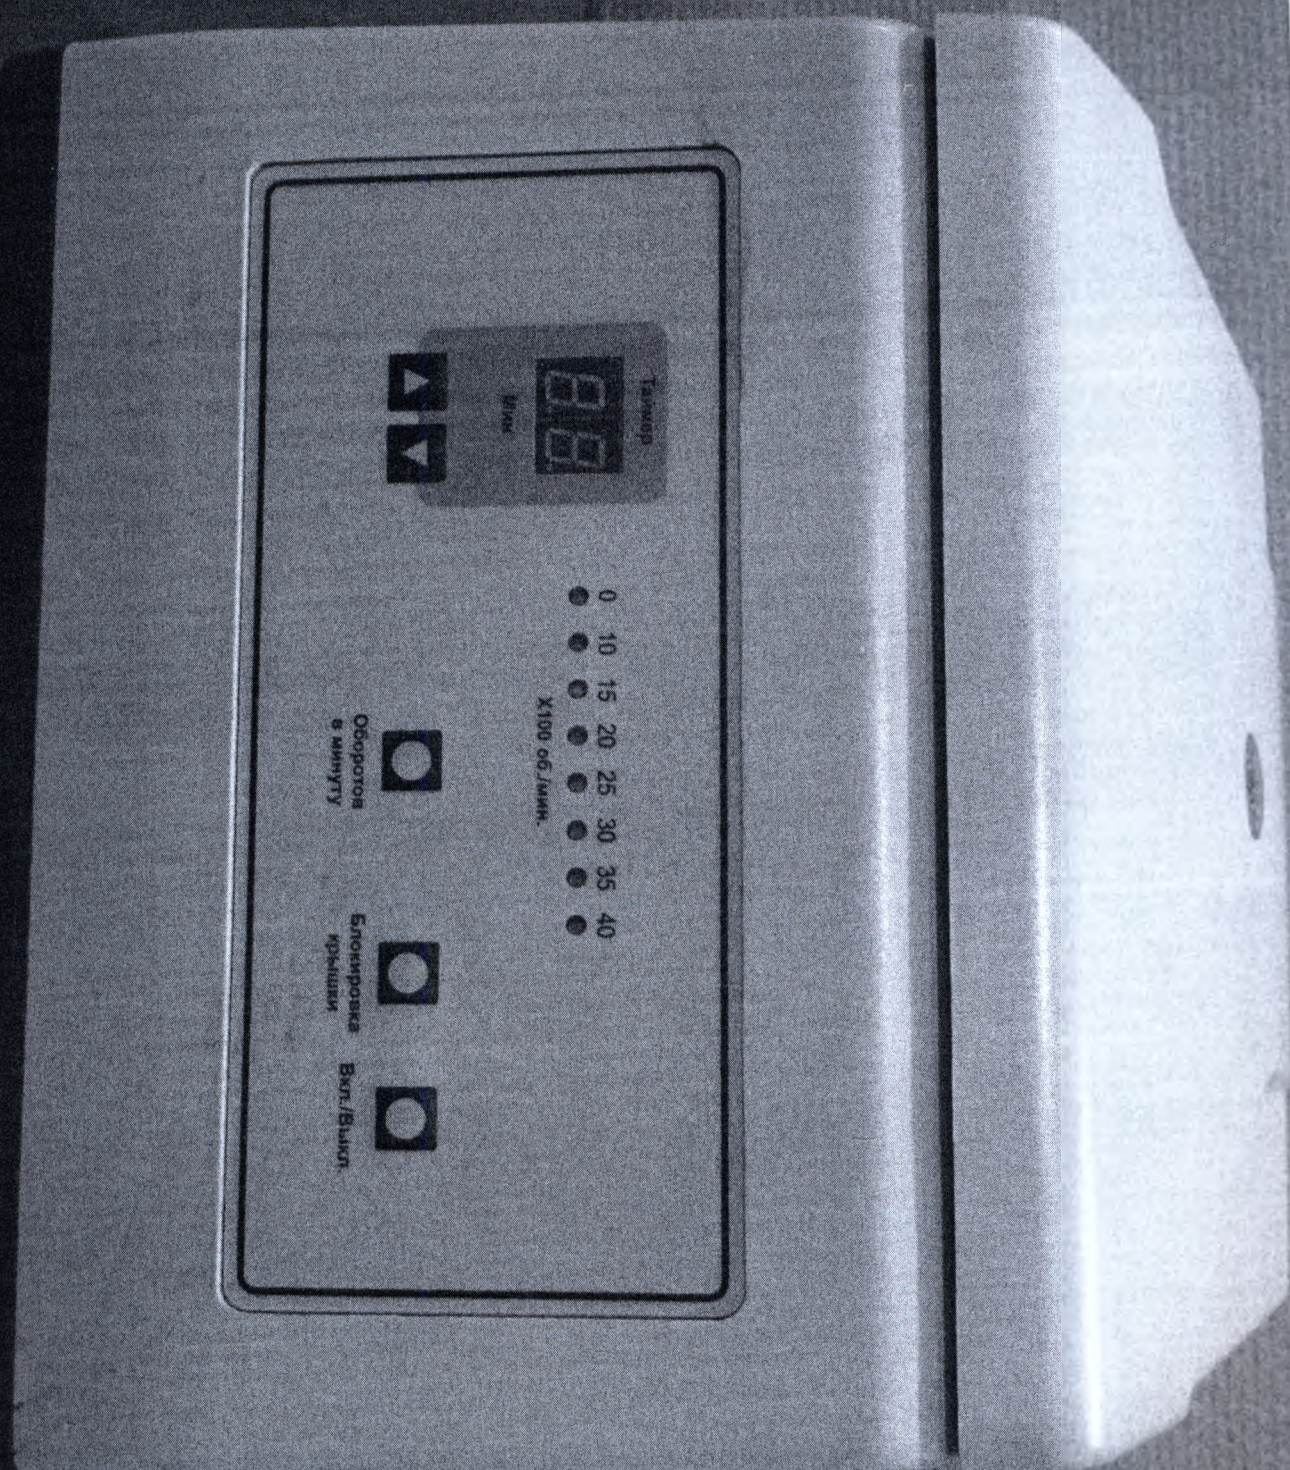


Рис. 20 – Центрифуга (вид спереди)



Рис. 21 – Центрифуга (вид сбоку 1)

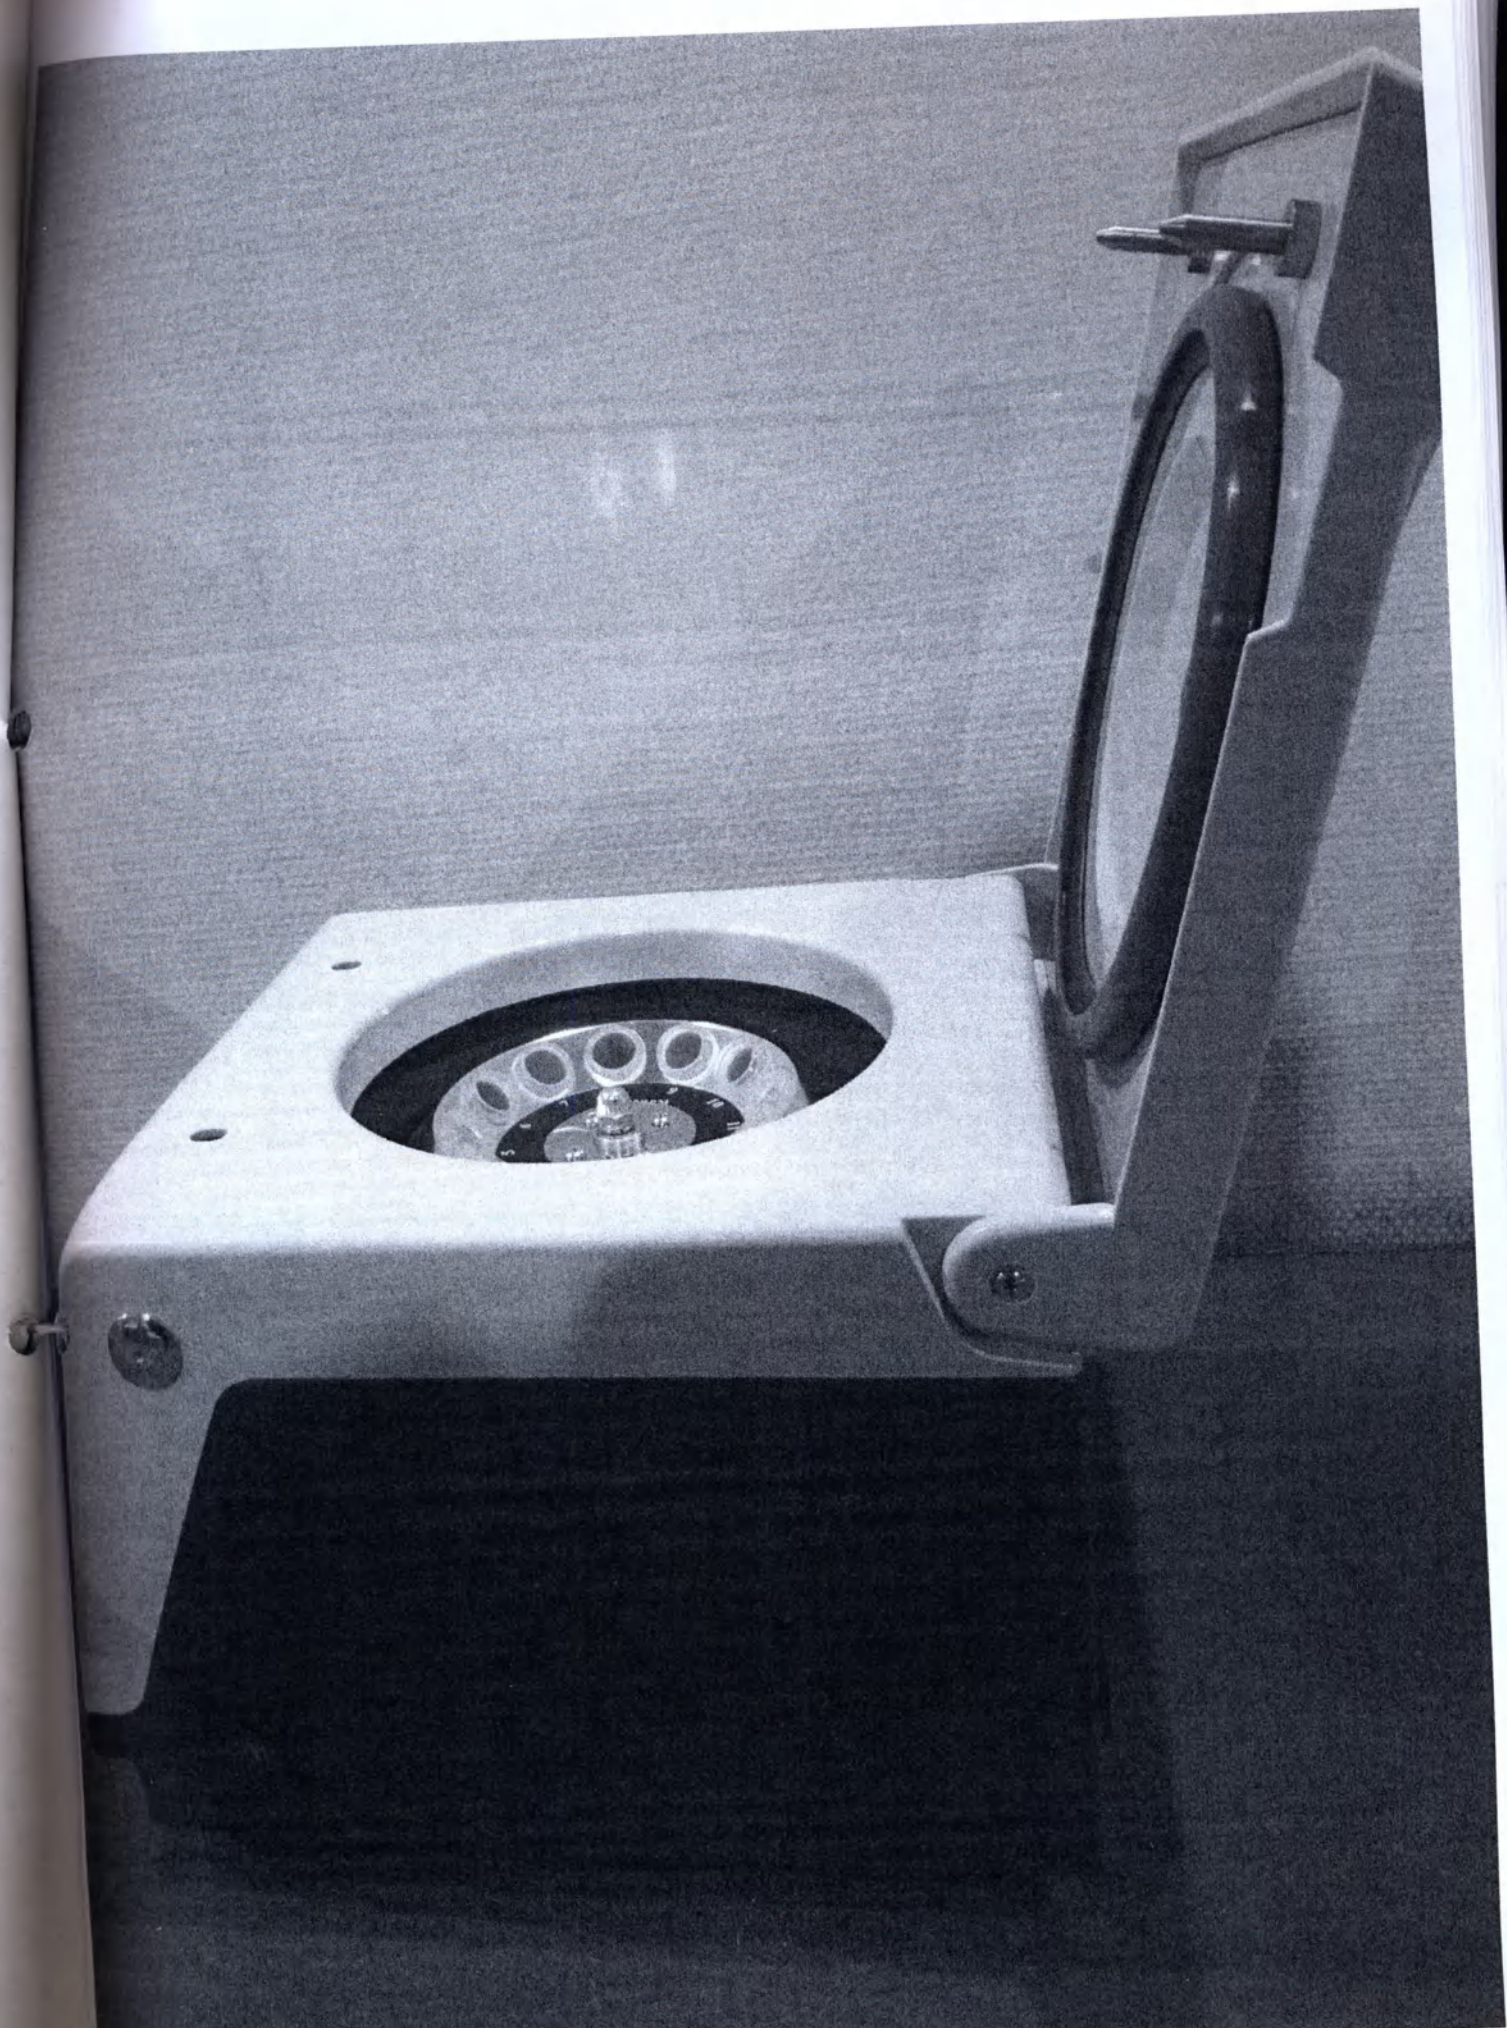


Рис. 22 – Центрифуга (вид сбоку 2)

Центрифуга лабораторная универсальная настольная
"Алмед"

Вариант исполнения: LC-04A

Р/У № _____

Производитель: Zhenh Lab (Hangzhou) Co., Ltd. No. 12
Hefeng Road, Industrial Zone, Jiecheng Town, Anshan
District, Chaohu City, Anhui, China (С.З.Ханг Чжэнь Лаб
Ко., Лтд., ул. 12, г. Хуаншань, Промышленная зона
города Чжаоху, провинция Аньхой, Китай)

Дистрибутор: ООО "АЛМЕДТЕСТ",
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская,
дом 5/2, пом. 3А, офис 211
Порядковый номер: 220 В 12 1093
Масштаб: 50 (1:50)
Дата выпуска: 03.2018
Серийный номер: 2150040

IPD Δ ∇ IP34

Рис. 23 – Центрифуга (вид сзади)

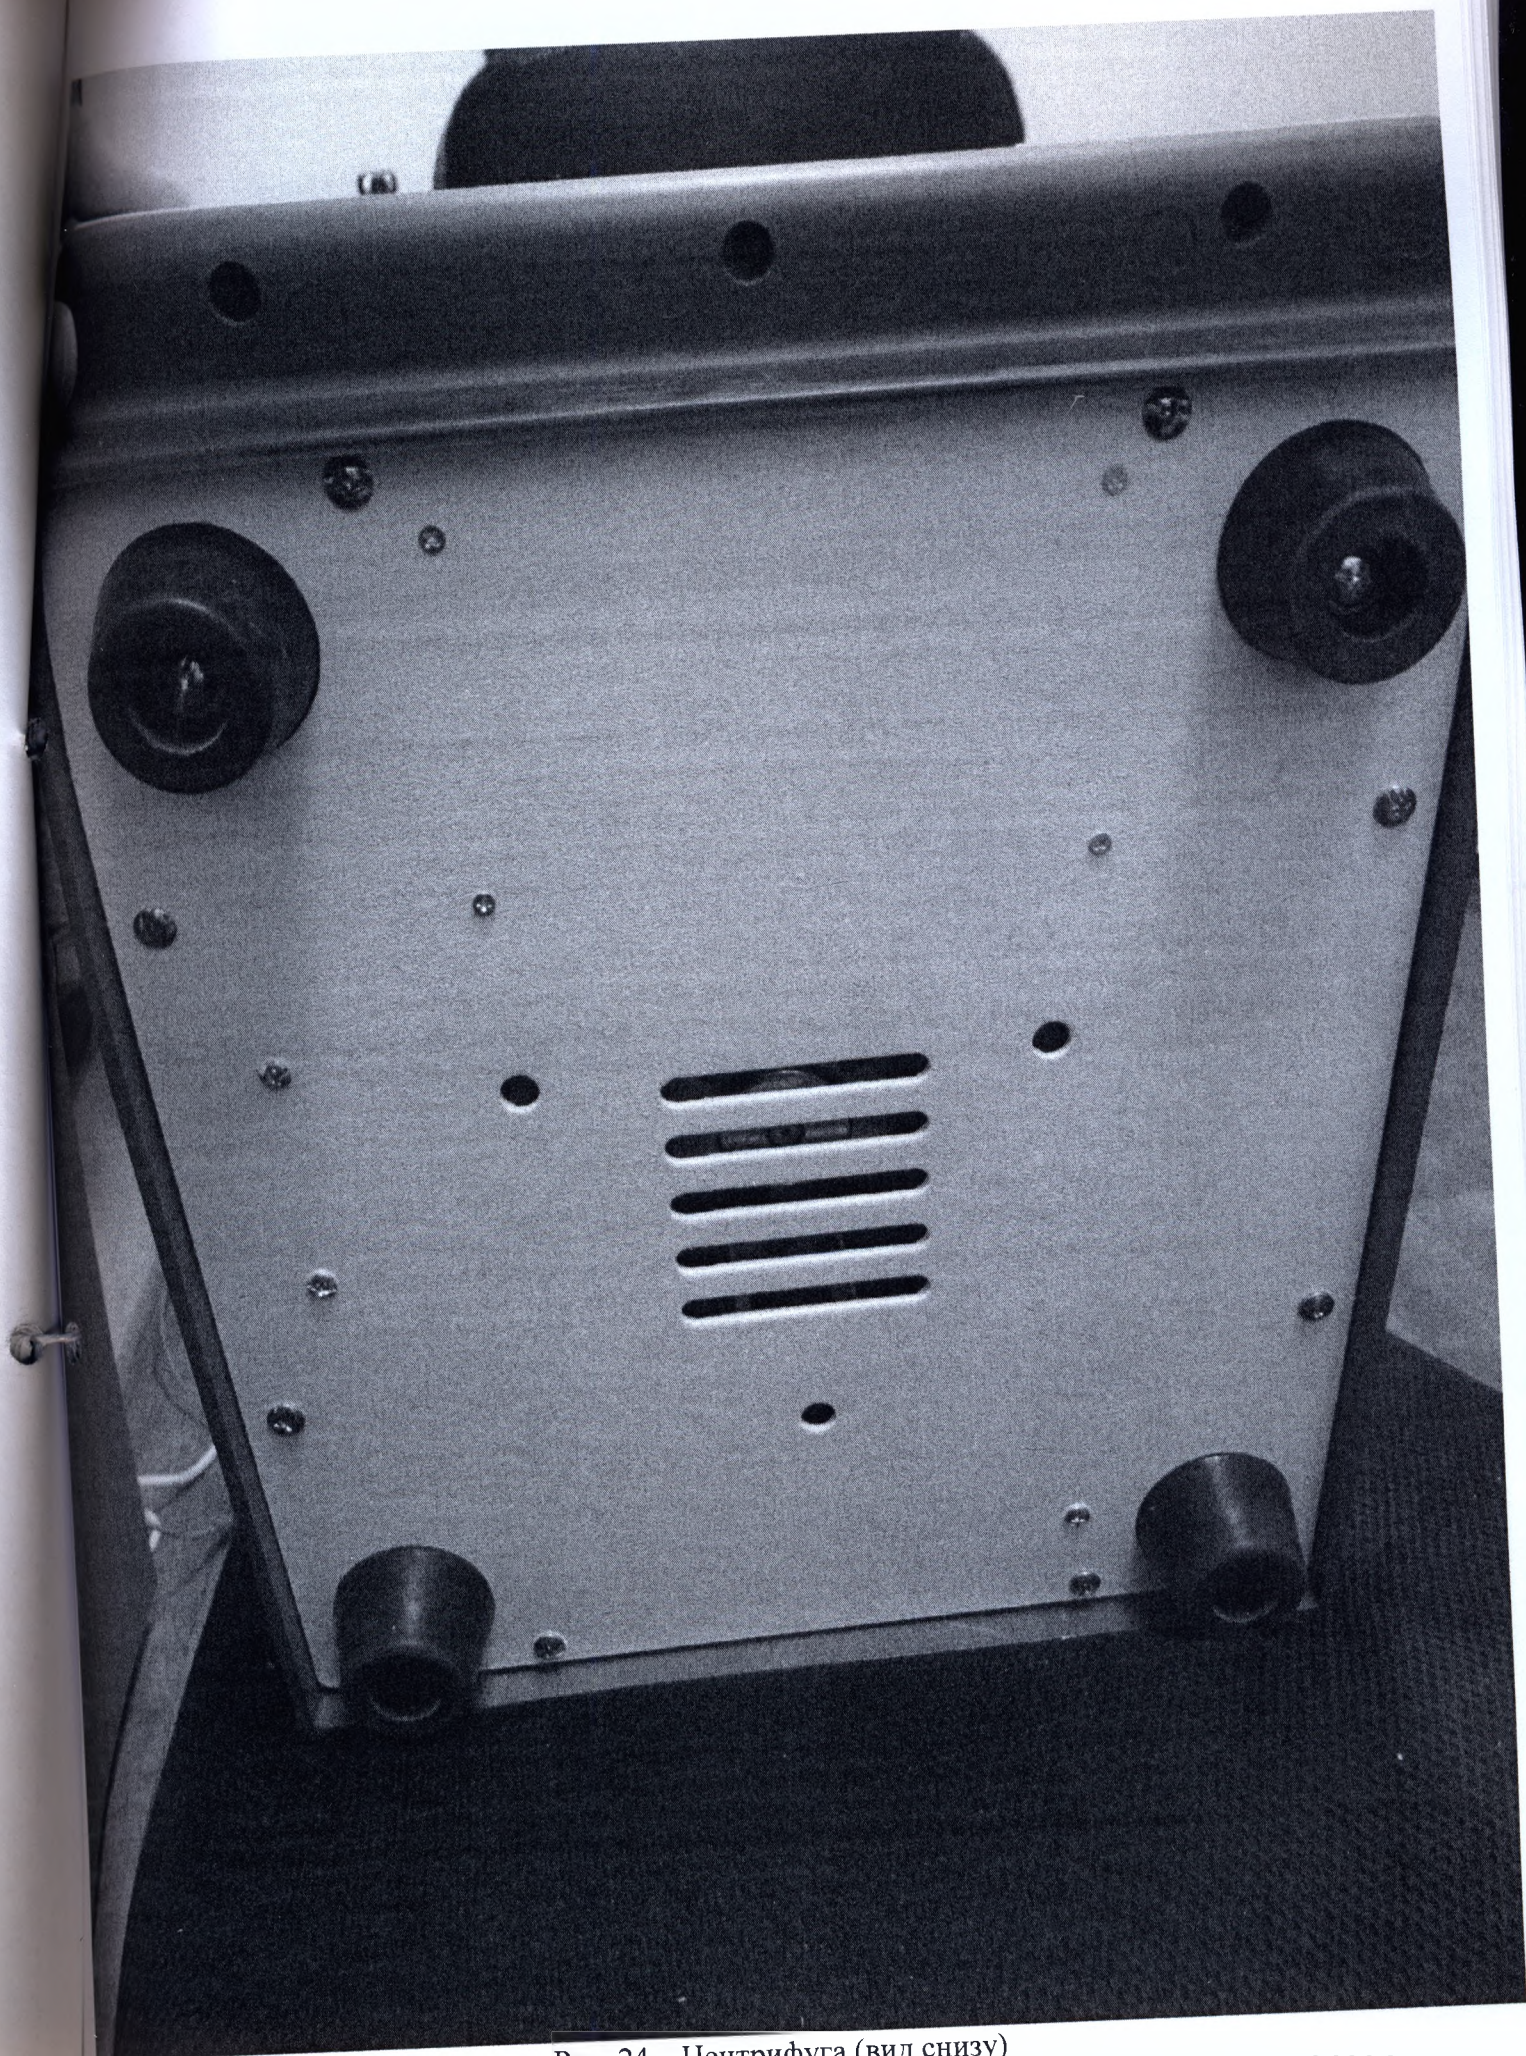


Рис. 24 – Центрифуга (вид снизу)



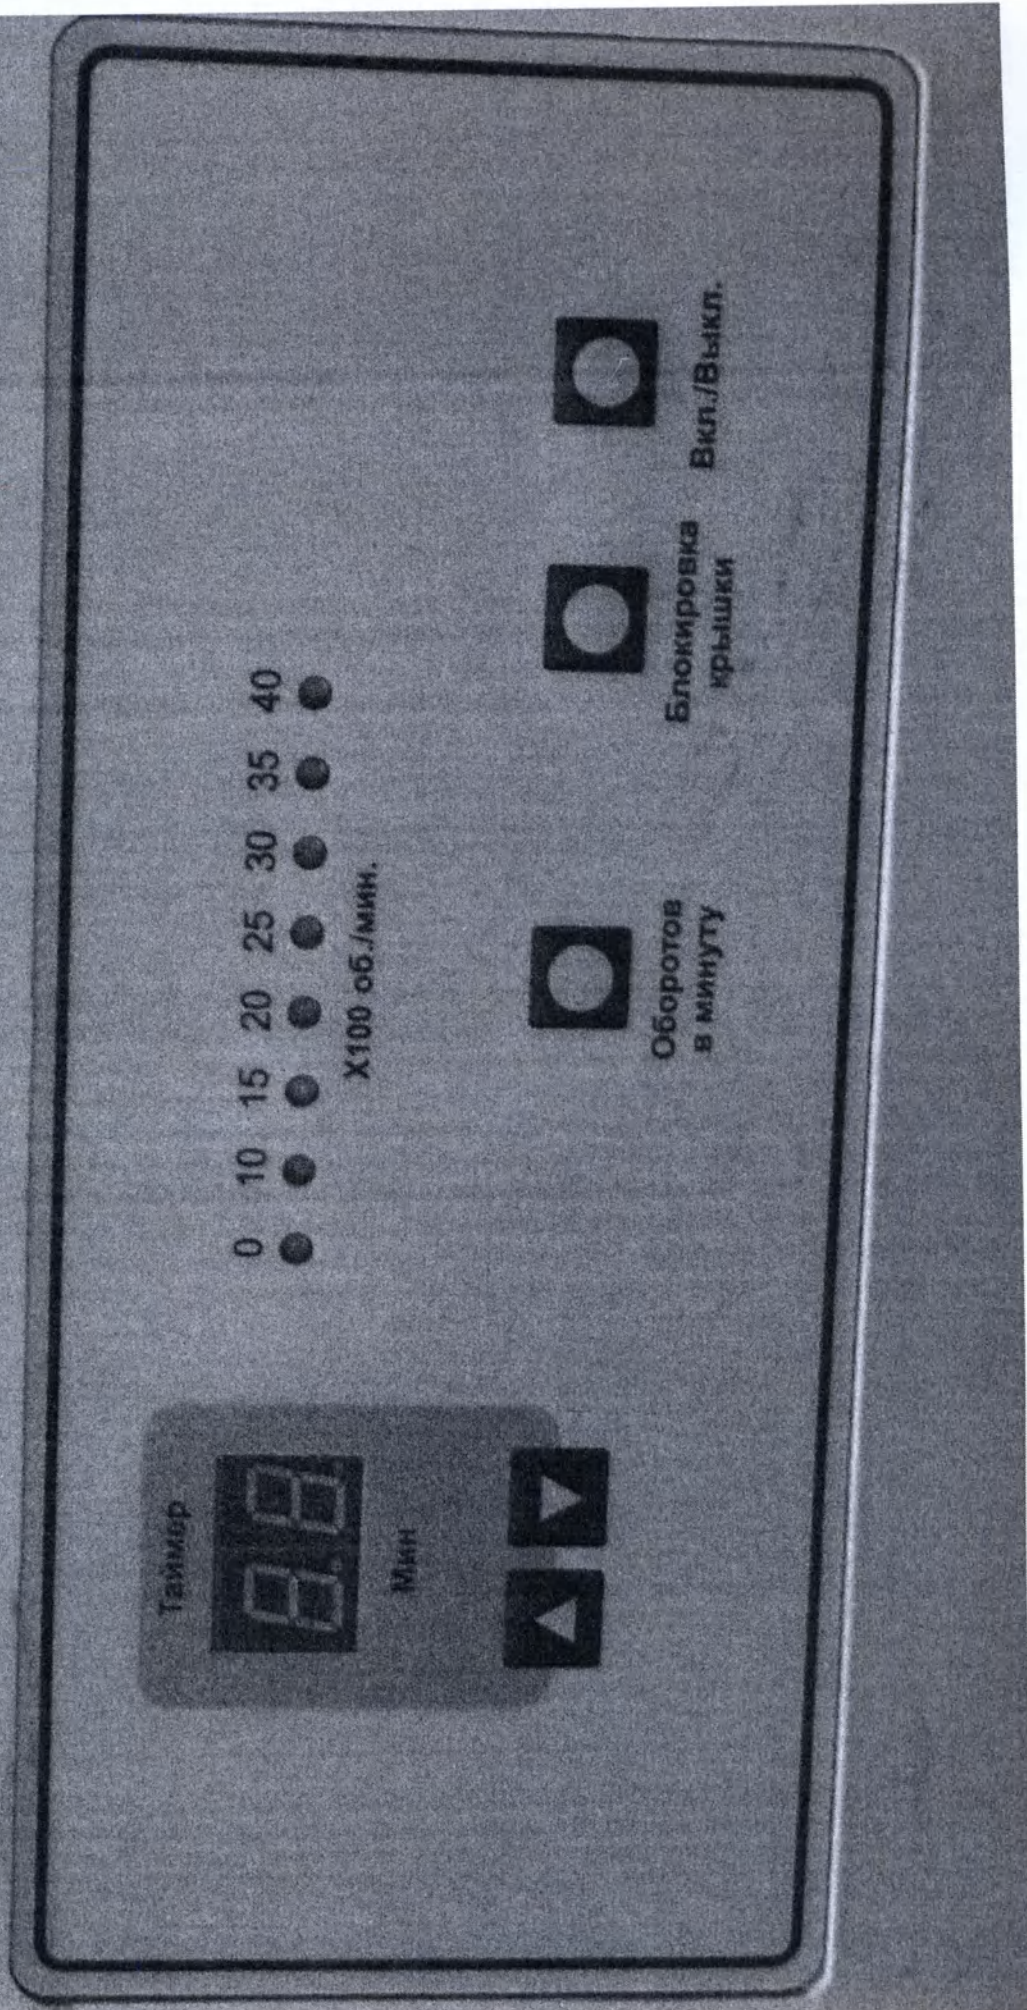




Рис. 27 – Маркировка ротора

31684
14.05.2020

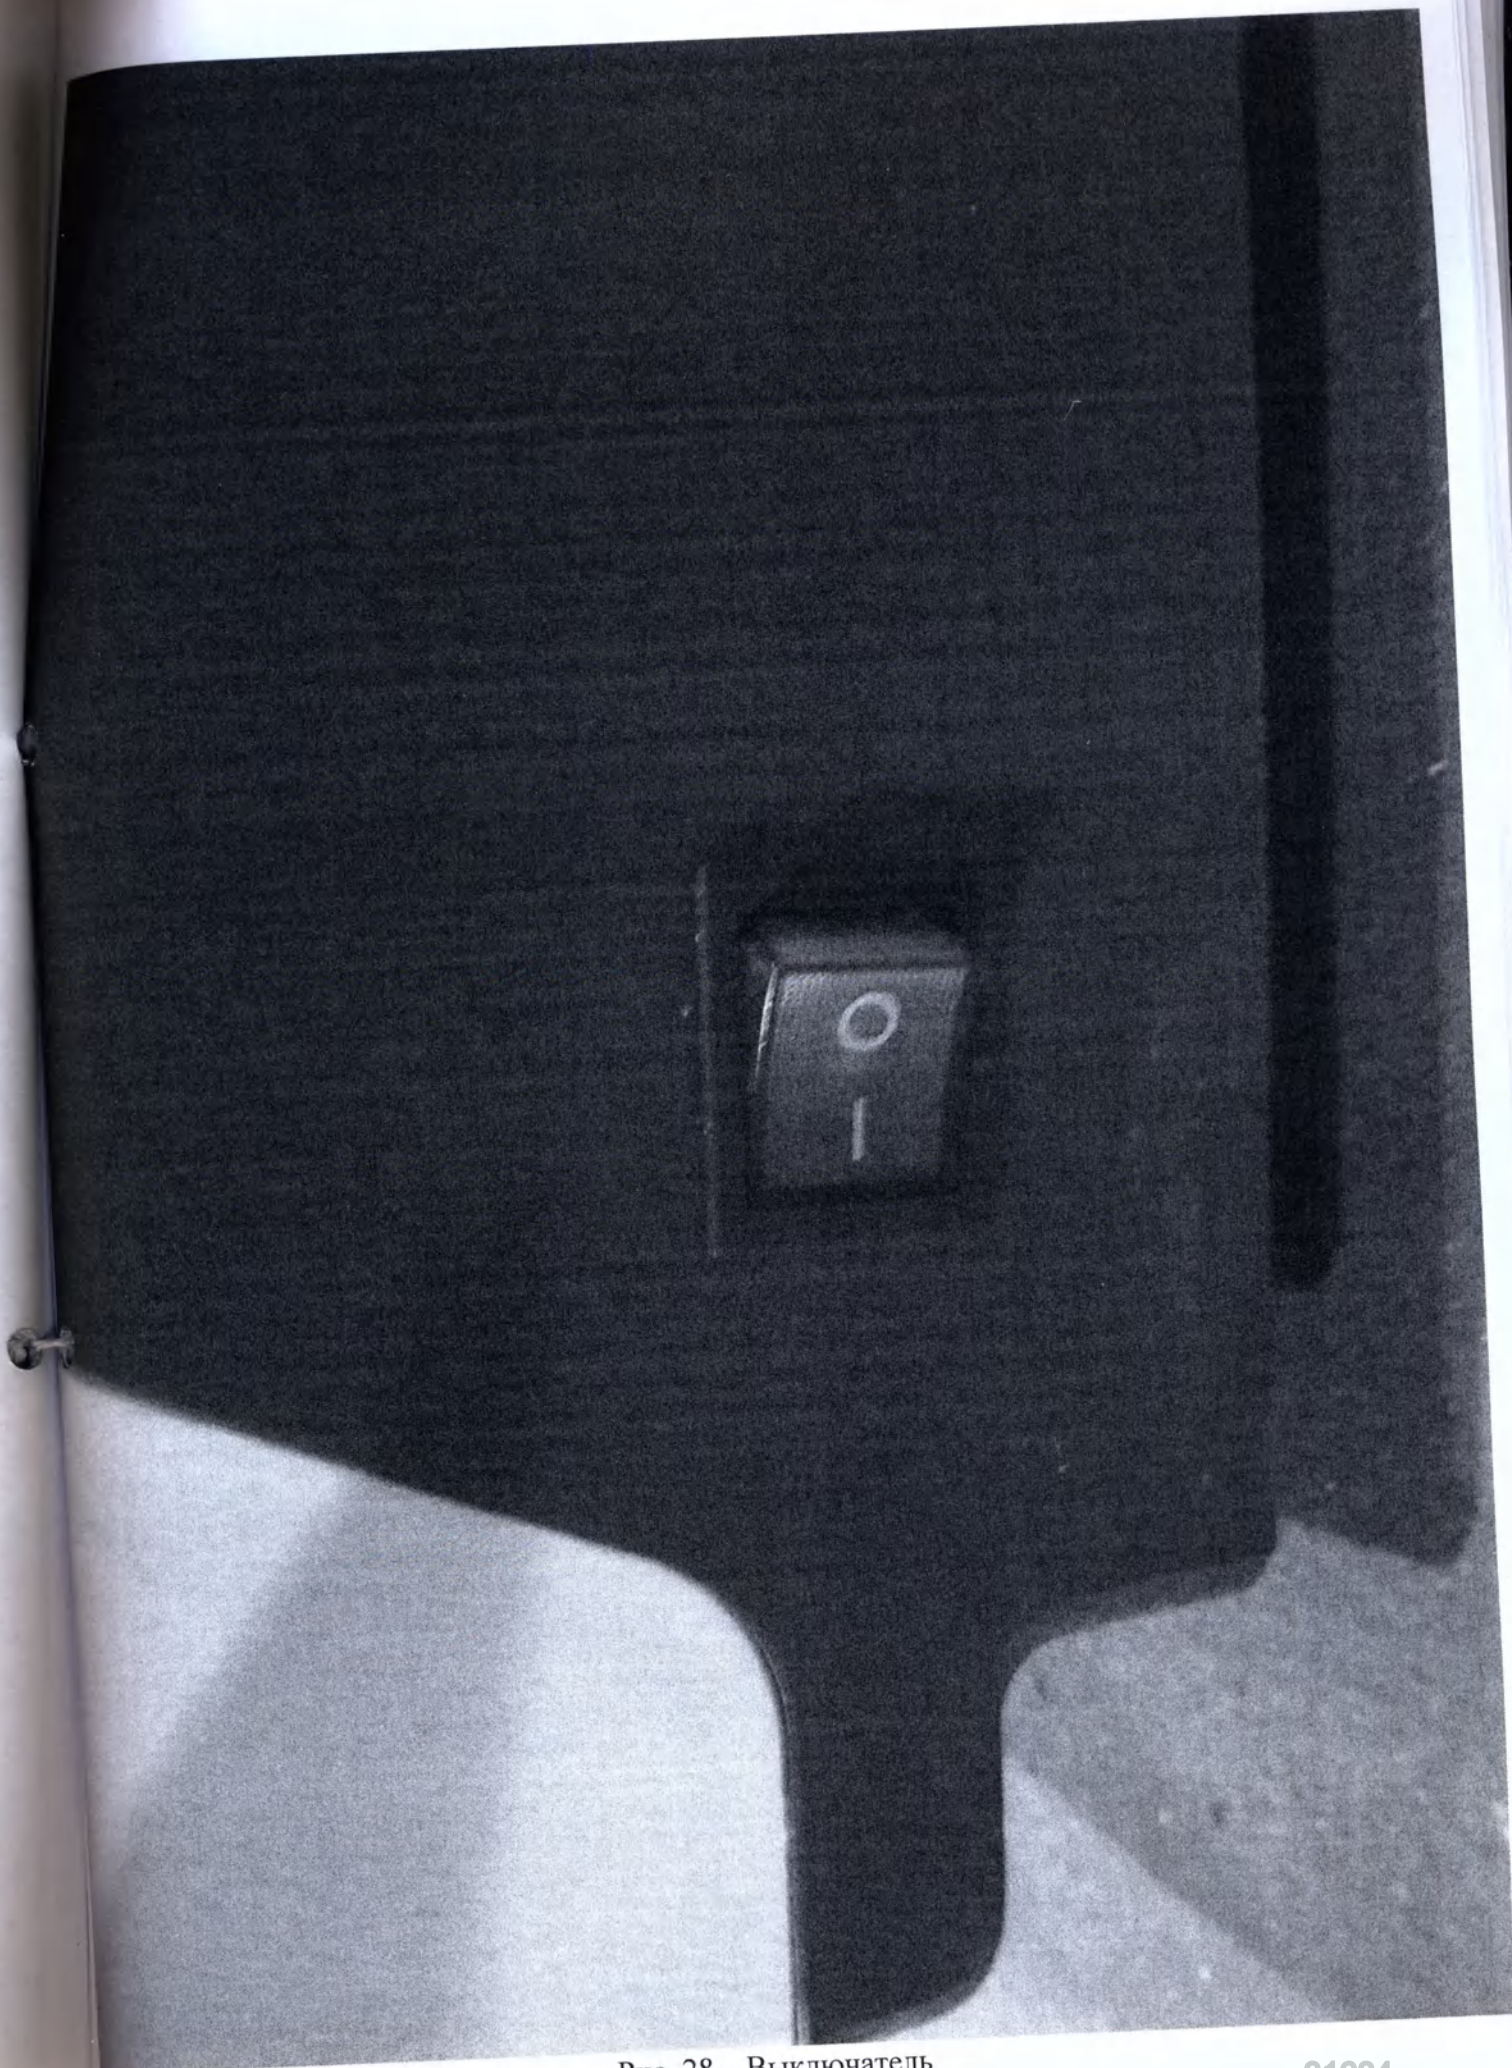


Рис. 28 – Выключатель

иская настольная

Co., Ltd., No. 12
Jintan Town, Jintan
(Цзянсу)
зона.
Чанчжоу.

630091
Советская.

Центрифуга лабораторная медицинская настольная
«Armed»

Вариант исполнения: LC-04A

РУ № _____ от _____ г.

Производитель: Zenith Lab (Jiangsu) Co., Ltd., No. 12
Hongshan Road, Industrial Zone, Jincheng Town, Jintan
District, Changzhou, Jiangsu, China («Зенит Лаб (Цзянсу)
Ко., Лтд.», № 12, ул. Хуншань, Промышленная зона,
городок Цзиньчен, район Цзиньтань, г. Чанчжоу,
провинция Цзянсу, Китай)

Дистрибьютер: ООО «МЕДИМПОРТ», 630091
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская,
дом 52, пом. 14, офис 211

Потребляемая мощность: не более 160 В*А


Напряжение питания: ~220 В (± 10%)


Частота сети: 50 Гц (± 2%)


Дата выпуска: 03.2018


Серийный номер: 21530040




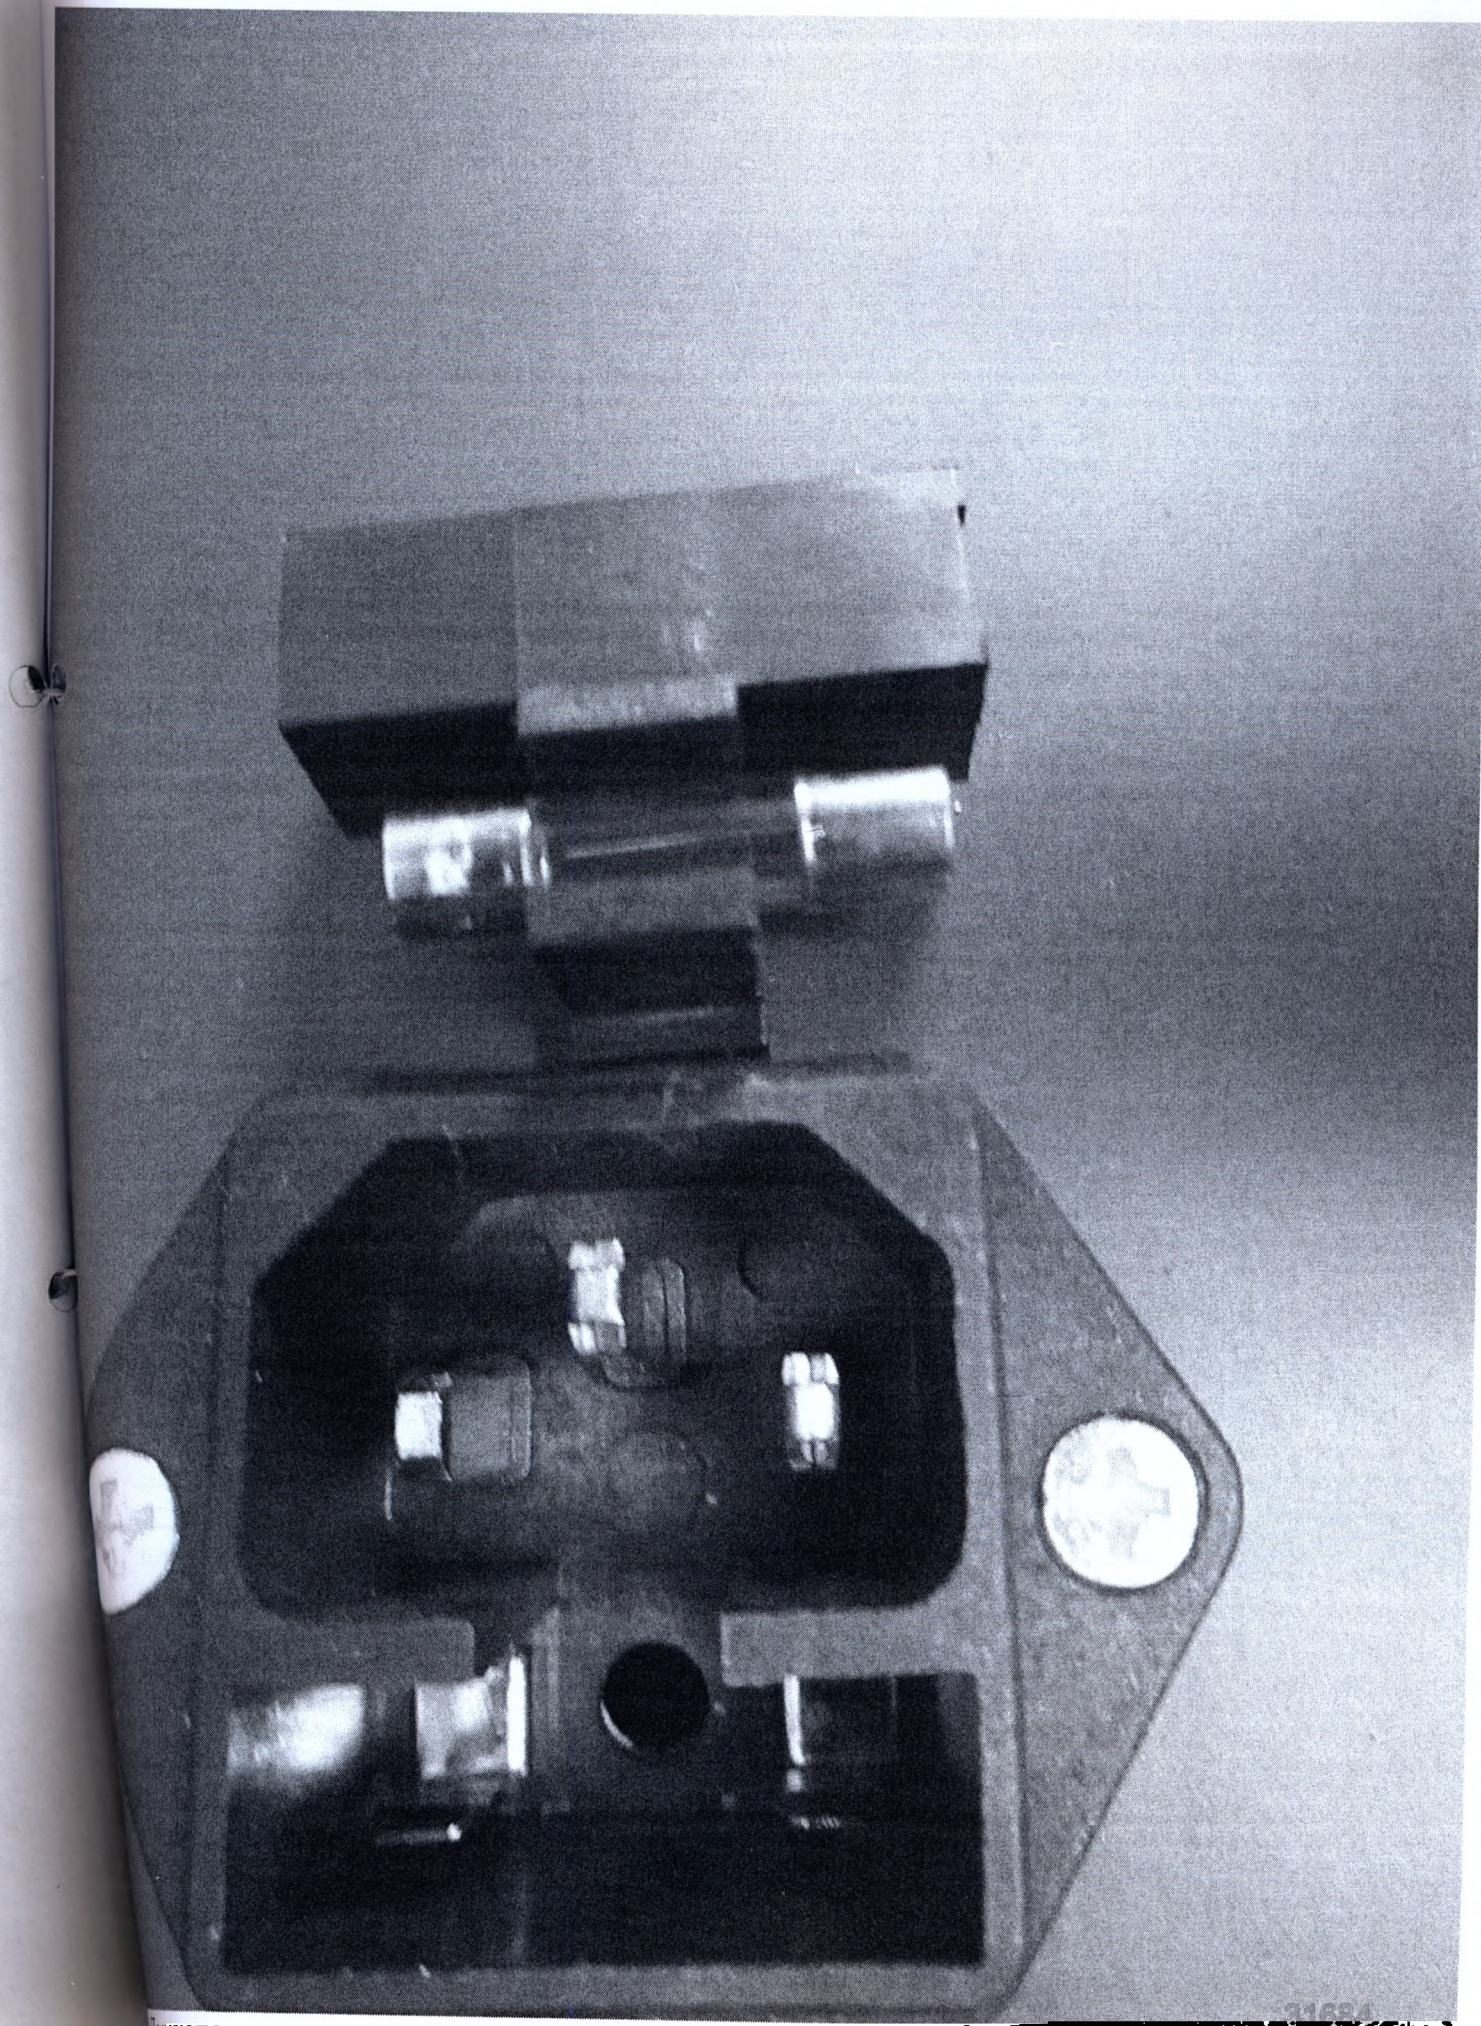


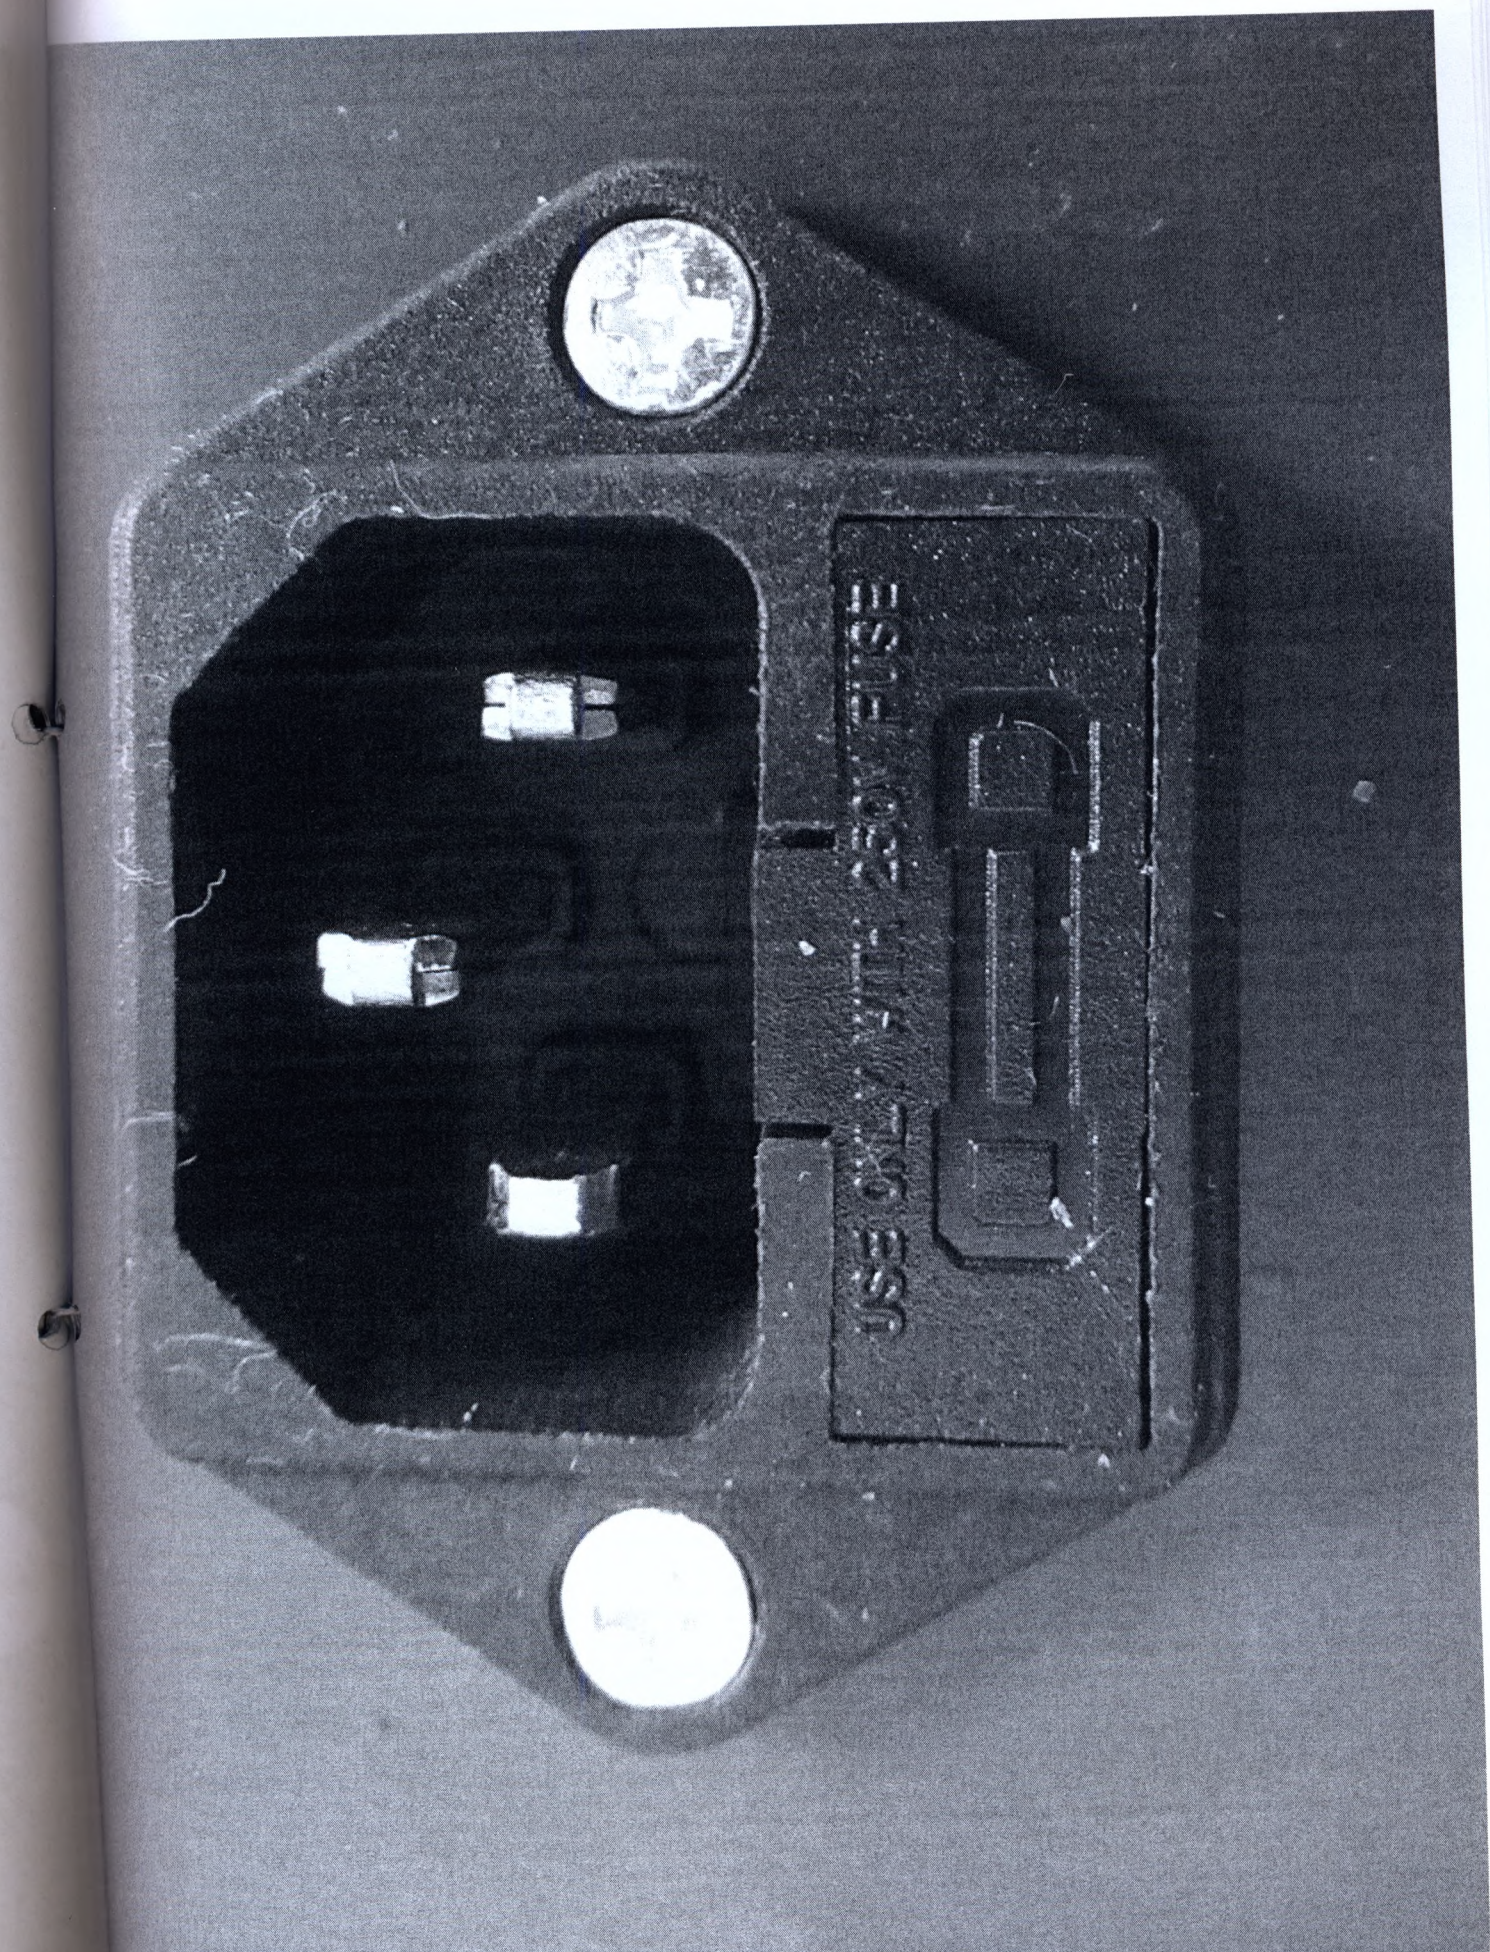

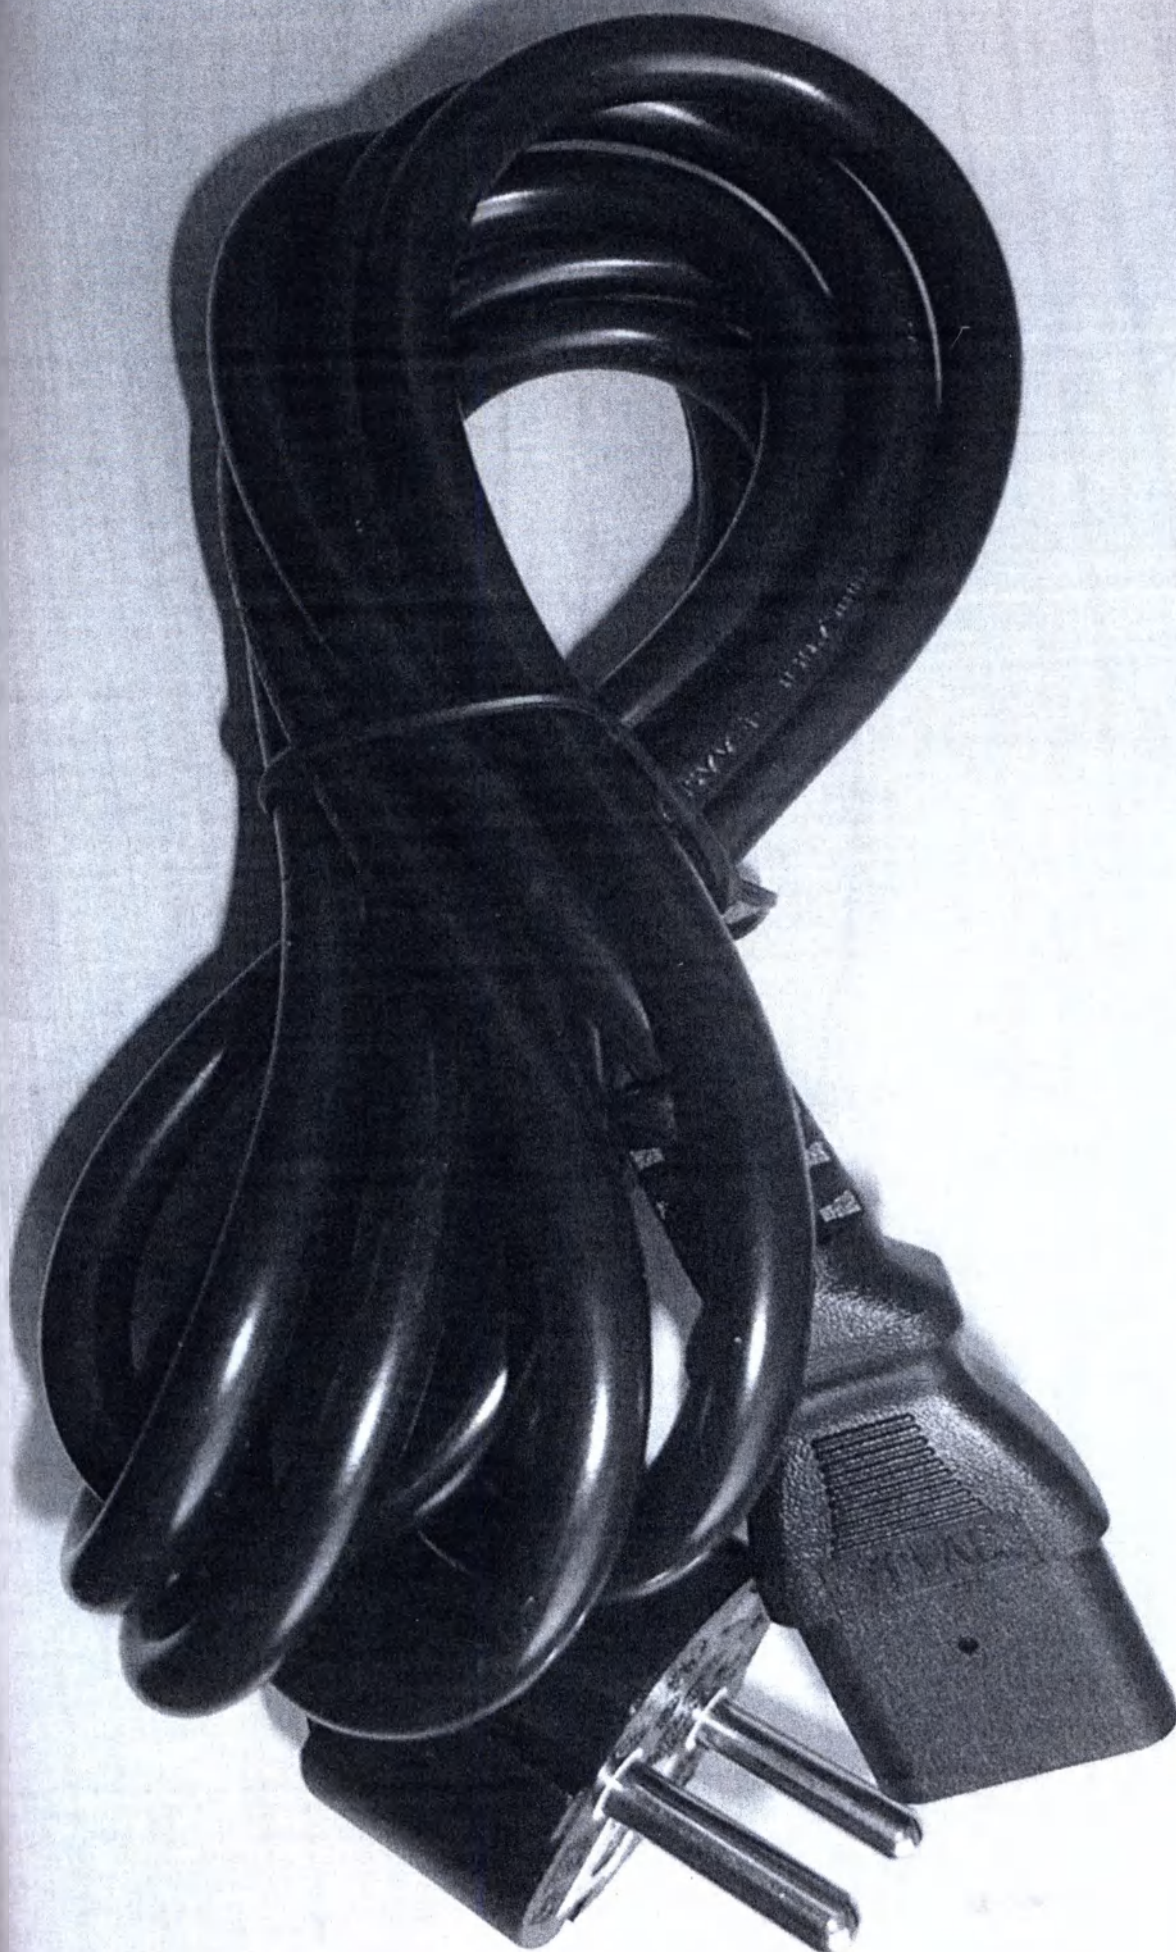

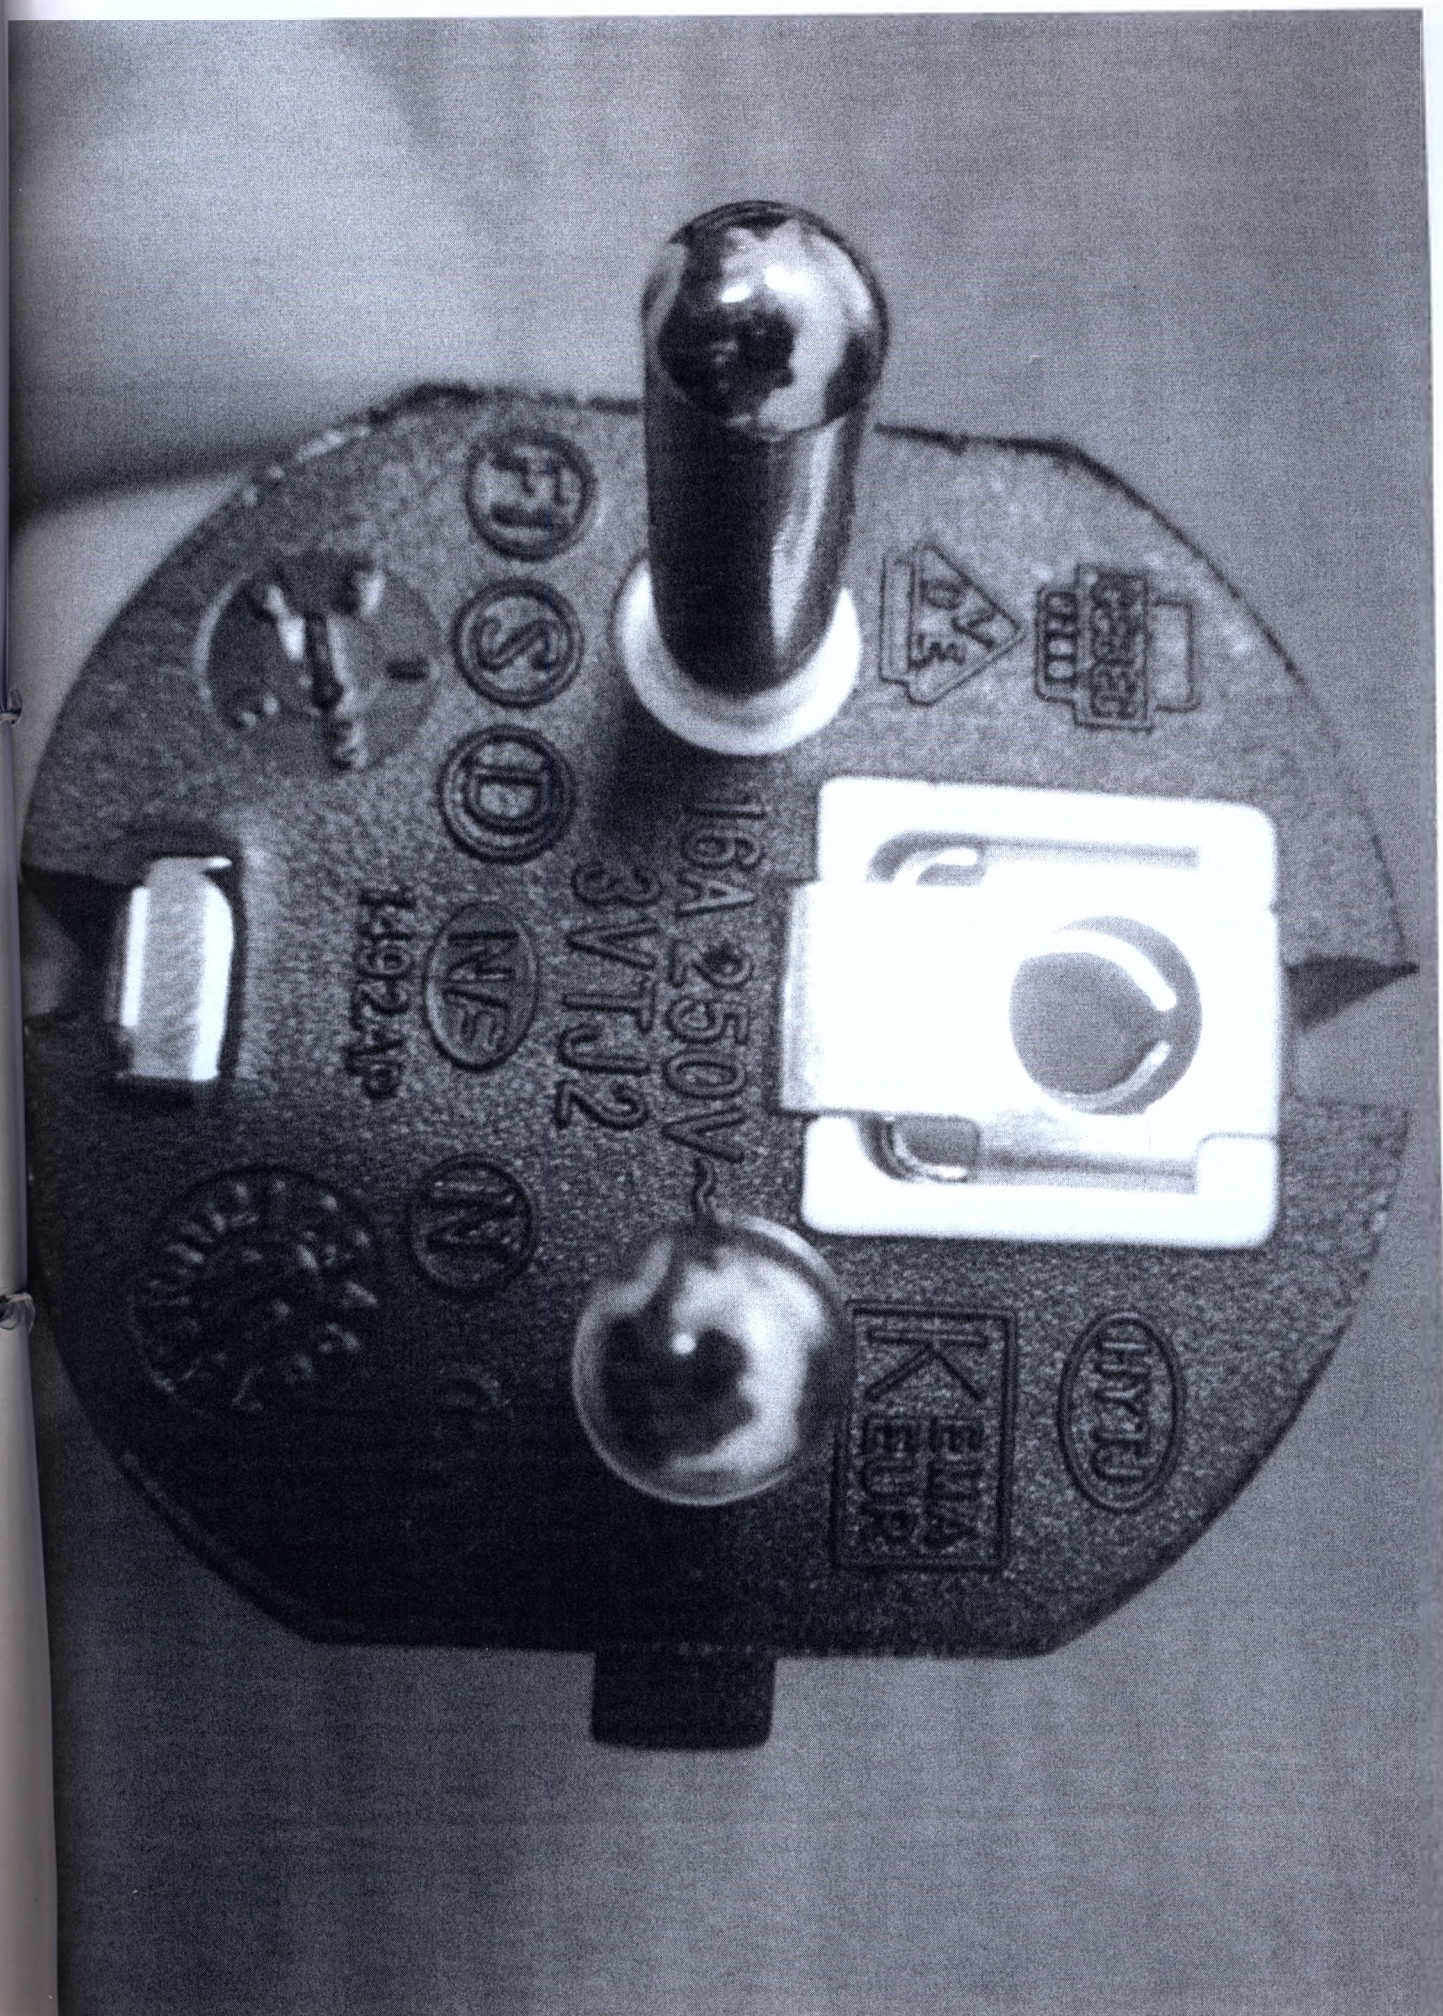

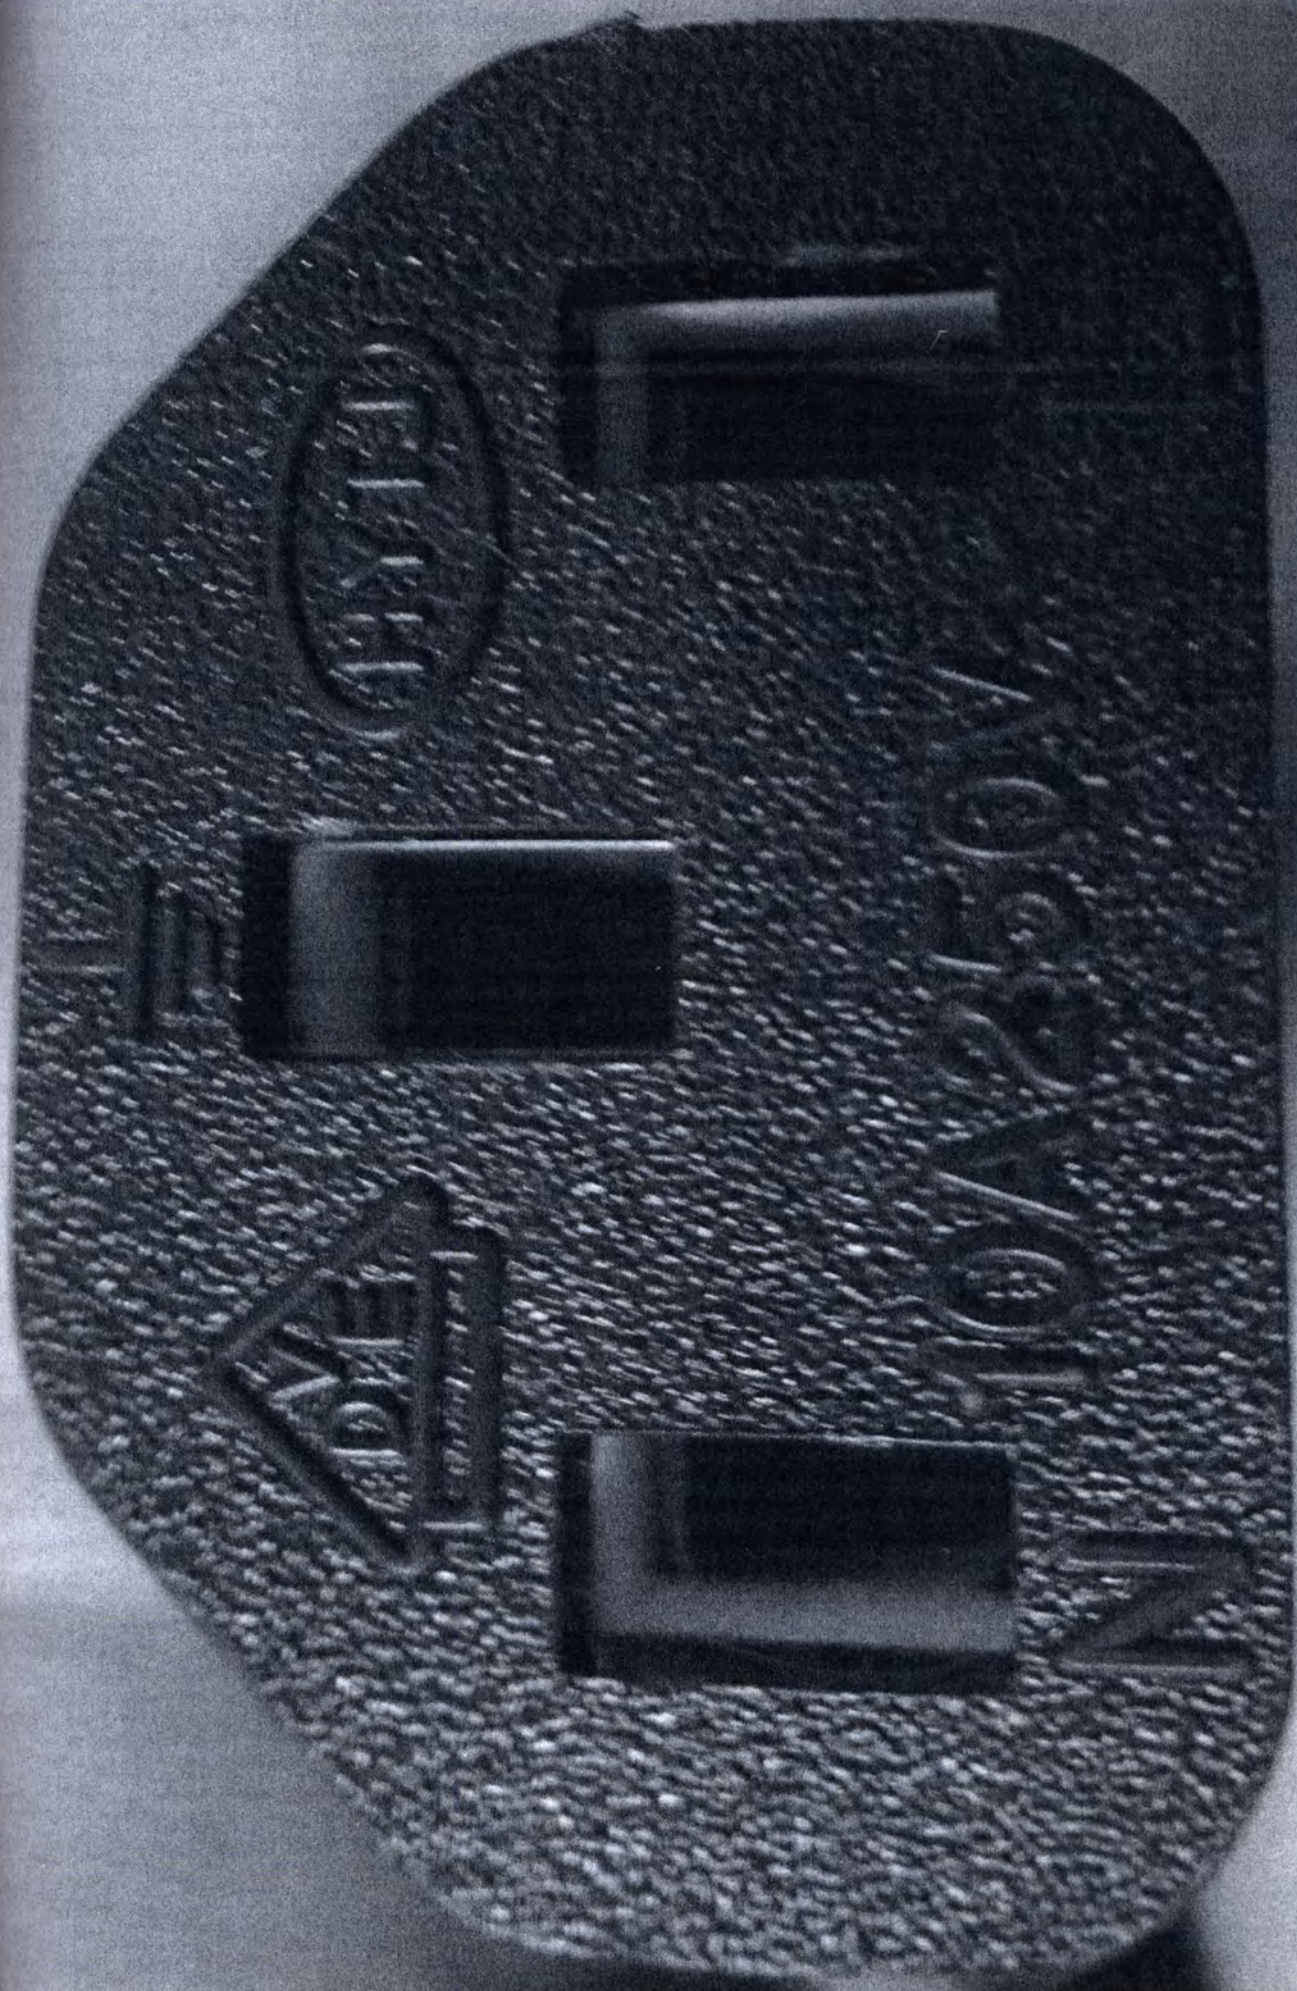

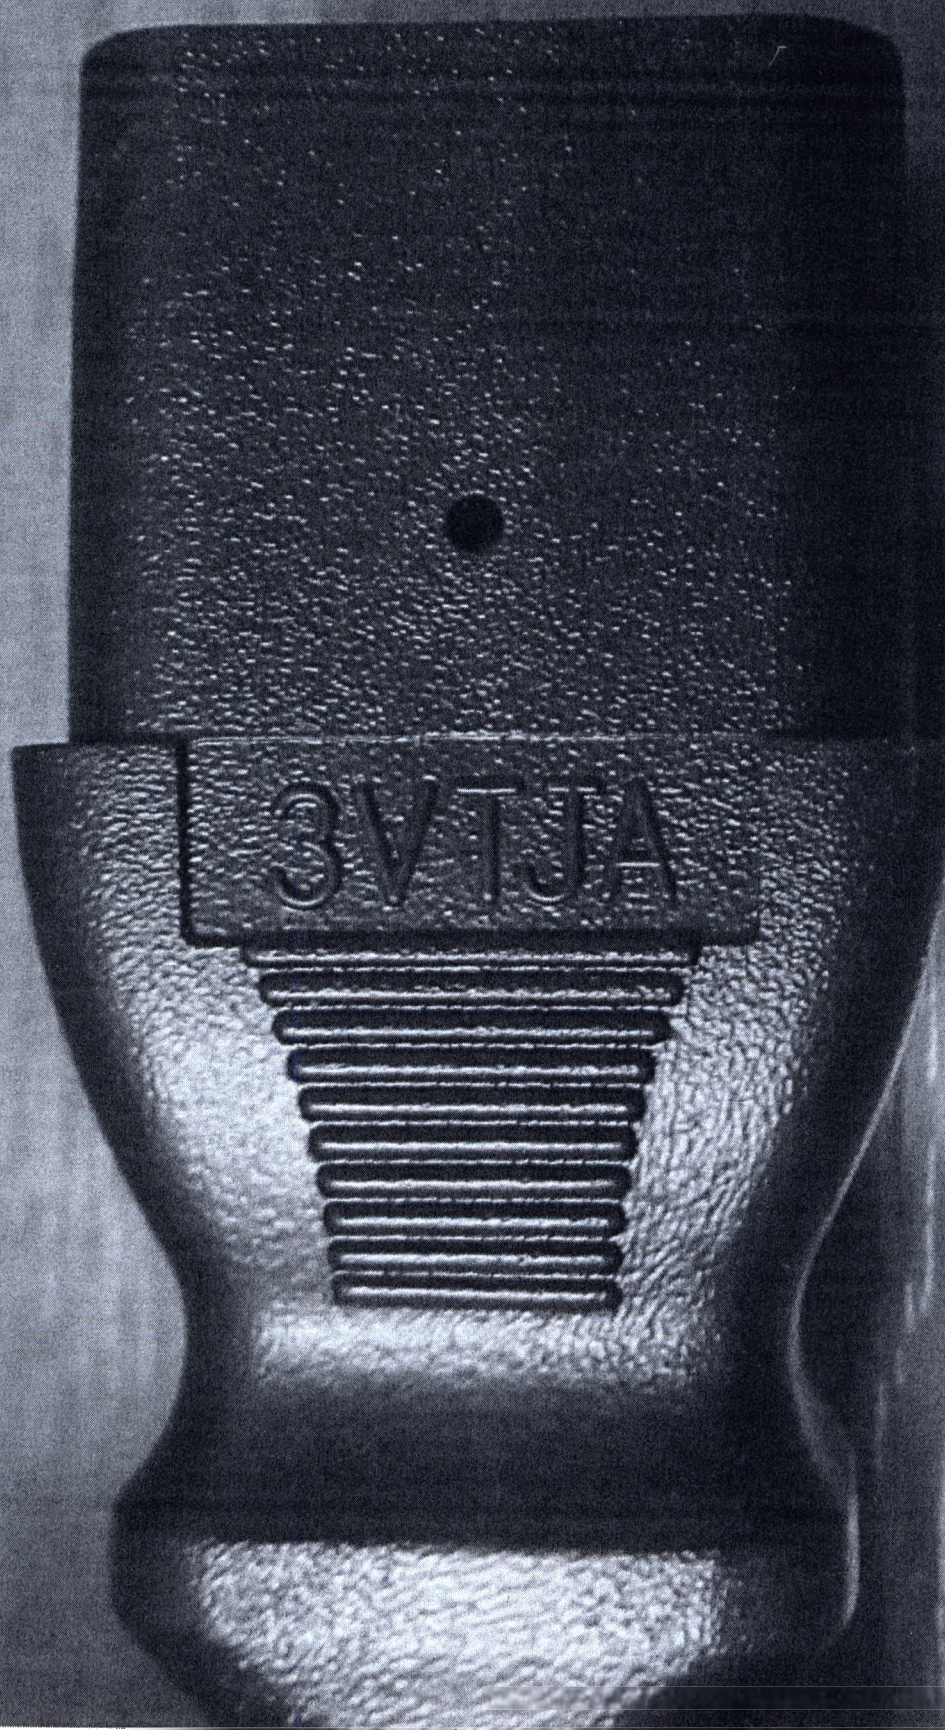

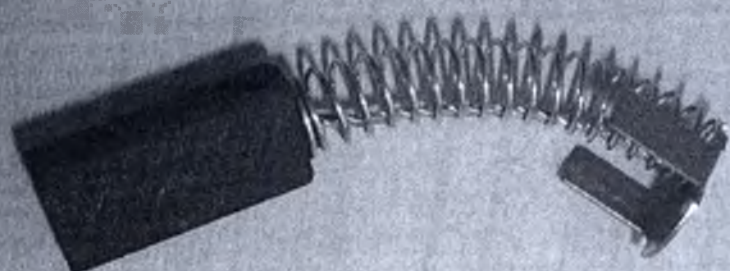


Рис. 36 – Щетка электродвигателя (2 шт.)

31684
14.05.2020

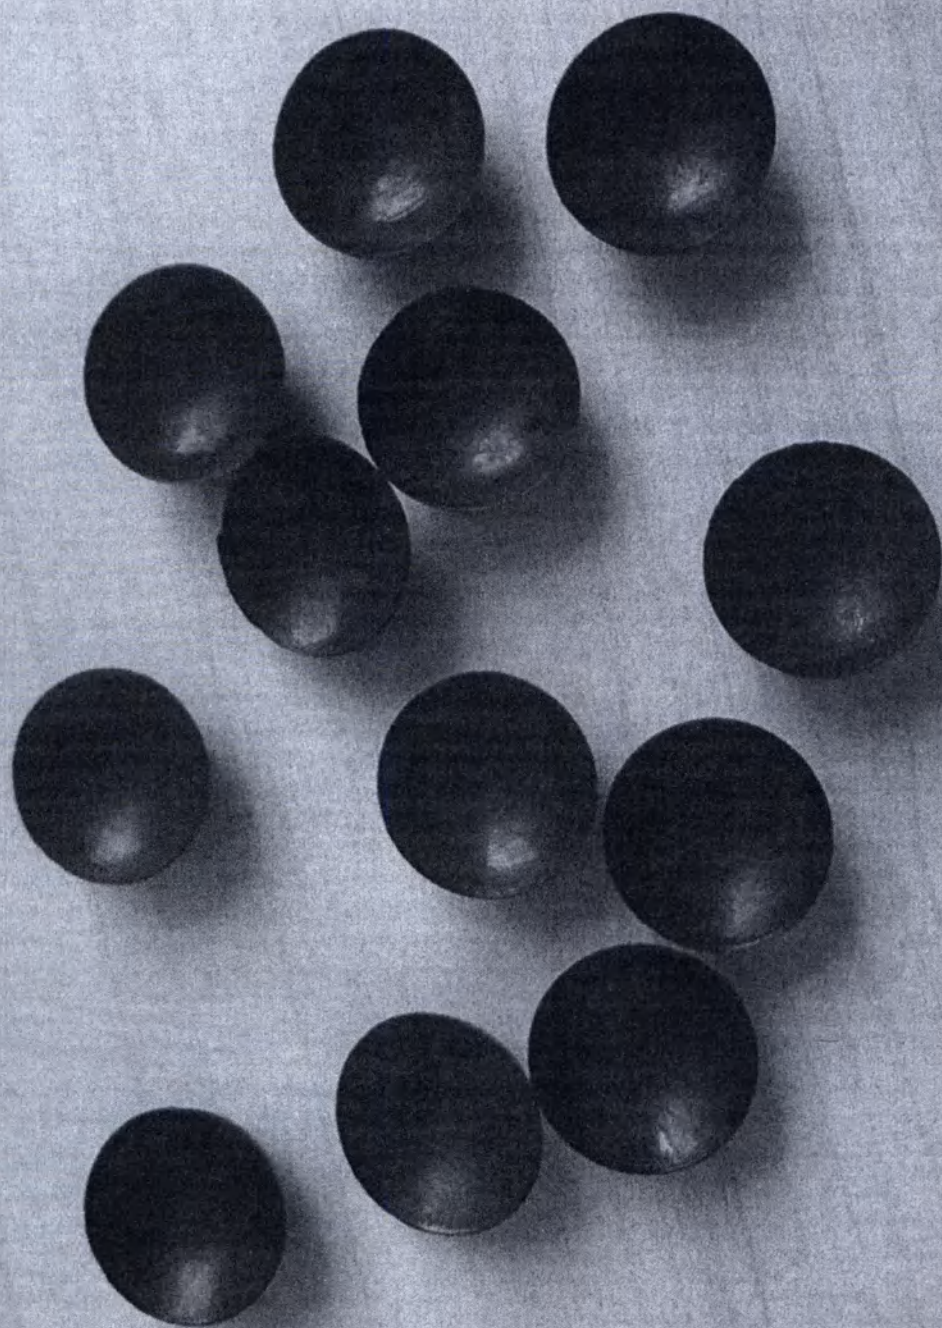


Рис. 37 – Уплотнитель (12 шт.)

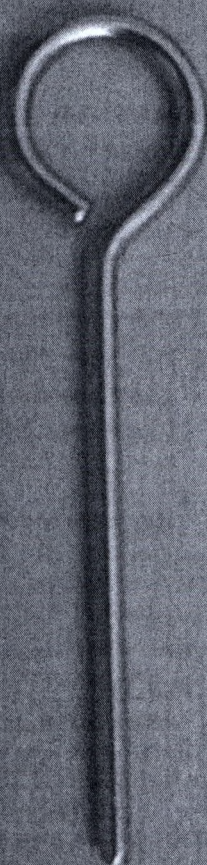
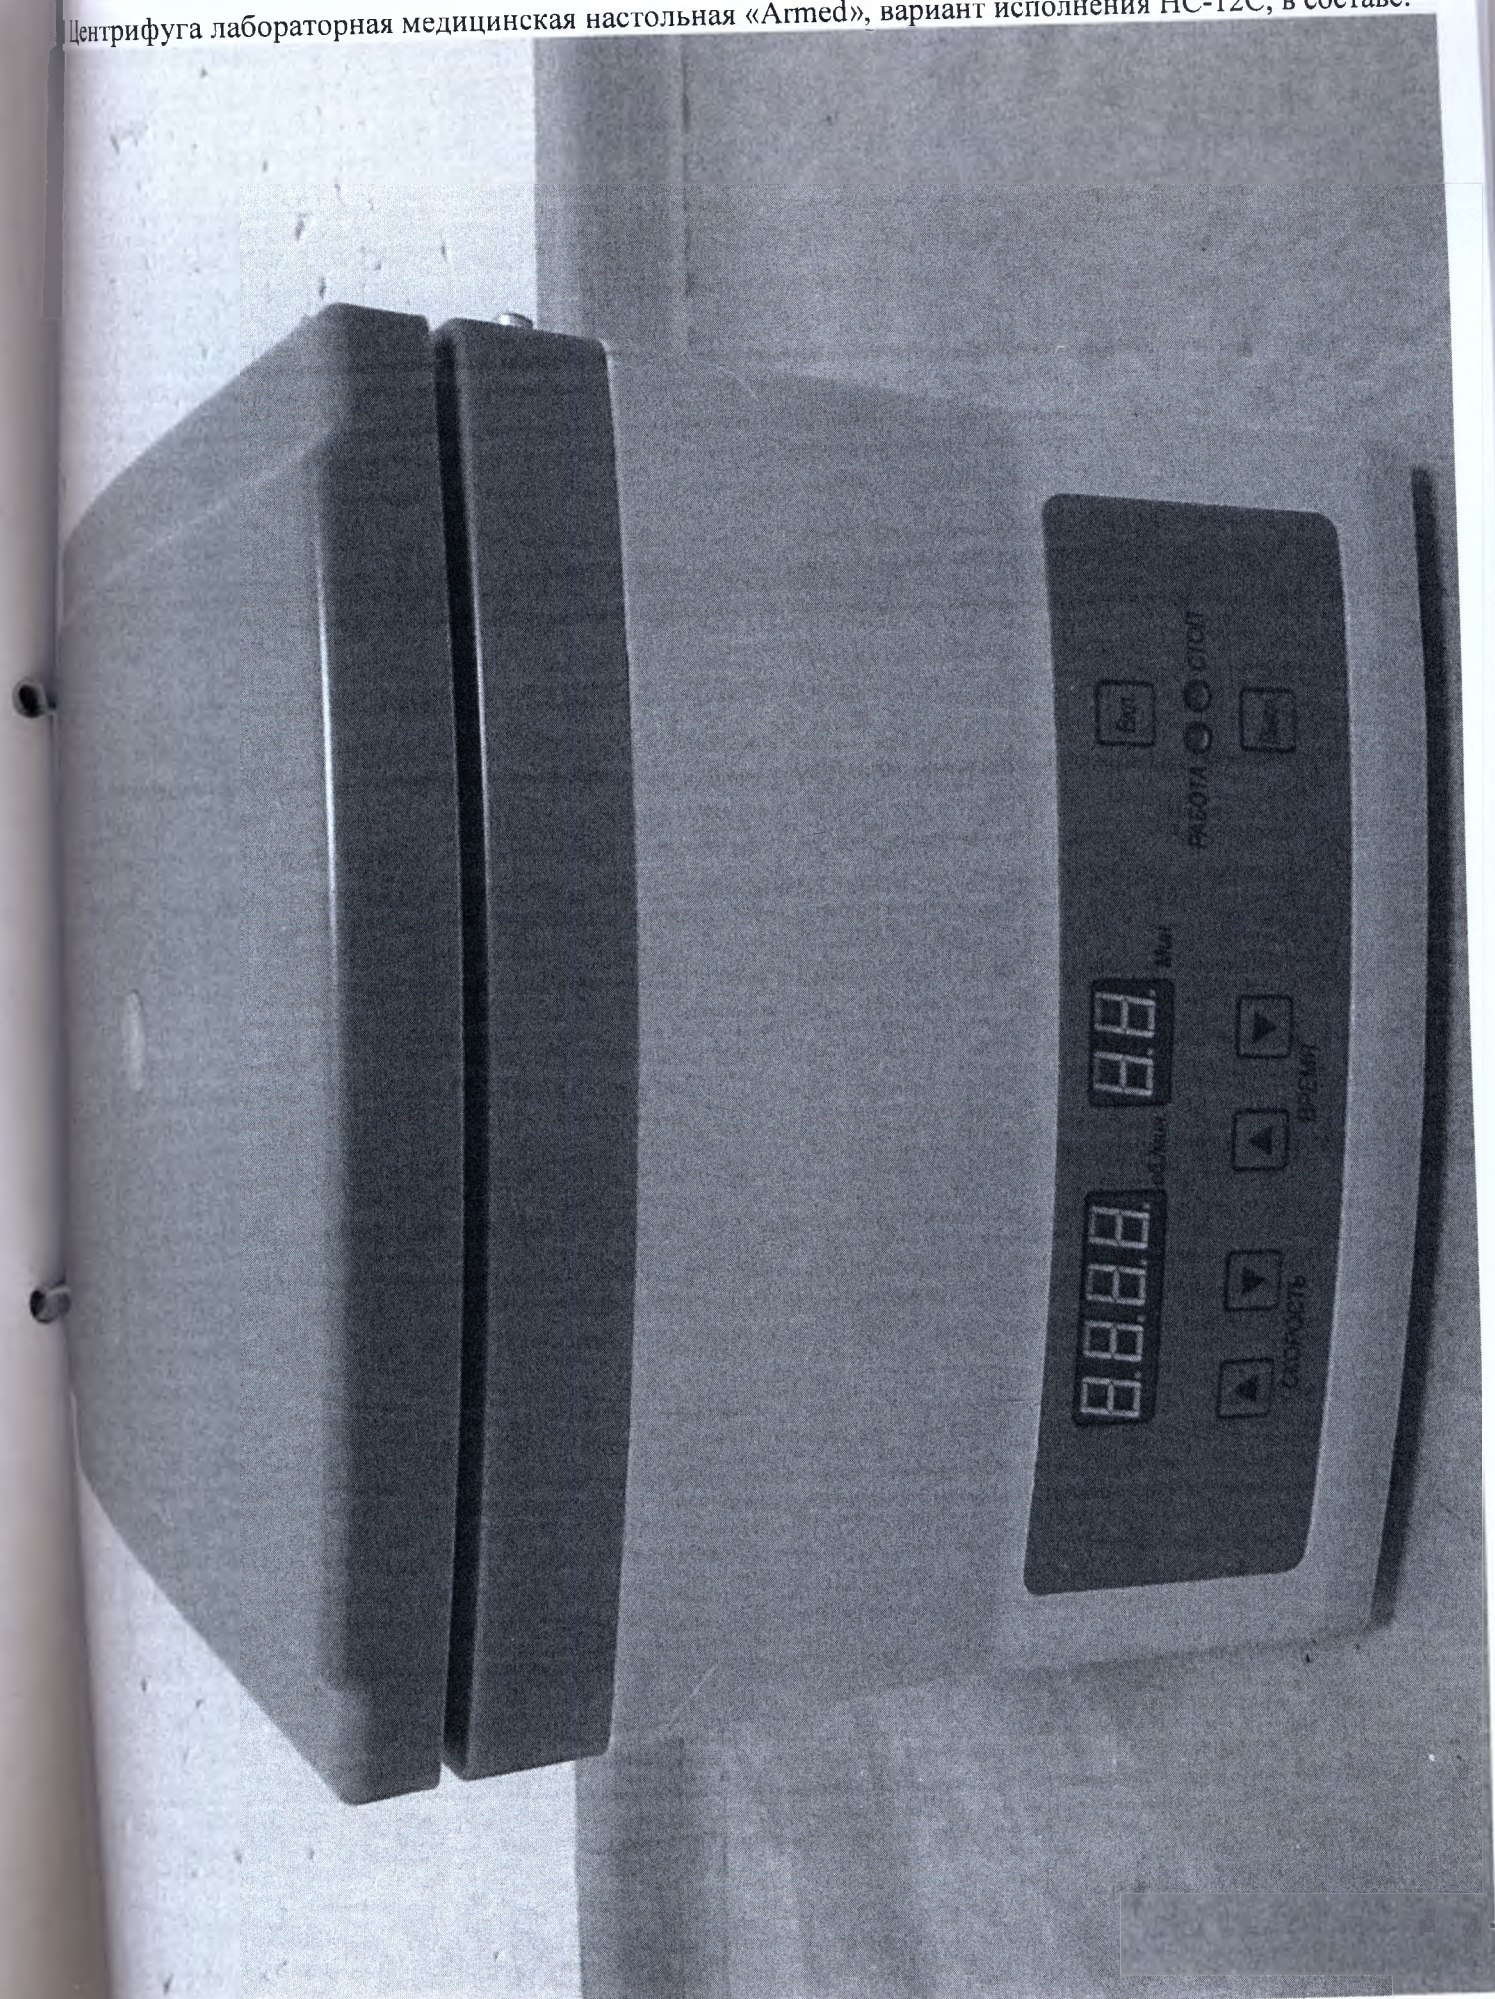


Рис. 38 – Ключ для открытия крышки



Рис. 39 – Предохранитель плавкий F2AL 250 В (2 шт.)

Центрифуга лабораторная медицинская настольная «Armed», вариант исполнения НС-12С, в составе:



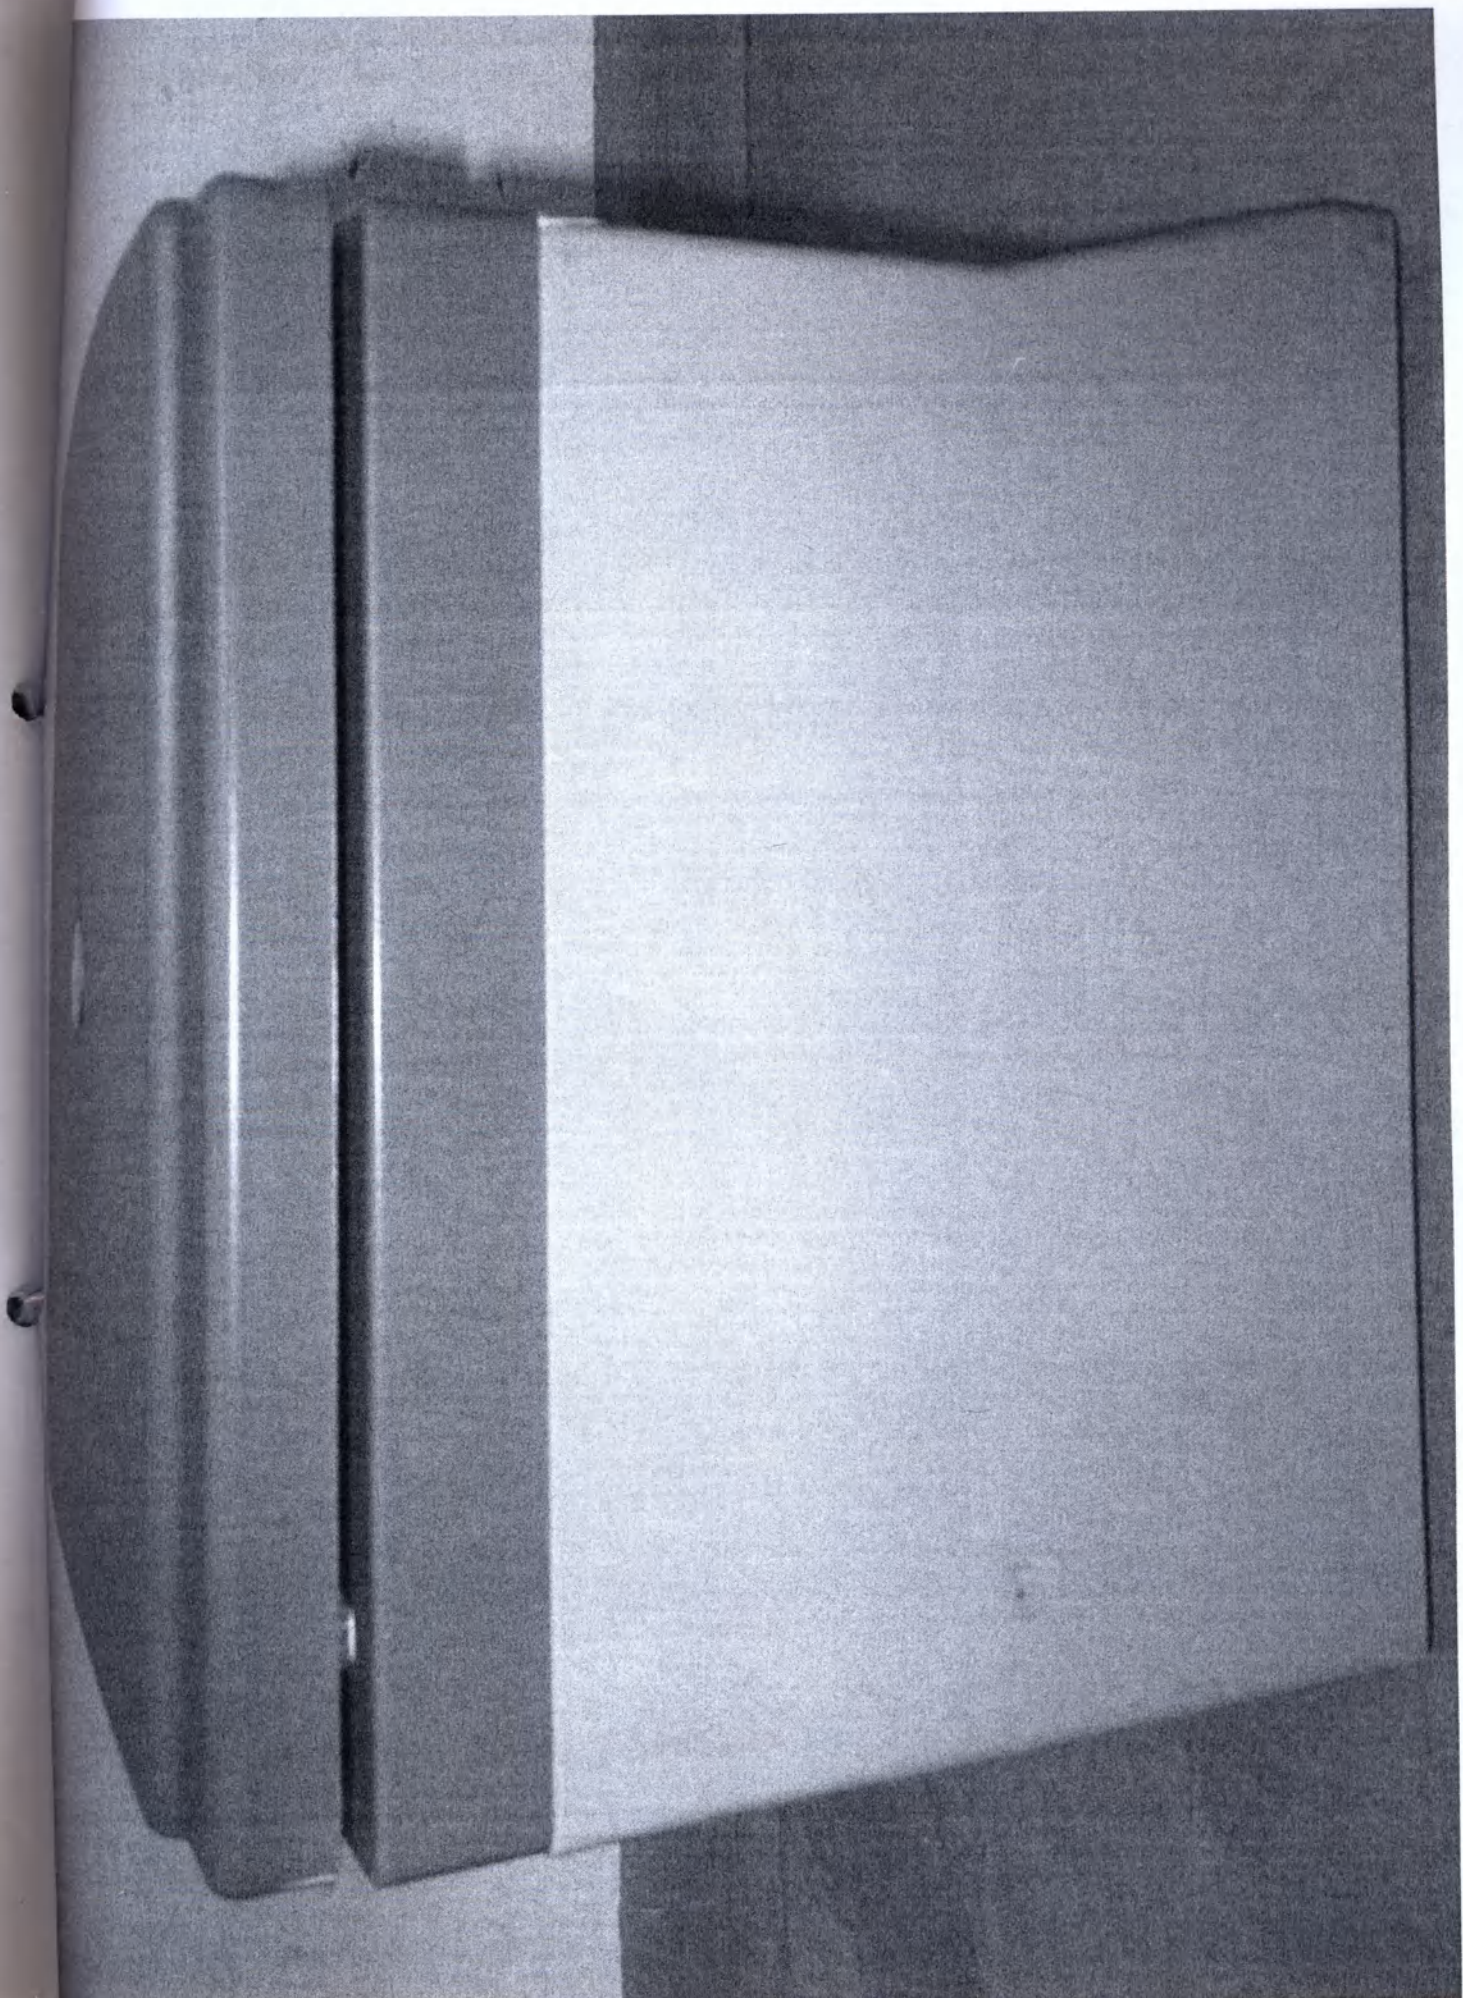


Рис. 41 – Центрифуга (вид сбоку 1)


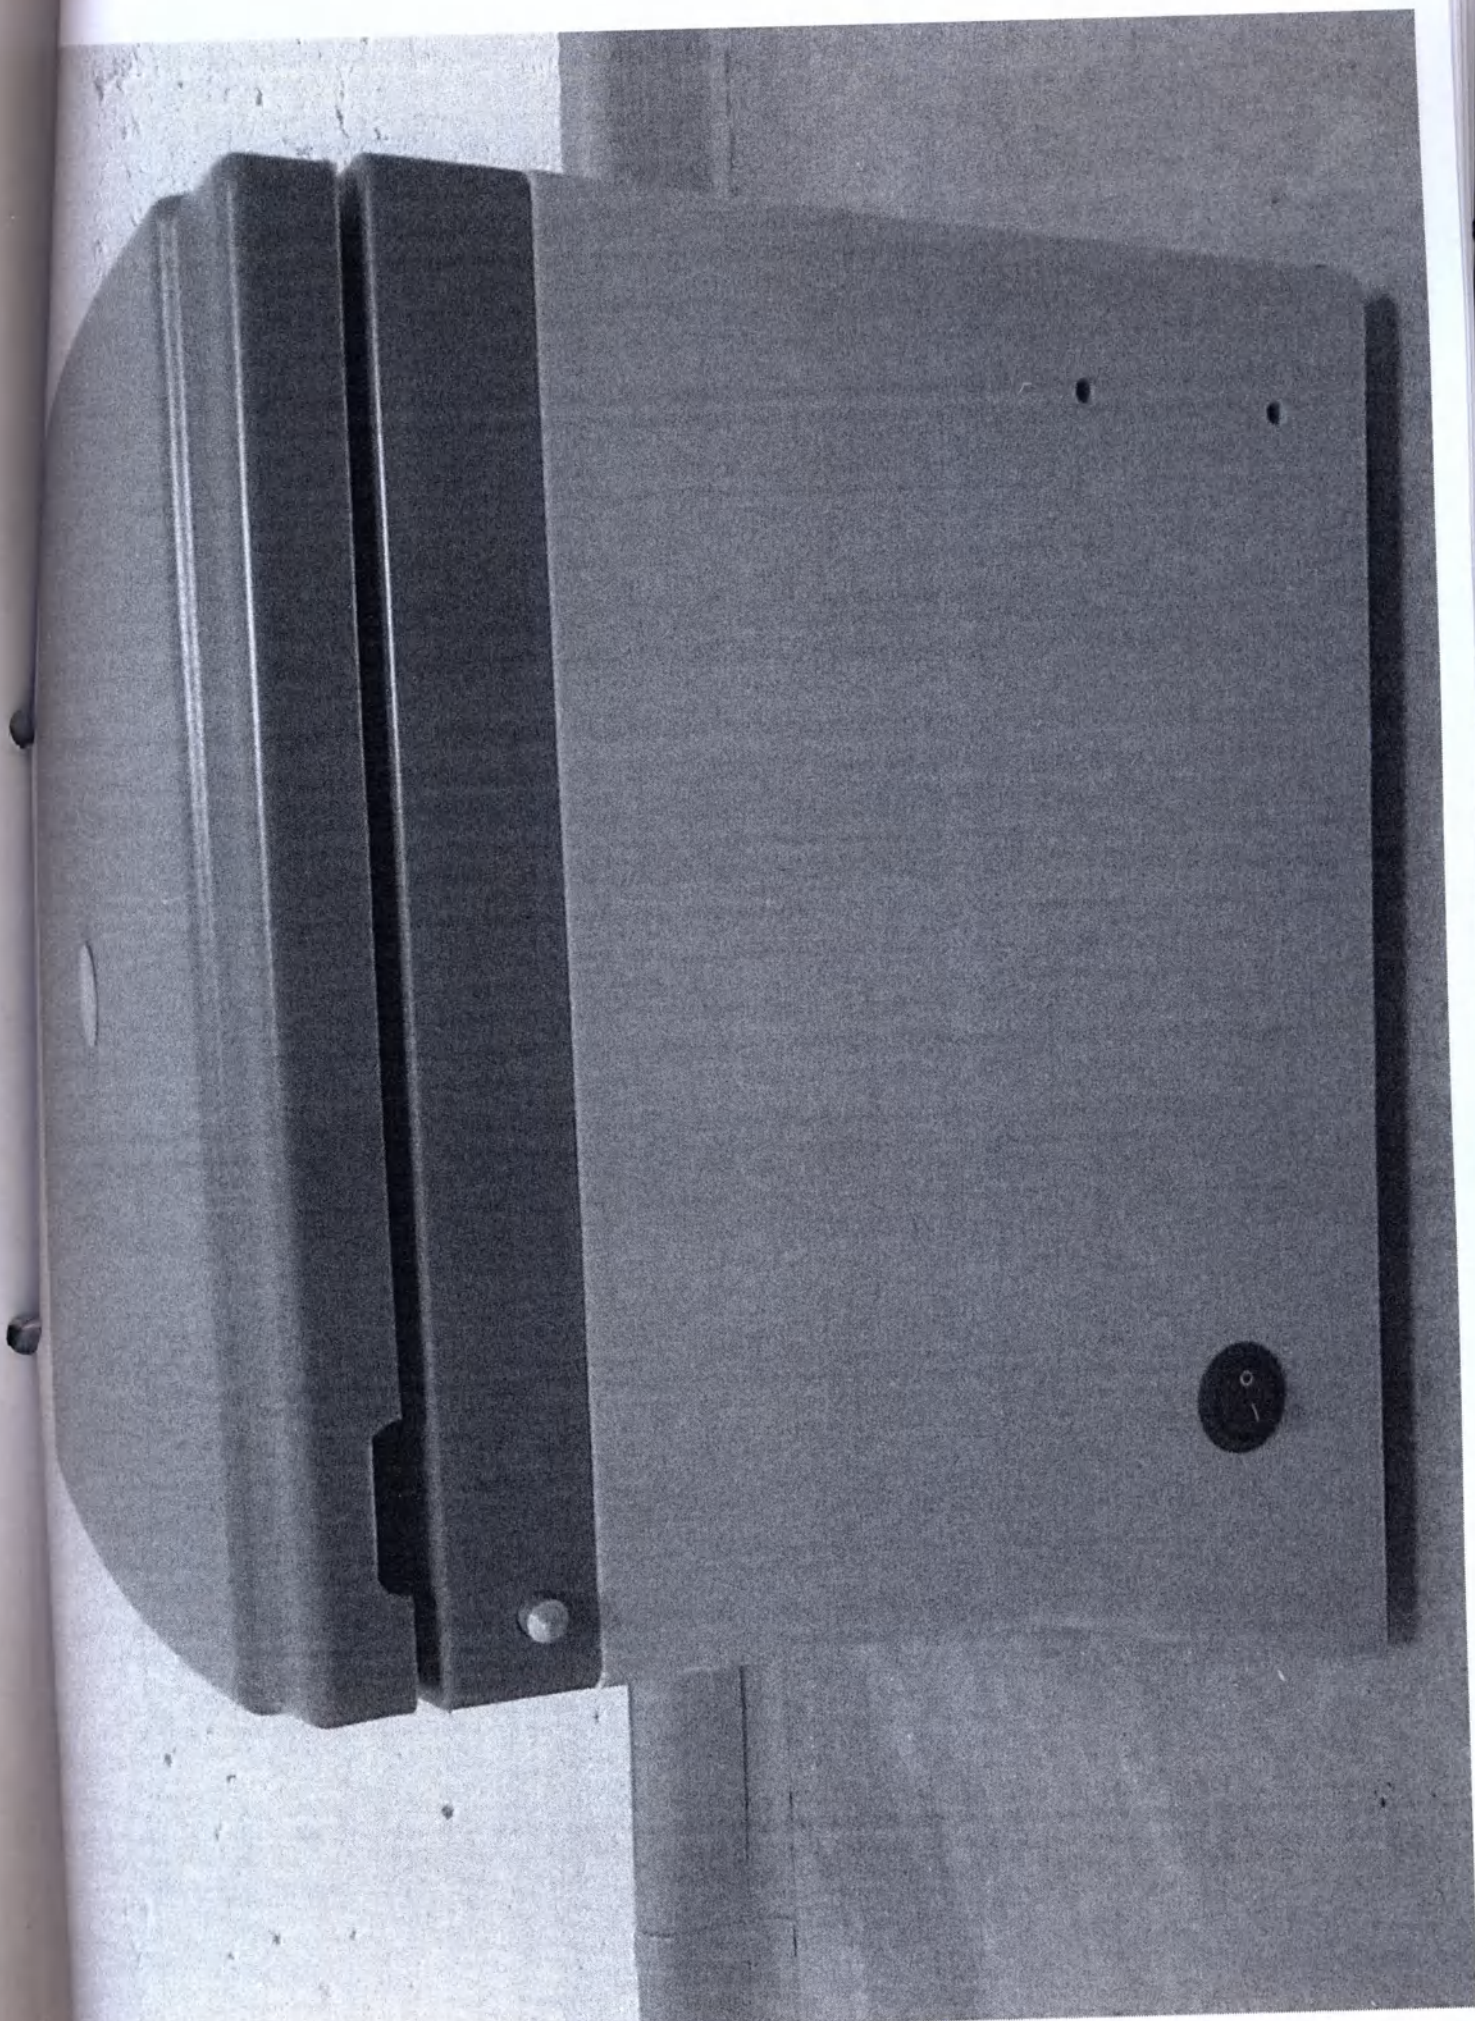


Рис. 42 – Центрифуга (вид сбоку 2)

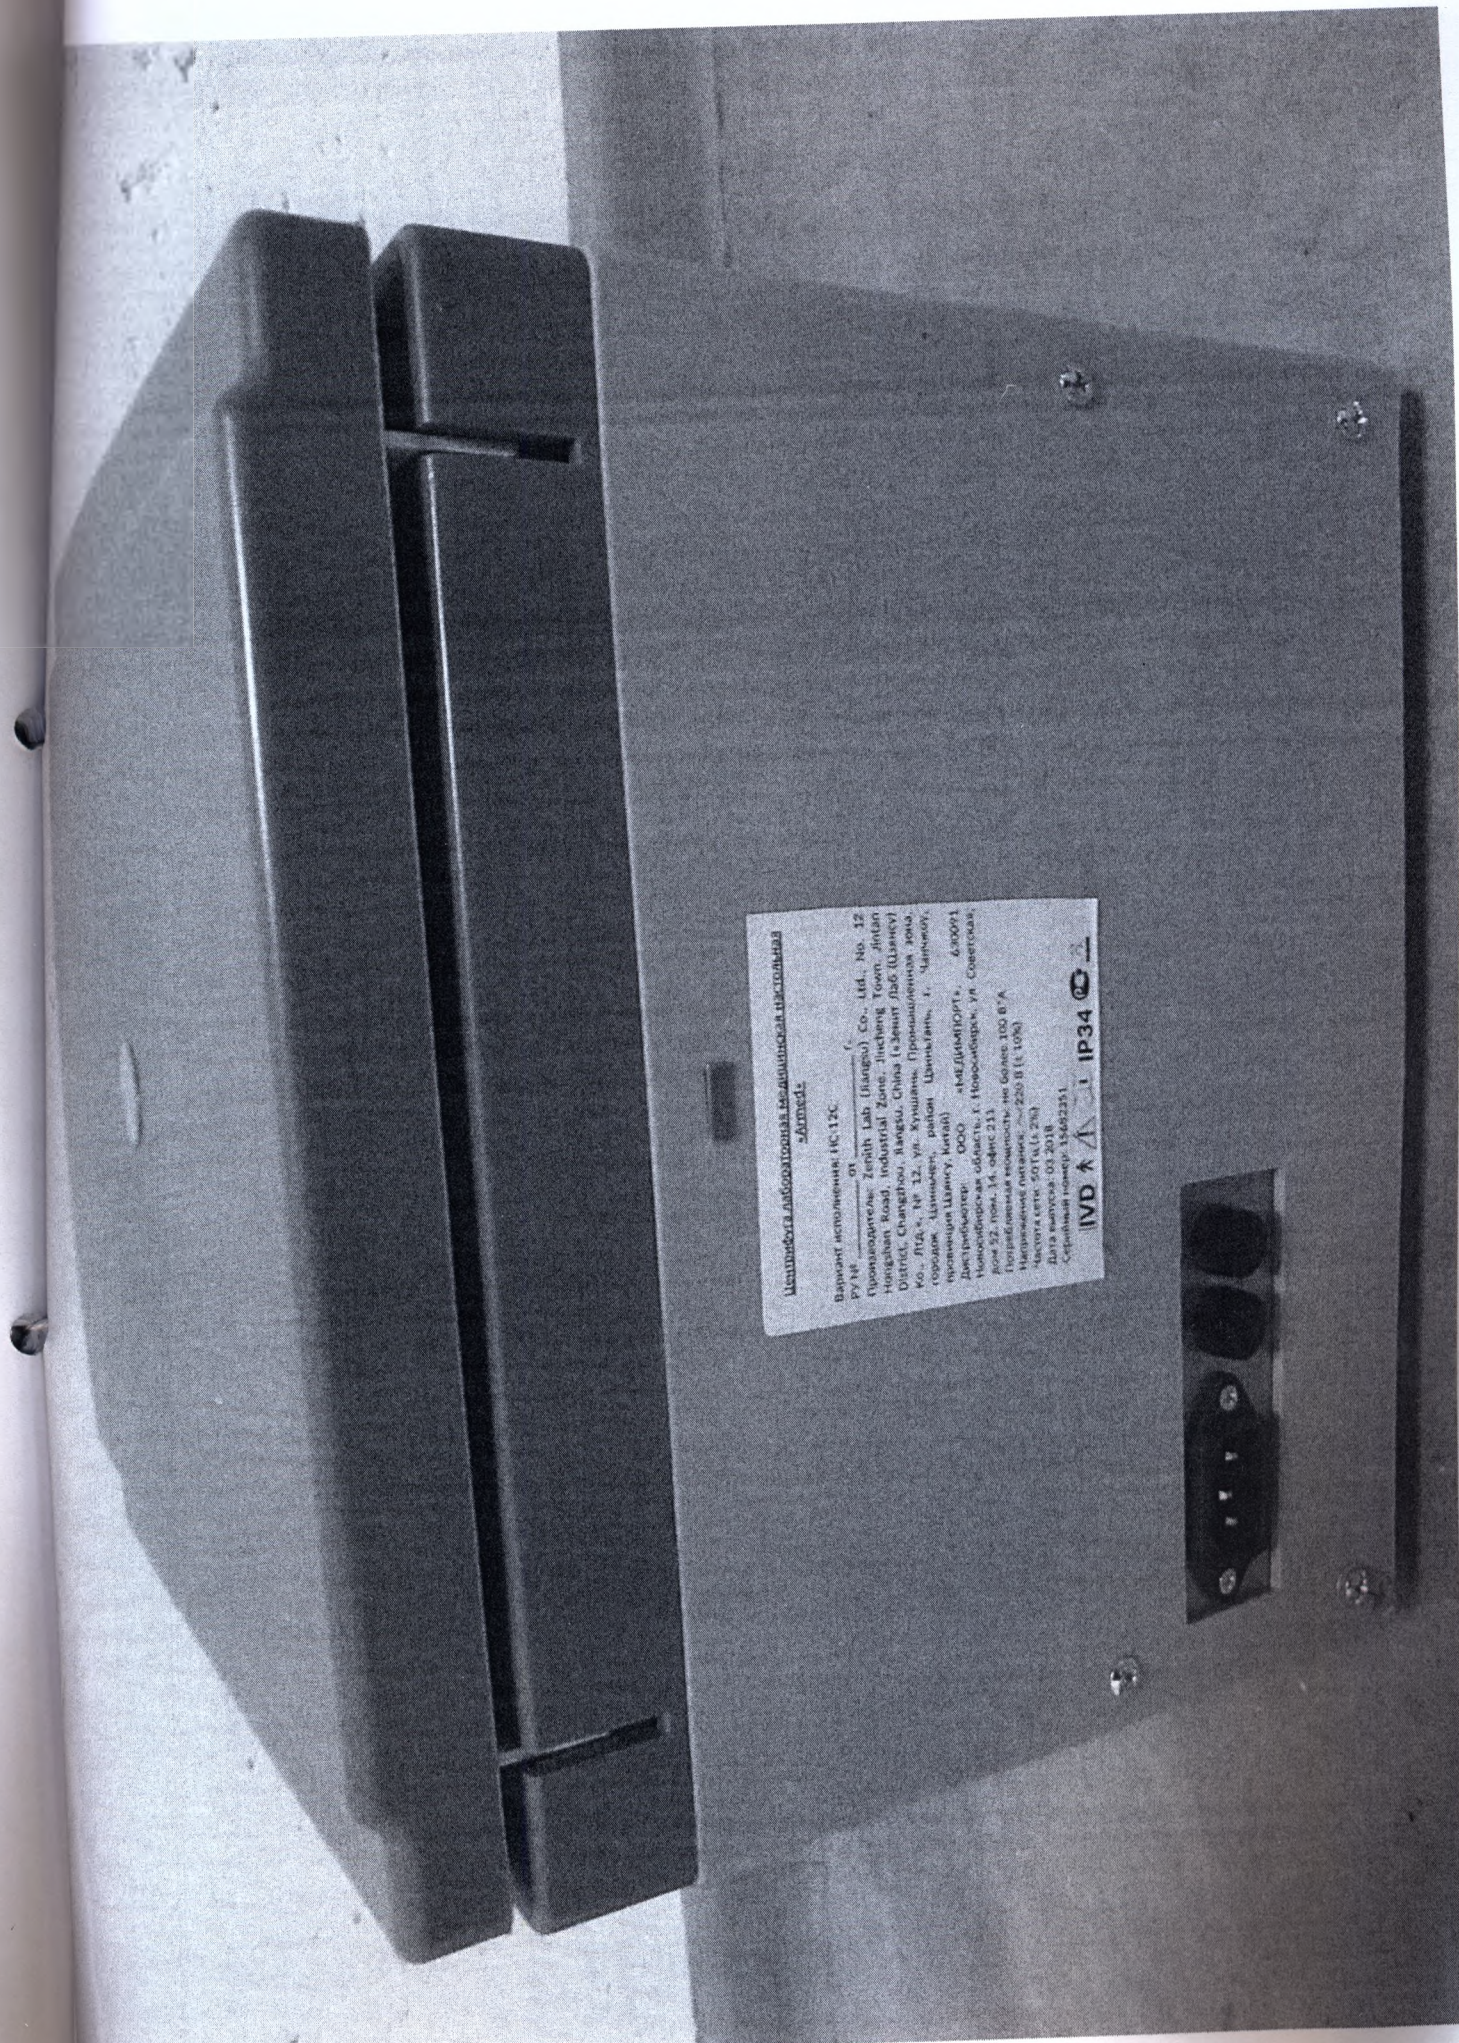

Центрифуга лабораторная гравитационная настольная
Завтра:

Вариант исполнения: НС-12С.
Р/У № _____ от _____
Производитель: Zhenli Lab (Hangzhou) Co., Ltd., No. 12
Hongshan Road, Industrial Zone, Jiesheng Town, Jintan
District, Changzhou, Jiangsu, China (Зентли Лаб (Ханчжоу)
Ко. Лтд - № 12, ул. Хуншань, Промышленная зона
города Цзиньцзюнь, район Цзиньцзюнь, г. Чанчжоу,
провинция Цзянсу, Китай)
Дистрибьютор: ООО «МЕДИМЭД», 600091
Нижнегородская область, г. Новосибирск, ул. Советская,
дом 52, пом. 14, офис 213
Примечание: мощность не более 100 Вт
Напряжение питания: ~220 В (±10%)
Частота сети: 50 Гц (±2%)
Дата выпуска: 03.2018
Серийный номер: 15032351

IPD A A IP34

Рис. 43 – Центрифуга (вид сзади)

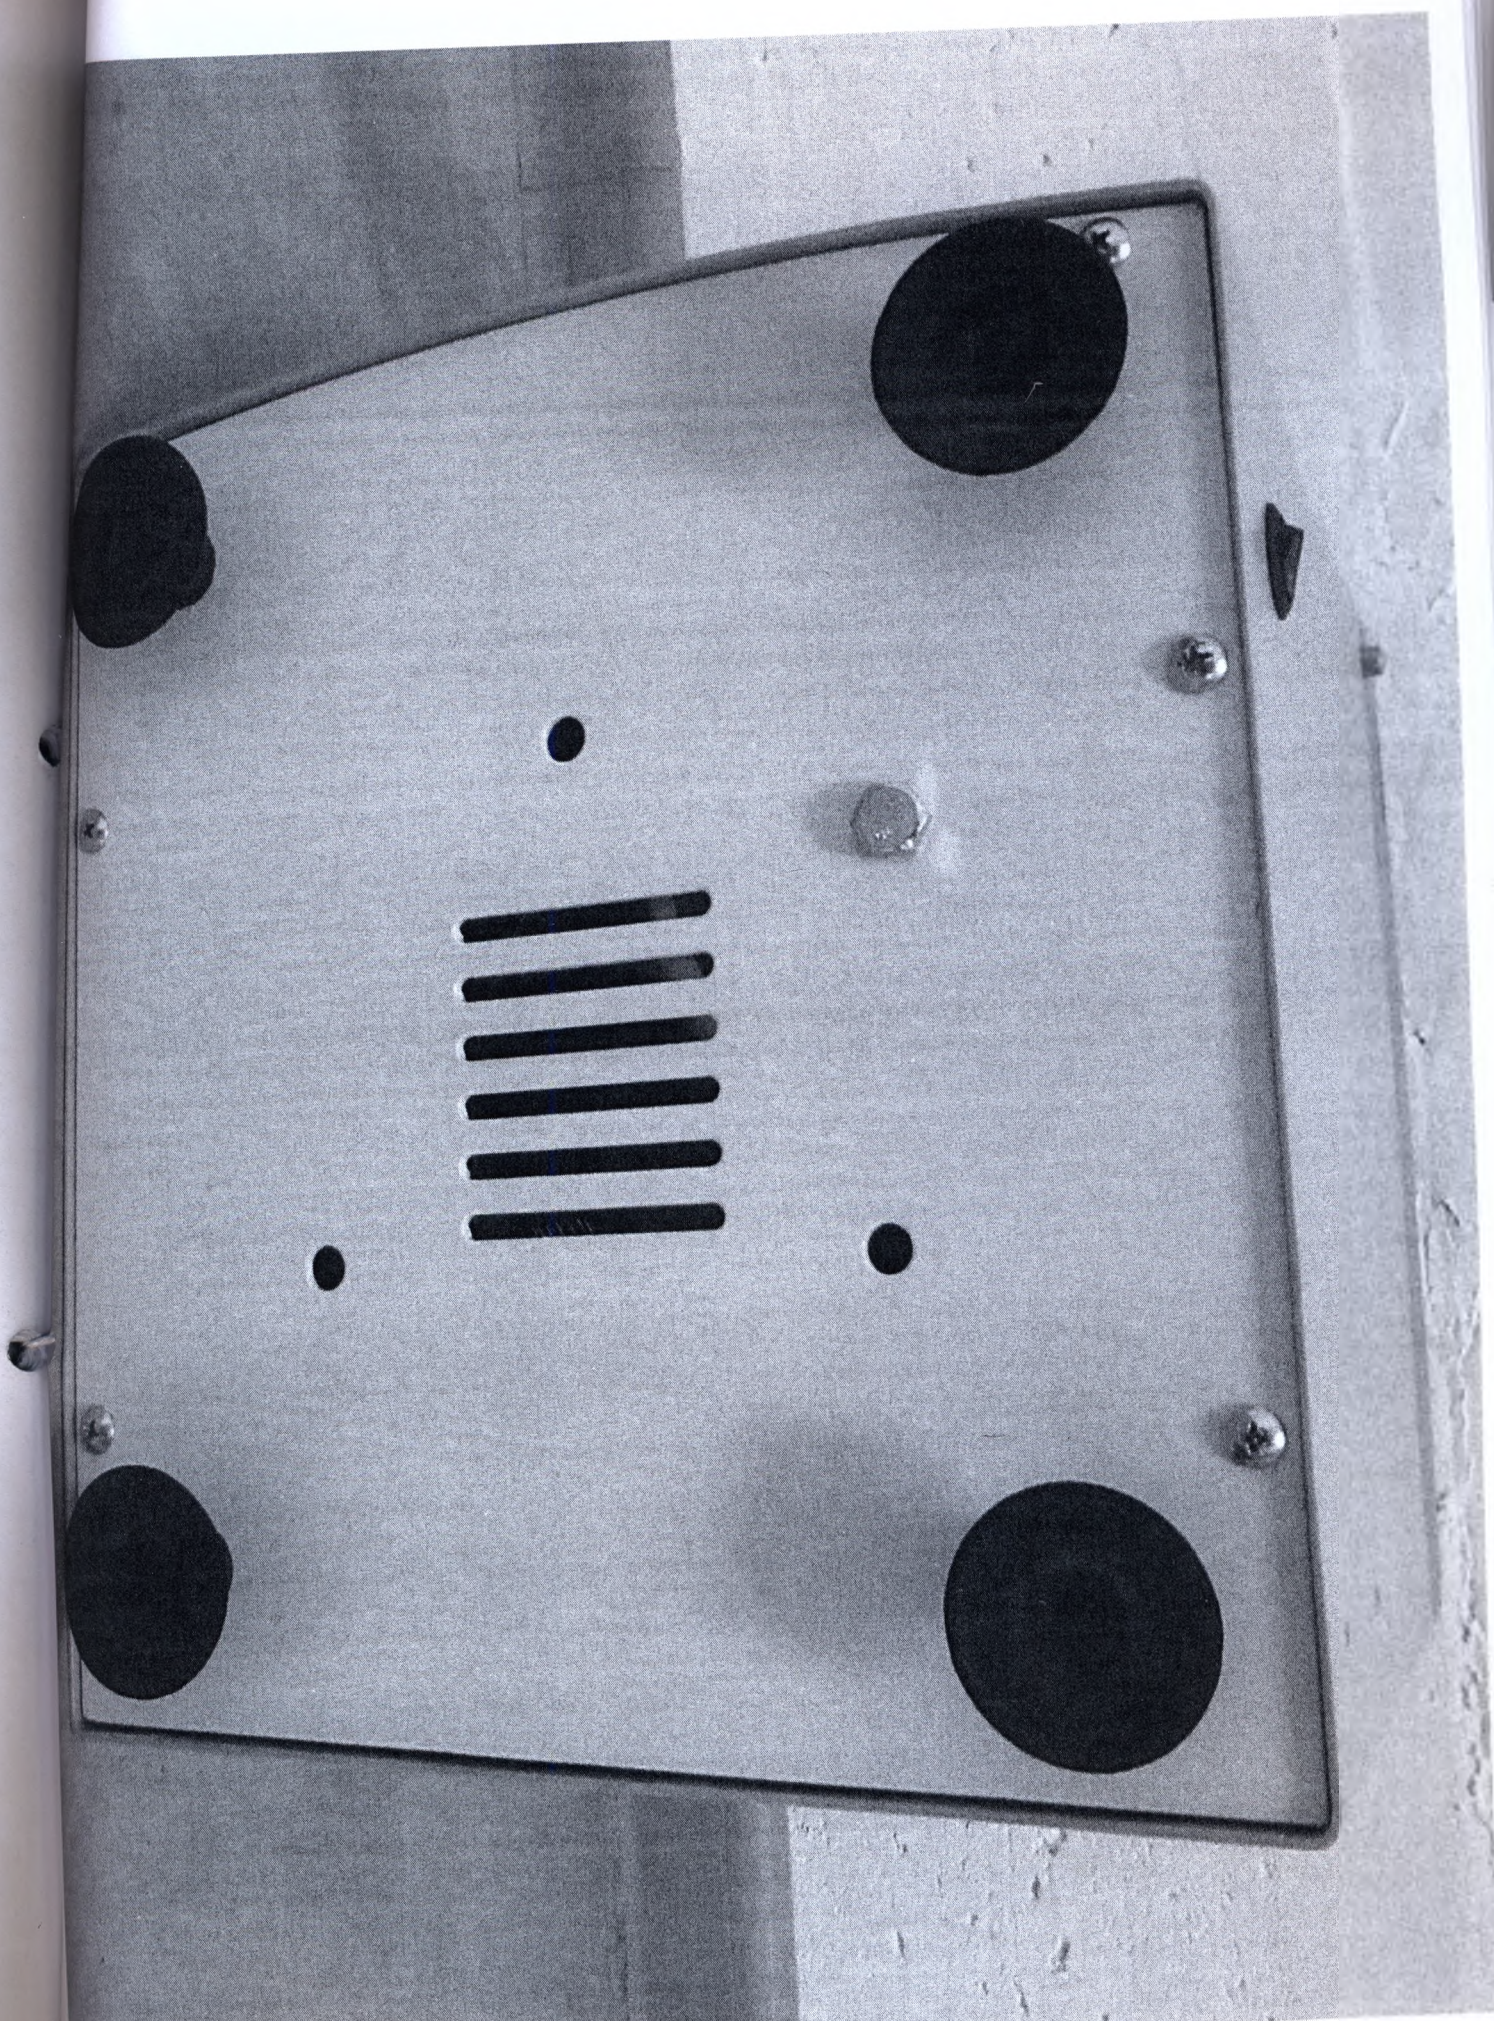


Рис. 44 – Центрифуга (вид снизу)



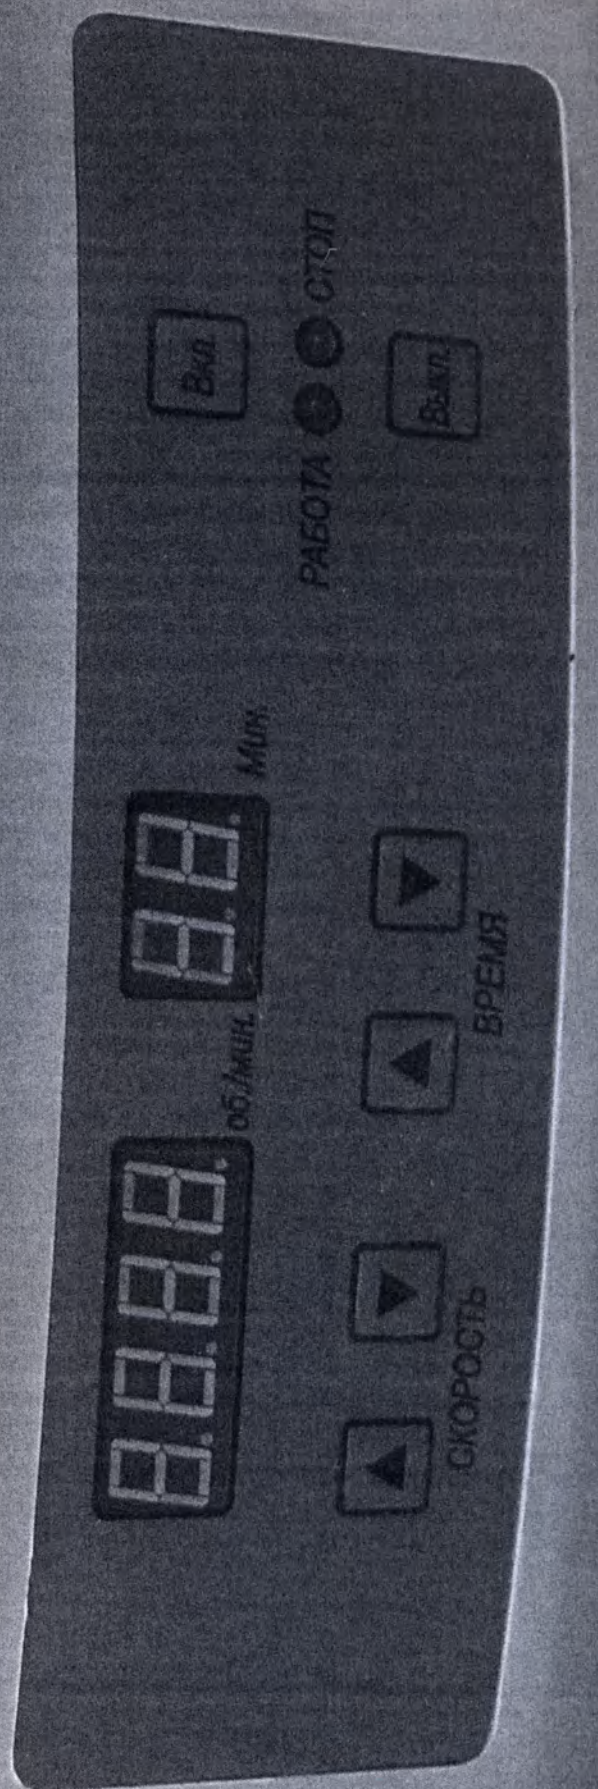


Рис. 46 – Панель управления центрифуги

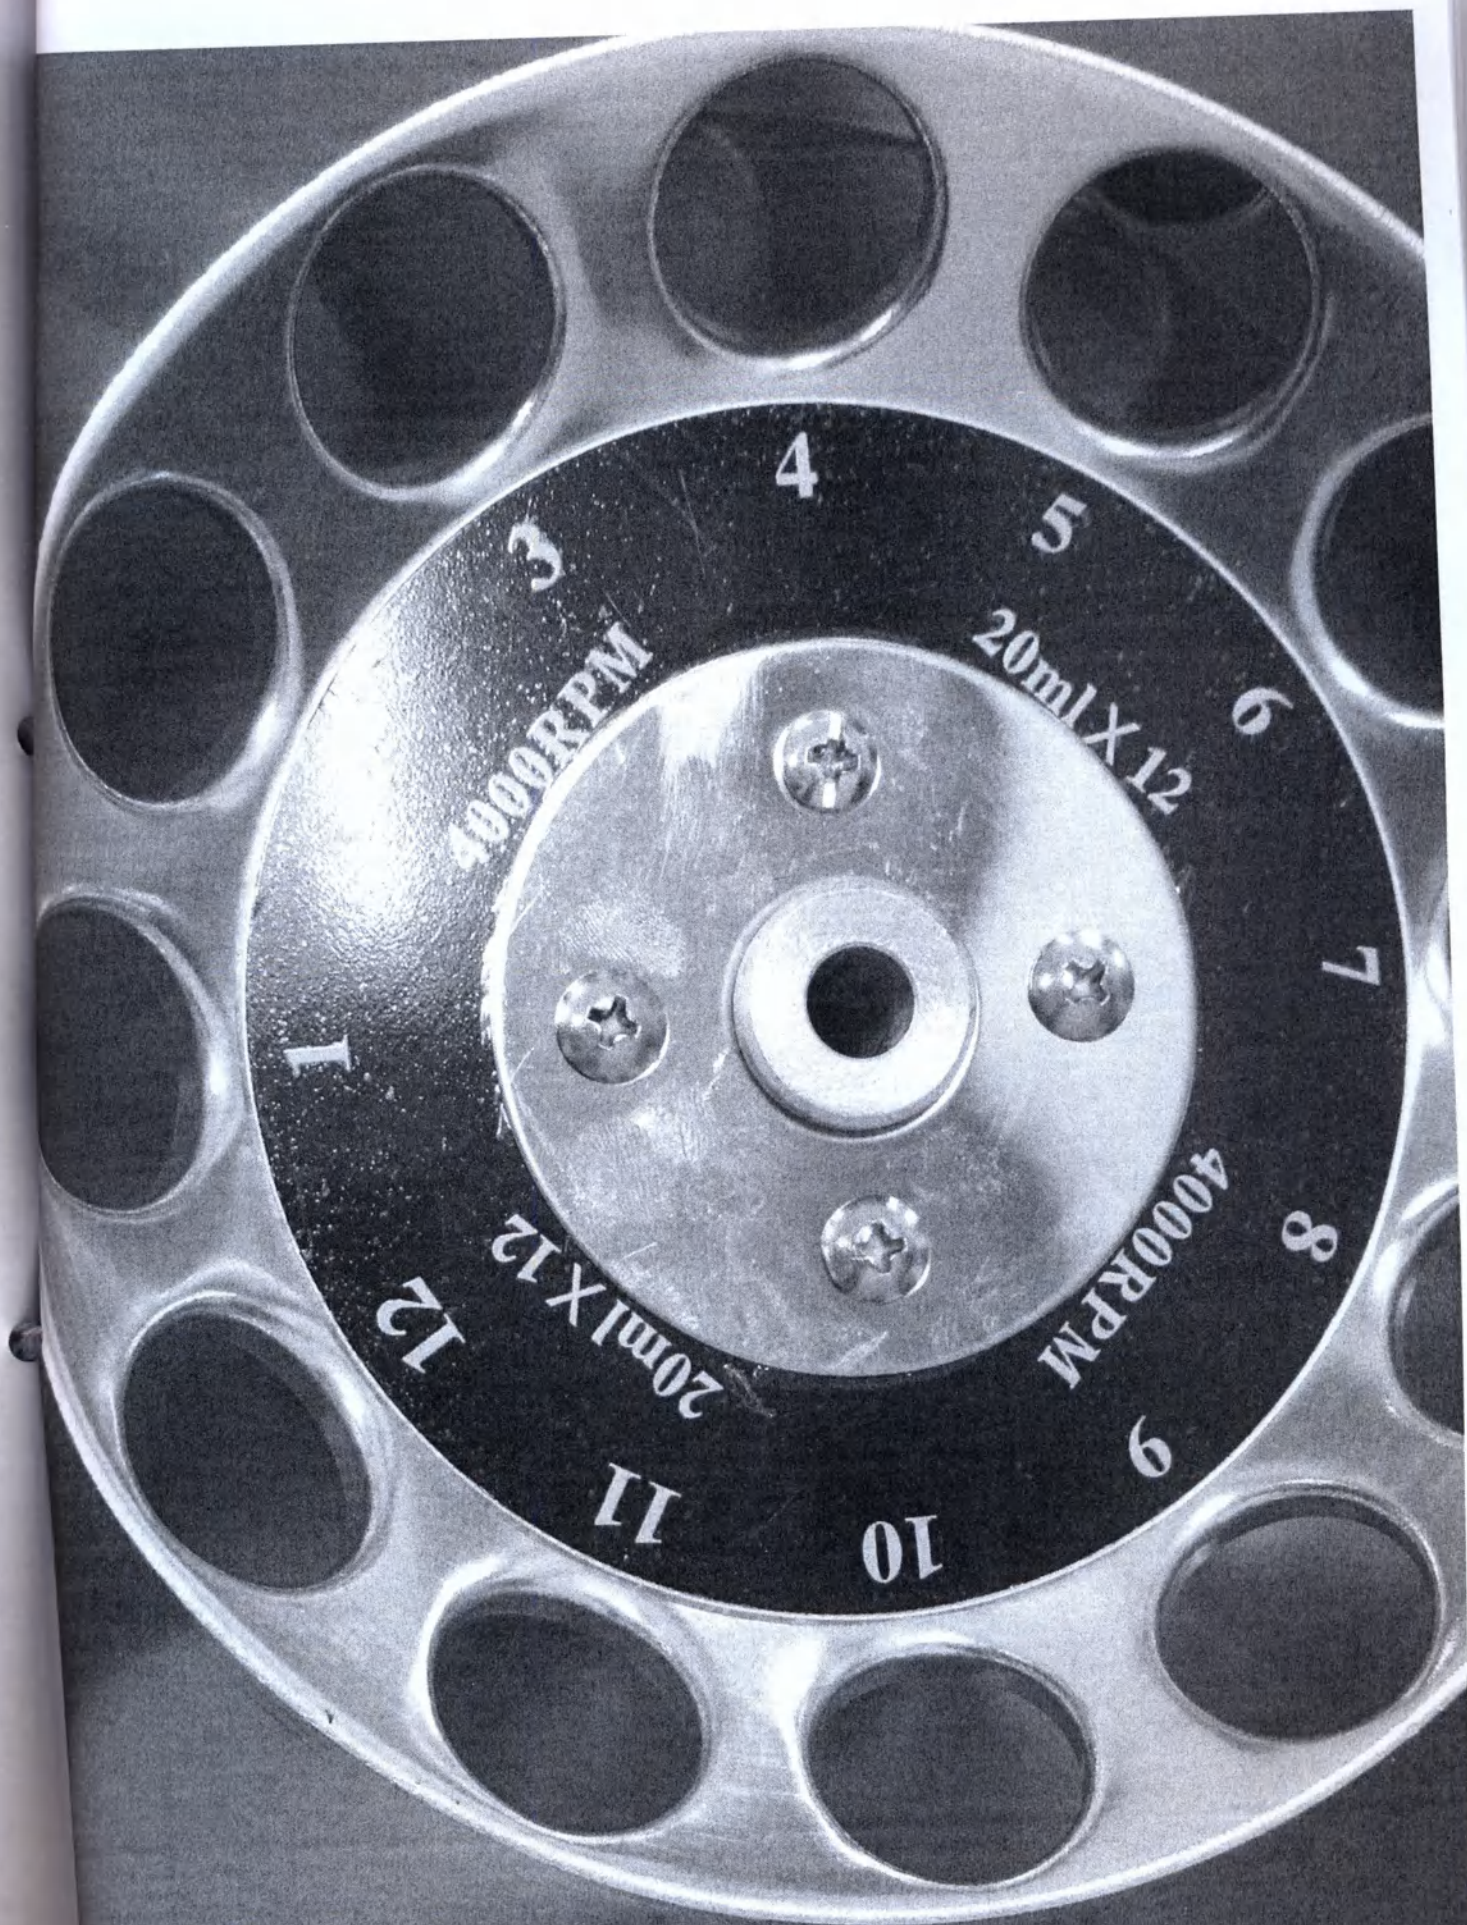


Рис. 47 – Маркировка ротора

31684
14.05.2020



Рис. 48 – Выключатель

31684
14.05.2020

Центрифуга лабораторная медицинская настольная
«Armed»

Вариант исполнения: НС-12С

РУ № _____ от _____ г.

Производитель: Zenith Lab (Jiangsu) Co., Ltd., No. 12
Hongshan Road, Industrial Zone, Jincheng Town, Jintan
District, Changzhou, Jiangsu, China («Зенит Лаб (Цзянсу)
Ко., Лтд.». № 12, ул. Хуншань, Промышленная зона,
городок Цзиньчен, район Цзиньтань, г. Чанчжоу,
провинция Цзянсу, Китай)

Дистрибьютер: ООО «МЕДИМПОРТ», 630091
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская,
дом 52, пом. 14, офис 211

Потребляемая мощность: не более 200 В*А

Напряжение питания: ~ 220 В (± 10%)

Частота сети: 50 Гц (± 2%)

Дата выпуска: 03.2018

Серийный номер: 15682351



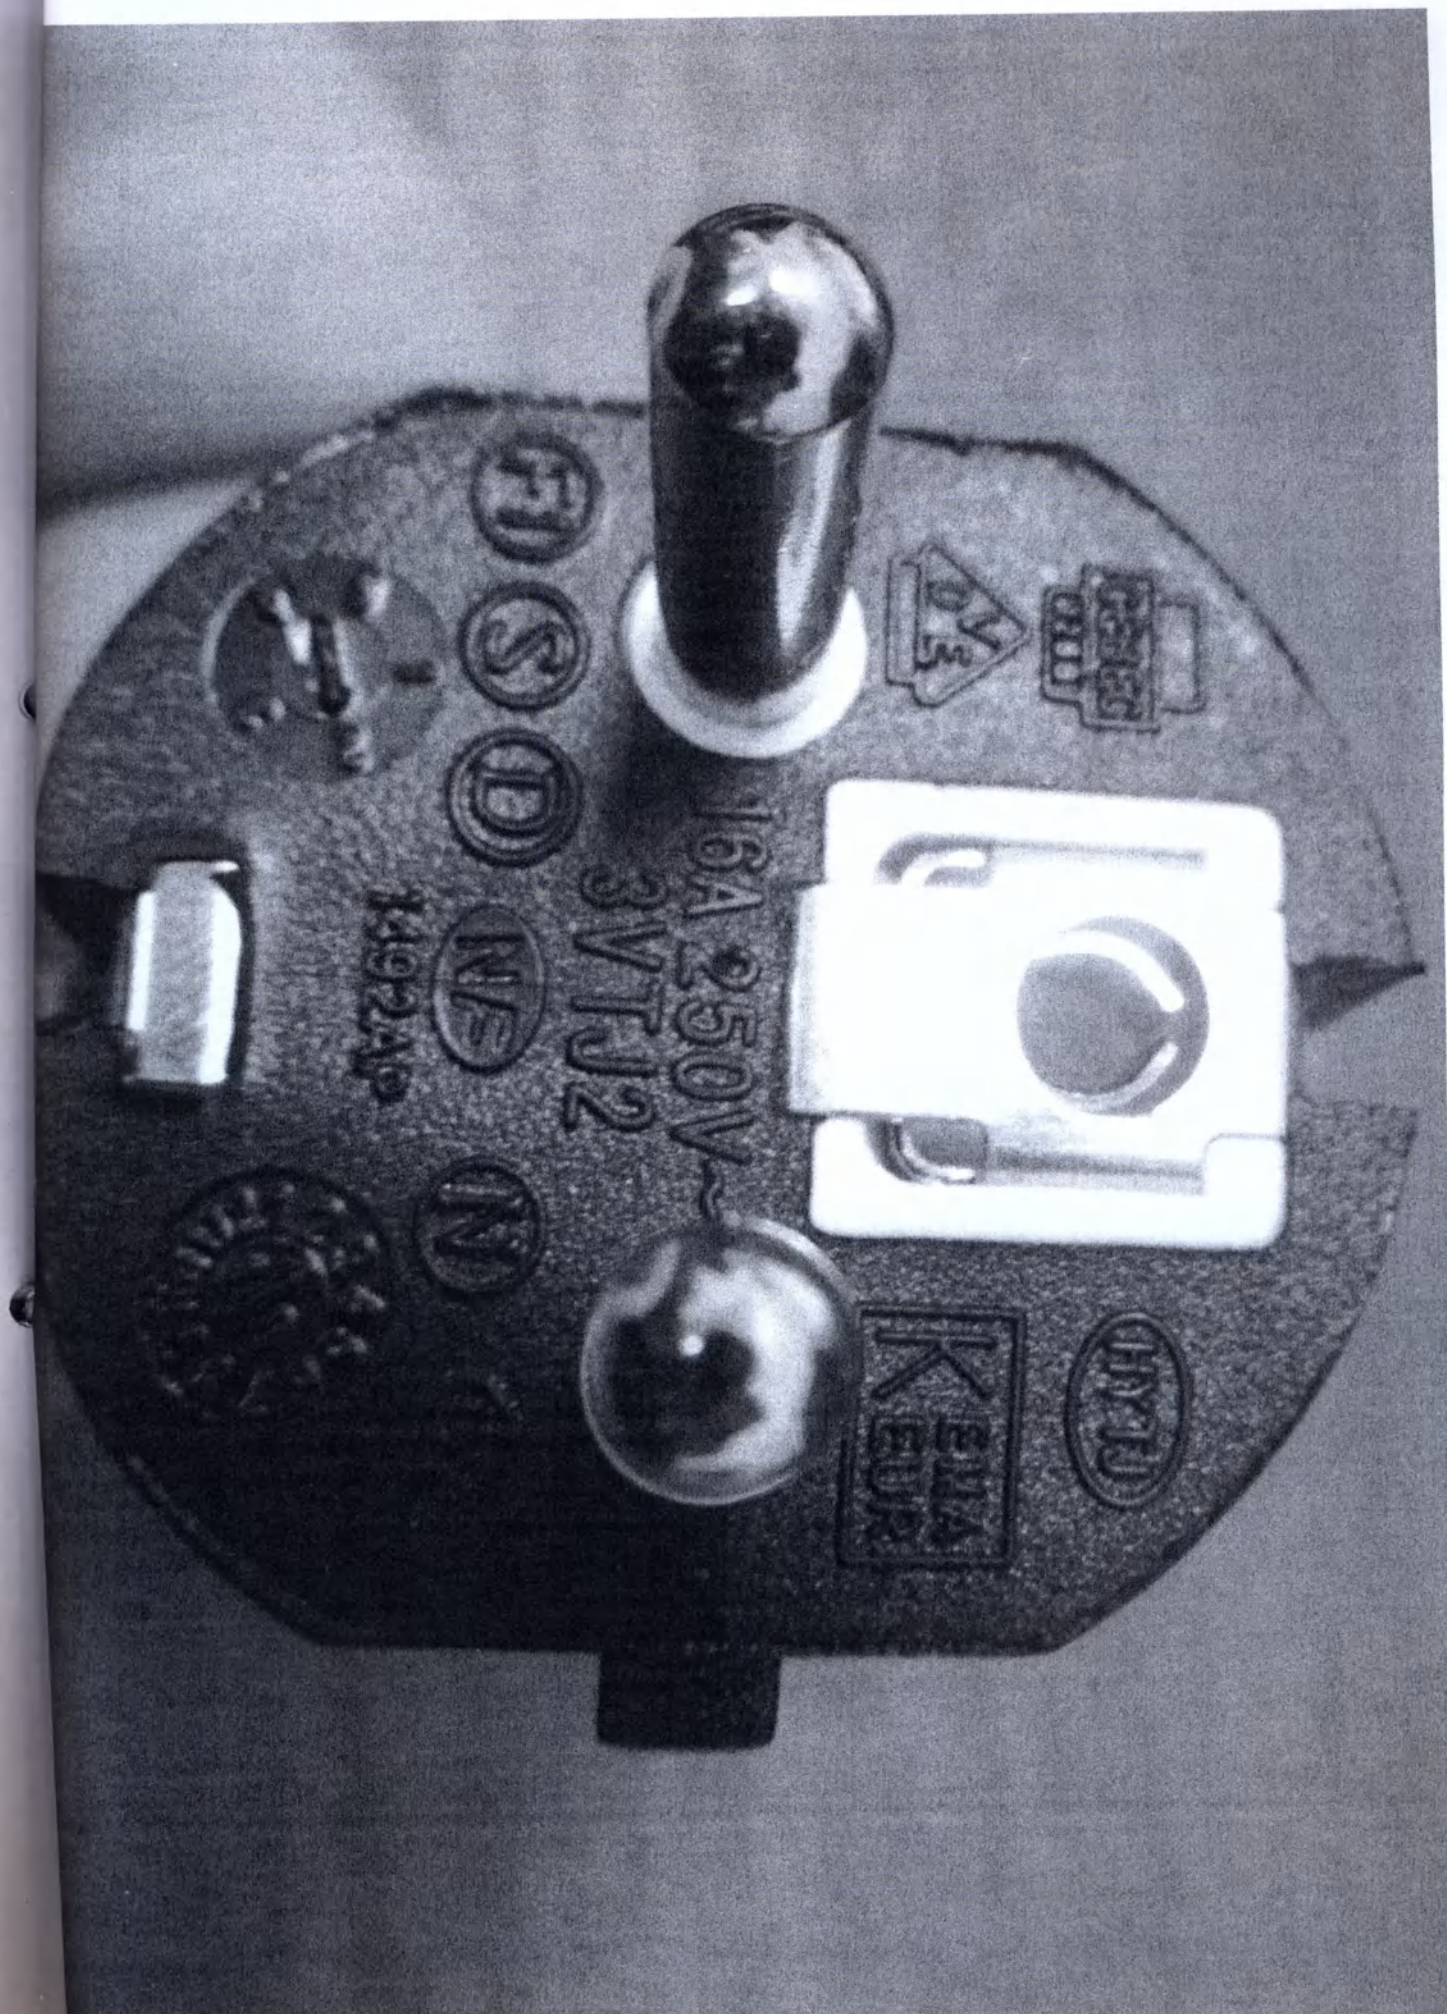





Рис. 51 – Клемма для соединения с источниками сетевого питания, держатель плавкого предохранителя и маркировка клеммы заземления (земля) на корпусе центрифуги



Рис. 52 – Шнур питания (общий вид)





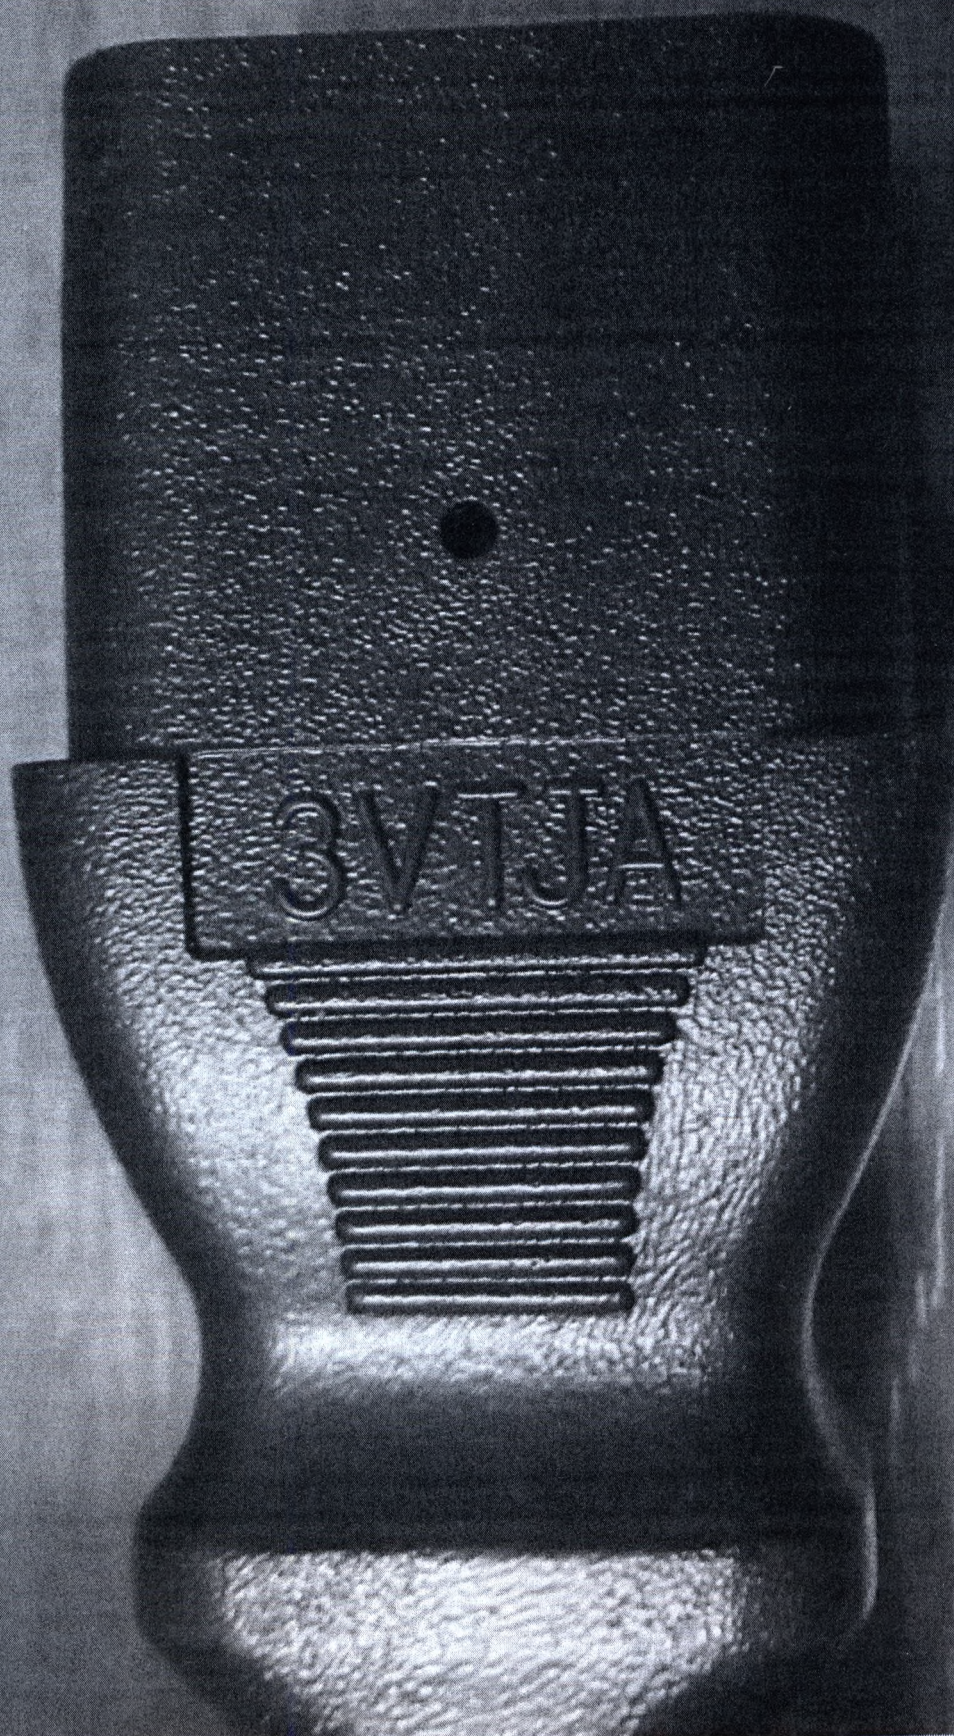

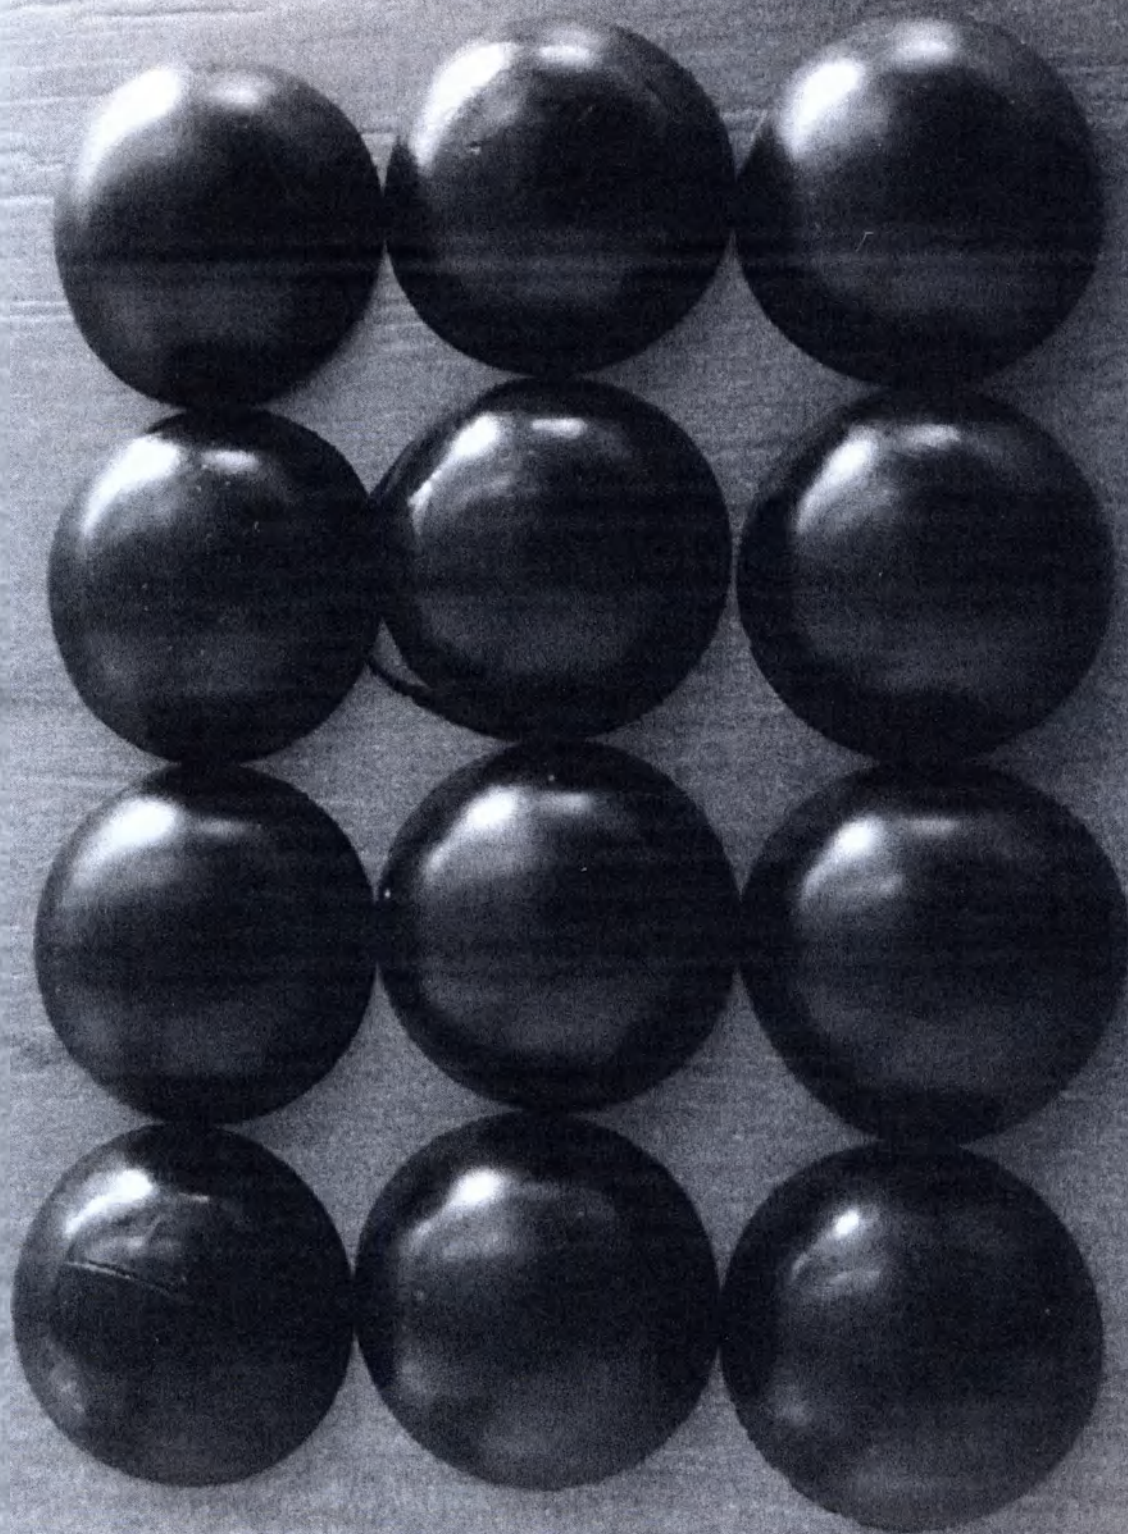


Рис. 56 – Уплотнитель (12 шт.)



Рис. 57 – Предохранитель плавкий F2AL 250 В (2 шт.)



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 59
Левченко
Светлов 1 лист 06

Генеральный директор
ООО «МЕДИМПОРТ»
Леохтьев А.М