

Фотографические изображения медицинского изделия

Набор реагентов «VIDAS AMH» для количественного определения антимюллера гормона (АМН) в сыворотке или плазме крови человека (лития гепаринат) на анализаторах иммунологических семейства VIDAS


Генеральный директор
ООО «биоМерье Рус»
(от имени «биоМерье С.А.»
по доверенности от 13.09.2018)

М.П.




Н.В. Бердникова

Набор реагентов «VIDAS AMH» для количественного определения антимюллерова гормона (AMH) в сыворотке или плазме крови человека (лития гепаринат) на анализаторах иммунологических семейства VIDAS (общий вид)

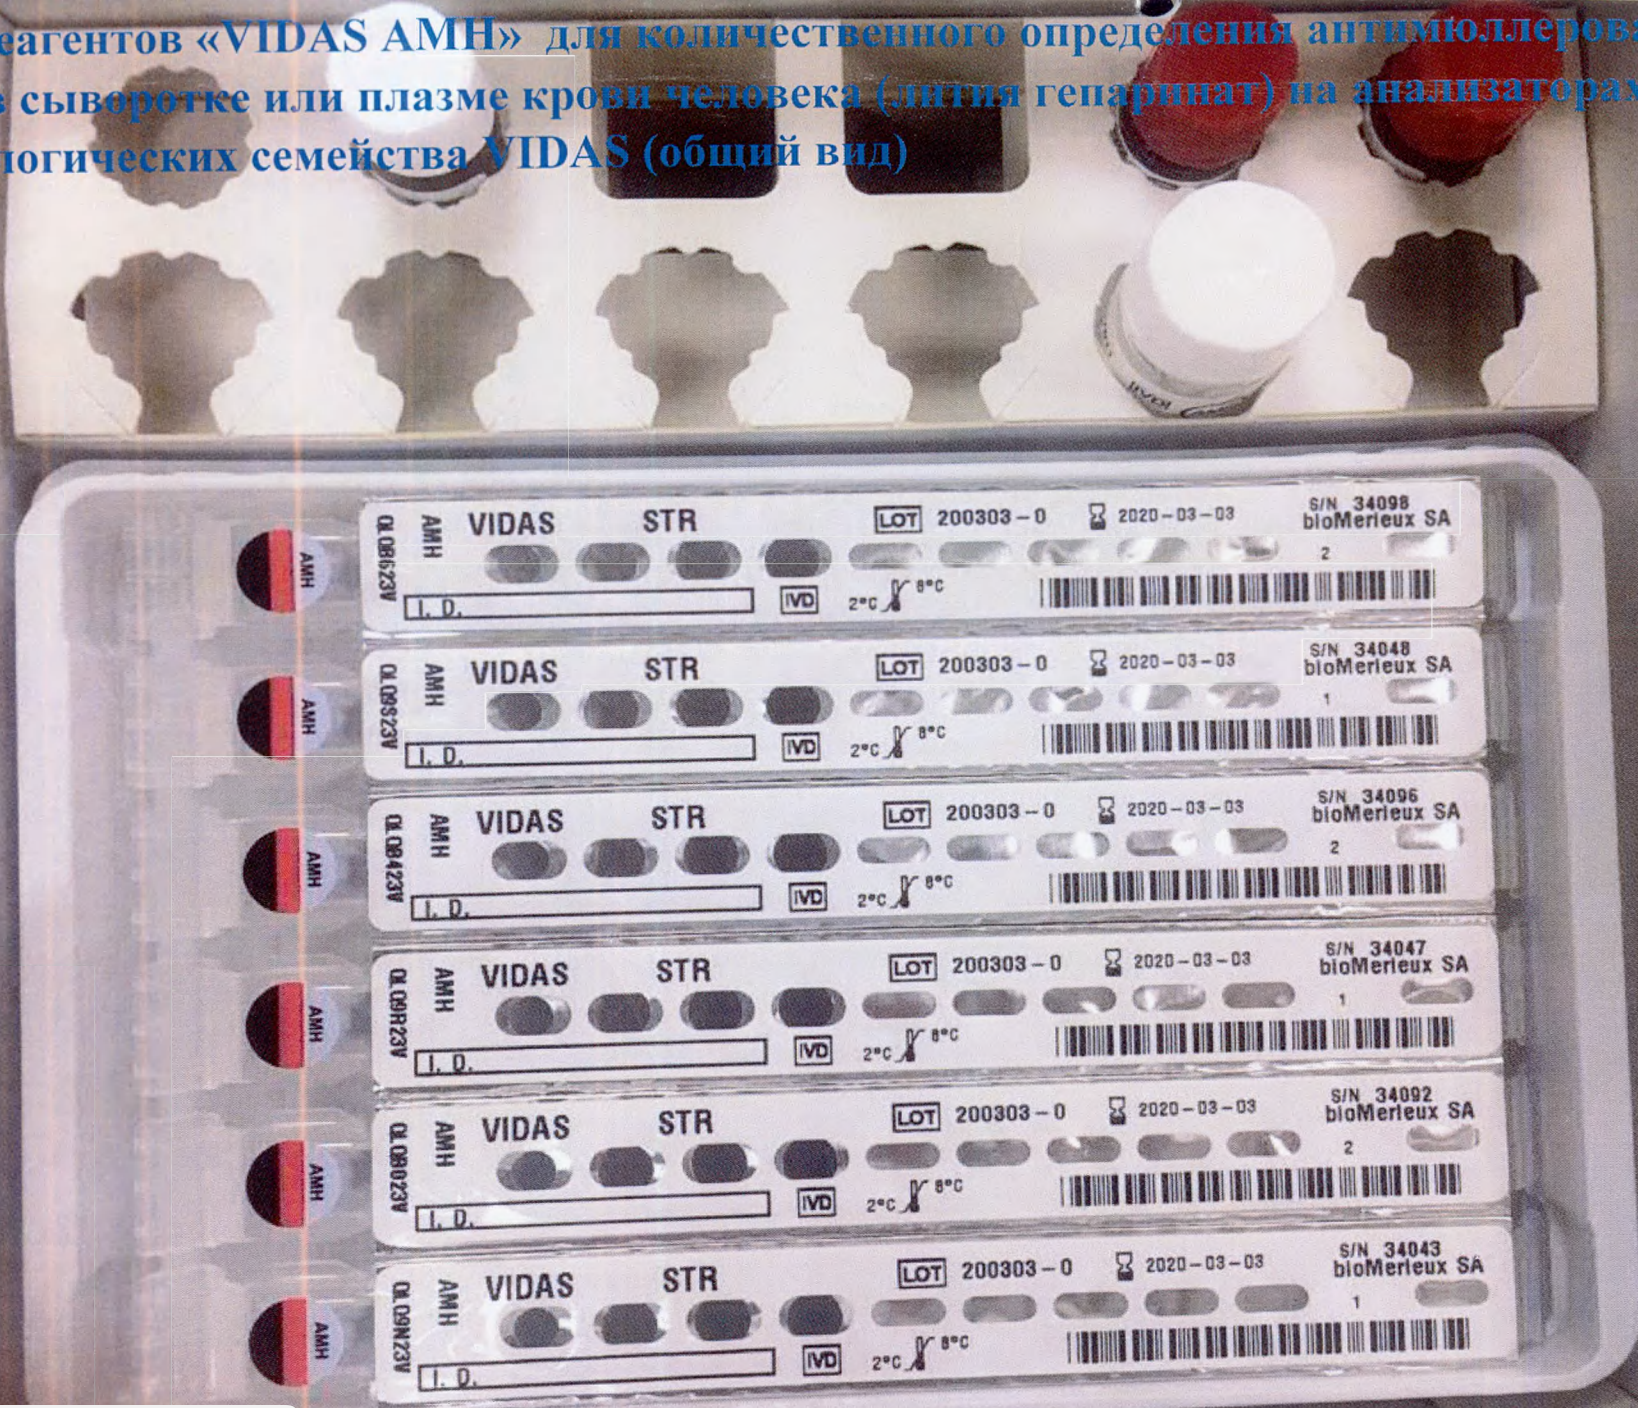


Набор реагентов «VIDAS AMH» для количественного определения антимюллерова гормона (AMH) в сыворотке или плазме крови человека (лития гепаринат) на анализаторах иммунологических семейства VIDAS (общий вид)

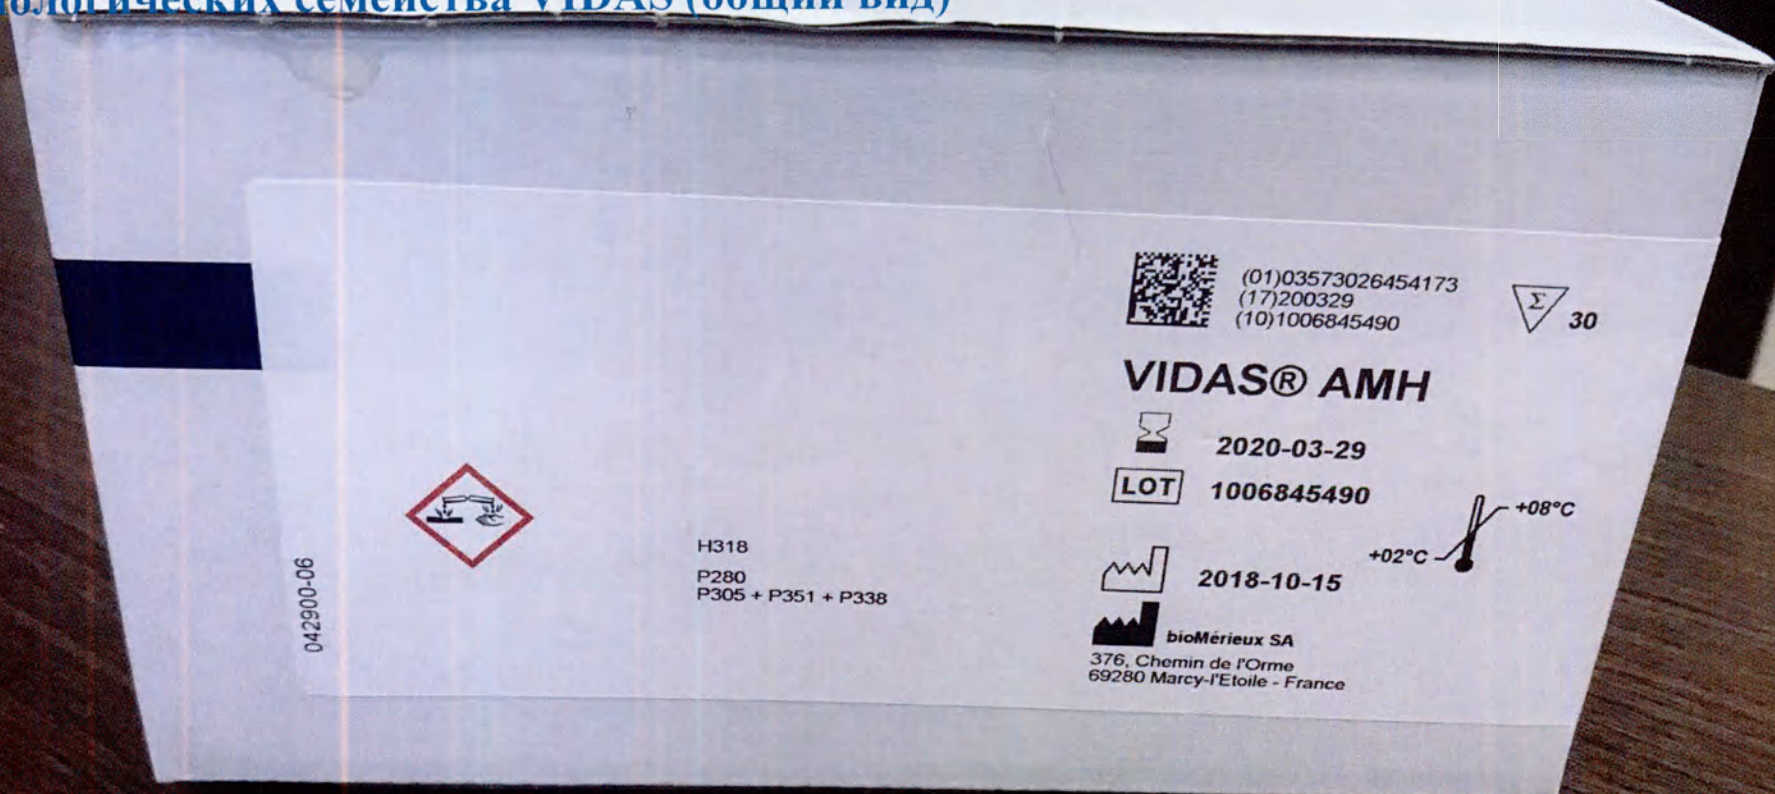

Набор реагентов «VIDAS AMH» для количественного определения антимюллерова гормона (AMH) в сыворотке или плазме крови человека (лития гепаринат) на анализаторах иммунологических семейства VIDAS

1. Стрипы AMH (STR) –30 шт.

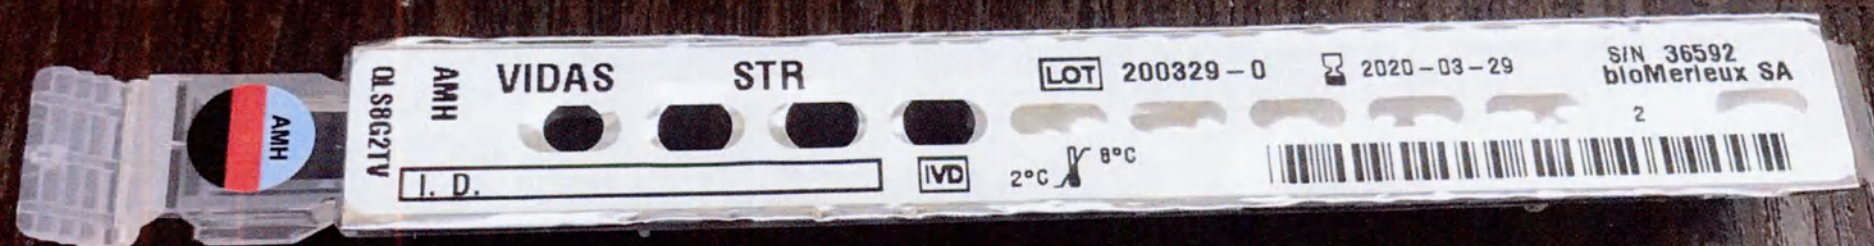

Набор реагентов «VIDAS AMH» для количественного определения антимюллерова гормона (AMH) в сыворотке или плазме крови человека (лития гепаринат) на анализаторах иммунологических семейства VIDAS

2. Наконечники AMH (SPR) – 30 шт./уп.




Набор реагентов «VIDAS AMH» для количественного определения антимюллерова гормона (AMH) в сыворотке или плазме крови человека (лития гепаринат) на анализаторах иммунологических семейства VIDAS

3. Контроль положительный AMH (C1) – 1 флакон х 2 мл (лиофилизированный)




Набор реагентов «VIDAS AMH» для количественного определения антимюллерова гормона (AMH) в сыворотке или плазме крови человека (лития гепаринат) на анализаторах иммунологических семейства VIDAS

4. Стандарт калибровочный AMH (S1) – 2 флакона x 2 мл (лиофилизированный)

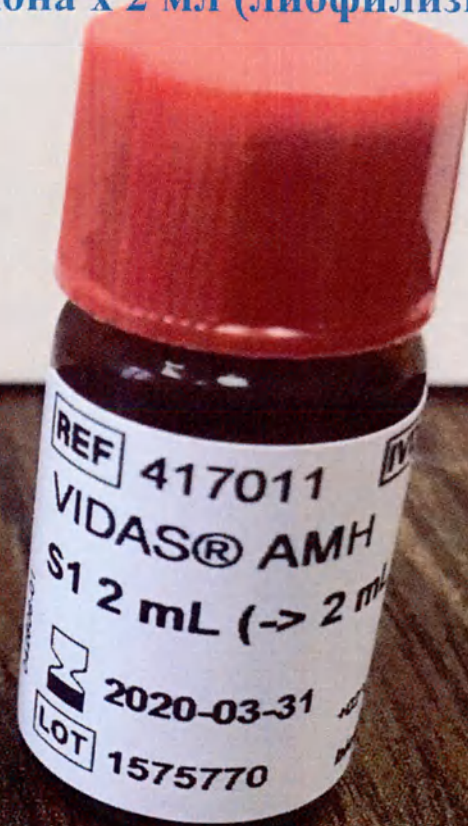

Набор реагентов «VIDAS AMH» для количественного определения антимюллерова гормона (AMH) в сыворотке или плазме крови человека (лития гепаринат) на анализаторах иммунологических семейства VIDAS

5. Разбавитель образца AMH (R1) - 1 флакон х 4,1 мл (жидкий)

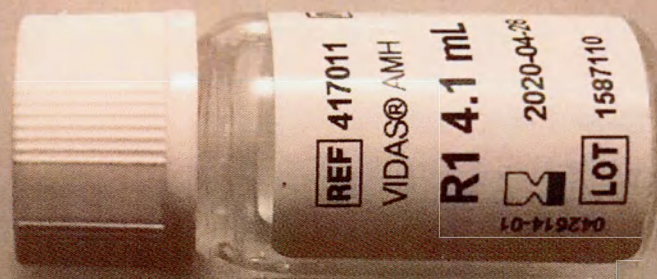

Набор реагентов «VIDAS AMH» для количественного определения антимюллера гормона (AMH) в сыворотке или плазме крови человека (лития гепаринат) на анализаторах иммунологических семейства VIDAS (маркировка на русском языке)

REF 417011
XXXXX-X-ru

Изготовитель:
«БиоМерье С.А.», Франция

Набор реагентов «VIDAS AMH» для количественного определения антимюллера гормона (AMH) в сыворотке или плазме крови человека (лития гепаринат) на анализаторах иммунологических семейства VIDAS

1. Стрипы AMH (STR) – 30 шт.
2. Наблюдения AMH (SPR) – 30 шт./уп.
3. Контроль положительный AMH (C1) – 1 флакон x 2 мл (лиофилизированный)
4. Стандарт калибровочный AMH (S1) – 2 флакона x 2 мл (лиофилизированный)
5. Разбавитель образца AMH (R1) – 1 флакон x 4,1 мл (жидкий)

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «БиоМерье Рус»

Адрес:

Россия, 115230, Москва,

1-ый Нагатинский проезд, д. 10, стр. 1

Тел./факс: +7 (495) 221 10 79

PV <XXXXXXXX от XXXXXXXX>

BIOMÉRIEUX

VIDAS®

Прошито и
пронумеровано 9 листов

«17» 10 2019 г.

Генеральный директор
Бердникова Н.В.

