




**Общий вид медицинского изделия: Бинты марлевые медицинские, стерильные по
ГОСТ 1172-93**

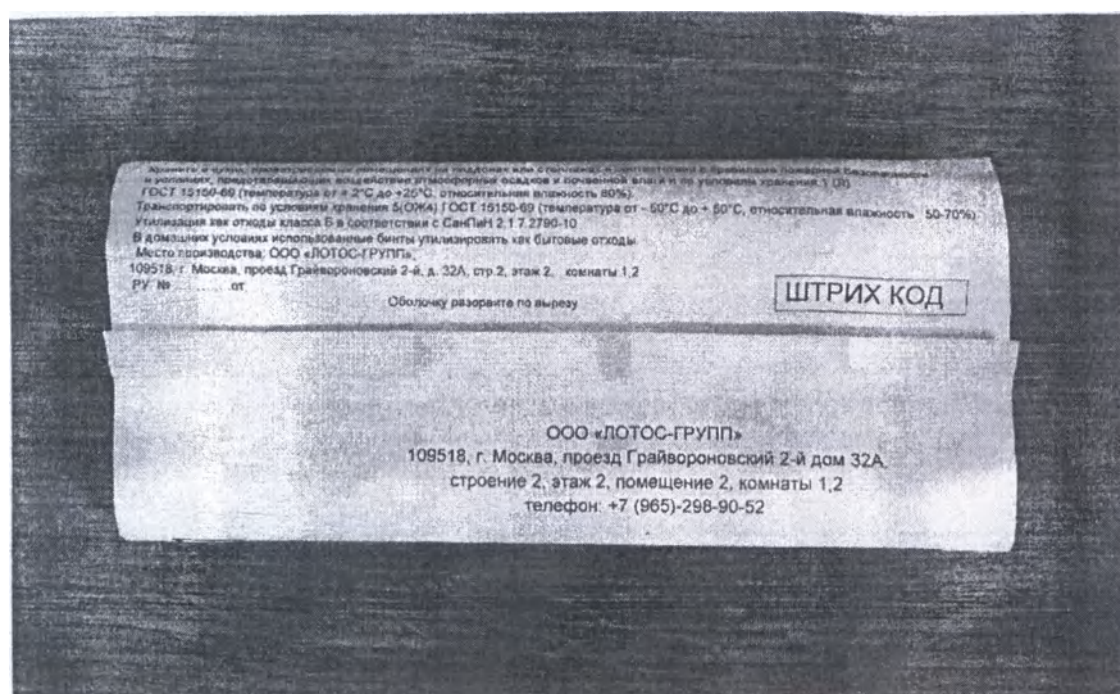

Общий вид медицинского изделия: Бинты марлевые медицинские, стерильные по ГОСТ 1172-93 в индивидуальной упаковке

ООО «ЛОТОС-ГРУПП»
109518, г. Москва, проезд Грайвороновский 2-й дом 32А,
строение 2, этаж 2, помещение 2, комнаты 1,2
телефон: +7 (965)-298-90-52

БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

по ГОСТ 1172-93

ДЛИНА ШИРИНА

7 м х 14 см

Дата стерилизации 3 кв 2018 Стерильно. Нетоксично
Срок годности 5 лет Апиrogenно
Количество штук: 1 штука Партия №3




Хранить в сухих, проветриваемых помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги и по условиям хранения 1 (Л)
ГОСТ 15150-69 (температура от + 2°C до +25°C, относительная влажность 80%).
Транспортировать по условиям хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150-69 (температура от - 50°C до + 50°C, относительная влажность 50-70%)
Утилизация как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10
В домашних условиях использованные бинты утилизировать как бытовые отходы
Место производства: ООО «ЛОТОС-ГРУПП»,
109518, г. Москва, проезд Грайвороновский 2-й, д. 32А, стр.2, этаж 2, комнаты 1,2
PV № от

Оболочку разорвите по вырезу

ШТРИХ КОД

Макет маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия:
Бинты марлевые медицинские, стерильные по ГОСТ 1172-93

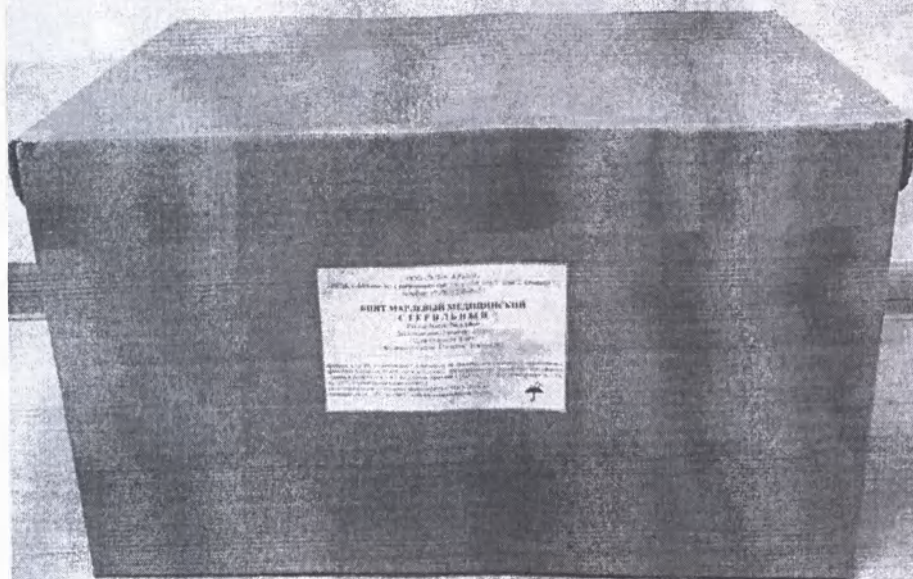

ООО «ЛОТОС-ГРУПП»
109518, г. Москва, пр. Грайвороновский 2-й д. 32А, стр 2, этаж 2, комнаты 1,2
телефон: +7 (965) 298-90-52

БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Размер бинта: 7м x 14см
Дата упаковки: 3 квартал 2018г.
Срок годности: 5 лет
Количество штук: 150 штук. Партия №3

Хранить в сухих, проветриваемых помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги и по условиям хранения 1 (Л) ГОСТ 15150-69 (температура от + 2°C до +25°C, относительная влажность 80%)

Транспортировать по условиям хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150-69 (температура от + 50°C до + 50°C, относительная влажность 50-70%).



Общий вид транспортной упаковки медицинского изделия: Бинты марлевые медицинские, стерильные по ГОСТ 1172-93