

**3M Россия**

108811, г. Москва, п. Московский,
Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1
Тел.: 8 800 250 84 74
www.3MRussia.ru

3M Russia

108811, Moscow, Poselenie Moskovskiy,
Kievskoe shosse, 22 km, 6, bld.1
Phone: 8 800 250 84 74
www.3MRussia.ru

« 15 » октября 2019 г

Фотографические изображения медицинского изделия

Инкубаторы для биологических индикаторов

Старший эксперт по сертификации
Отдела Здравоохранения
АО «3М Россия»
(должность)

(подпись)



А.А. Репина
(И.О. Фамилия)

71-6782



Инкубаторы для биологических индикаторов, варианты исполнения:

Инкубатор для биологических индикаторов Attest для паровой стерилизации.

Производитель: 3M Компани, 3M Хелс Кепар (3M Company, 3M Health Care), США, 3M Center, 2510 Conway Avenue, Bldg. 275-5W-06, St. Paul, Minnesota, 55144, USA.

Назначение: Предназначен для контроля эффективности процесса паровой и газовой стерилизации медицинских изделий в гравитационных паровых и газовых стерилизаторах.

Условия хранения и транспортировки: Температура от -10 до $+50^{\circ}\text{C}$, относительная влажности от 20 до 80% (без образования конденсата), давление не регламентируется. При транспортировке изделия могут испытывать кратковременное изменение температуры, не влияющее на безопасность и характеристики изделий. Медицинское изделие транспортируют всеми видами транспорта. Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства РФ. Перед применением ознакомиться с руководством по эксплуатации.




РУ № ФСЗ 2011/11111 от _____, срок действия не ограничен

Уполномоченный представитель в РФ: АО "3М Россия", 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1. Тел. +7 (495) 784-74-74

Изготовлено в США

#PC#495-84769-0012599529
 Центральный офис 06.04.2019 21:57:12
 (Склад Терминал АЗЛКЗ)
 Курьер-Ремонт (Москва), 119270, Москва г. Лужнецкая наб. дом 14-201
 748-77-48

1. Инкубатор для биологических индикаторов Attest для паровой стерилизации (в упаковке).

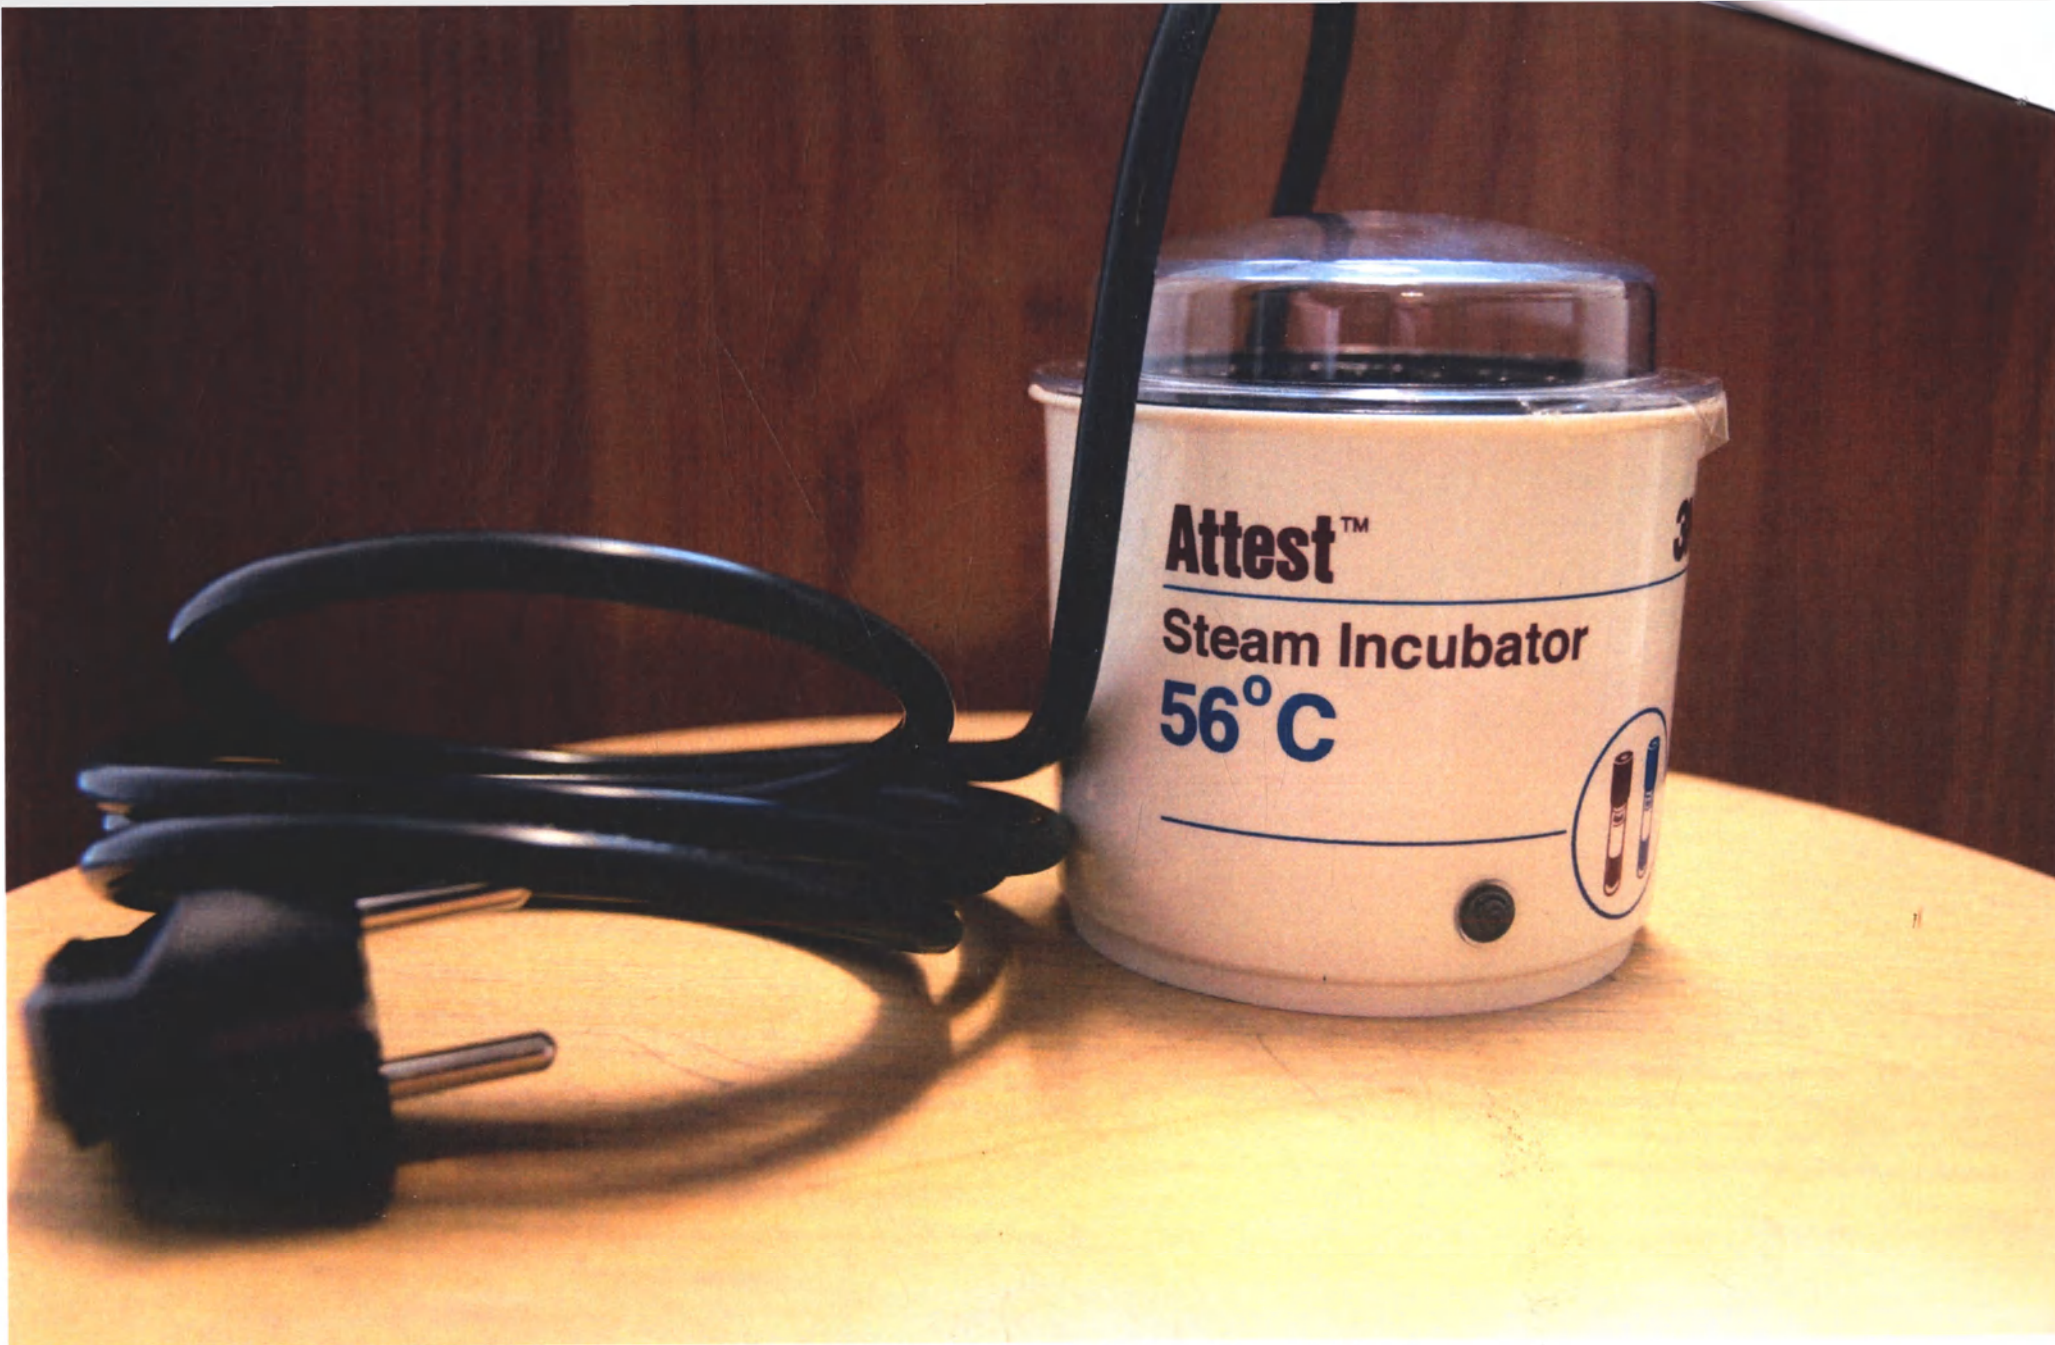

2. Инкубатор для биологических индикаторов Attest для паровой стерилизации



✓

русская

MT SP00263673

3M

Инкубатор для биологических индикаторов, варианты исполнения:
Инкубатор для биологических индикаторов Attest для газовой стерилизации

Производитель: 3M Компания, 3M Health Care (3M Company, 3M Health Care, США, 3M Center, 2101 Lakeside Avenue, Bldg. 275-5W-06, St. Paul, Minnesota, 55144, USA)

Назначение: Предназначен для контроля эффективности процесса паровой и газовой стерилизации медицинских изделий в гравитационных паровых и газовых стерилизаторах.

Условия хранения и транспортировки: Температура от -10 до +50°С, относительная влажность от 20 до 90% без образования конденсата, воздействие на регламентированные изделия может испытывать кратковременное изменение температуры, не влияющее на безопасность и характеристики изделий. Медицинские изделия транспортируются всеми видами транспорта. Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства РФ. Перед применением ознакомиться с руководством по эксплуатации.




ЕАС

РФ № ФС 1 2011/11111 от _____, срок действия не ограничен

Уполномоченный представитель в РФ: АО "3М Россия", 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1. Тел.: +7 (495) 784-76-74

Национально в США

3. Инкубатор для биологических индикаторов Attest для газовой стерилизации (в упаковке).

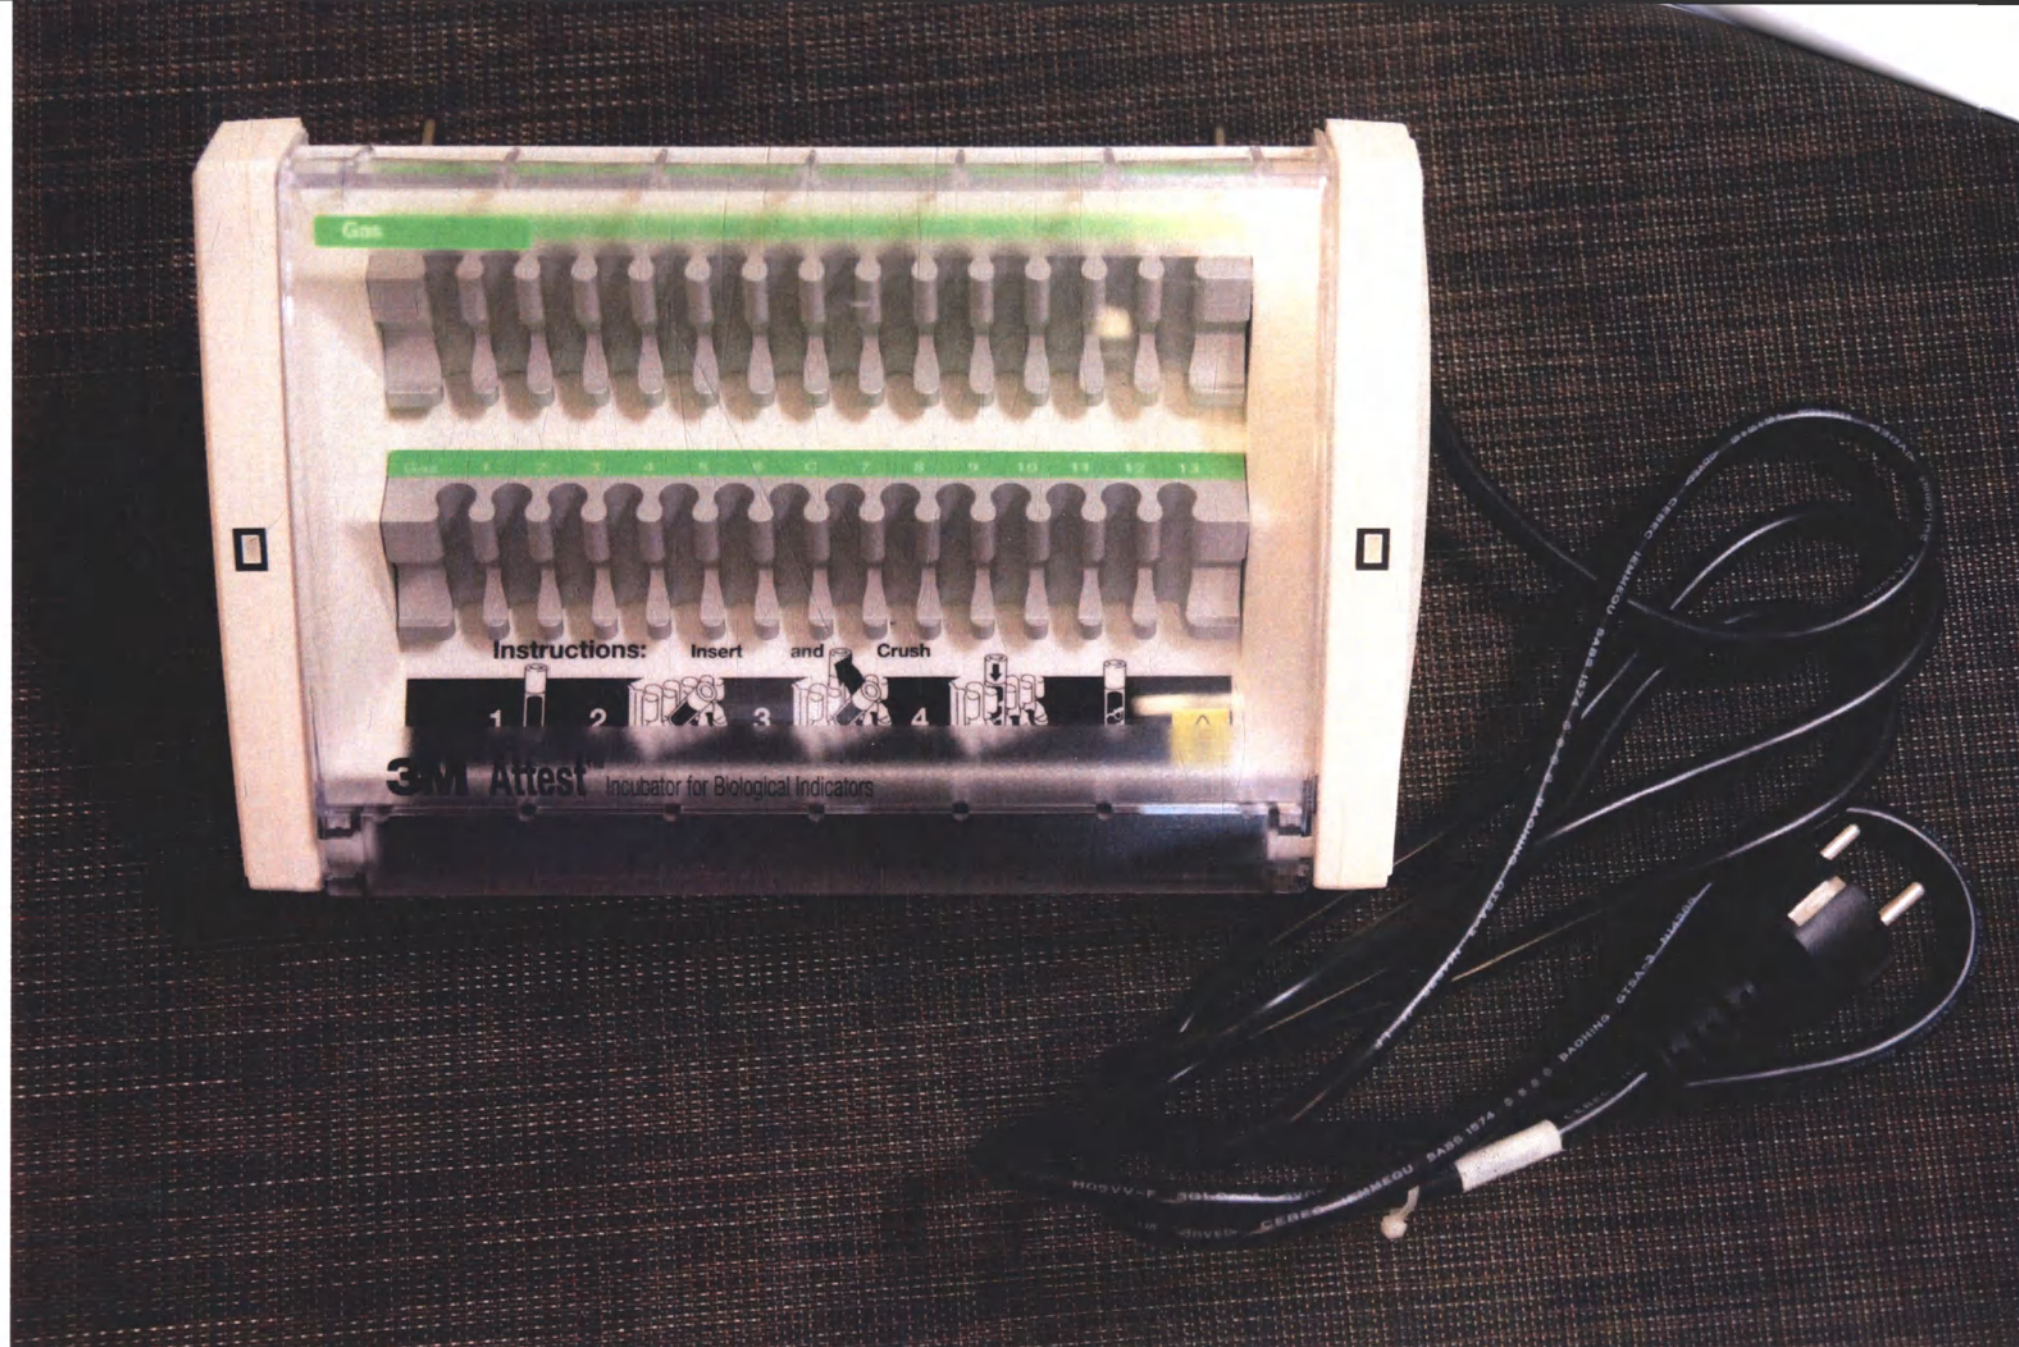

4. Инкубатор для биологических индикаторов Attest для газовой стерилизации

✓
MLCP00212652

JT020619 KARTON N
 70-2007-7180-9 01 3091
 18
 3M Russia, Moscow Warehouse
 Клиента photo:direct, Koptolnikov
 Yous Order
 00000000000000000000000000000000
 Code: 7007 390 AUTOREADER FOR STEAM
 Code Weight: 2.40 kg
 Information
 Print Lot
 Shipping Date: 18.03.2019
 74011111198-00010
 Quantity: 100 EACH
 3M Attest? Autoreader for Steam
 in Model 390
 EX RUS Shipment: SUEC/MNL
 Ship from no: 2729
 NVE
 SSCC

Центральный офис 11.04.2019 8:23:33
 (Склад Терминал 183 (Консолидация 127 стр.))
495-00012331455
 Пломба: 01826947

Кол-во HAWB	Вес GMT
78	
ORIGI.	DESTINATION
M.W	MOO


 #F#495-000000000002348106

3M
 Инкубаторы для биологических индикаторов, варианты исполнения:
 Инкубатор (авторидер) для биологических индикаторов быстрого чтения Attest Rapid
 Readout для паровой стерилизации.
 Производитель: 3M Company, 3M Healthcare, 3M Health Care, 3M Health Care, 2510 Conway Avenue, Bldg
 275-4W-06, St. Paul, Minnesota, 55144, USA
 Назначение: Предназначен для контроля эффективности процесса паровой и газовой стерилизации медицинских изделий
 в гравитационных паровых и газовых стерилизаторах. Температура от -10 до +50° C, относительная влажность от 20 до 80% (без
 образования конденсата), давление не регулируется. При транспортировке изделия могут использоваться кратковременное
 изменение температуры, не влияющее на безопасность и характеристики изделий. Медицинские изделия транспортируются
 всеми видами транспорта. Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства РФ. Перед применением
 ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

РЭ № ФСЗ 2011/11111 от _____, срок действия не ограничен
 Уполномоченный представитель в РФ: АО "3M Россия", 108811, г. Москва, п.
 Московский, Киевское ш., 22-й км, домов. 6, стр. 1. Тел. +7 (495) 784-74-74
 Изготовлено в США

70000391111

5. Инкубатор (авторидер) для биологических индикаторов быстрого чтения Attest Rapid Readout для паровой стерилизации (в упаковке).



6. Инкубатор (автопилен) для биологических индикаторов быстрого чтения Attest Rapid Readout для паровой стерилизации (общий вид)



8. Инкубатор (авторидер) для биологических индикаторов быстрого чтения Attest Rapid Readout для газовой стерилизации (общий вид).

12

Инкубаторы для биологических индикаторов, варианты исполнения:
Инкубатор (авторидер) для биологических индикаторов быстрого чтения Attest Rapid Readout для стерилизации перекисью водорода.

3M
 Производитель: 3M Company, 3M Xcelo Keep (3M Company, 3M Health Care) США, 3M Center, 2510 Conway Avenue, Bldg. 275-5W-06, St. Paul, Minnesota, 55144, USA
 Назначение: Предназначен для контроля эффективности процесса паровой и газовой стерилизации медицинских изделий и графических паровых и газовых стерилизаторов.
 Условия хранения и транспортировки: Температура от -10 до +50° С, относительная влажность от 20 до 80% (без образования конденсата), давление не регламентируется. При транспортировке изделия могут испытывать кратковременное изменение температуры, не влияющее на безопасность и характеристики изделий. Медицинское изделие транспортируют всеми видами транспорта. Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства РФ. Перед применением ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

РУ № ФСЗ 2013/11111 от _____, срок действия не ограничен.
 Уполномоченный представитель в РФ: АО "3M Россия", 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, дом № 6, стр. 1. Тел: +7 (495) 784-74-74
 Изготовлено в США

MLSP00217983



✓

1-1685

JT027973 KARTON
 70-2011-7631-3 01 6001

+

1

18

18 *JUEH847Y*

3M Russia, Molcom Warehouse

Kiyazma micro-district, Kostomarovs
 RUS 141230 Pushkino

Your Order:
 000000007100168569
 Order Text: 3M ATTEST AUTO-READER 490 - 1/EU
 Netto Weight: 2.68 kg
 Information:

Run Lot Expiry Date

00040018955442945936

9. Инкубатор (авторидер) для биологических индикаторов быстрого чтения Attest Rapid Readout для стерилизации перекисью водорода (в упаковке).



10. Инкубатор (авторидер) для биологических индикаторов быстрого чтения Attest Rapid Readout для стерилизации перекисью водорода (общий вид)

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

11 листа(ов).

Должность: Старший эксперт по сертификации
Отдела Здравоохранения ЗАО «ЗМ Россия»



(подпись)

Репина А.А.

М.П.