



Фотографические изображения

«Иглы одворазовые для взятия венозной крови вакуумной пробиркой под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.13-002- 31043776-2017»


1. Игла одноразовая двусторонняя с прозрачной камерой, варианты исполнения: 0,5х19 мм; 0,5х25 мм; 0,5х31 мм; 0,5х38 мм; 0,6х19 мм; 0,6х25 мм; 0,6х31 мм; 0,6х38 мм; 0,7х19 мм; 0,7х25 мм; 0,7х31 мм; 0,7х38 мм; 0,8х19 мм; 0,8х25 мм; 0,8х31 мм; 0,8х38 мм; 0,9х19 мм; 0,9х25 мм; 0,9х31 мм; 0,9х38 мм; 1,2х19 мм; 1,2х25 мм; 1,2х31 мм; 1,2х38 мм.

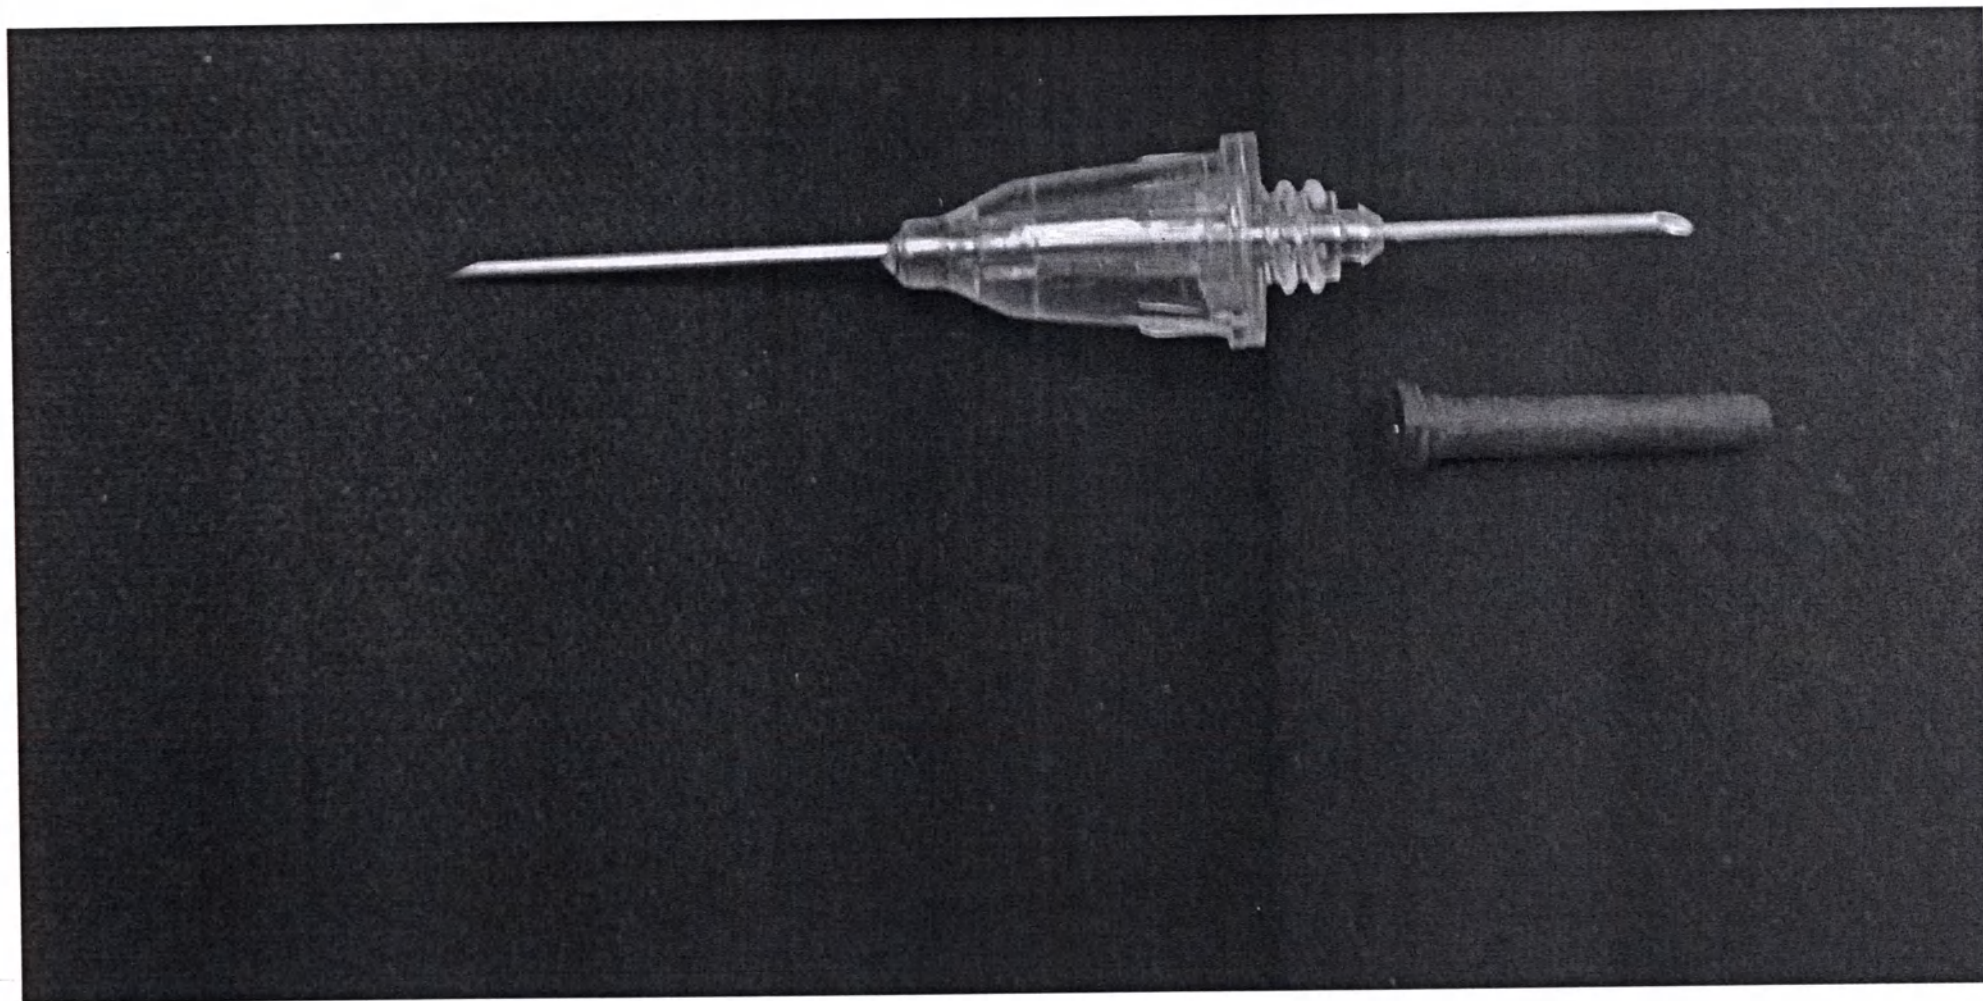


2. Игла одноразовая двусторонняя, варианты исполнения: 0,5х19 мм; 0,5х25 мм; 0,5х31 мм; 0,5х38 мм; 0,6х19 мм; 0,6х25 мм; 0,6х31 мм; 0,6х38 мм; 0,7х19 мм; 0,7х25 мм; 0,7х31 мм; 0,7х38 мм; 0,8х19 мм; 0,8х25 мм; 0,8х31 мм; 0,8х38 мм; 0,9х19 мм; 0,9х25 мм; 0,9х31 мм; 0,9х38 мм; 1,2х19 мм; 1,2х25 мм; 1,2х31 мм; 1,2х38 мм.

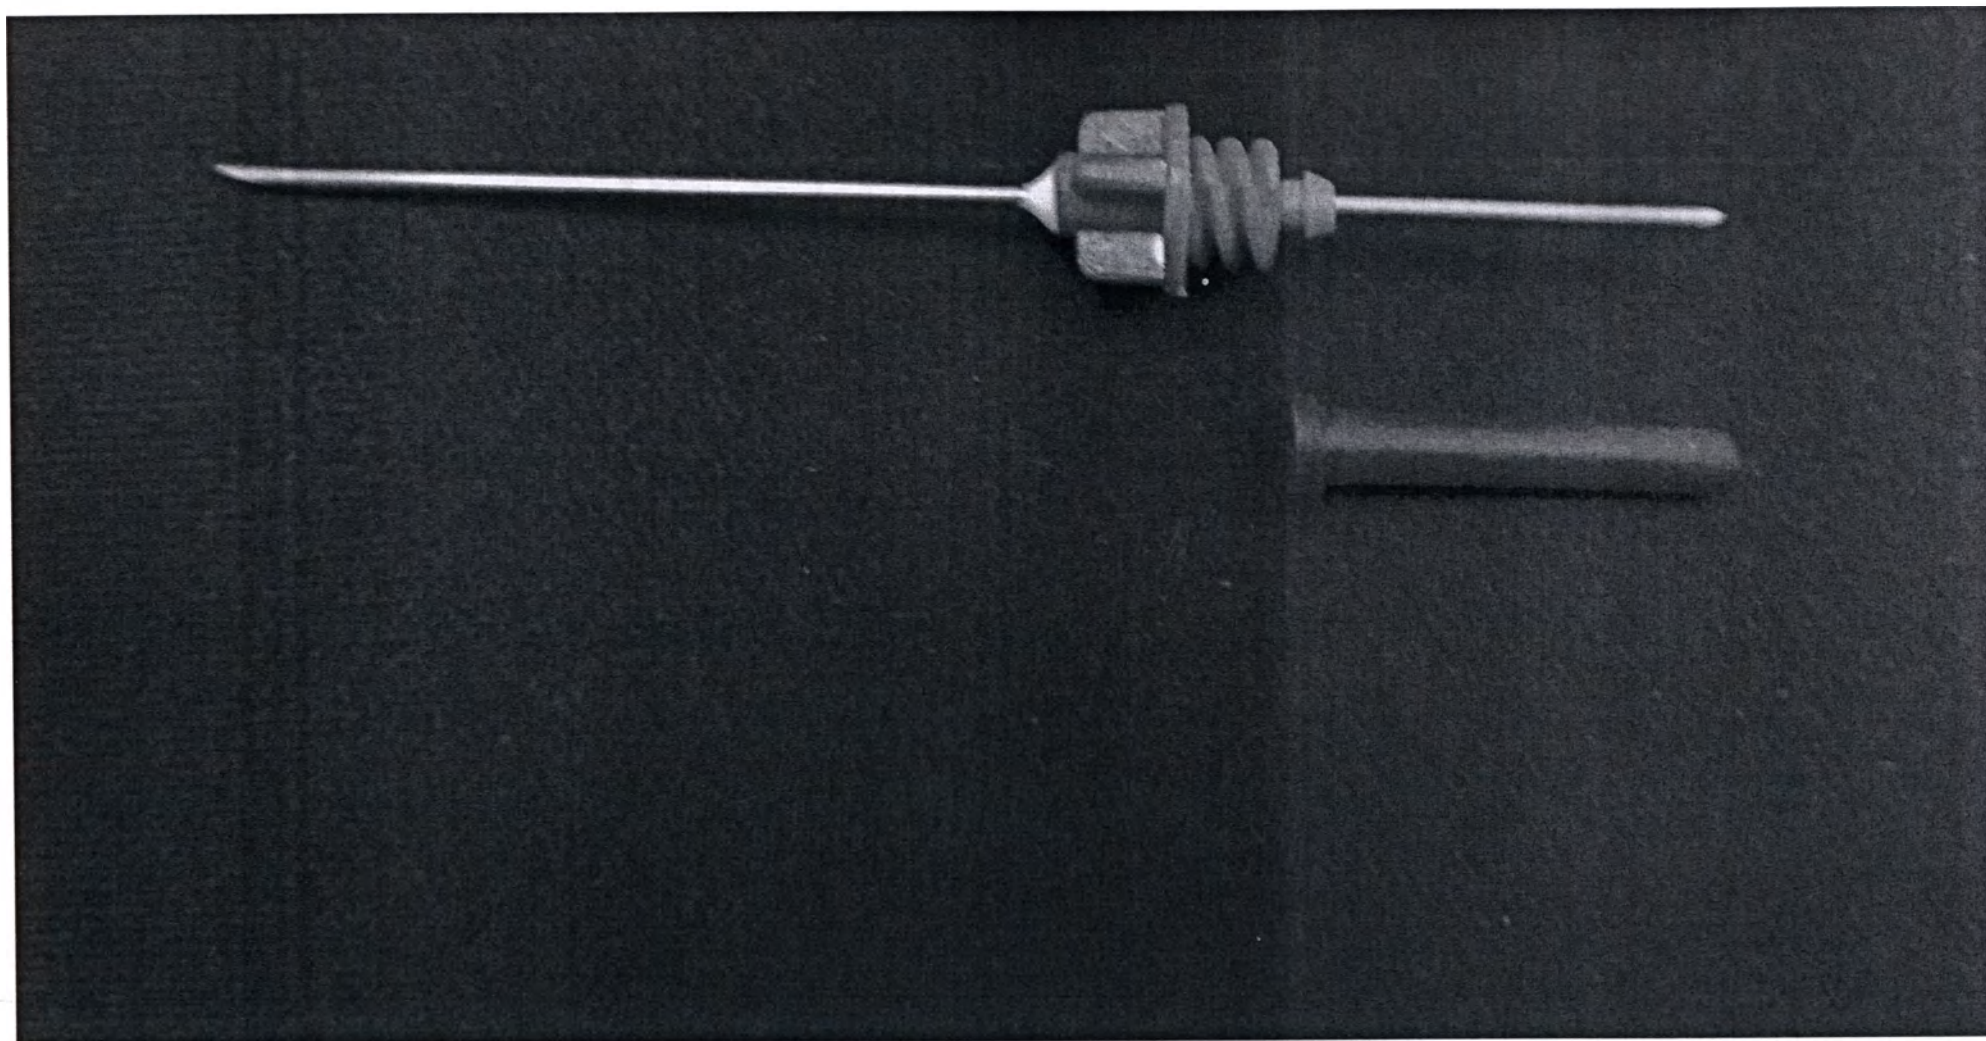


3. Игла одноразовая двусторонняя с защитным колпачком, варианты исполнения: 0,5х19 мм; 0,5х25 мм; 0,5х31 мм; 0,5х38 мм; 0,6х19 мм; 0,6х25 мм; 0,6х31 мм; 0,6х38 мм; 0,7х19 мм; 0,7х25 мм; 0,7х31 мм; 0,7х38 мм; 0,8х19 мм; 0,8х25 мм; 0,8х31 мм; 0,8х38 мм; 0,9х19 мм; 0,9х25 мм; 0,9х31 мм; 0,9х38 мм; 1,2х19 мм; 1,2х25 мм; 1,2х31 мм; 1,2х38 мм.

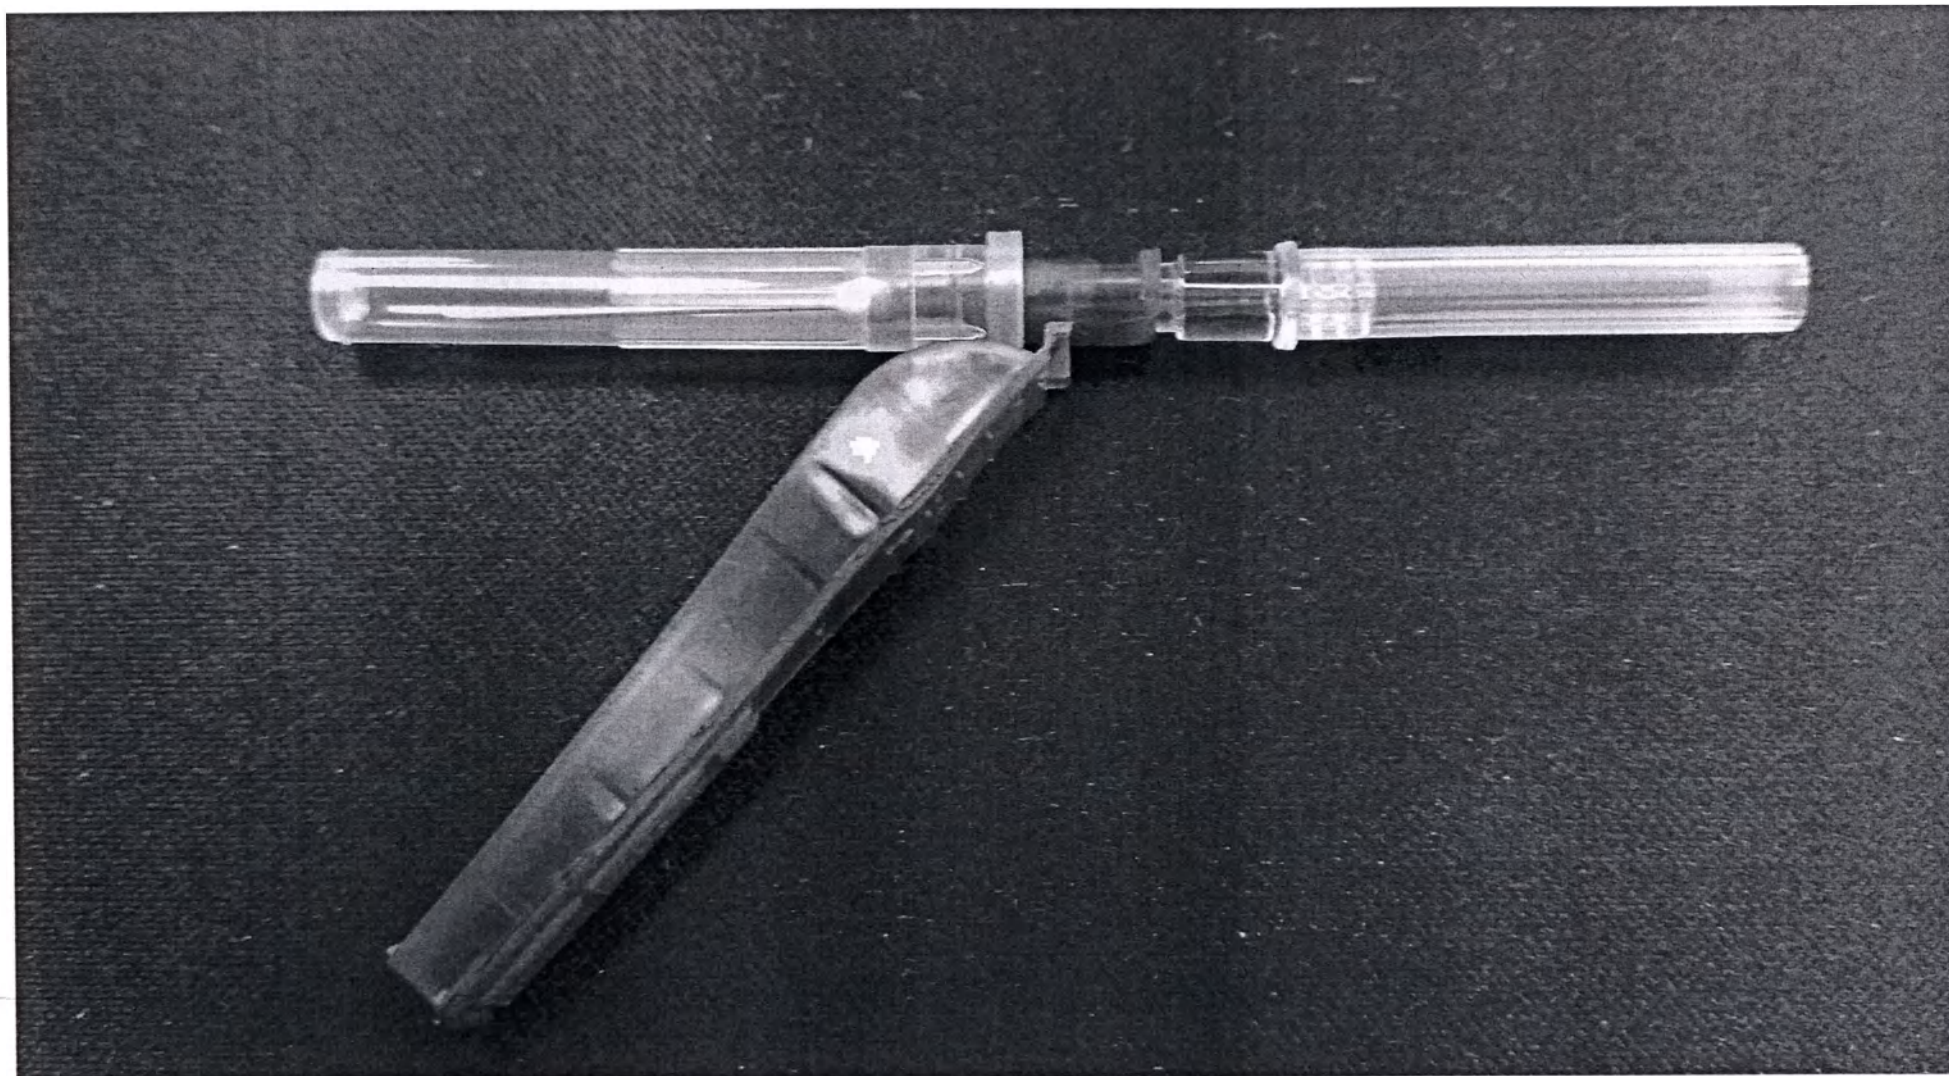


4. Игла одноразовая двусторонняя с прозрачной камерой с присоединенным адаптером (держателем), варианты исполнения: 0,5х19 мм; 0,5х25 мм; 0,5х31 мм; 0,5х38 мм; 0,6х19 мм; 0,6х25 мм; 0,6х31 мм; 0,6х38 мм; 0,7х19 мм; 0,7х25 мм; 0,7х31 мм; 0,7х38 мм; 0,8х19 мм; 0,8х25 мм; 0,8х31 мм; 0,8х38 мм; 0,9х19 мм; 0,9х25 мм; 0,9х31 мм; 0,9х38 мм; 1,2х19 мм; 1,2х25 мм; 1,2х31 мм; 1,2х38 мм.

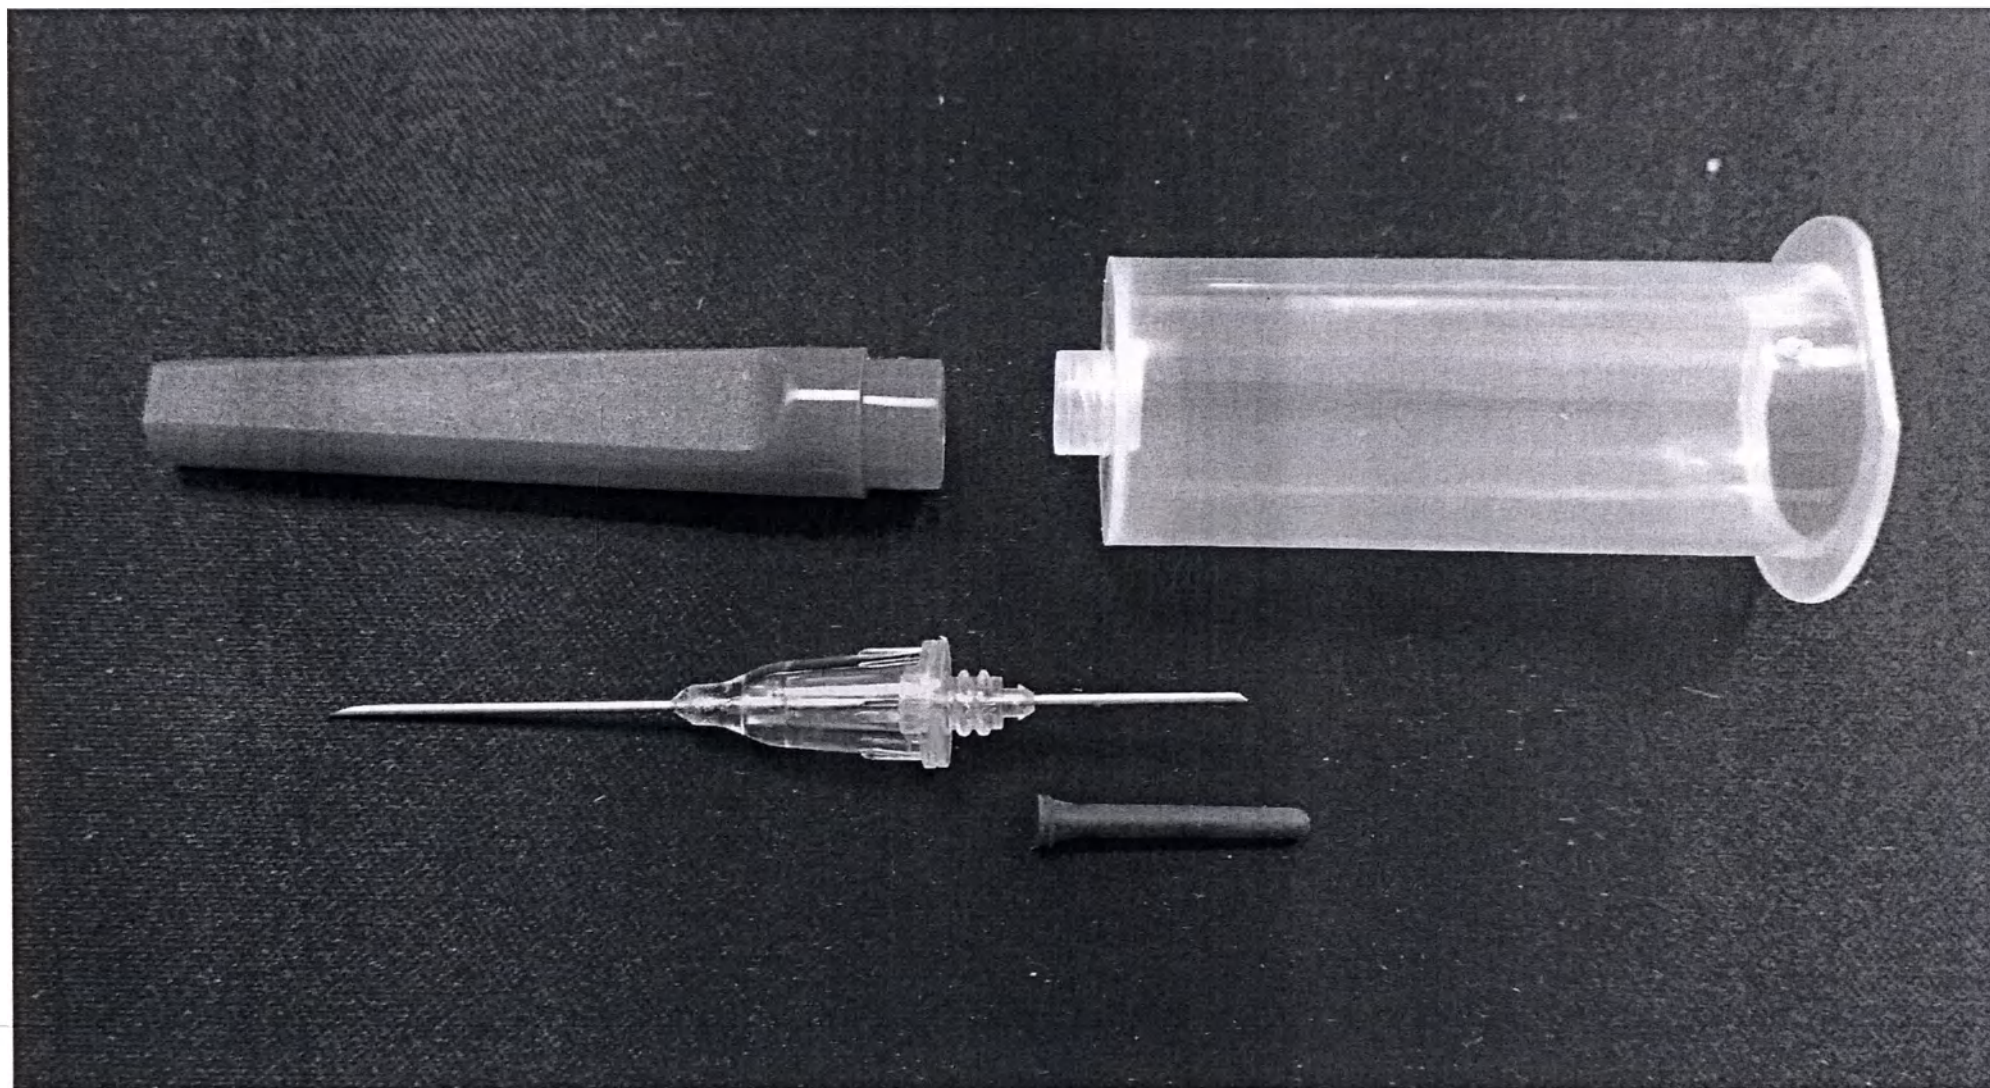

5. Игла одноразовая двусторонняя с присоединенным адаптером (держателем), варианты исполнения: 0,5х19 мм; 0,5х25 мм; 0,5х31 мм; 0,5х38 мм; 0,6х19 мм; 0,6х25 мм; 0,6х31 мм; 0,6х38 мм; 0,7х19 мм; 0,7х25 мм; 0,7х31 мм; 0,7х38 мм; 0,8х19 мм; 0,8х25 мм; 0,8х31 мм; 0,8х38 мм; 0,9х19 мм; 0,9х25 мм; 0,9х31 мм; 0,9х38 мм; 1,2х19 мм; 1,2х25 мм; 1,2х31 мм; 1,2х38 мм.

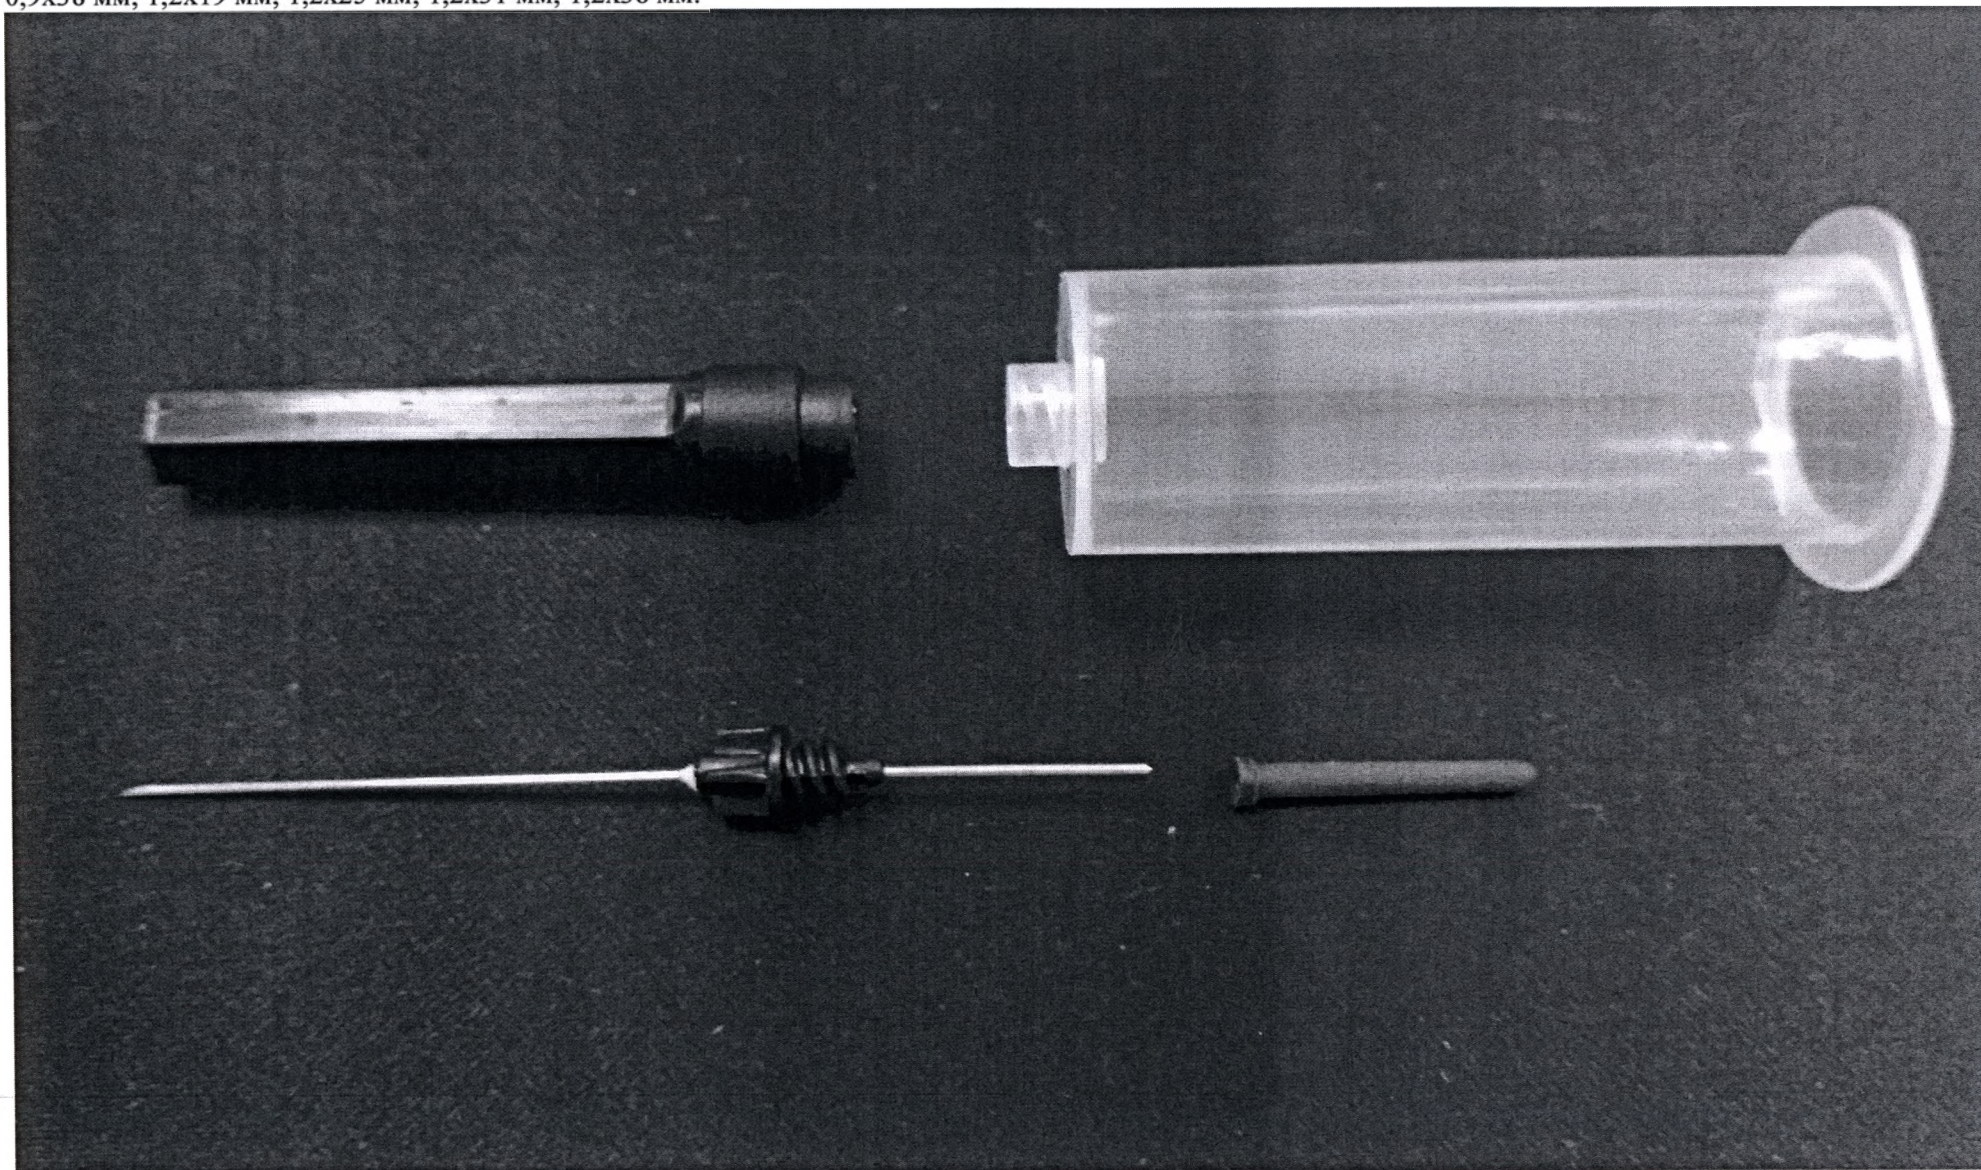


6. Игла одноразовая двусторонняя с защитным колпачком и с присоединенным адаптером (держателем) варианты исполнения: 0,5х19 мм; 0,5х25 мм; 0,5х31 мм; 0,5х38 мм; 0,6х19 мм; 0,6х25 мм; 0,6х31 мм; 0,6х38 мм; 0,7х19 мм; 0,7х25 мм; 0,7х31 мм; 0,7х38 мм; 0,8х19 мм; 0,8х25 мм; 0,8х31 мм; 0,8х38 мм; 0,9х19 мм; 0,9х25 мм; 0,9х31 мм; 0,9х38 мм; 1,2х19 мм; 1,2х25 мм; 1,2х31 мм; 1,2х38 мм.

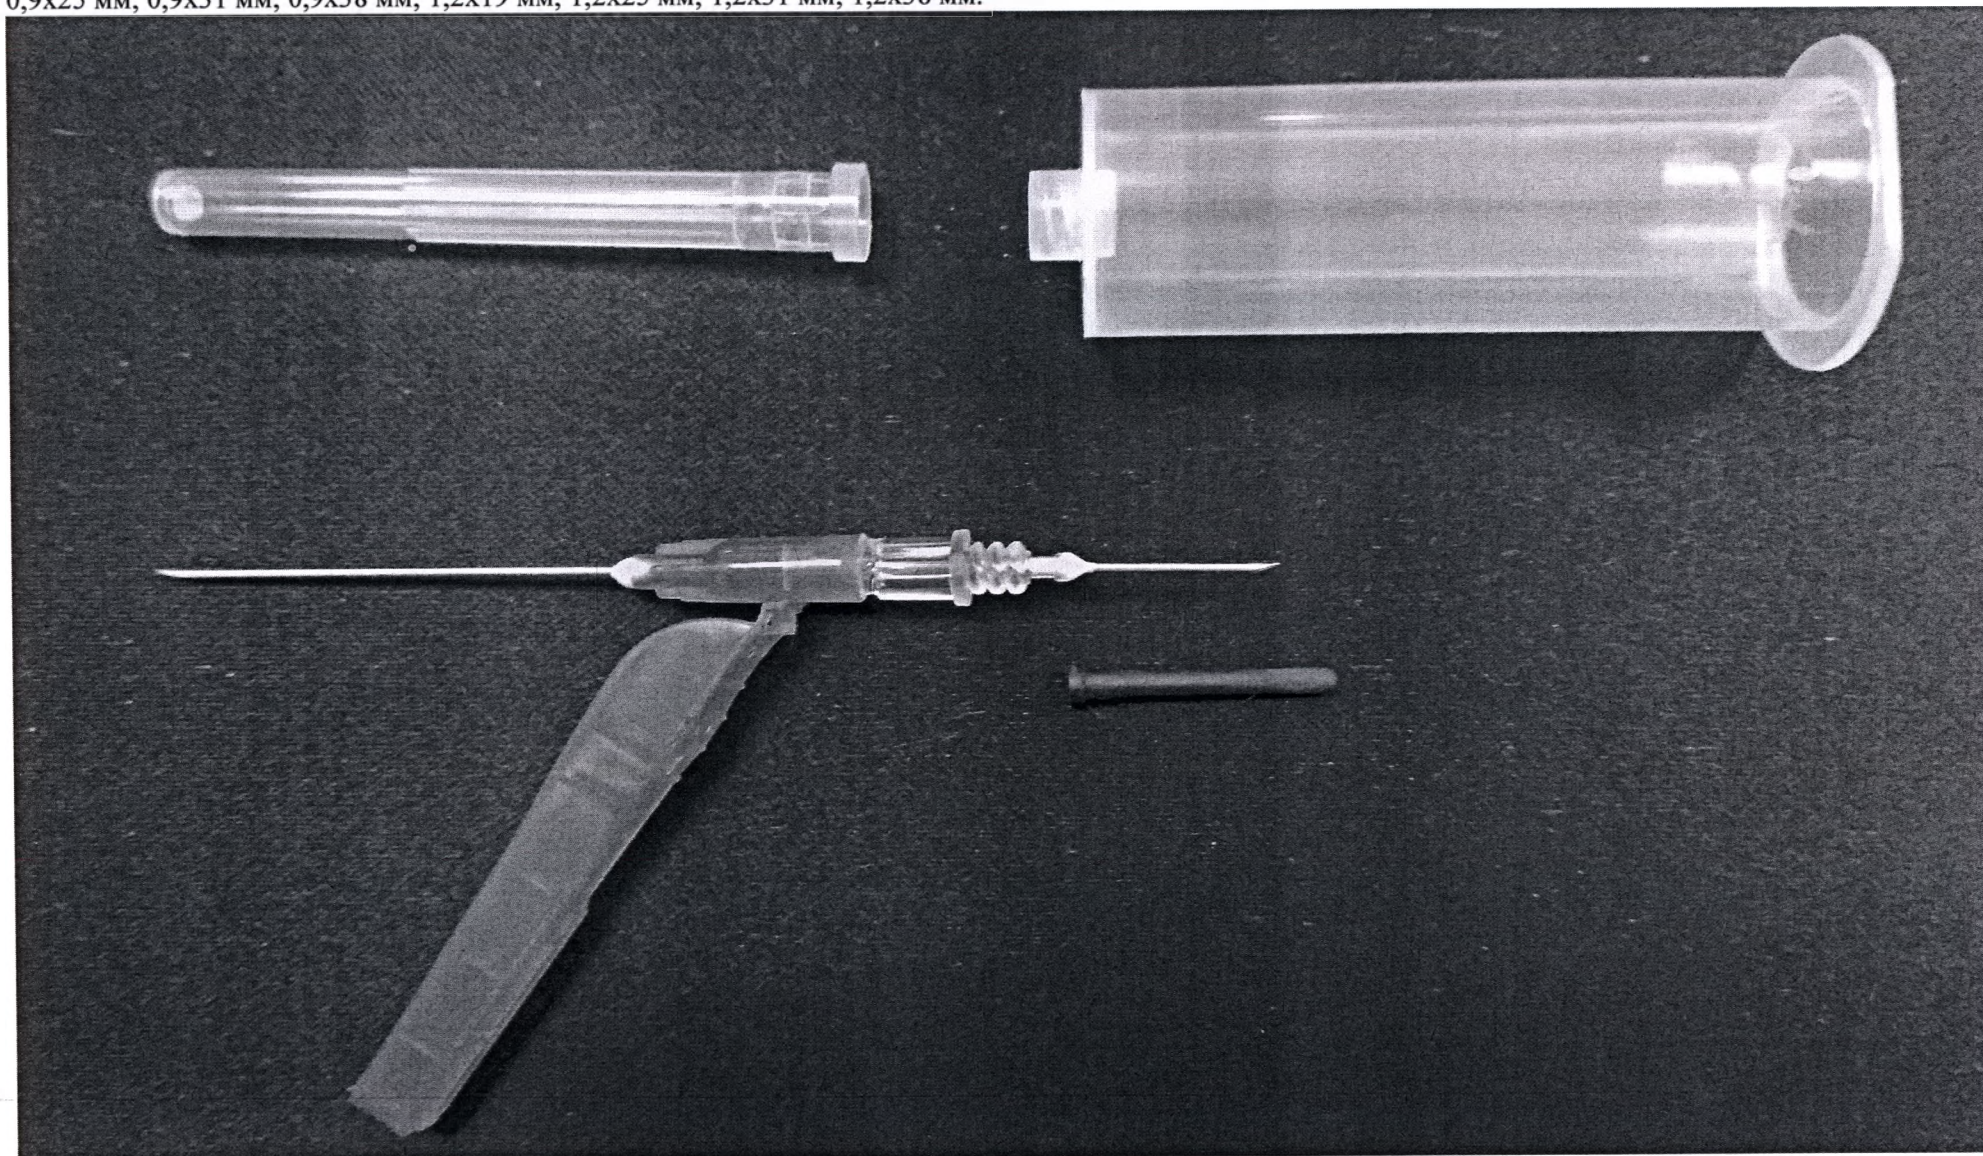


II. Принадлежности

1. Адаптер (держатель) одноразовый

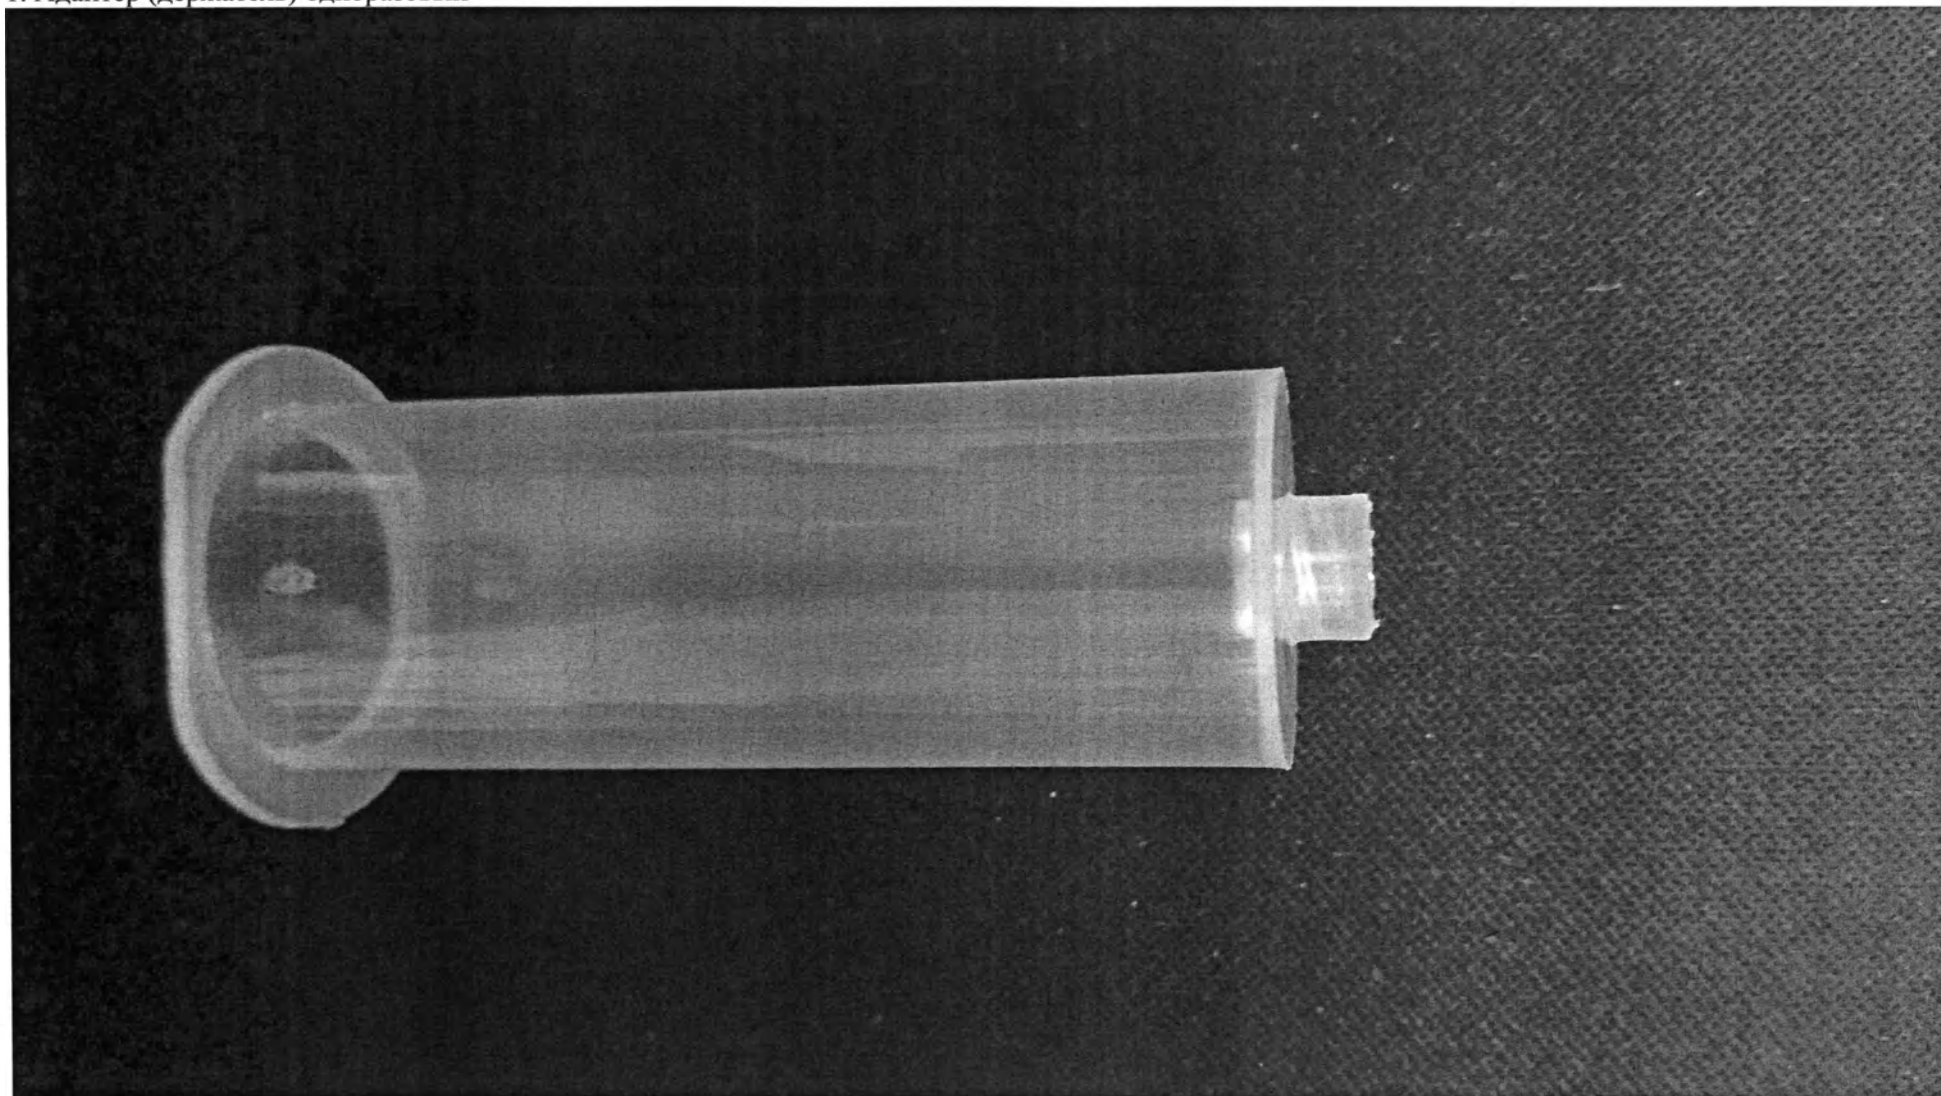

2. Адаптер (держатель) одноразовый с механизмом безопасного сброса иглы

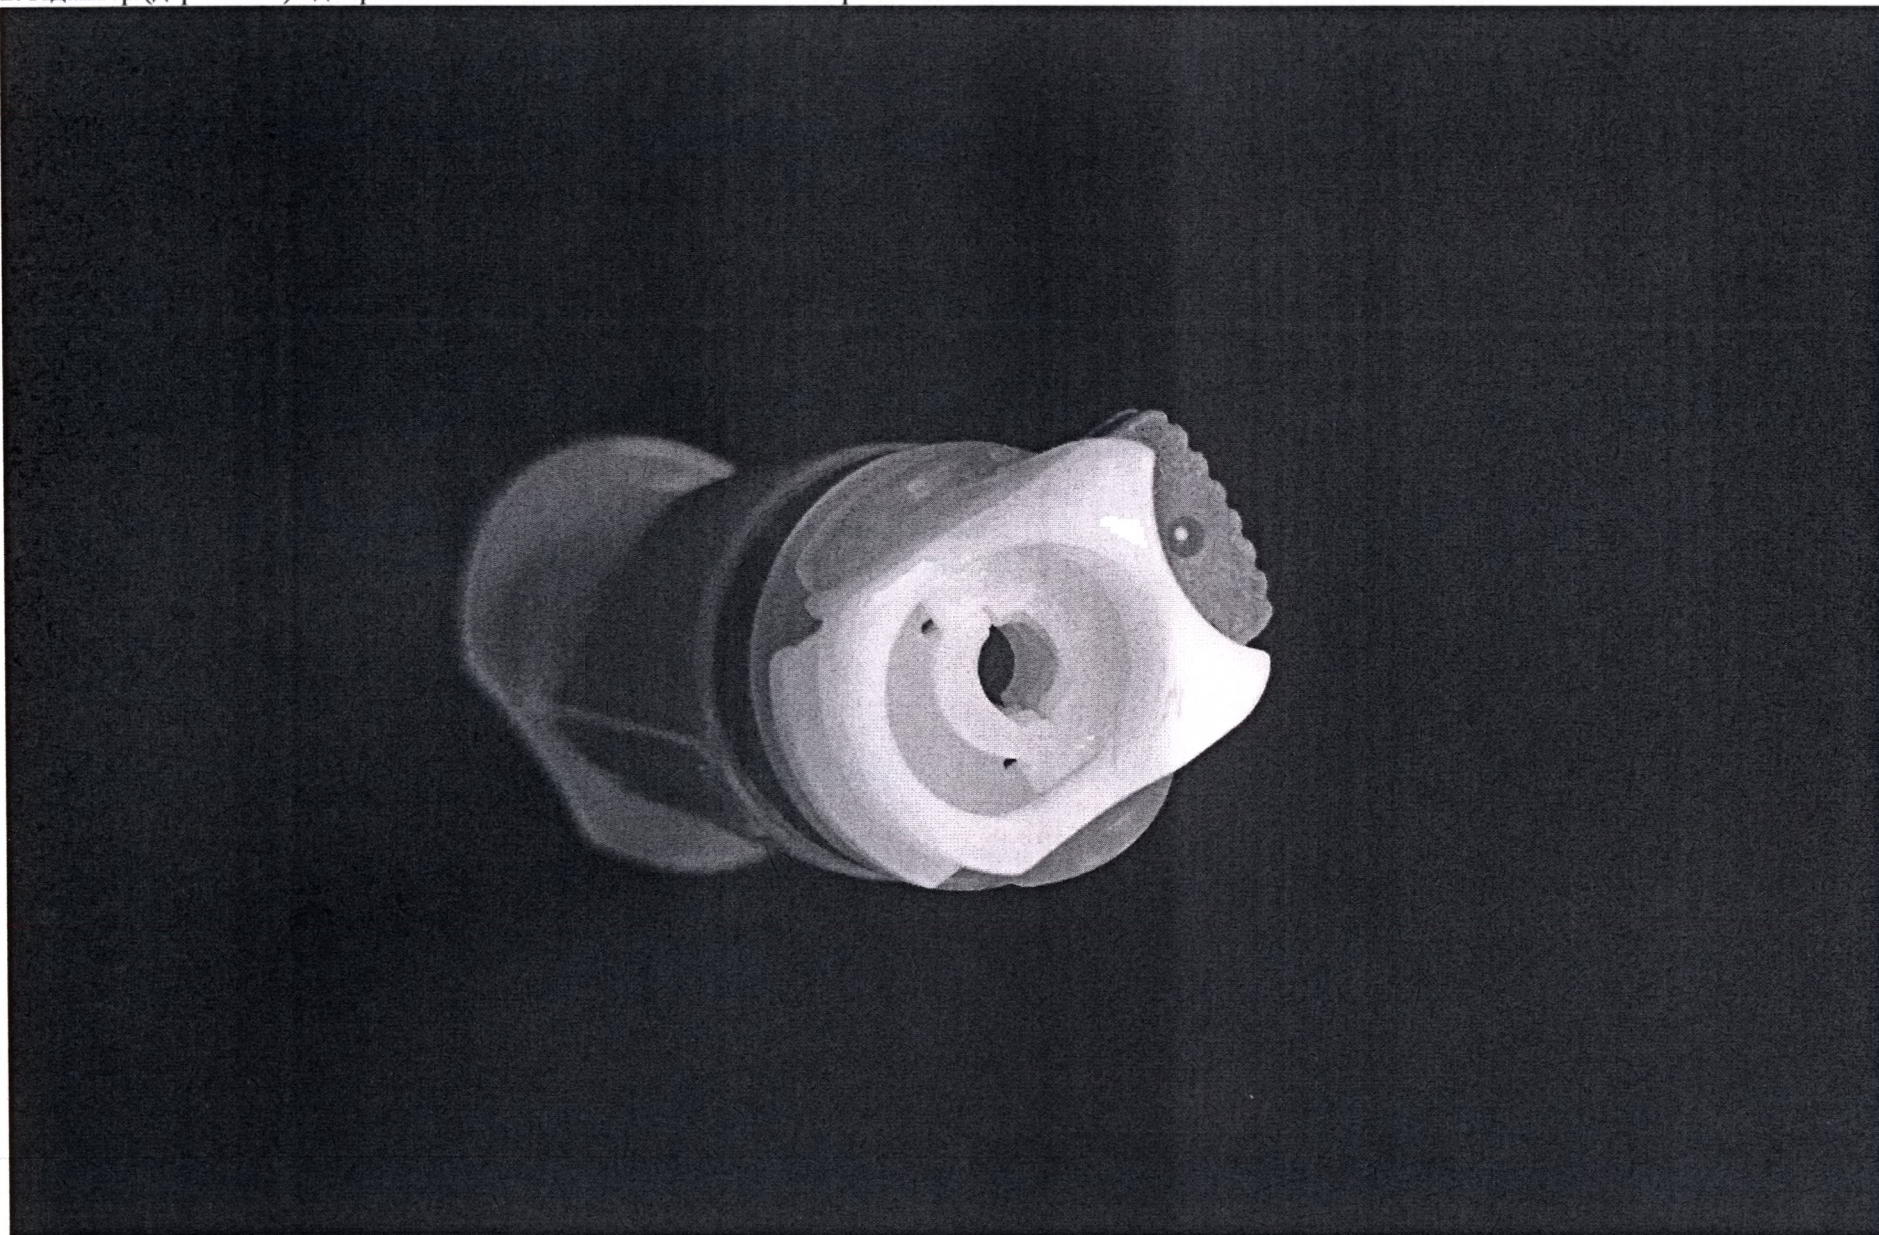

Проект макета маркировки РФ (потребительская упаковка иглы):

ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А		Открыть тут
Иглы одноразовые двусторонние для взятия венозной крови вакуумной пробиркой под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.13-002- 31043776-2017. Вариант исполнения		
Размер:	Использовать до:	
LOT	REF	
  		VacuLab®


Проект макета маркировки РФ (Адаптер (держатель) одноразовый и/или Адаптер (держатель) одноразовый с механизмом безопасного сброса иглы):

ООО «МИНИМАКС», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А		Открыть тут
Адаптер (держатель) одноразовый		
STERILE EO	Использовать до:	
LOT	REF	
  		VacuLab®

Пример проекта маркировки РФ (вторичная упаковка)

ООО «МИНИМАКС» 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А		VacuLab®
Иглы одноразовые двусторонние для взятия венозной крови вакуумной пробиркой под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.13-002- 31043776-2017. Вариант исполнения		
Код партии		
Номер по каталогу		
Размер иглы		
Количество		
Дата упаковывания		
Дата стерилизации		
ТУ XXXXXXXXXX		
Номер и дата РУ		
 Использовать до:		
Условия хранения и транспортирования: Транспортировать при температуре от -30°C до +50 °C и относительной влажности воздуха не более 90%. Хранить при температуре от +4 °C до +25 °C и относительной влажности воздуха не более 90%.		
  		

Пример проекта маркировки РФ (транспортная упаковка)

ООО «МИНИМАКС» 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, лит. А., пом. 28Н, офис 514А	
Иглы одноразовые двусторонние для взятия венозной крови вакуумной пробиркой под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.13-002- 31043776-2017. Вариант исполнения	
   	
LOT	
REF	
 Использовать до:	
Размеры игл	
Количество	
Дата упаковывания	
Дата стерилизации	
Условия транспортировки и хранения	Транспортировать при температуре от -30°C до +50 °C и относительной влажности воздуха не более 90%. Хранить при температуре от +4 °C до +25 °C и относительной влажности воздуха не более 90%.

Всего пронумеровано, сшито и скреплено
печатью 12 (двенадцать) листа(-ов)
Генеральный директор
ООО «МиниМакс»
Маханова Е.А.

