


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «КардиоМед»

Кузнецова Д.В.

07 октября 2019 г.

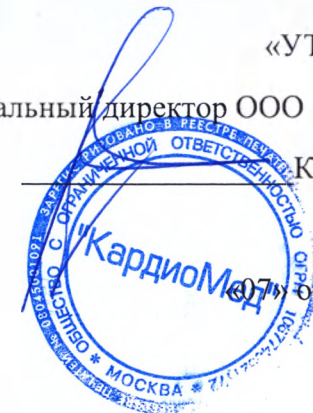

Фотографические изображения медицинского изделия

«Облучатель фототерапевтический «Intensive Phototherapy» для новорожденных», варианты исполнения

производства Tosan Co., Iran / Тосан Ко., Иран

2019


1. Общий вид. Облучатель фототерапевтический «Intensive Phototherapy» для новорожденных, модели 222, 224, 225



2. Основной блок. Облучатель фототерапевтический «Intensive Phototherapy» для новорожденных, модель 222




Лампы светодиодные, 8 шт. Облучатель фототерапевтический «Intensive Phototherapy» для новорожденных, модель 222

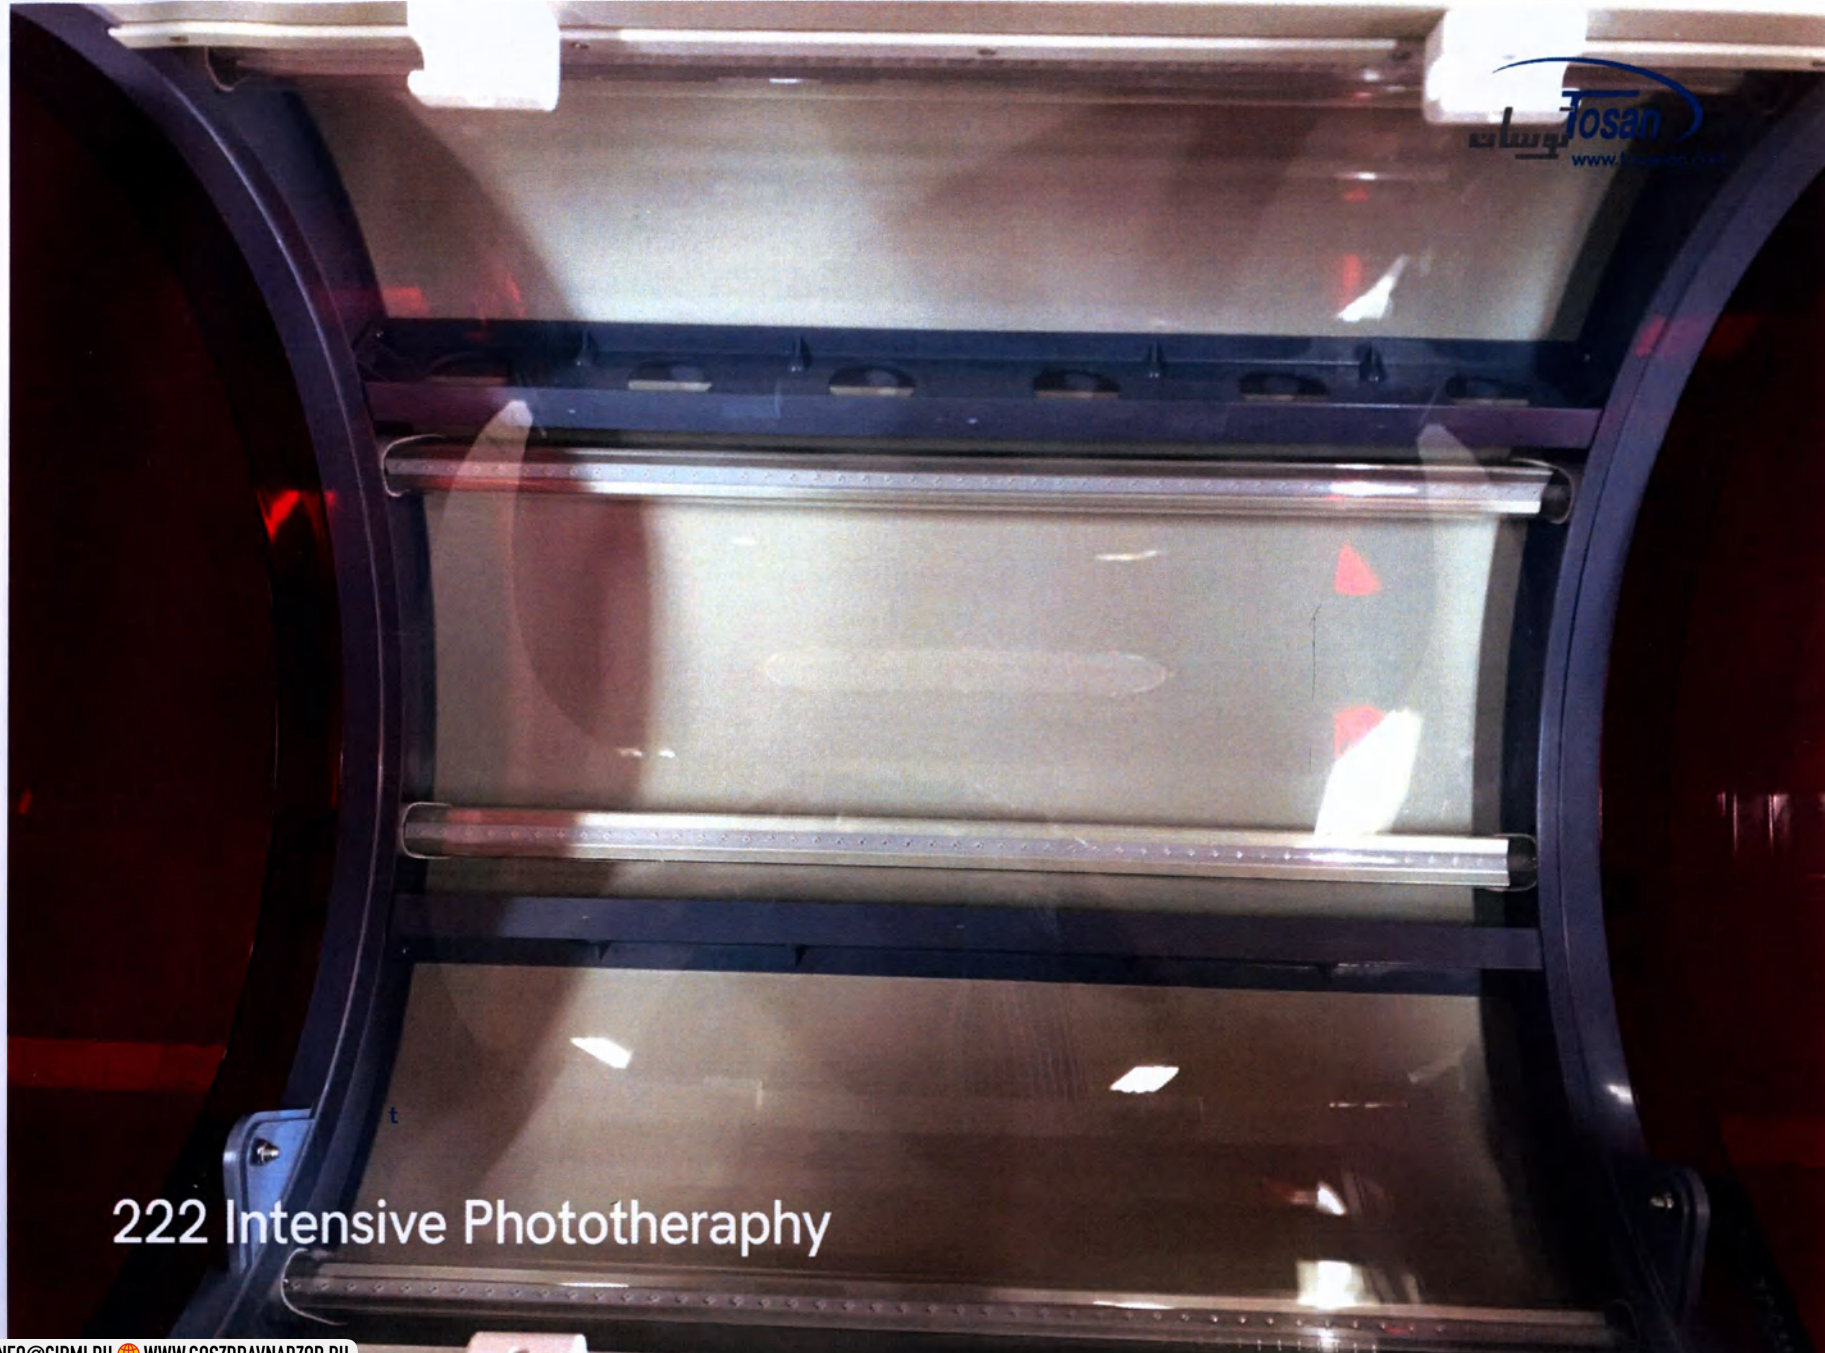


222 Intensive Phototherapy

Лампы светодиодные, 8 шт. Облучатель фототерапевтический «Intensive Phototherapy» для новорожденных, модель 222

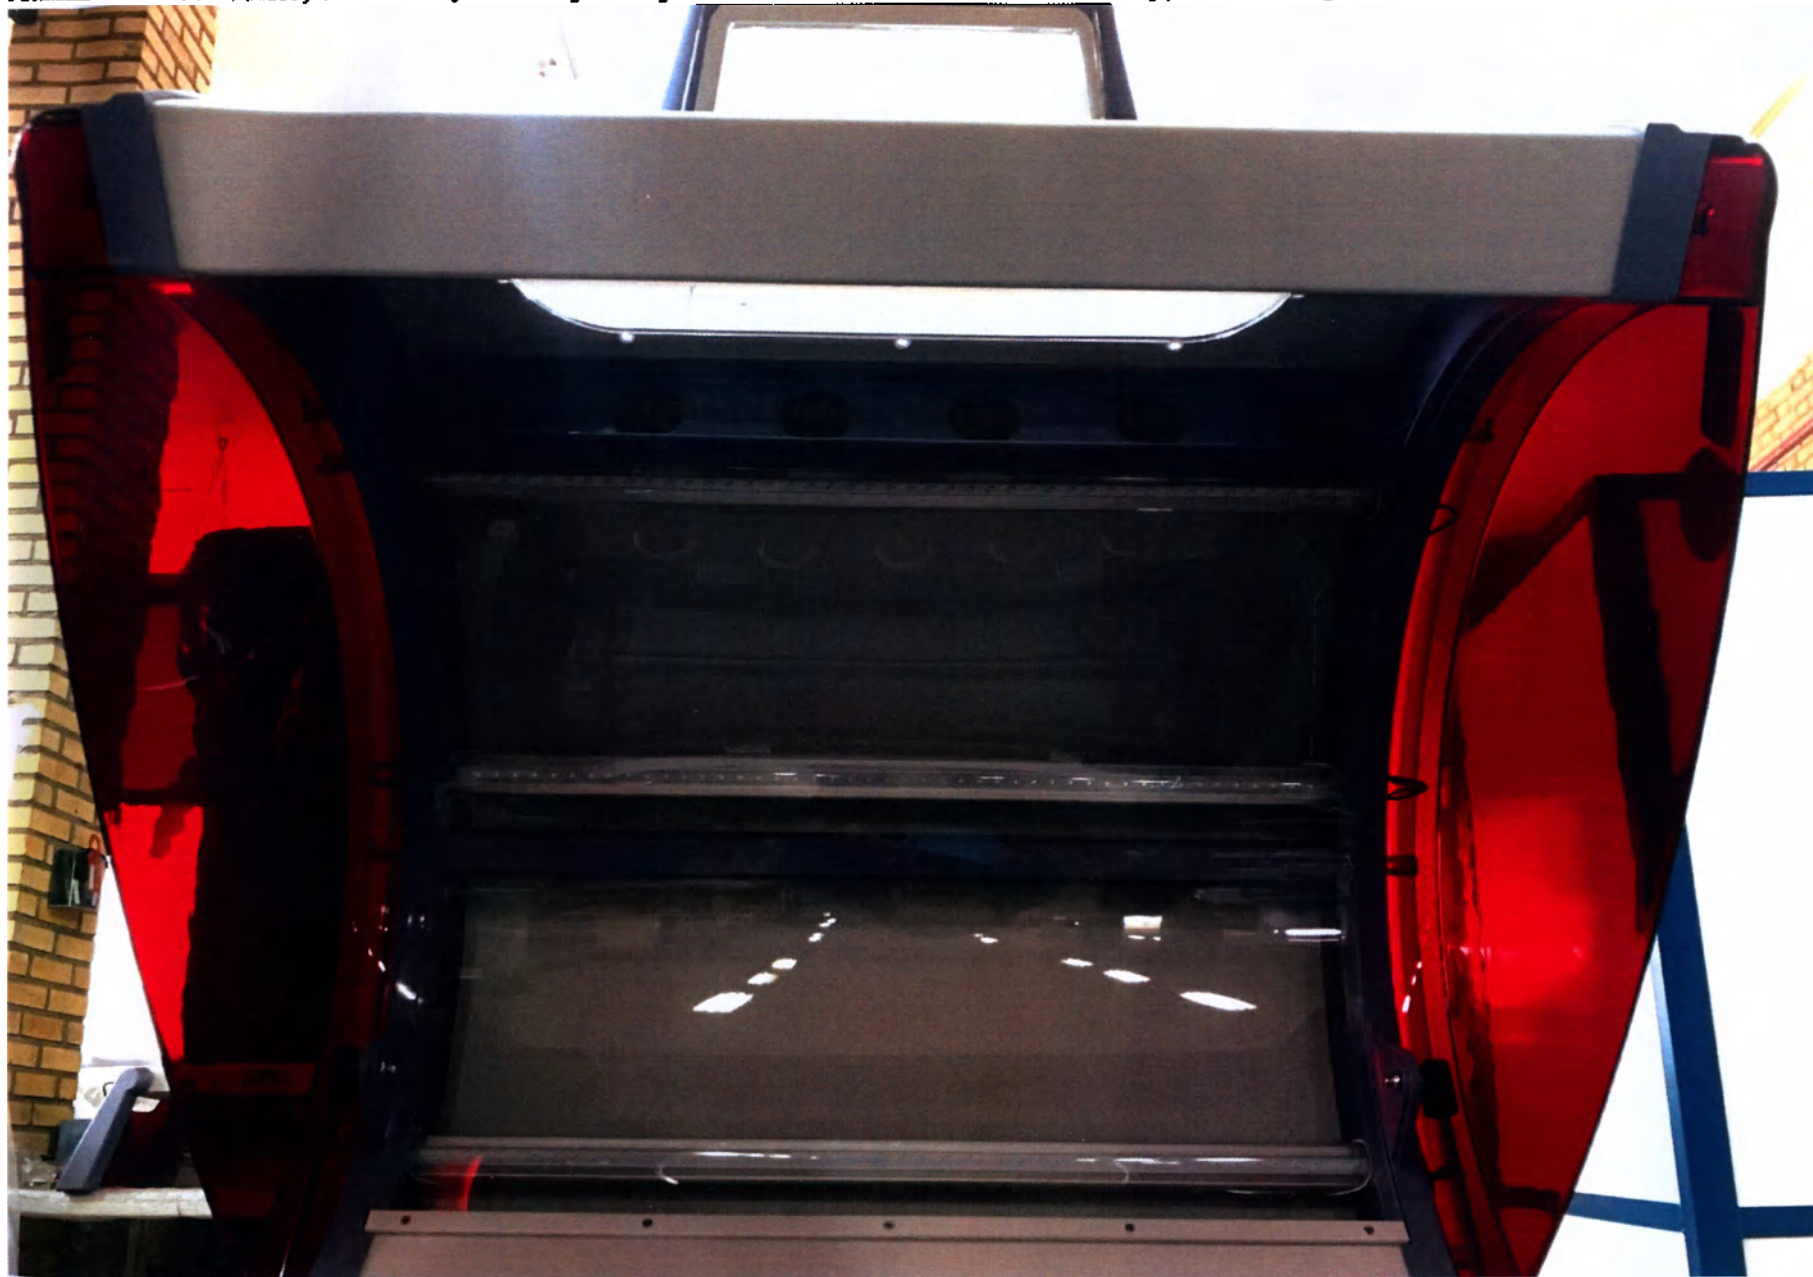

Лампы светодиодные, 12 шт. Облучатель фототерапевтический «Intensive Phototherapy» для новорожденных, модель 224

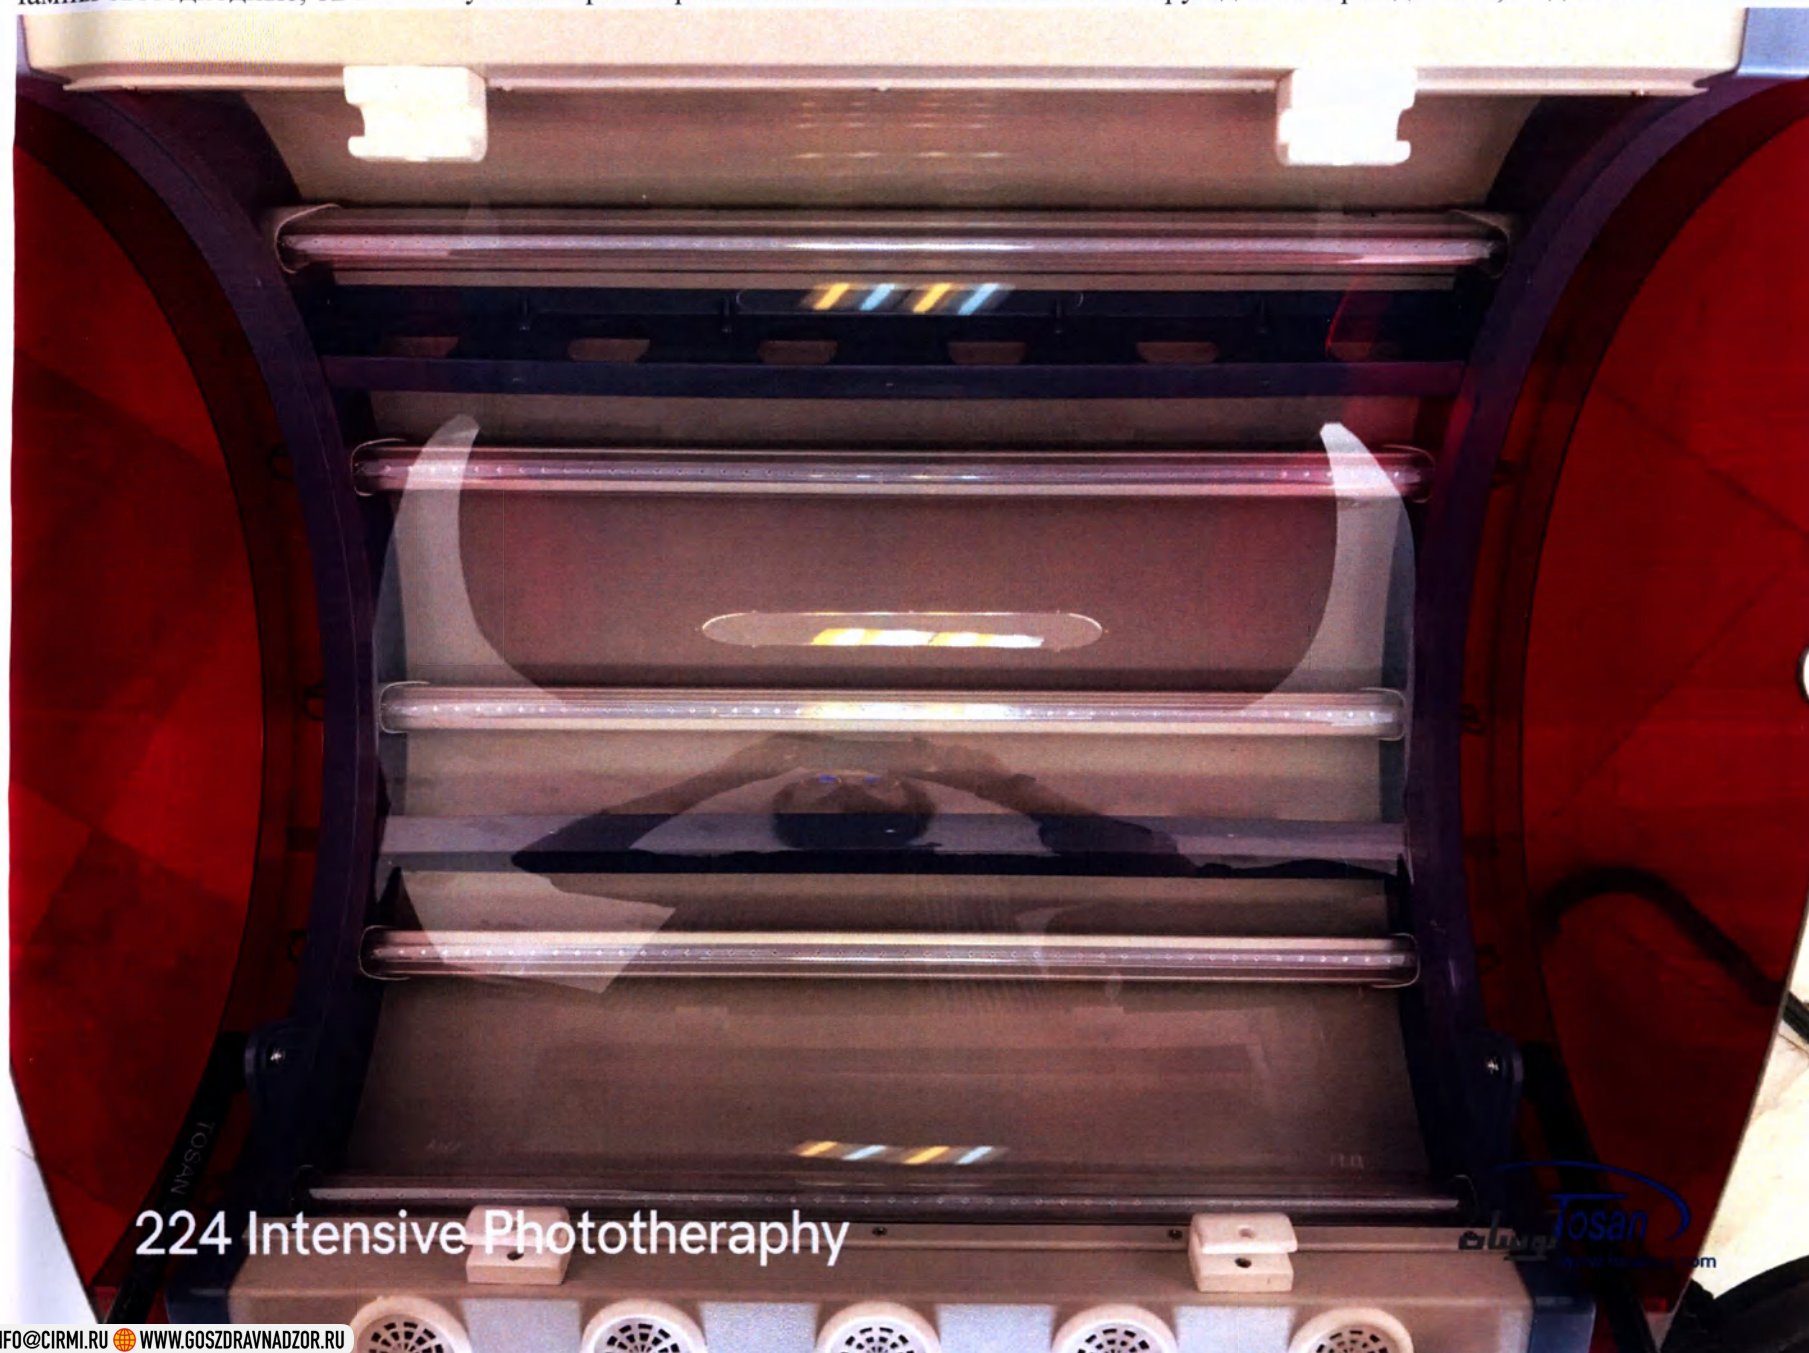

224 Intensive Phototherapy


Tosan
www.tosan.com

лампы светодиодные, 12 шт. Облучатель фототерапевтический «Intensive Phototherapy» для новорожденных, модель 224



224 Intensive Phototherapy

лампы светодиодные, 16 шт. Облучатель фототерапевтический «Intensive Phototherapy» для новорожденных, модель 225

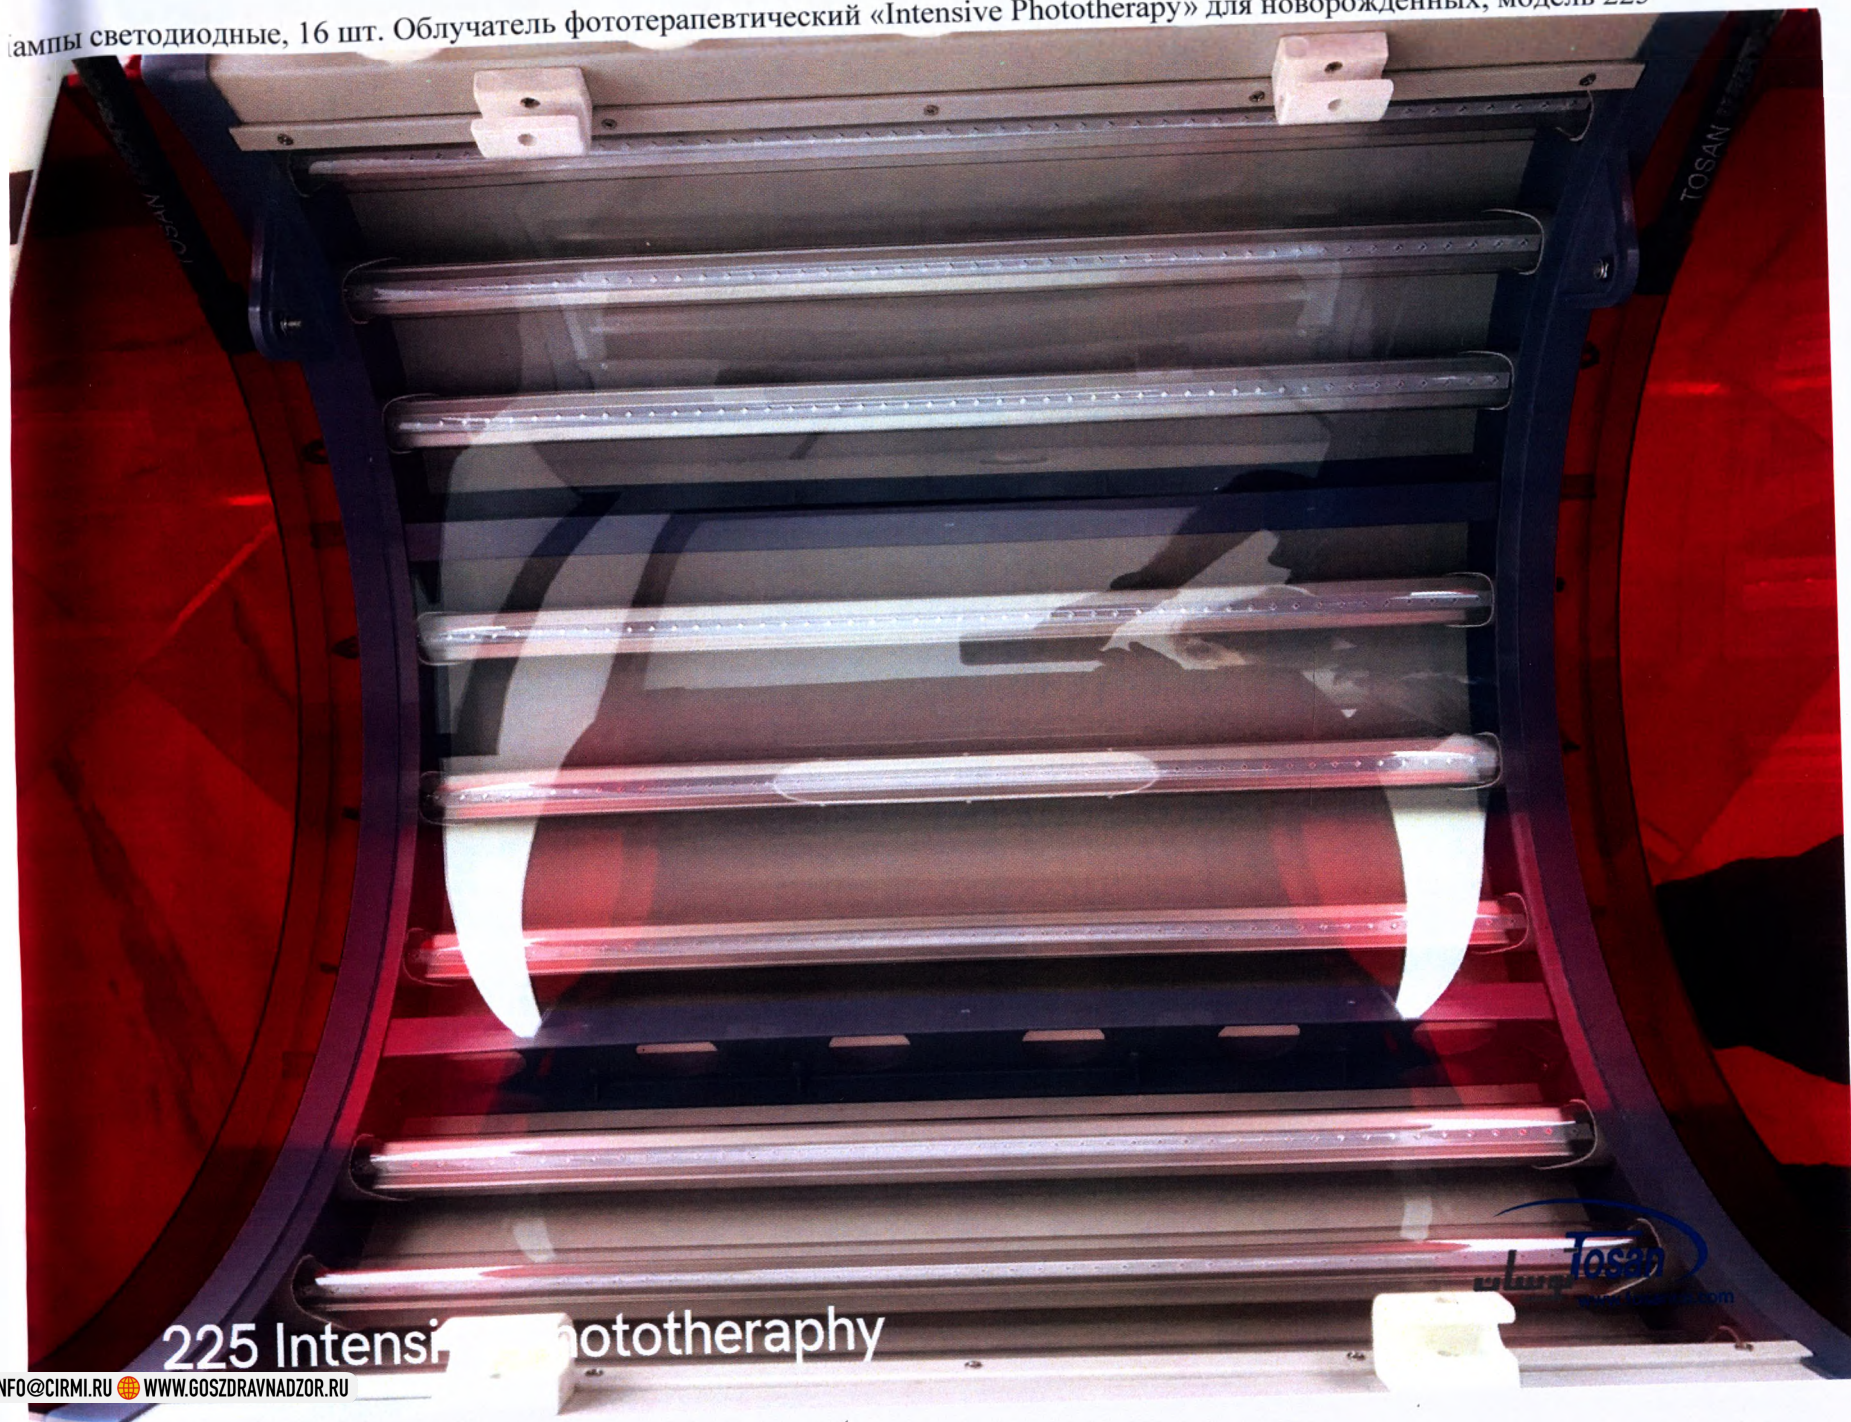

ампы светодиодные, 16 шт. Облучатель фототерапевтический «Intensive Phototherapy» для новорожденных, модель 225




анель управления. Облучатель фототерапевтический «Intensive Phototherapy» для новорожденных, модели 222, 224, 225




10. Тележка. Облучатель фототерапевтический «Intensive Phototherapy» для новорожденных, модели 222, 224, 225



11. Сетевой кабель. Облучатель фототерапевтический «Intensive Phototherapy» для новорожденных, модели 222, 224, 225

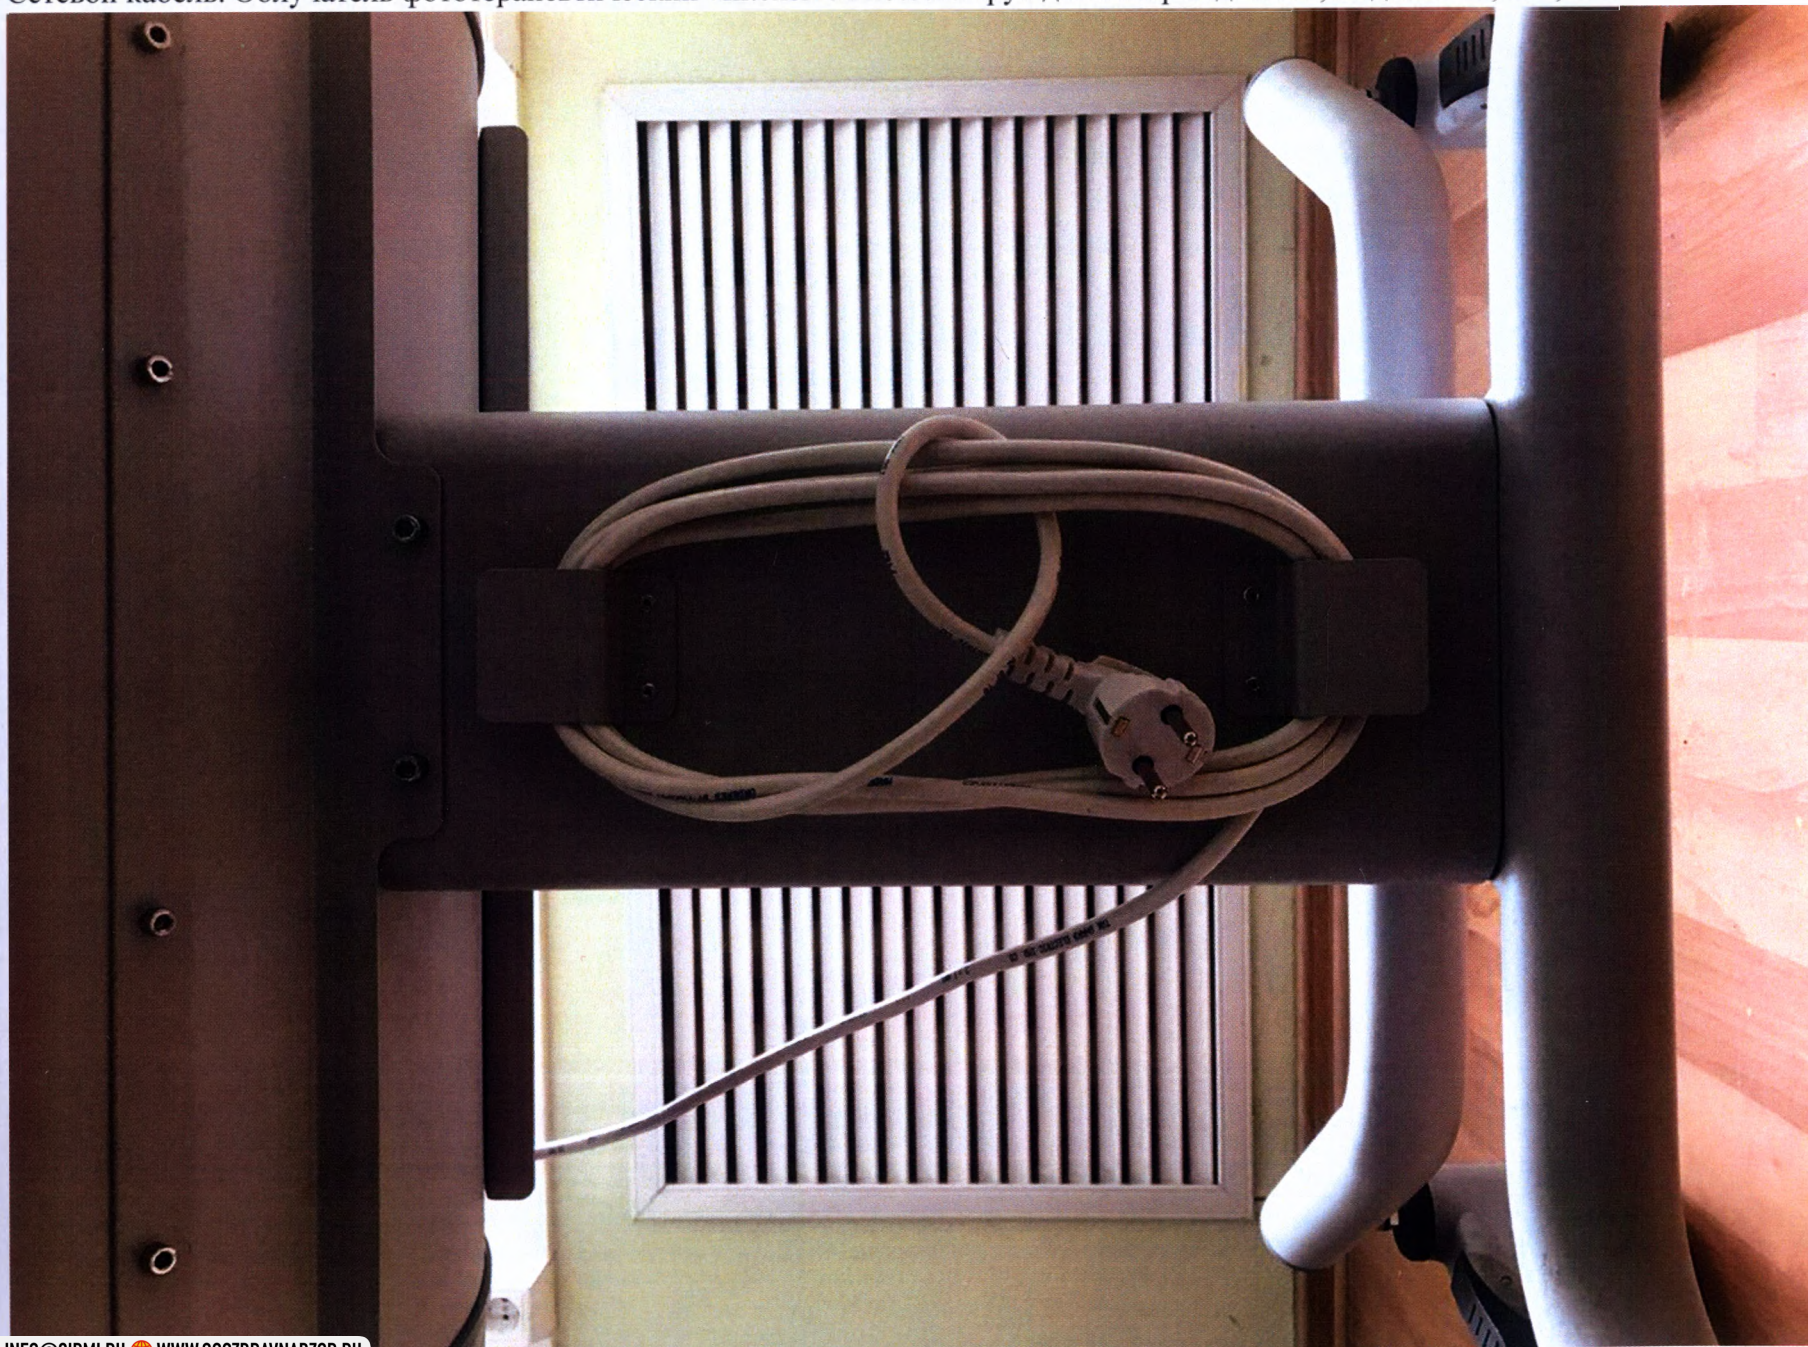


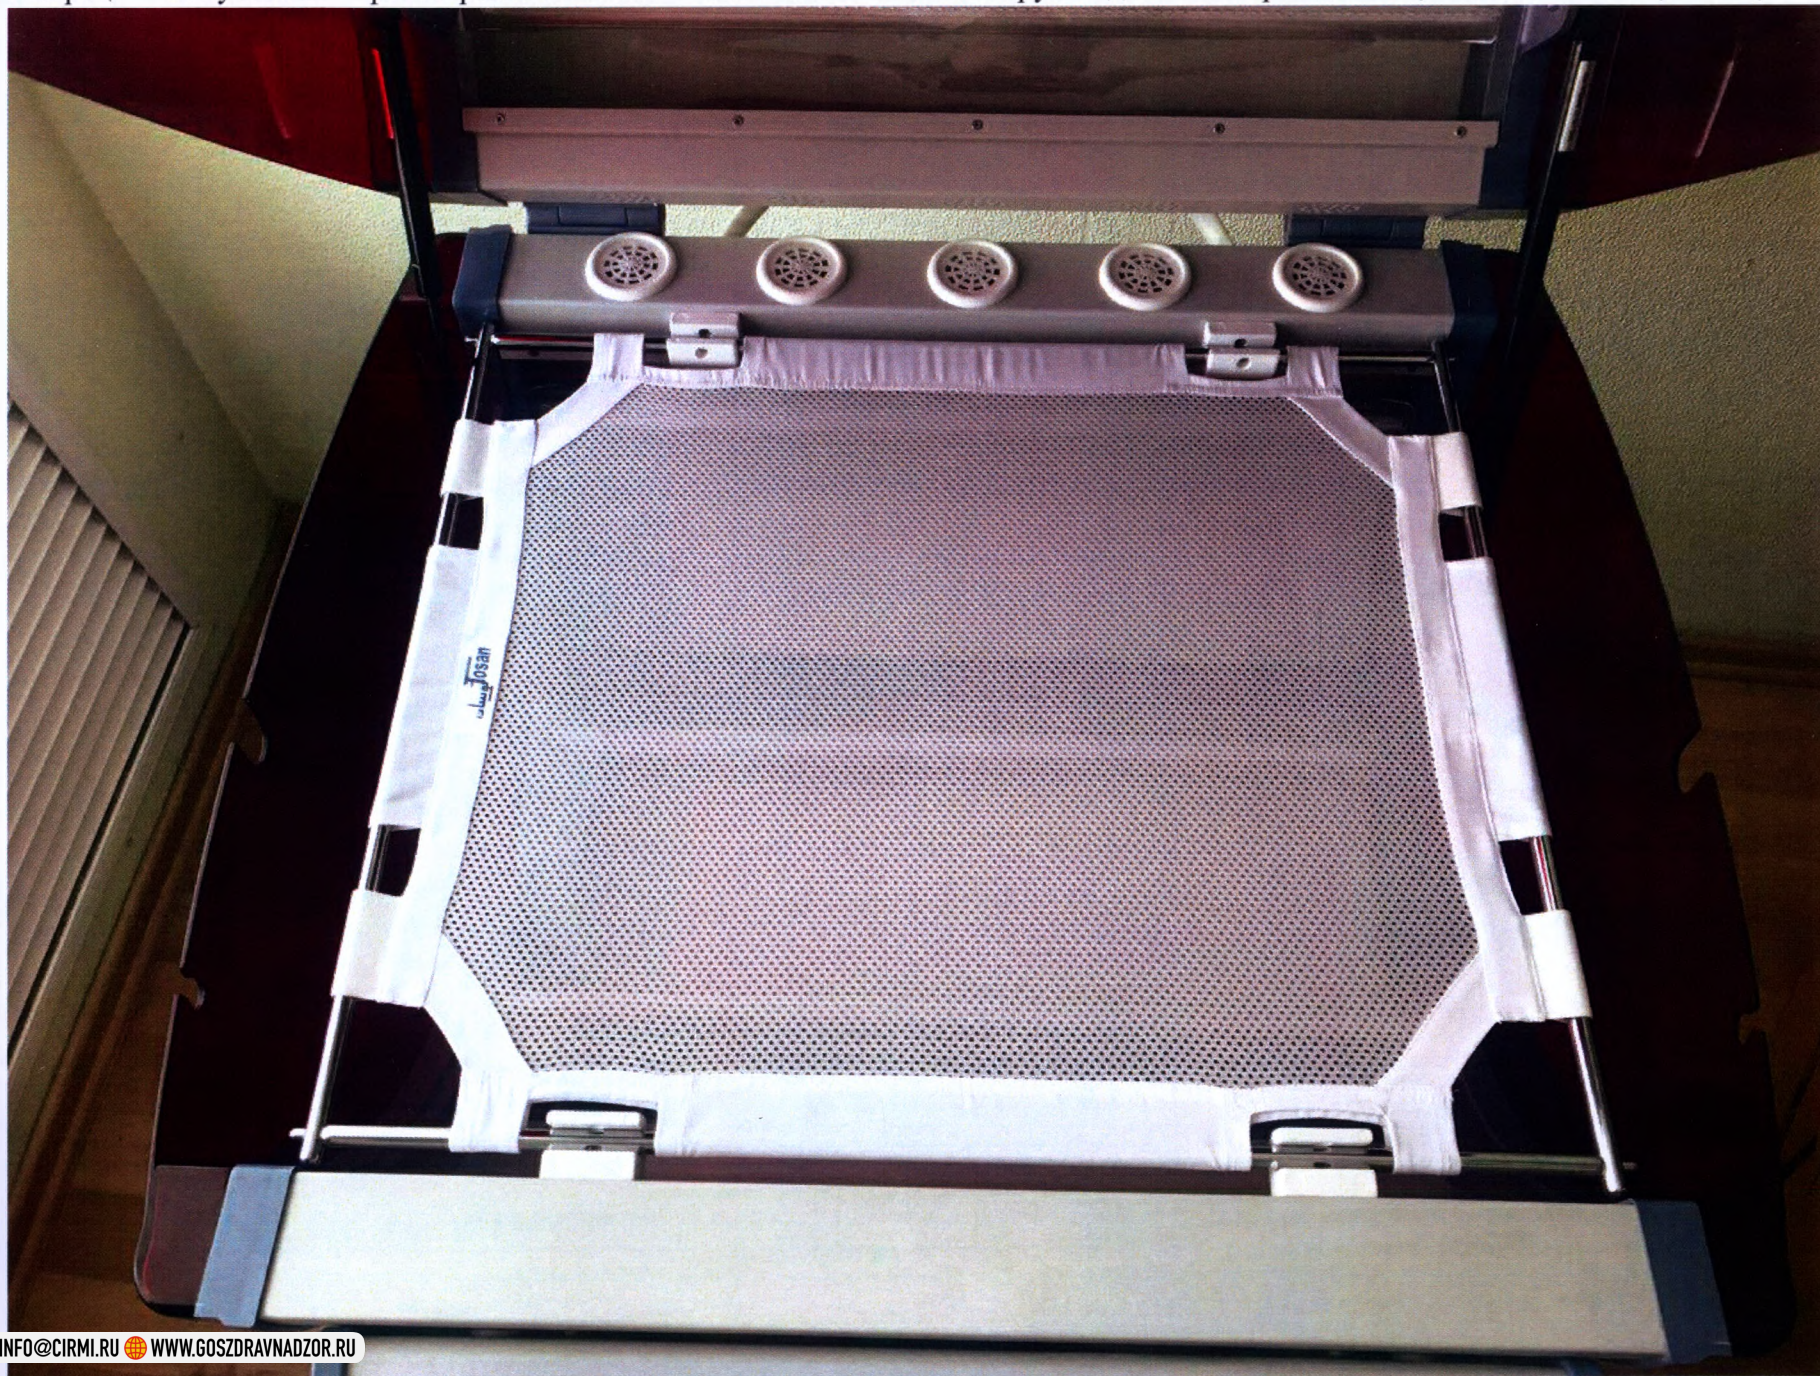

13. Датчик температуры воздуха. Облучатель фототерапевтический «Intensive Phototherapy» для новорожденных, модели 222, 224, 225




14. Датчик температуры тела. Облучатель фототерапевтический «Intensive Phototherapy» для новорожденных, модели 222, 224, 225

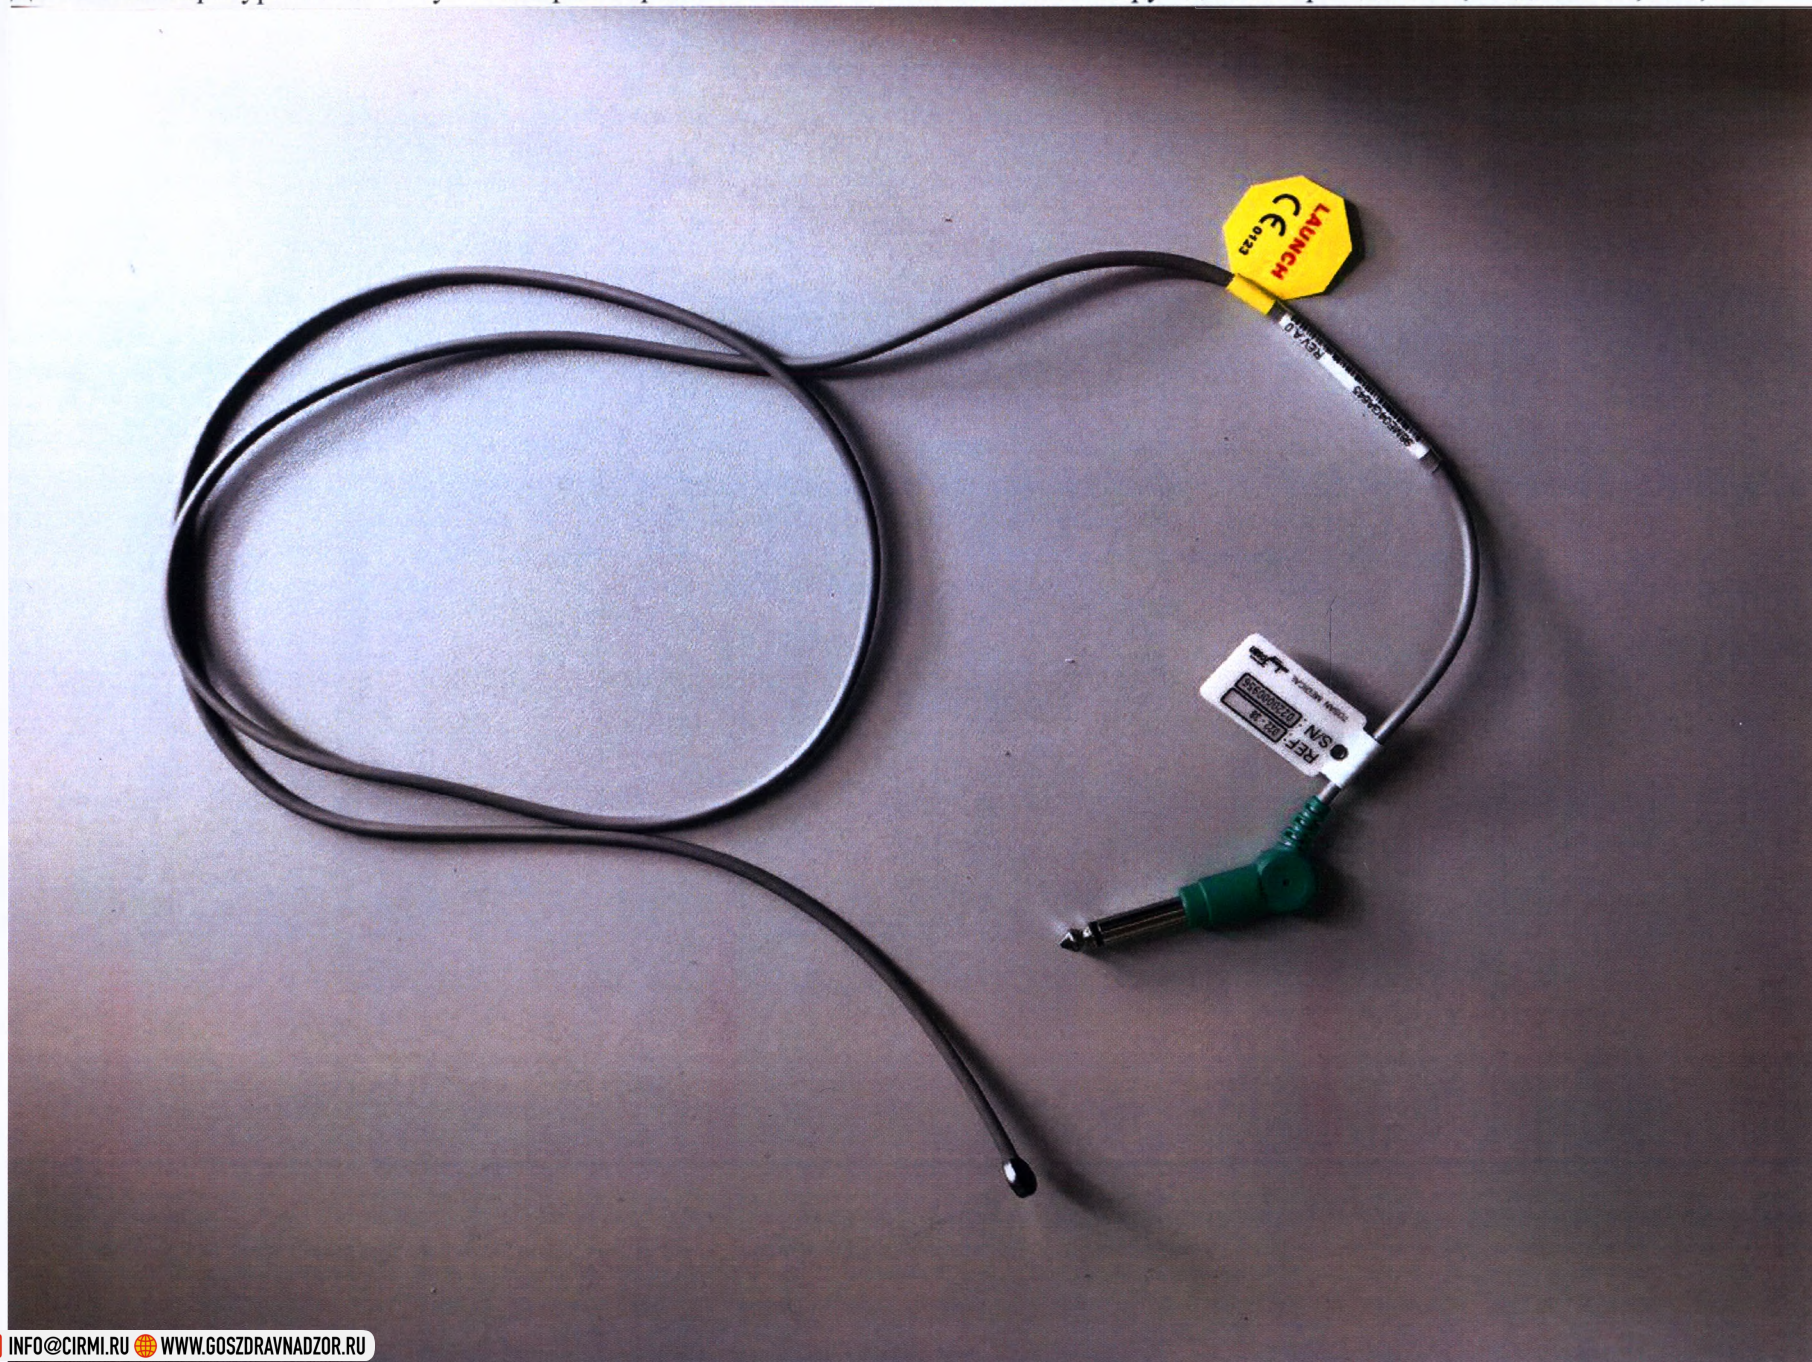



16. Шильдик. Облучатель фототерапевтический «Intensive Phototherapy» для новорожденных, модели 224

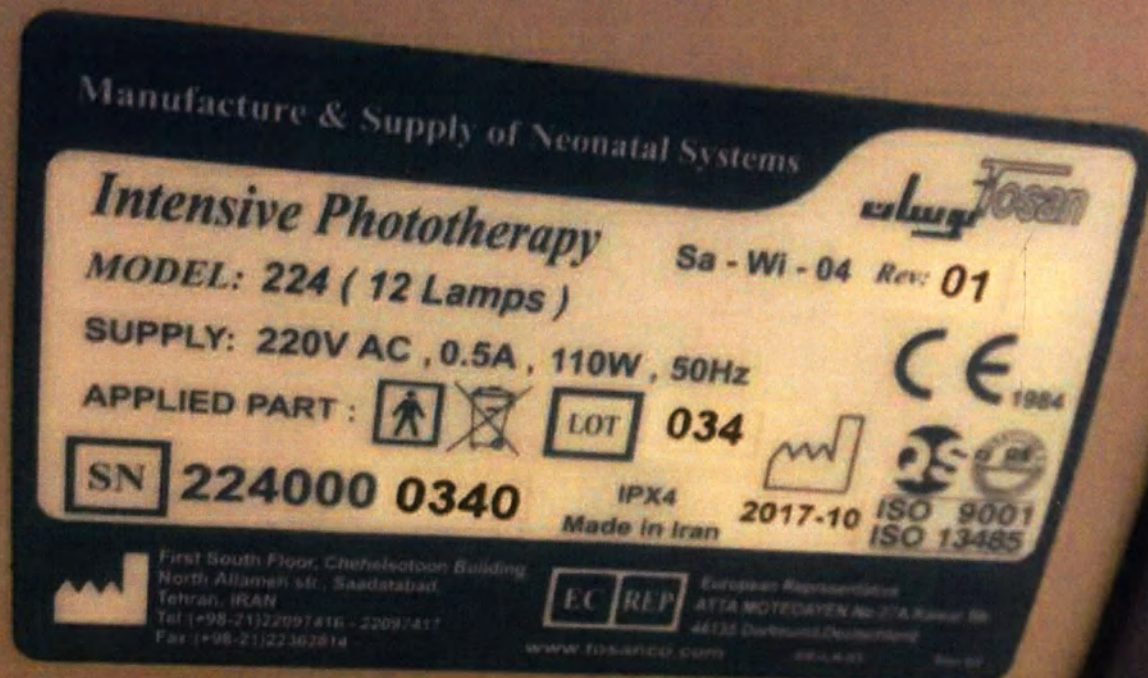

Electronic
Check 005

Final Check
Passed 006

17. Шильдик. Облучатель фототерапевтический «Intensive Phototherapy» для новорожденных, модели 225

Manufacture & Supply of Neonatal Systems

Intensive Phototherapy Sa - Wi - 04 Rev: **01**

MODEL: 225 (16 Lamps)

SUPPLY: 220V AC , 0.65A , 140W , 50Hz

APPLIED PART :   **LOT 028** 

SN 225000 0280 **IPX4 2017-10** **ISO 9001** **ISO 13485**

Made in Iran

First South Floor, Chehelgomon Building
North Allameh str., Saadatabad
Tehran, IRAN
Tel: (+98-21)22087416 - 22087417
Fax: (+98-21)22352814

EC REP  www.tosar.com

Electronic
Check 005

Manufacture & Supply of Neonatal Systems 

Intensive Phototherapy Sa - Wi - 04 Rev: 01

MODEL: 225 (16 Lamps)

SUPPLY: 220V AC , 0.65A , 140W , 50Hz

APPLIED PART :    028 

 225000 0280 IPX4 2017-10 ISO 9001 ISO 13485

Made in Iran

First South Floor, Chetelsotoon Building,
North Allameh str., Saadatabad,
Tehran, IRAN
Tel: (+98-21) 22097416 - 22097417
Fax: (+98-21) 22362814

EC REP European Representative
AITA MOTEDAYEN No 27/A Kaiser Str.
44135 Dortmund, Deutschland
www.tosanco.com PR-LA-01 Rev: 03

Electronic
Check 005

Final Check
Passed: 006



Manufacture & Supply of Neonatal System

Изготовление и поставка систем для новорожденных

Tosan

Облучатель фототерапевтический
«INTENSIVE PHOTOTHERAPY» для новорожденных
модель 222

Руководство по эксплуатации

Руководство
эксплуатации

по Идентификатор: Sa-Wi-04 Ред.: Дата вступления в силу: май
01 2019



Облучатель фототерапевтический
«INTENSIVE PHOTOTHERAPY» для новорожденных
модель 224

Руководство по эксплуатации

по Идентификатор: Sa-Wi-04 Ред.: Дата вступления в силу: май
01 2019

Руководство
эксплуатации



Изготовление и поставка систем для новорожденных

Облучатель фототерапевтический
«INTENSIVE PHOTOTHERAPY» для новорожденных
модель 225

Руководство по эксплуатации

Руководство
эксплуатации

по Идентификатор: Sa-Wi-04 Ред.: Дата вступления в силу: май
01 2019


21. Общий вид и сетевой кабель. Облучатель фототерапевтический «Intensive Phototherapy» для новорожденных, модель 0271



22. Лампы светодиодные, 4 шт. Облучатель фототерапевтический «Intensive Phototherapy» для новорожденных, модель 0271





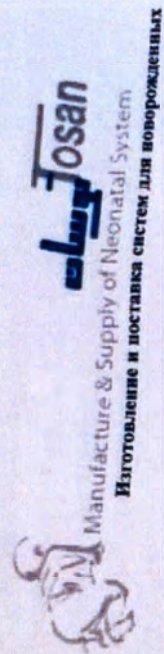


Облучатель фототерапевтический
«INTENSIVE PHOTOTHERAPY» для новорожденных
модель 0271

Руководство по эксплуатации

Руководство
эксплуатации

по Идентификатор: Sa-Wi-07 Ред.: 02
Дата вступления в силу: май 2019

25. Защитная повязка для глаз Облучателя фототерапевтического «Intensive Phototherapy» для новорожденных, модели 222, 224, 225, 0271

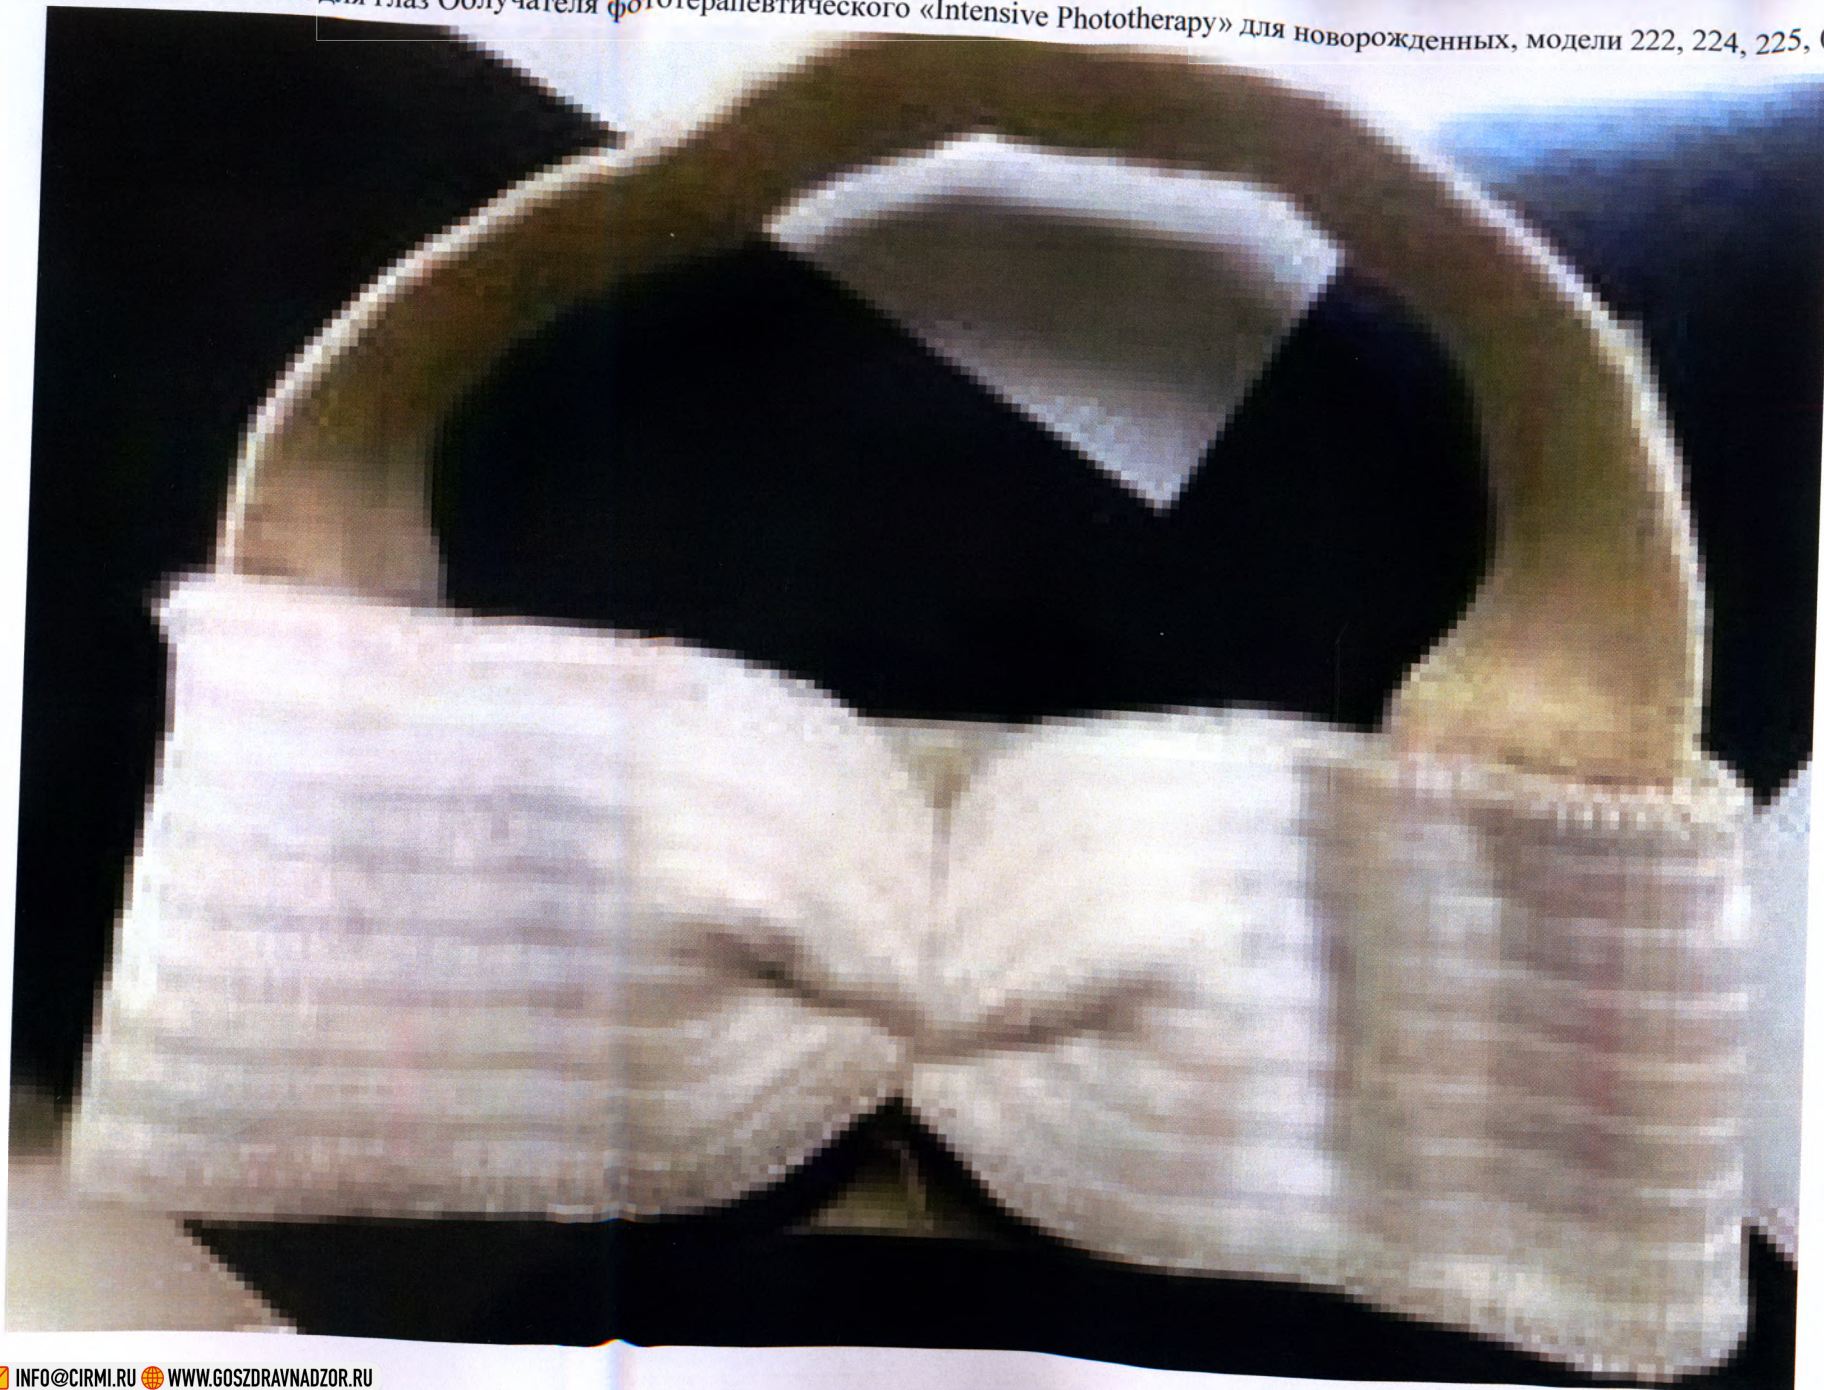

ПРОНУМЕРОВАНО И ПРОШИТО

26 ЛИСТОВ

ГЕН. ДИРЕКТОР
КУЗНЕЦОВА Д. В.

